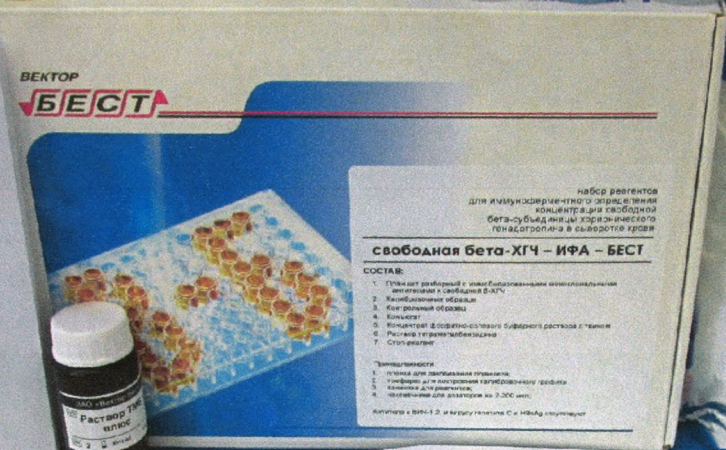
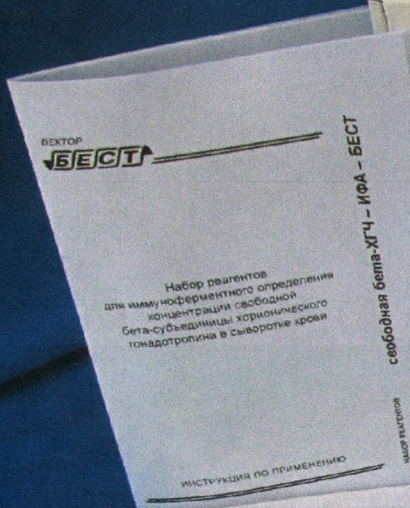


Характеристики и нормы		Результаты контроля	
Внешний вид (визуальный контроль)	Средняя оптическая плотность в диапазоне 0,1 - 0,3	Средняя оптическая плотность в диапазоне 0,1 - 0,3	Средняя оптическая плотность в диапазоне 0,1 - 0,3
Дифференциальная проба, серия 2	0,3 мкл	Дифференциальная проба, серия 2	0,3 мкл
Контактный образец, серия 2	0,3 мкл	Контактный образец, серия 2	0,3 мкл
Калибровка, серия 2	0,3 мкл	Калибровка, серия 2	0,3 мкл
Концентрация фосфатно-сольватного буферного раствора с танном, серия 2	0,3 мкл	Концентрация фосфатно-сольватного буферного раствора с танном, серия 2	0,3 мкл
Раствор гомотетраметилдендрина плюс, серия 2	0,3 мкл	Раствор гомотетраметилдендрина плюс, серия 2	0,3 мкл
Стоп-реактив, серия 2	0,3 мкл	Стоп-реактив, серия 2	0,3 мкл
Принадлежности		Принадлежности	
Платформа для закаливания планшета	2 шт.	Платформа для закаливания планшета	2 шт.
График для построения калибровочного графика	1 шт.	График для построения калибровочного графика	1 шт.
Волочка для реагента	2 шт.	Волочка для реагента	2 шт.
Наношпатель для дозирования на 2-200 мкл	1 шт.	Наношпатель для дозирования на 2-200 мкл	1 шт.
Технические характеристики		Технические характеристики	
Оптическая плотность калибровочных образцов, содержащих 200 нг/мл св. б-ХГЧ, ед. оп. пл.	Не менее 1,0	Оптическая плотность калибровочных образцов, содержащих 200 нг/мл св. б-ХГЧ, ед. оп. пл.	2,00 (соответствует)
Соотношение оптических плотностей калибровочных образцов, содержащих 0, 10, 25, 50, 100 и 200 нг/мл св. б-ХГЧ	80-810-825-850-8100-8200	Соотношение оптических плотностей калибровочных образцов, содержащих 0, 10, 25, 50, 100 и 200 нг/мл св. б-ХГЧ	80-810-825-850-8100-8200 (соответствует)
(810-800)/(8200-800)х100, %, в пределах	7-10	(810-800)/(8200-800)х100, %, в пределах	8,08 (соответствует)
(8100-800)/(8200-800)х100, %, в пределах	65-85	(8100-800)/(8200-800)х100, %, в пределах	73,80 (соответствует)
Мультипликация, мкл	Не более 0,5	Мультипликация, мкл	0,21 (соответствует)
Показатели правильности определения		Показатели правильности определения	
Концентрация св. б-ХГЧ в контрольном образце, нг/мл	26-42	Концентрация св. б-ХГЧ в контрольном образце, нг/мл	34,22 (соответствует)
Коэффициент вариации (КВ), %	Не более 8	Коэффициент вариации (КВ), %	0,92 (соответствует)
Тест на "открытие", %, в пределах	90-110	Тест на "открытие", %, в пределах	97,12 (соответствует)
Тест на "линейность", L200-2, %, в пределах	90-110	Тест на "линейность", L200-2, %, в пределах	97,48 (соответствует)
Тест на "линейность", L100-2, %, в пределах	90-110	Тест на "линейность", L100-2, %, в пределах	96,32 (соответствует)
Тест на "линейность", L50-2, %, в пределах	90-110	Тест на "линейность", L50-2, %, в пределах	92,64 (соответствует)
Тест на "линейность", L25-2,5, %, в пределах	90-110	Тест на "линейность", L25-2,5, %, в пределах	94,87 (соответствует)
Интерсепт, 20%, нг/мл, в пределах	12-32	Интерсепт, 20%, нг/мл, в пределах	21,46 (соответствует)
Чувствительность, нг/мл, в пределах	45-70	Чувствительность, нг/мл, в пределах	50,00 (соответствует)
Чувствительность, нг/мл, в пределах	105-135	Чувствительность, нг/мл, в пределах	123,66 (соответствует)