


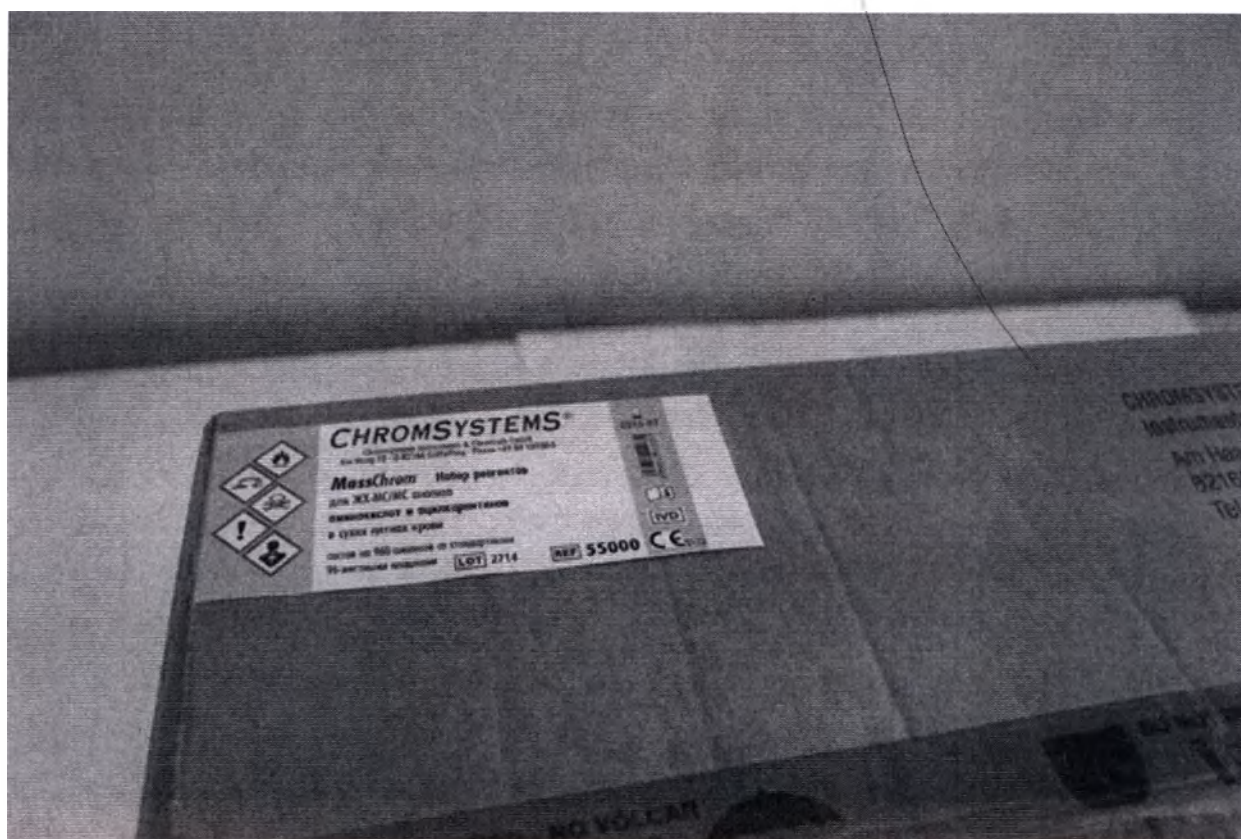
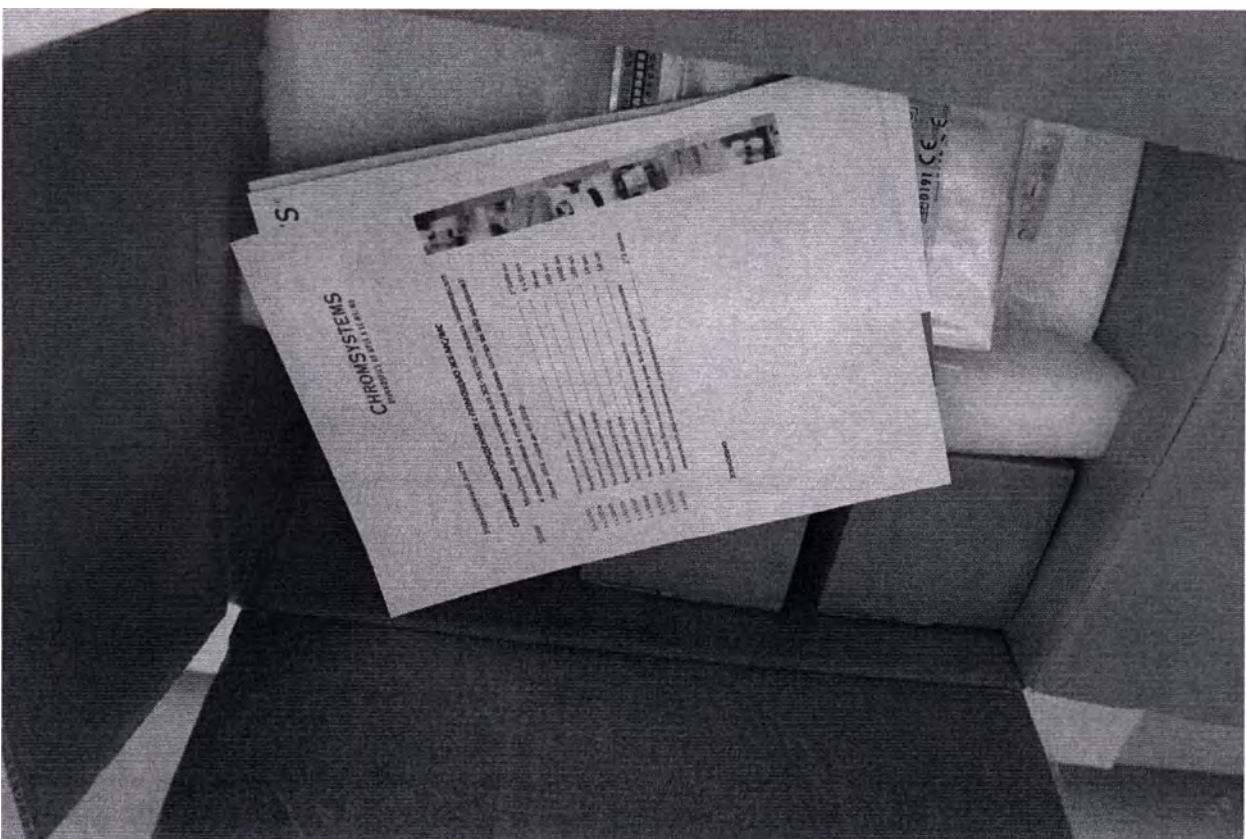




MassChrom Набор реагентов для ЖХ-МС/МС анализа аминокислот и ацилкарнитинов в сухих пятнах крови (состав на 960 анализов) вариант исполнения 55000

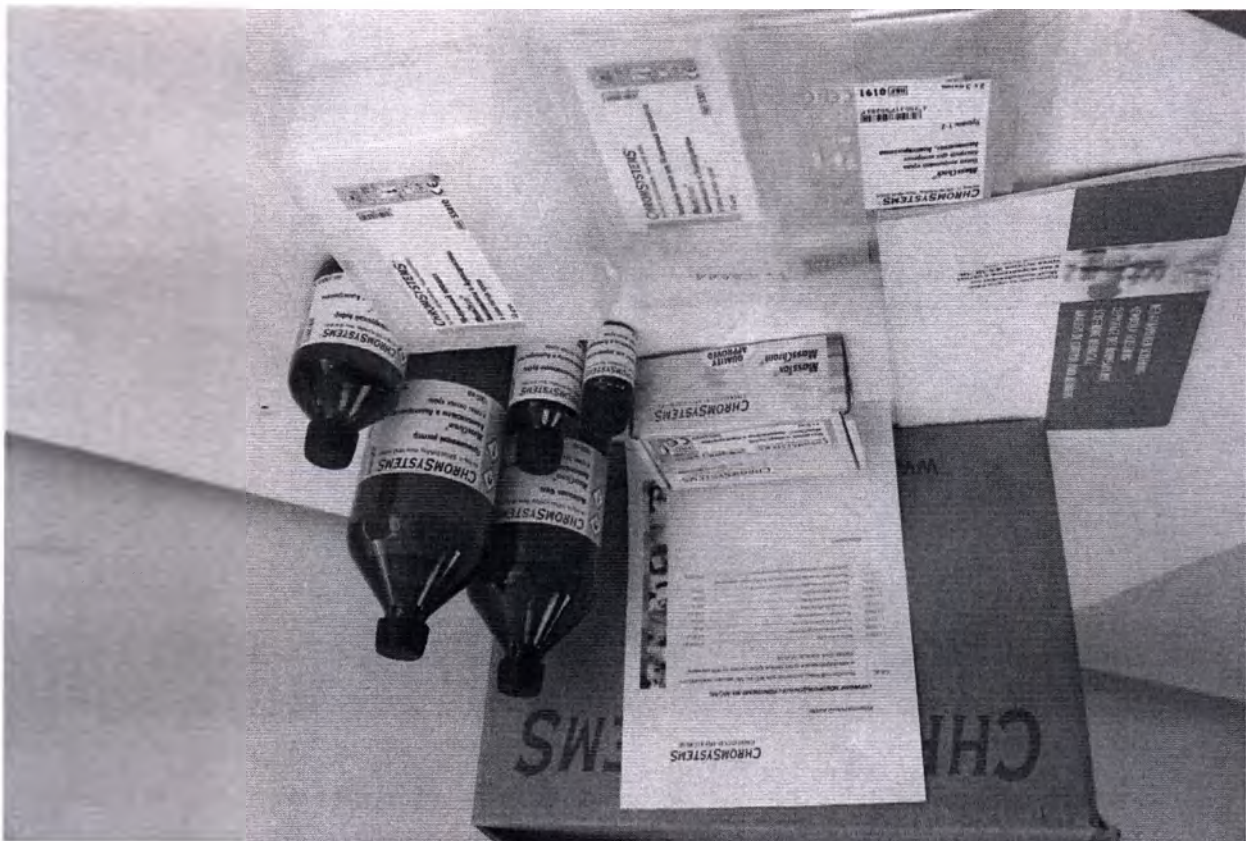

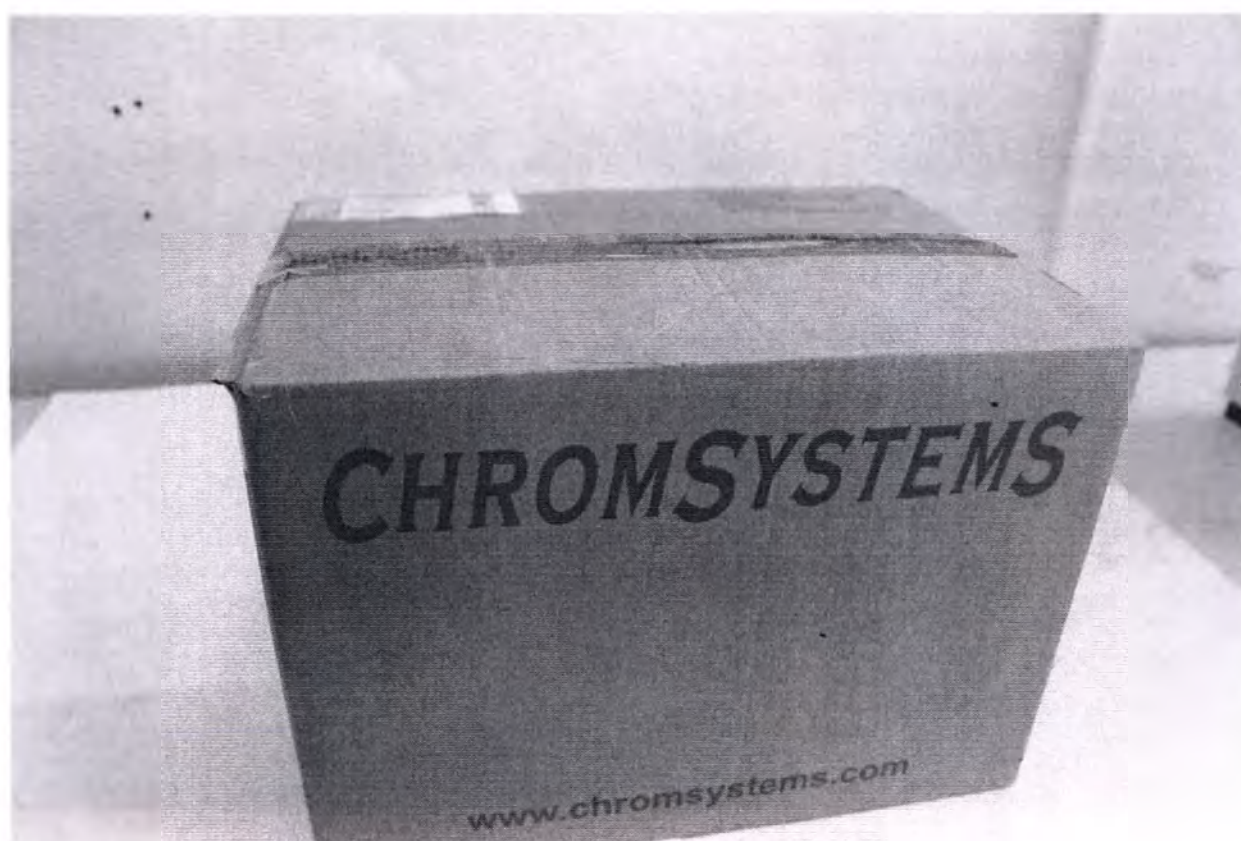


MassChrom Набор реагентов для ЖХ-МС/МС анализа аминокислот и ацилкарнитинов в сухих пятнах крови (состав на 960 анализов) вариант исполнения 55000/F

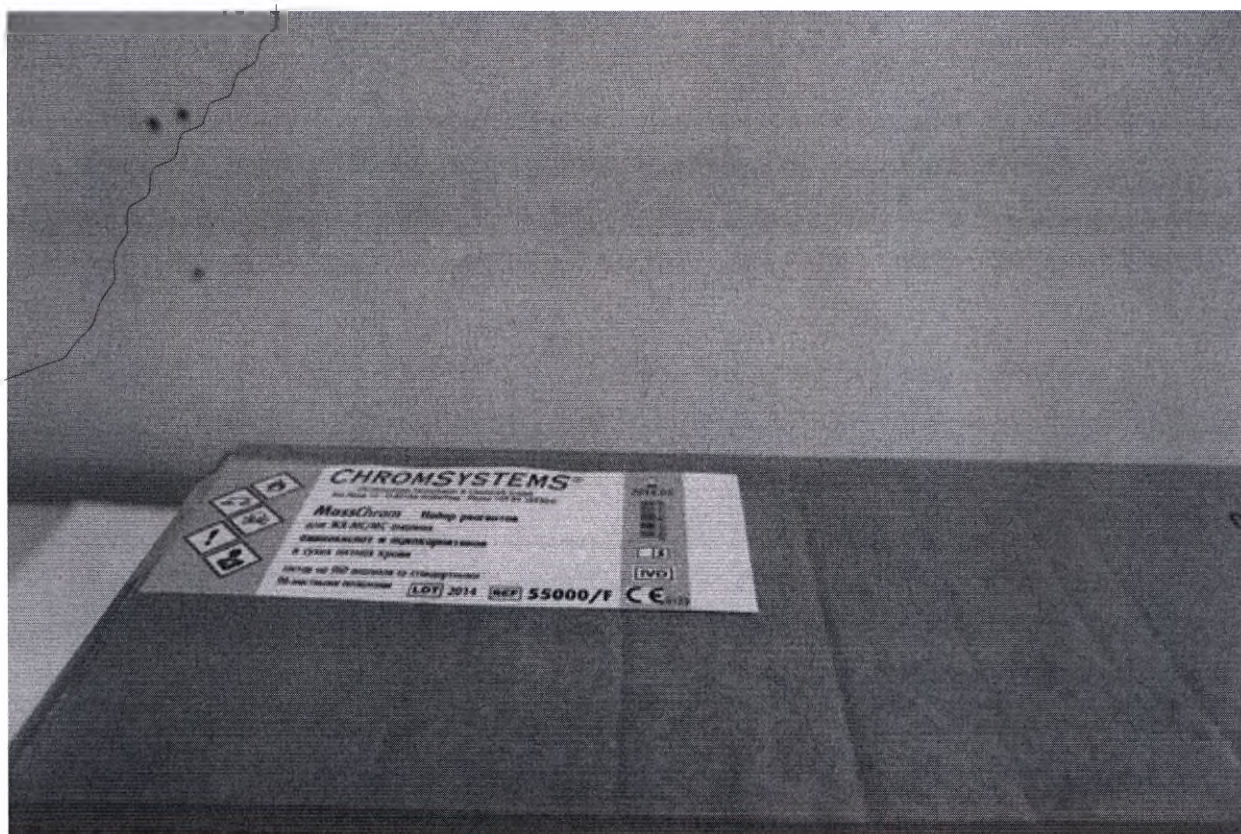

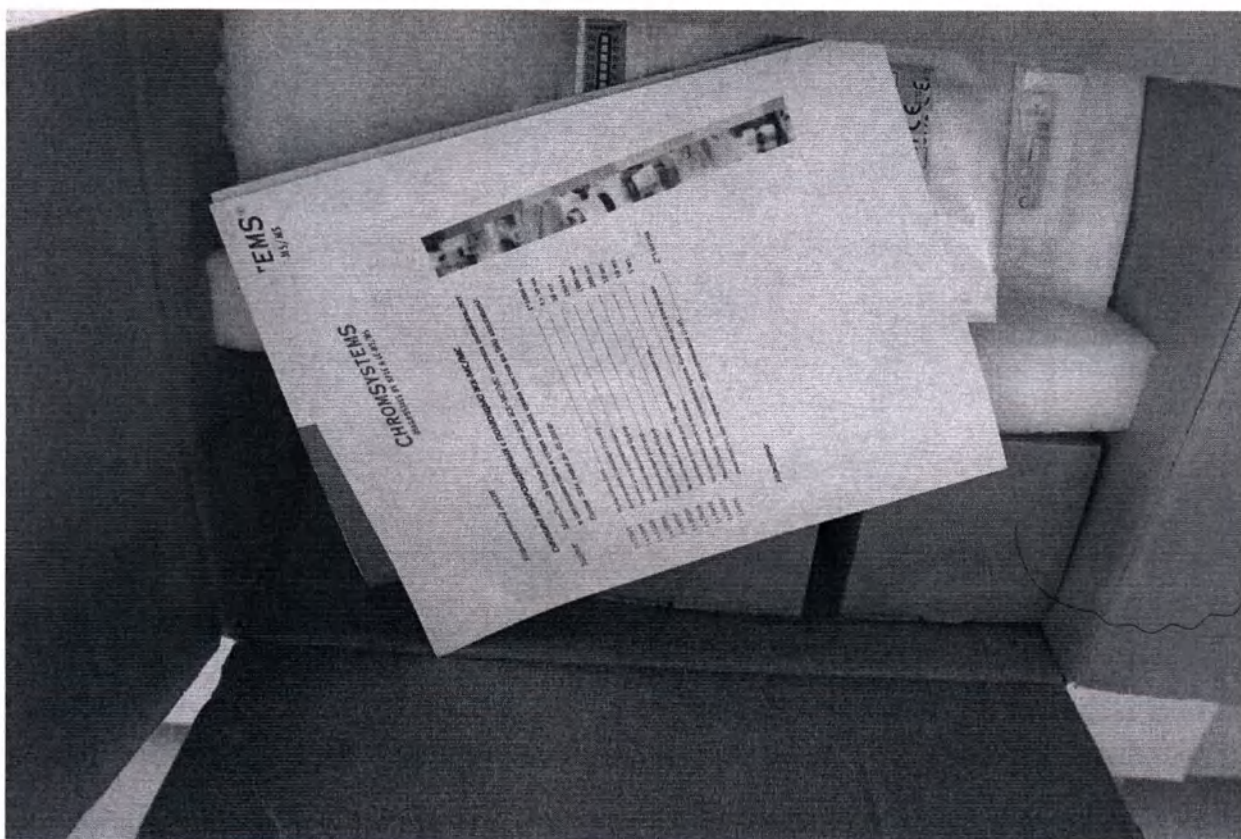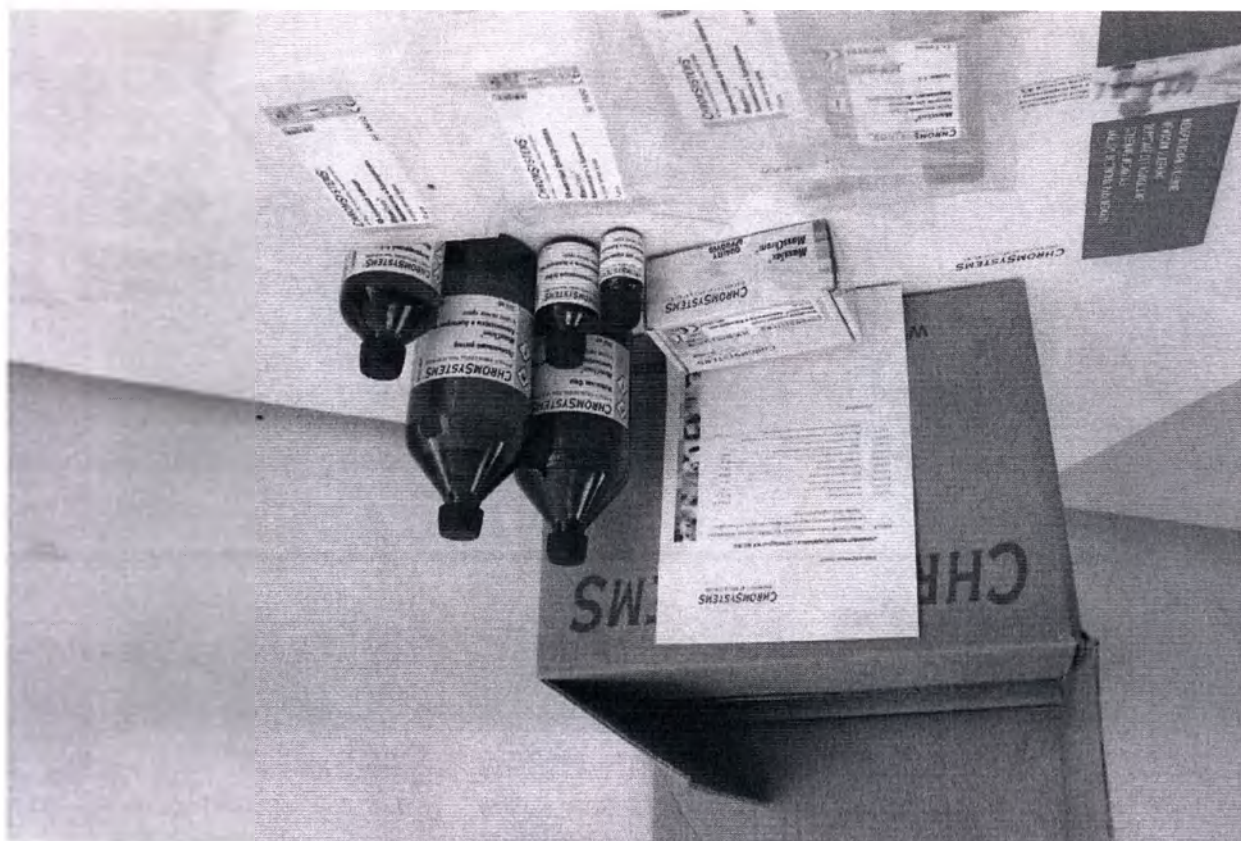


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:


1. MassCheck Пятна высушенной крови Контроли для измерения аминокислот, ацилкарнитинов двухуровневые (I + II)

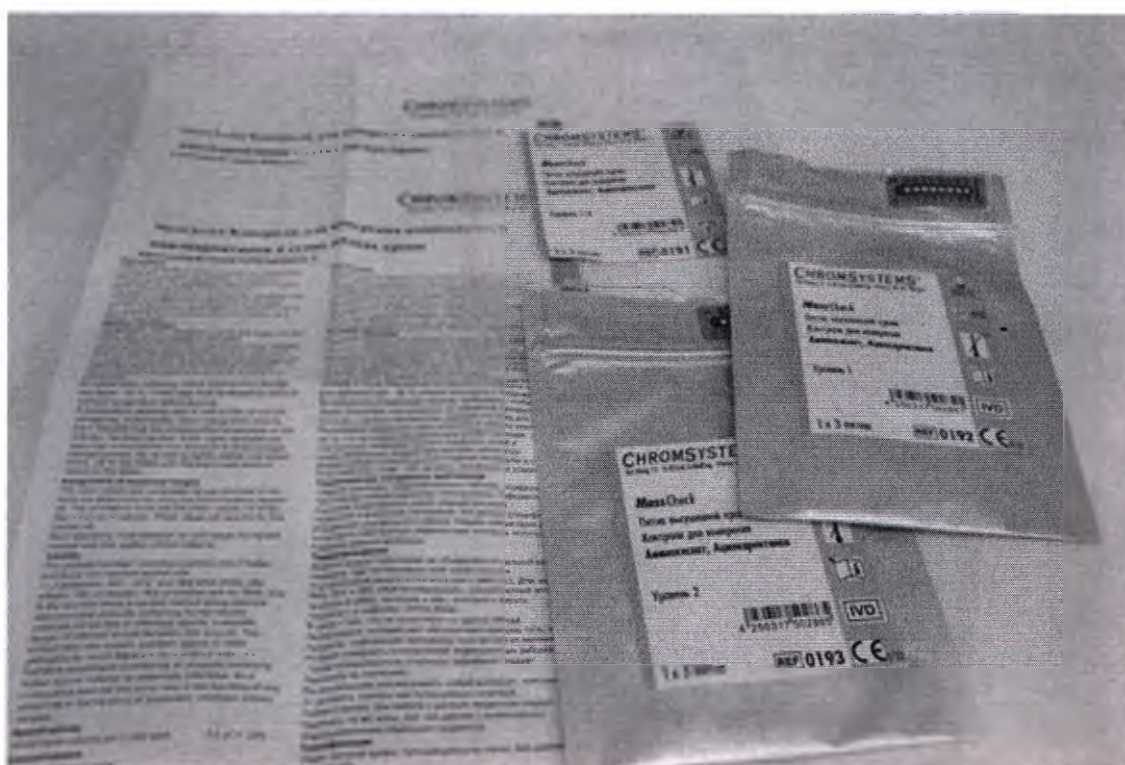



2. MassCheck Пятна высушенной крови Контроли для измерения аминокислот, ацилкарнитинов, уровень I

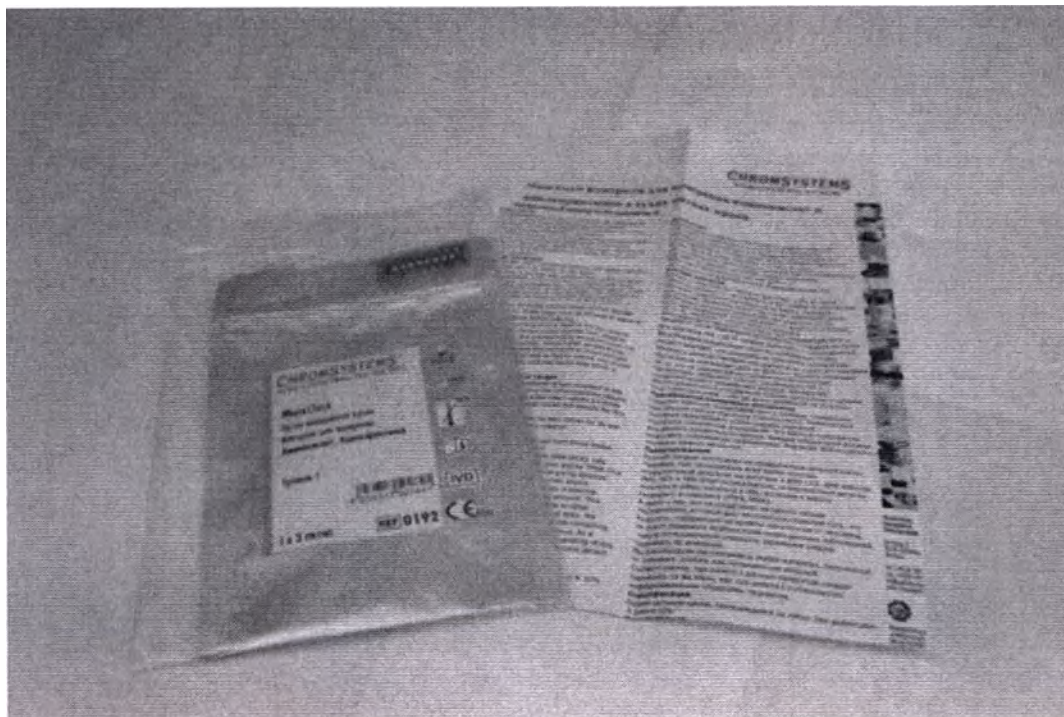


3. MassCheck Пятна высушенной крови Контроли для измерения аминокислот, ацилкарнитинов, уровень II

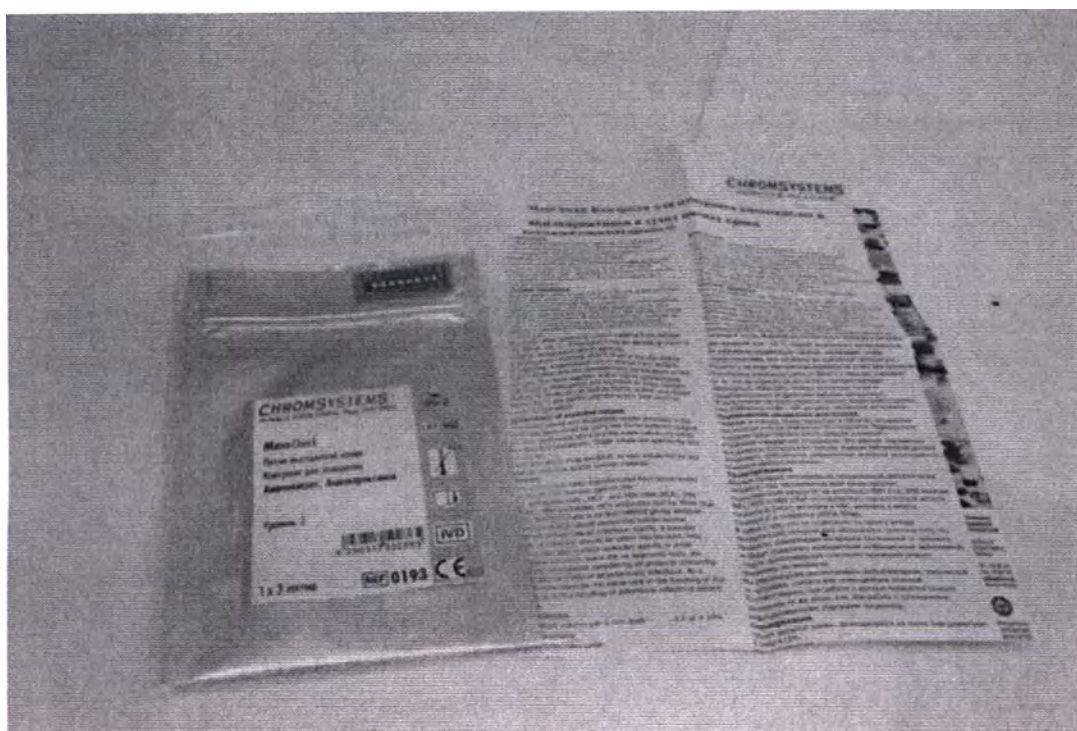




4. Мобильная фаза

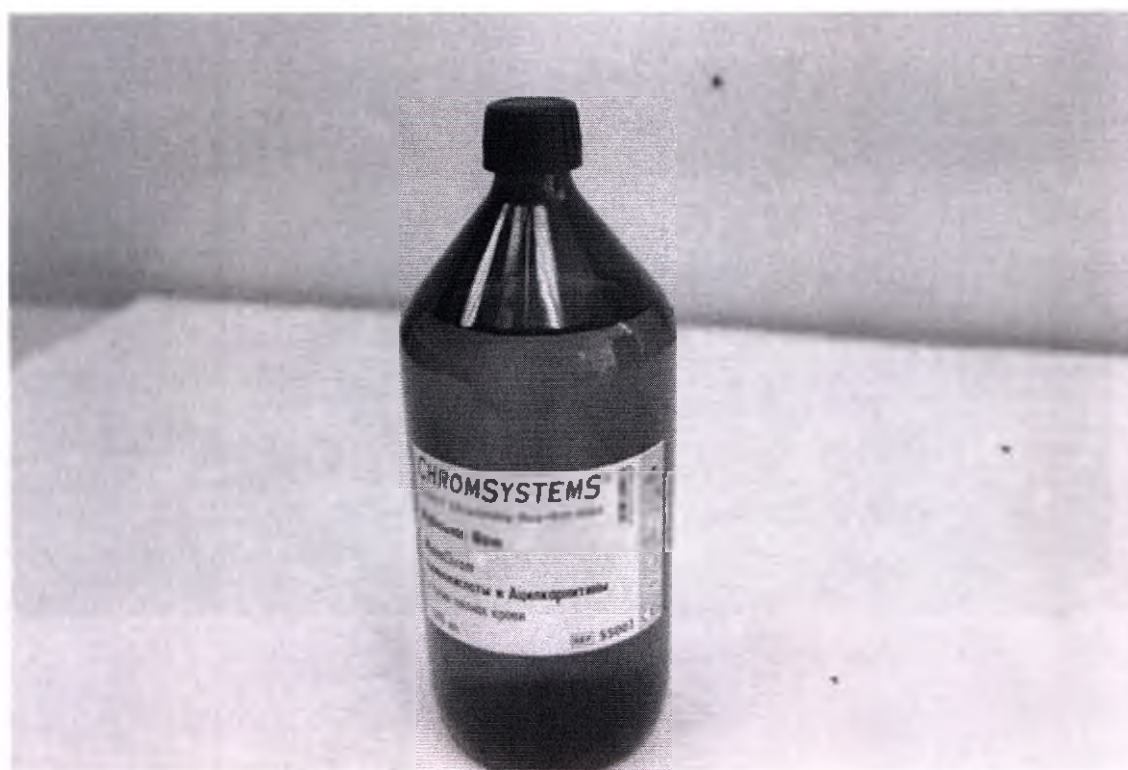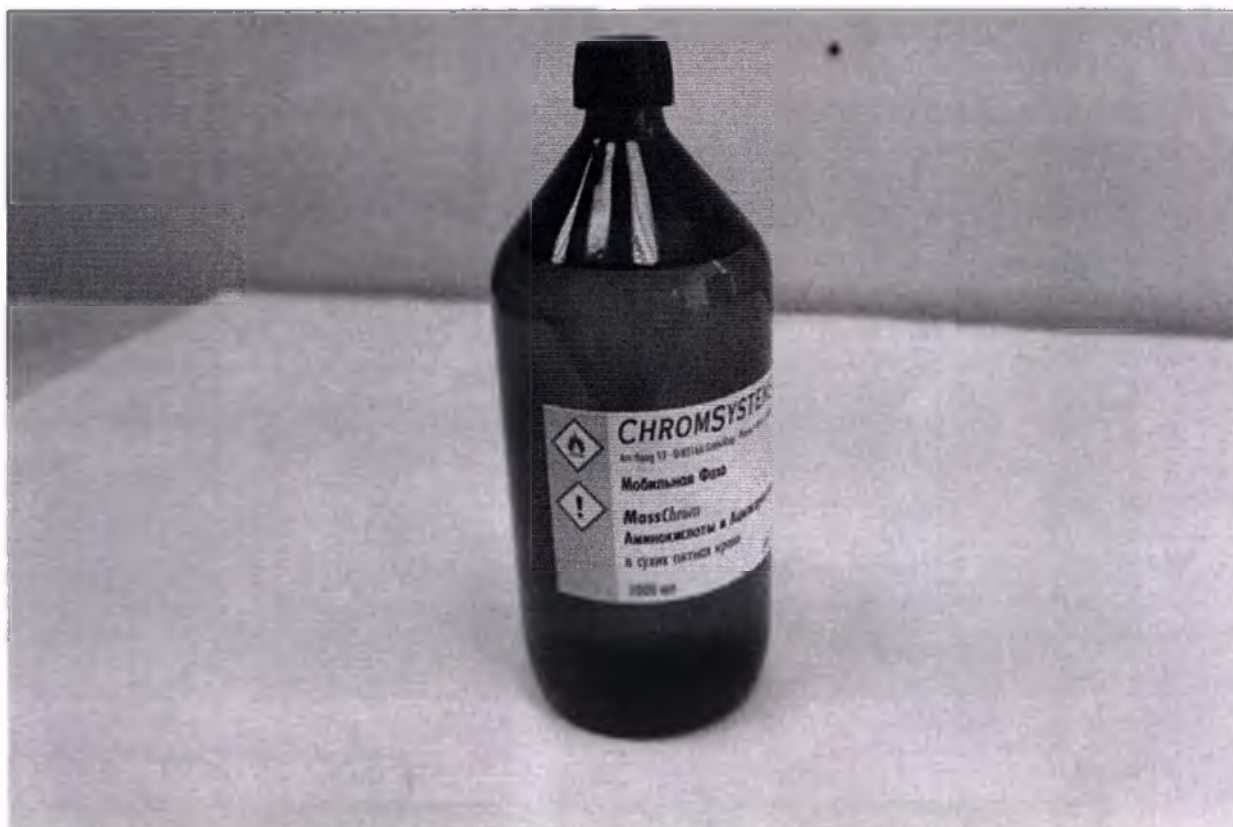

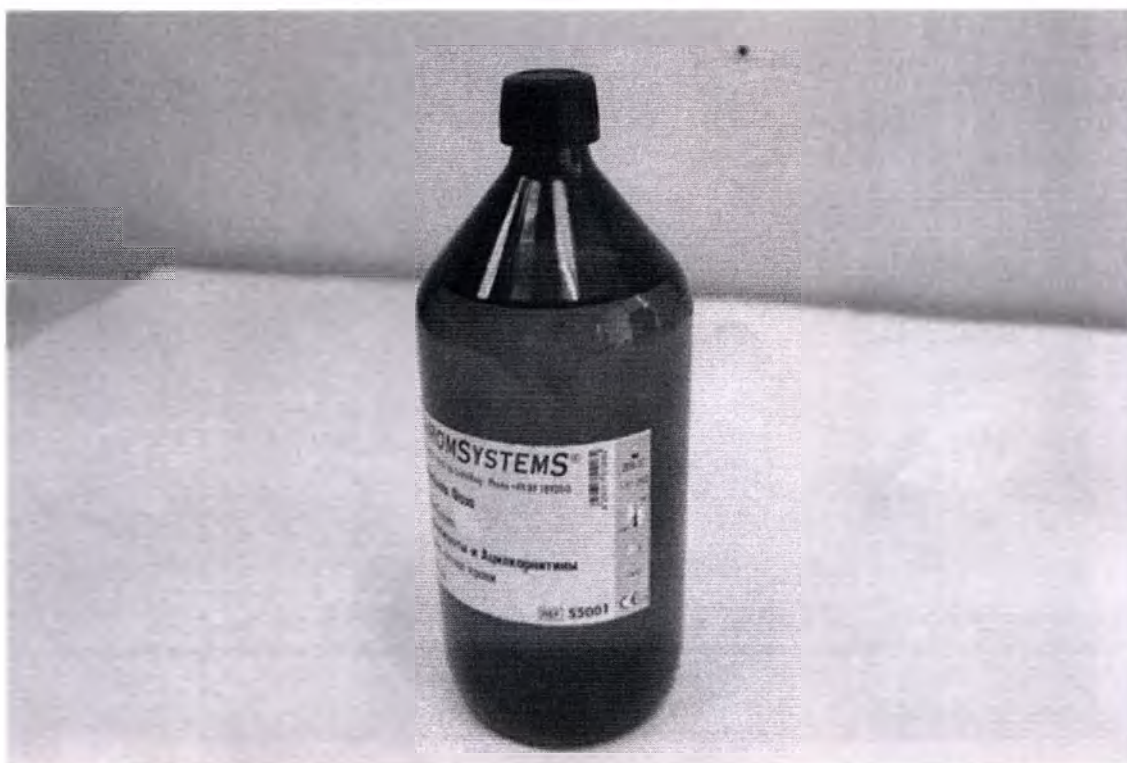



5. Внутренний стандарт (сухой)

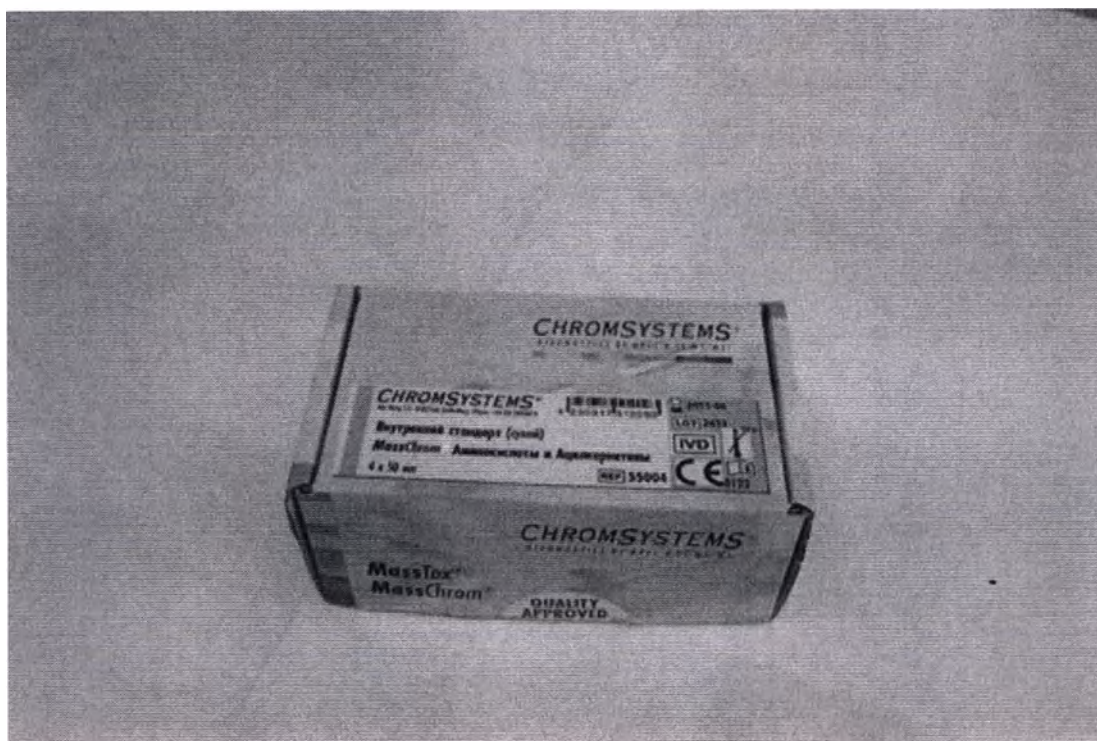

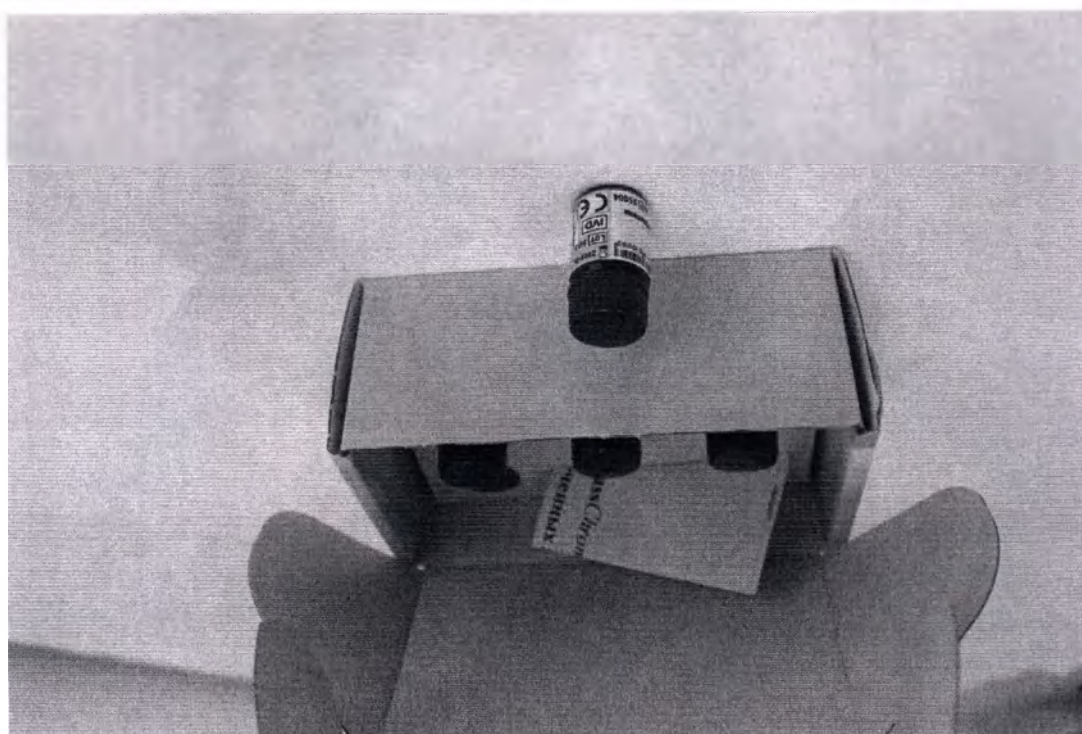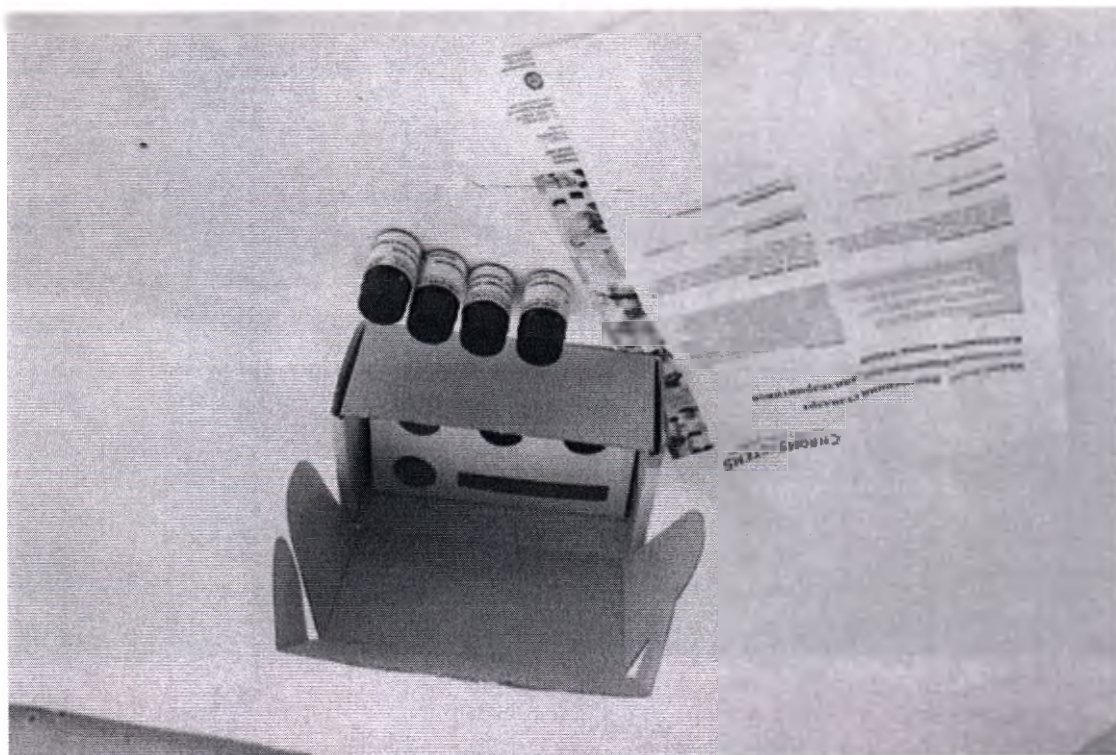


6. Внутренний стандарт для сукцинилацетона

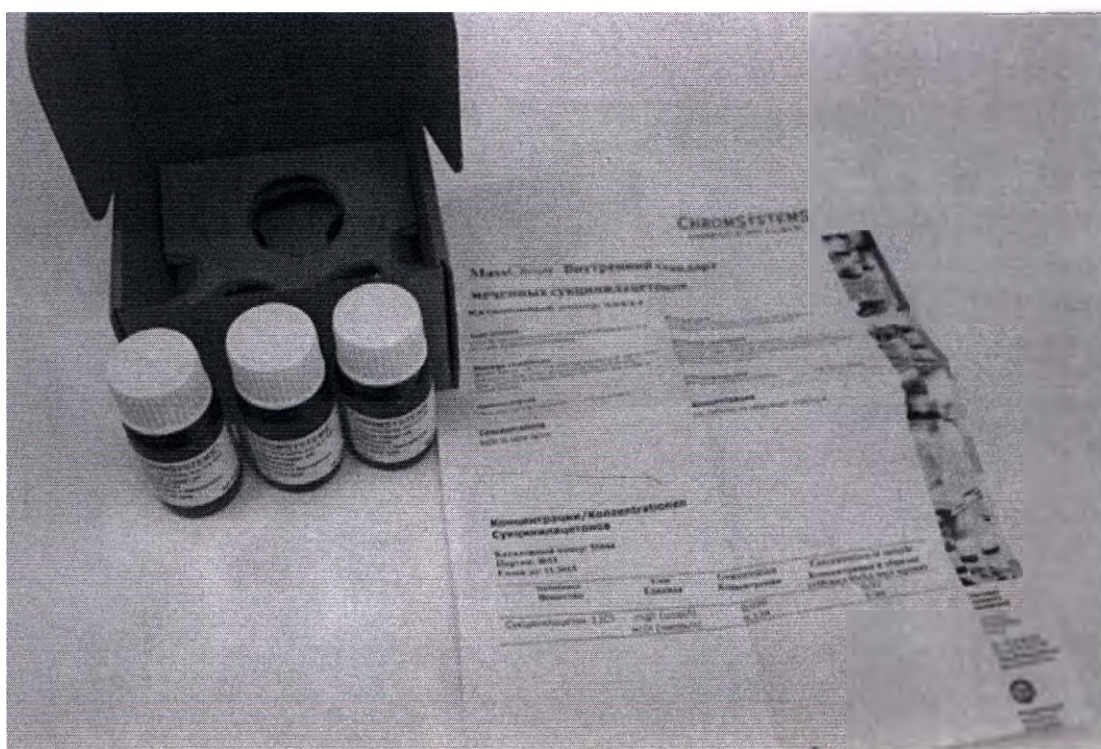

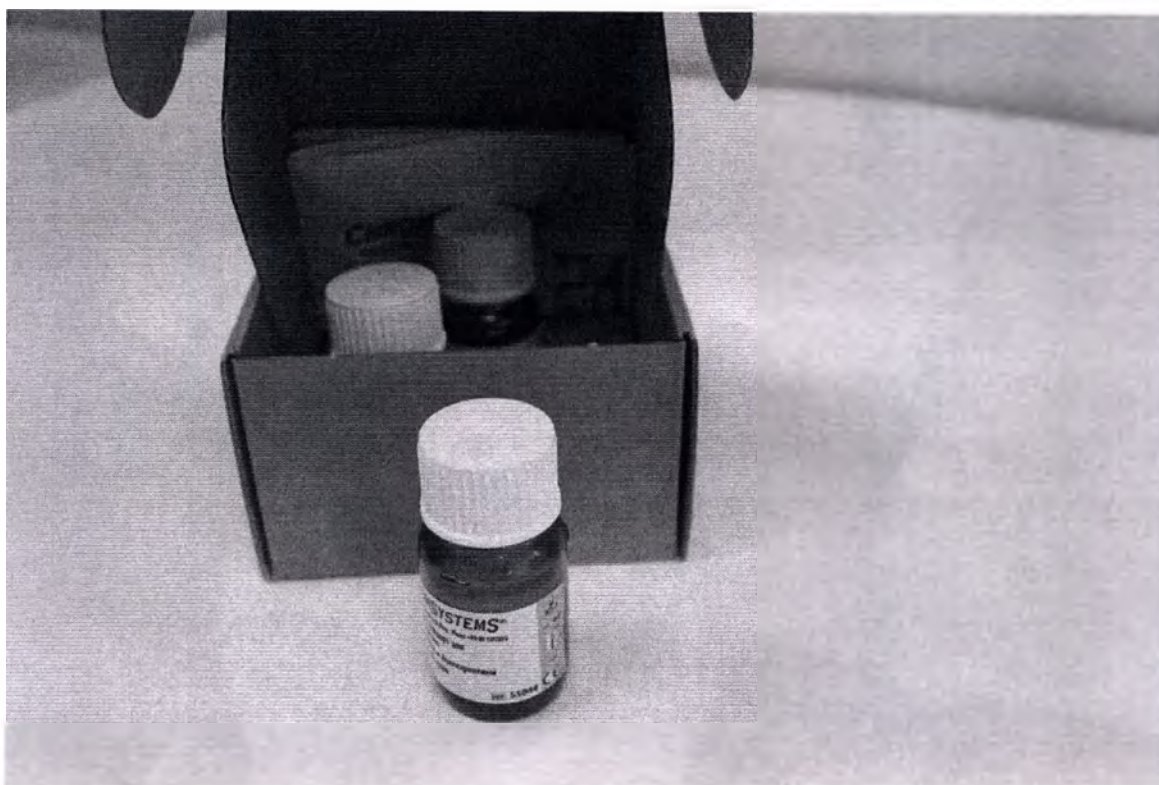


7. Реагент для дериватизации

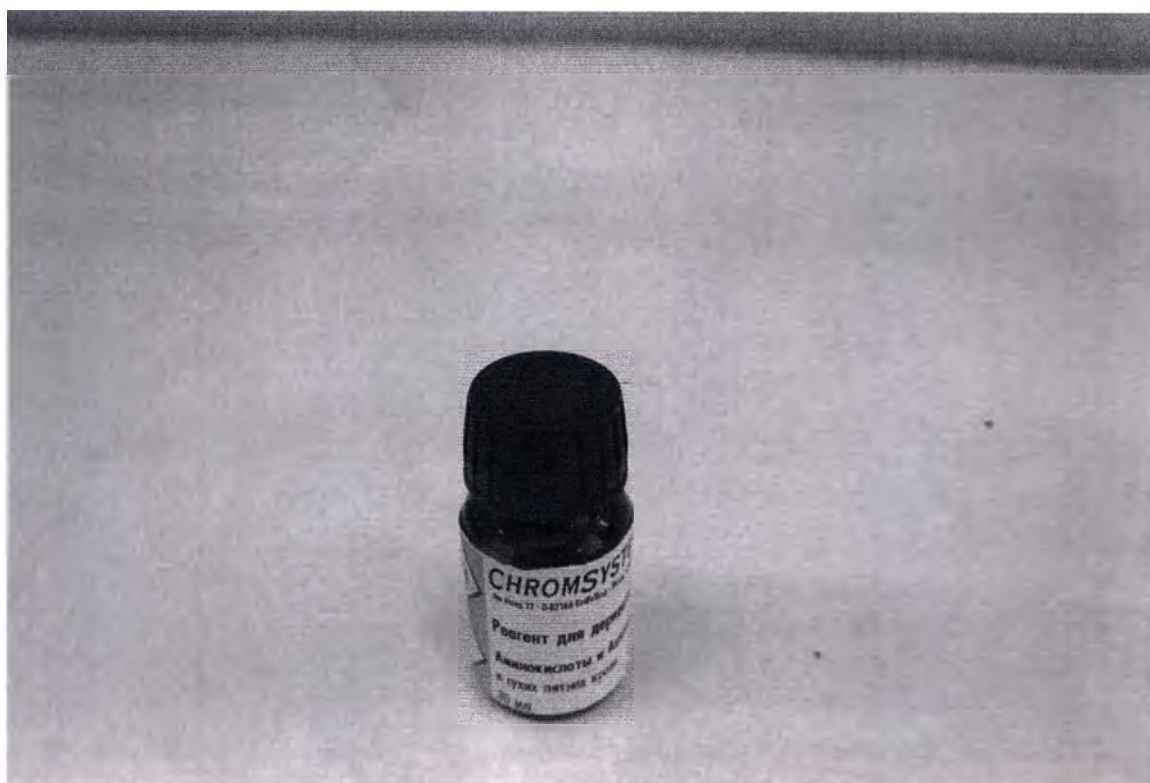




8. Восстанавливающий буфер




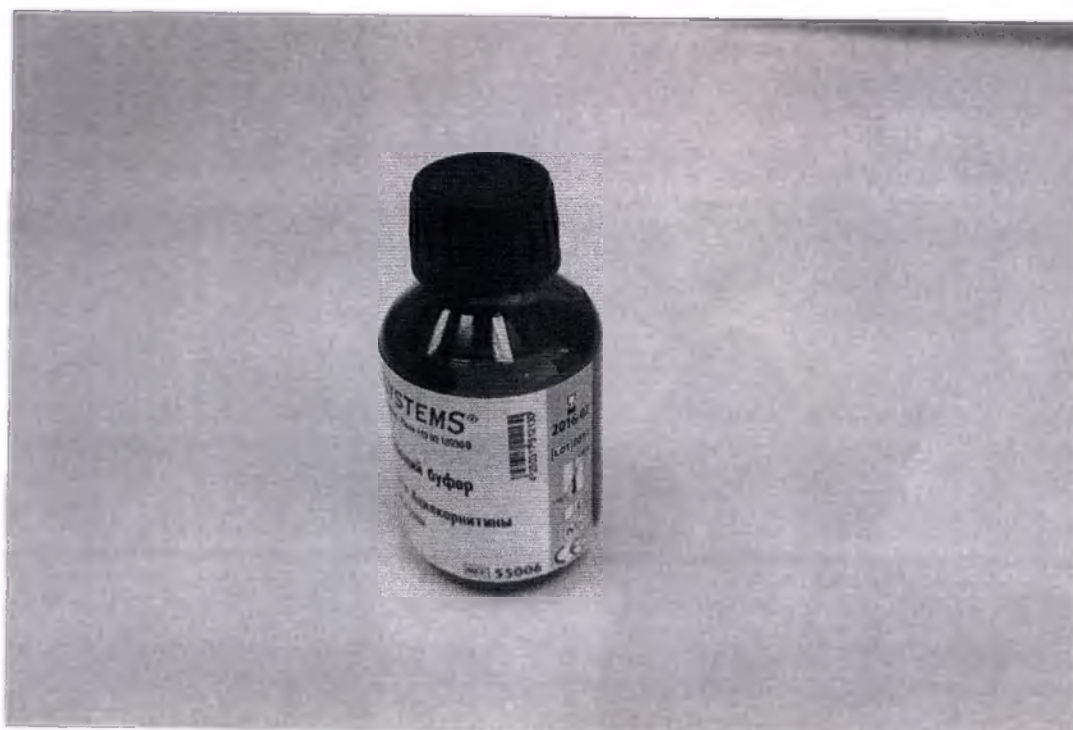


9. Промывающий раствор


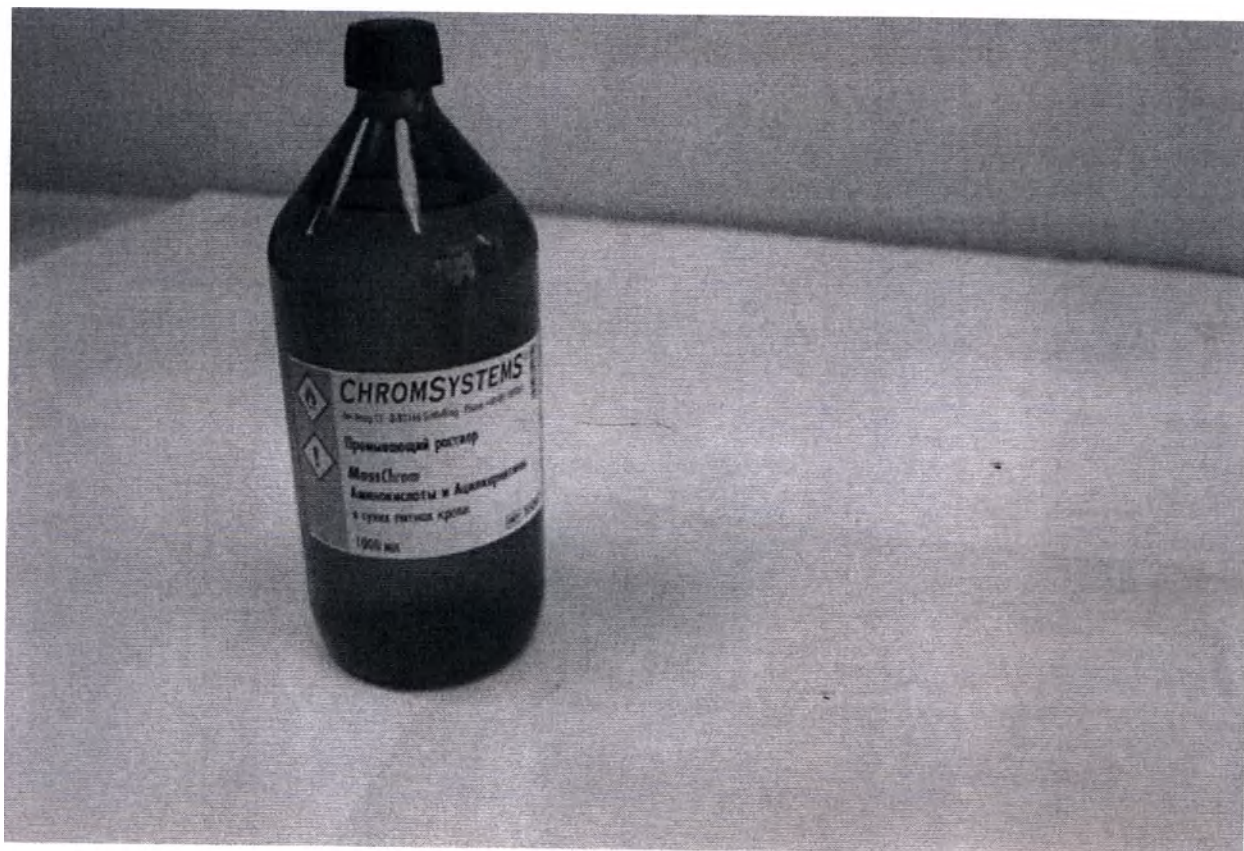


10. Экстрагирующий буфер


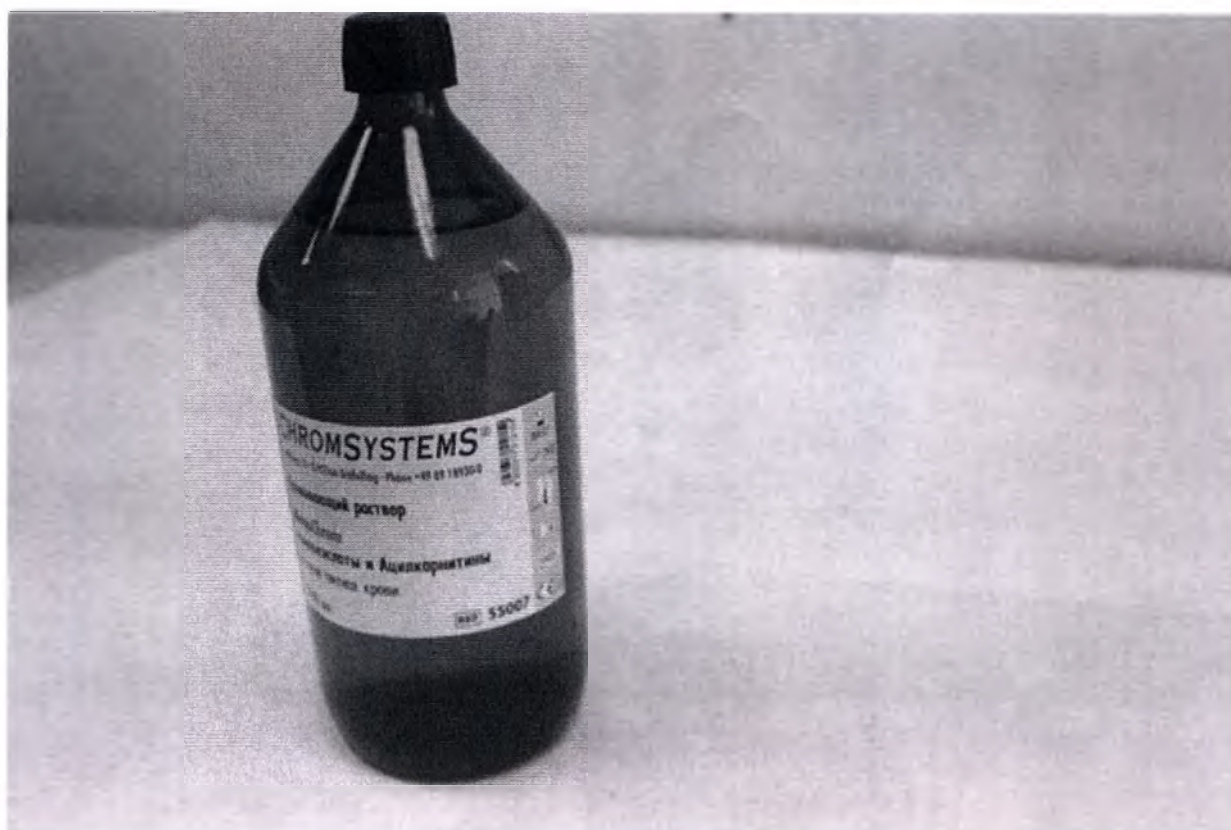


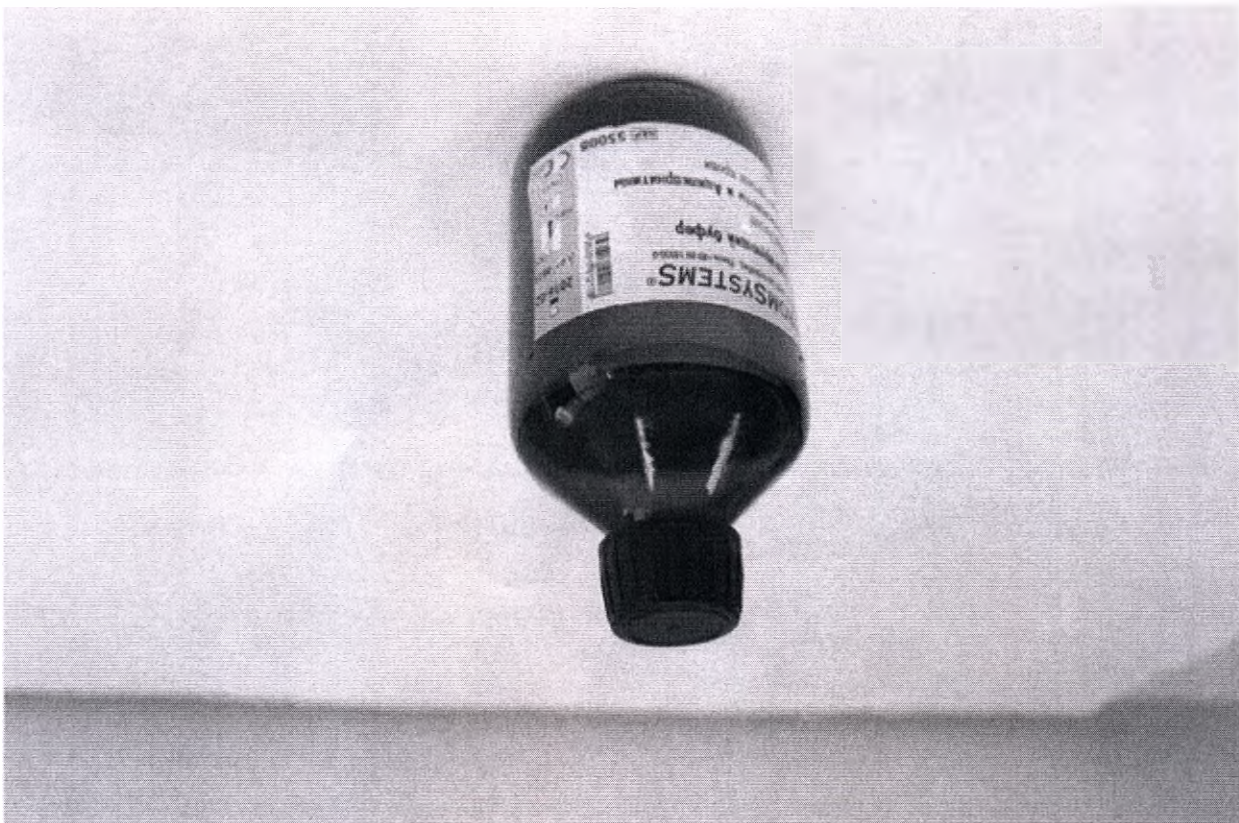



11. 96-луночный планшет

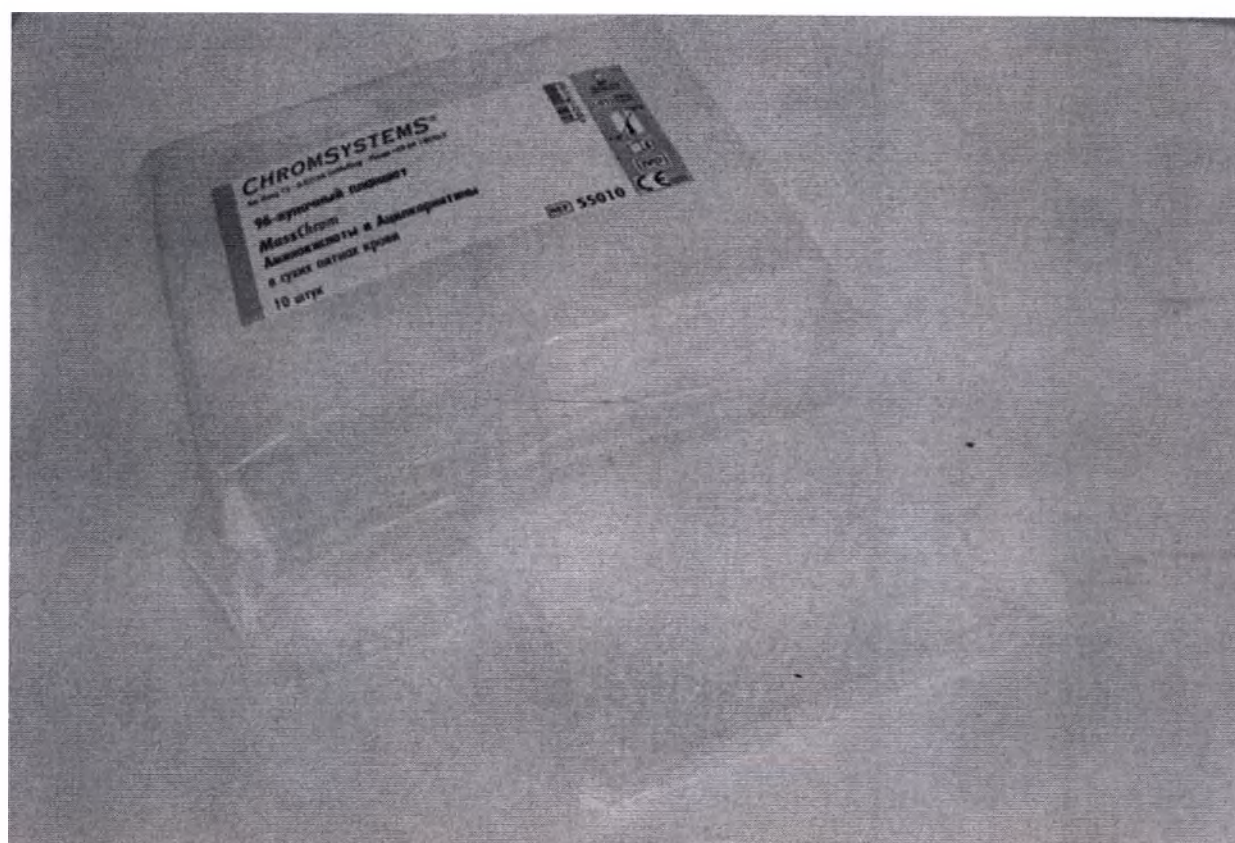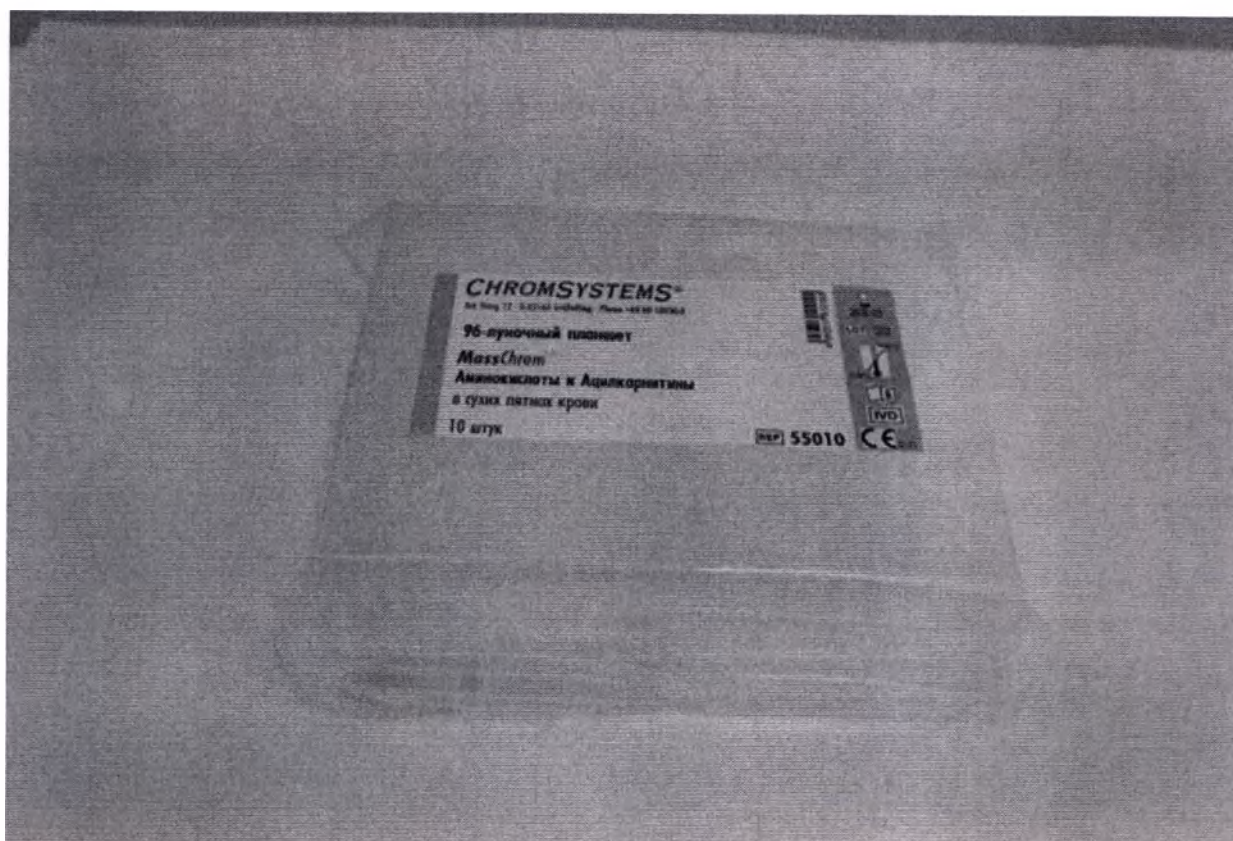



12. Защитные листы для 96-луночных планшетов

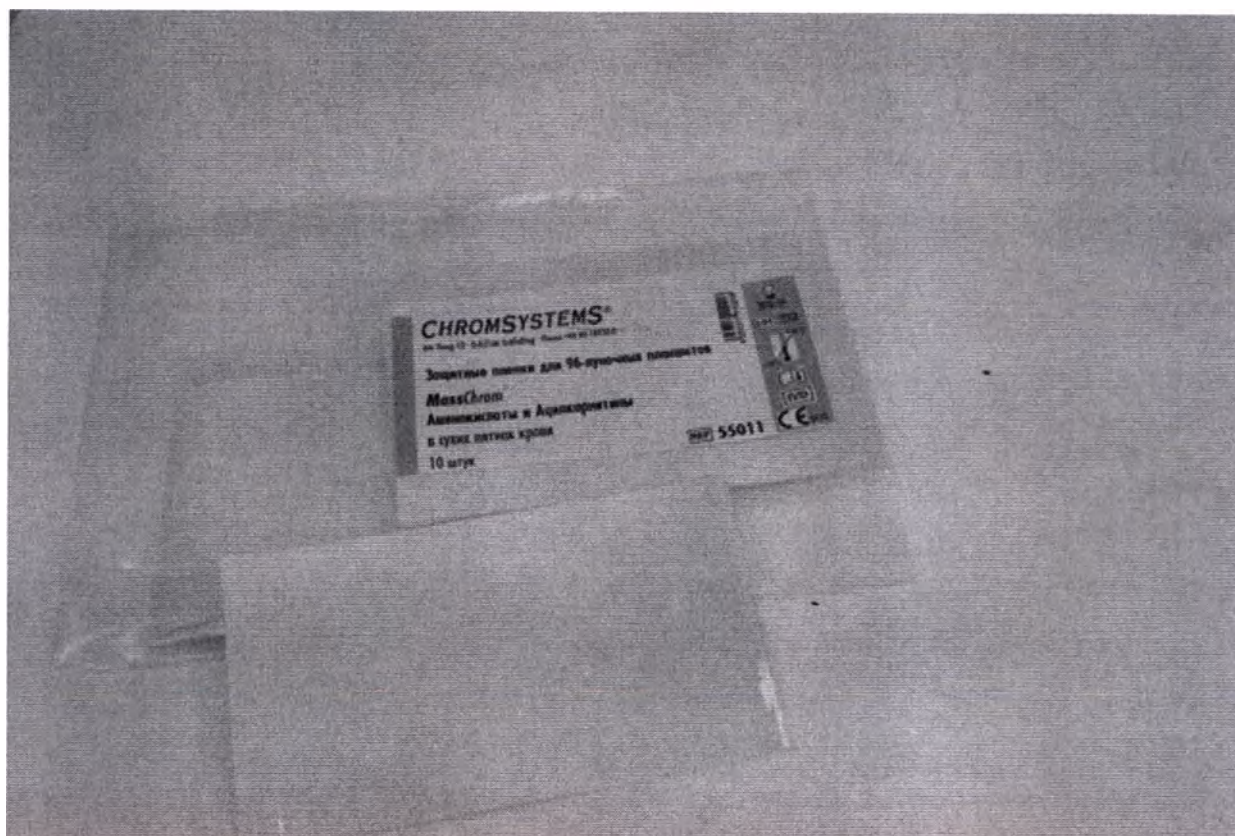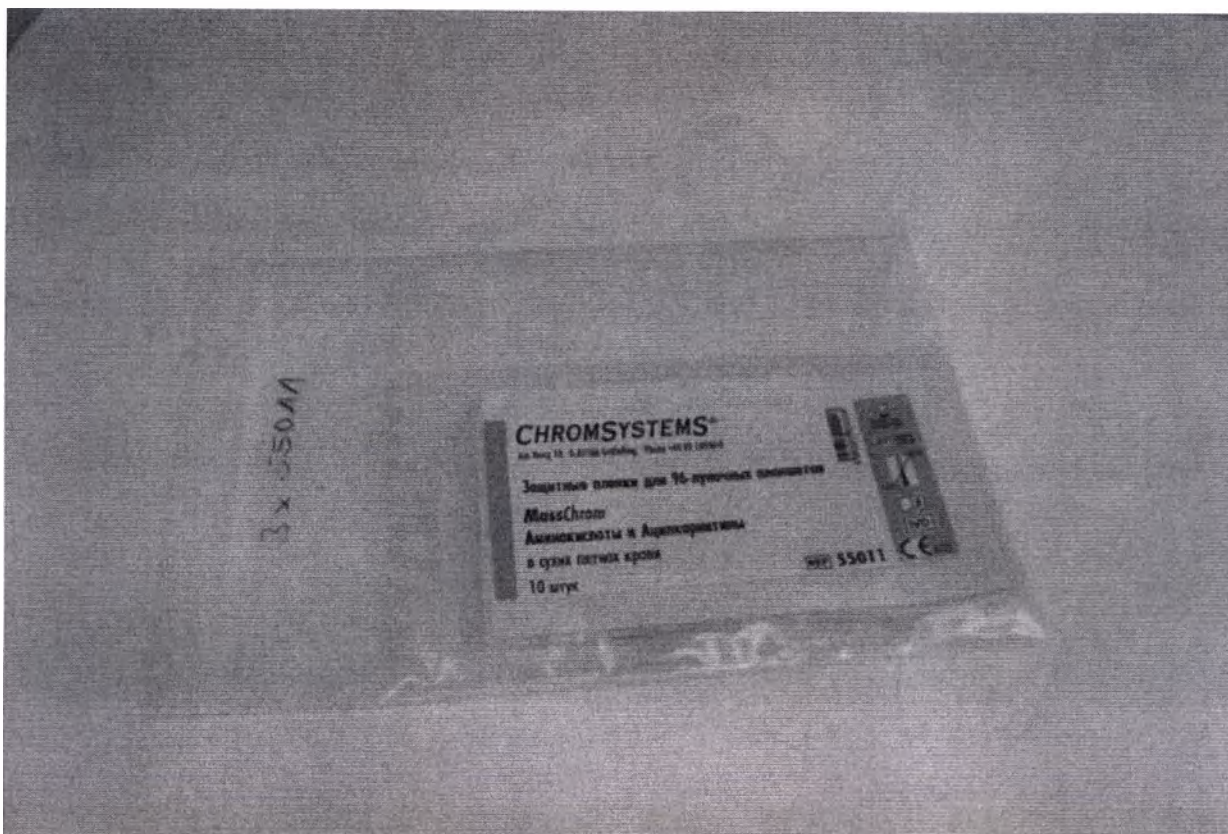


13. 96-местные фильтр-плашки

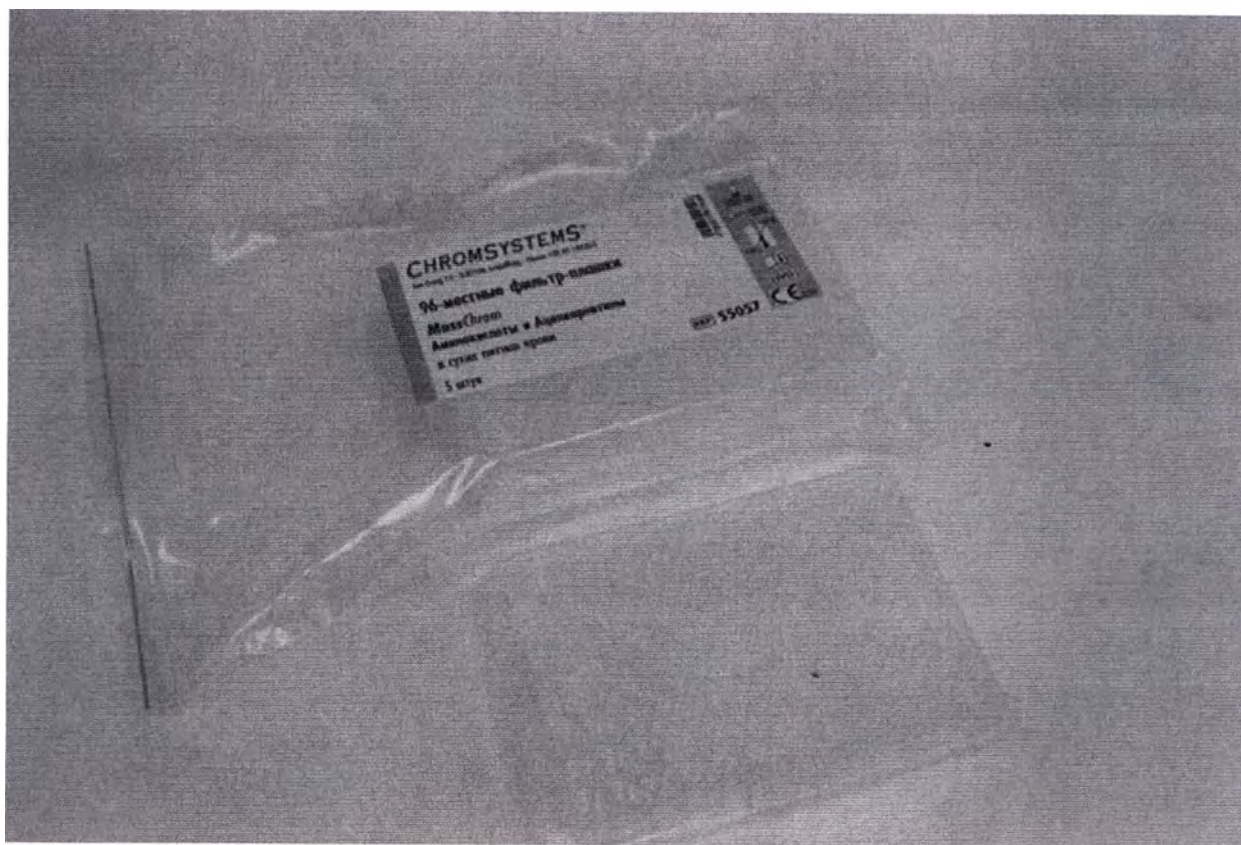
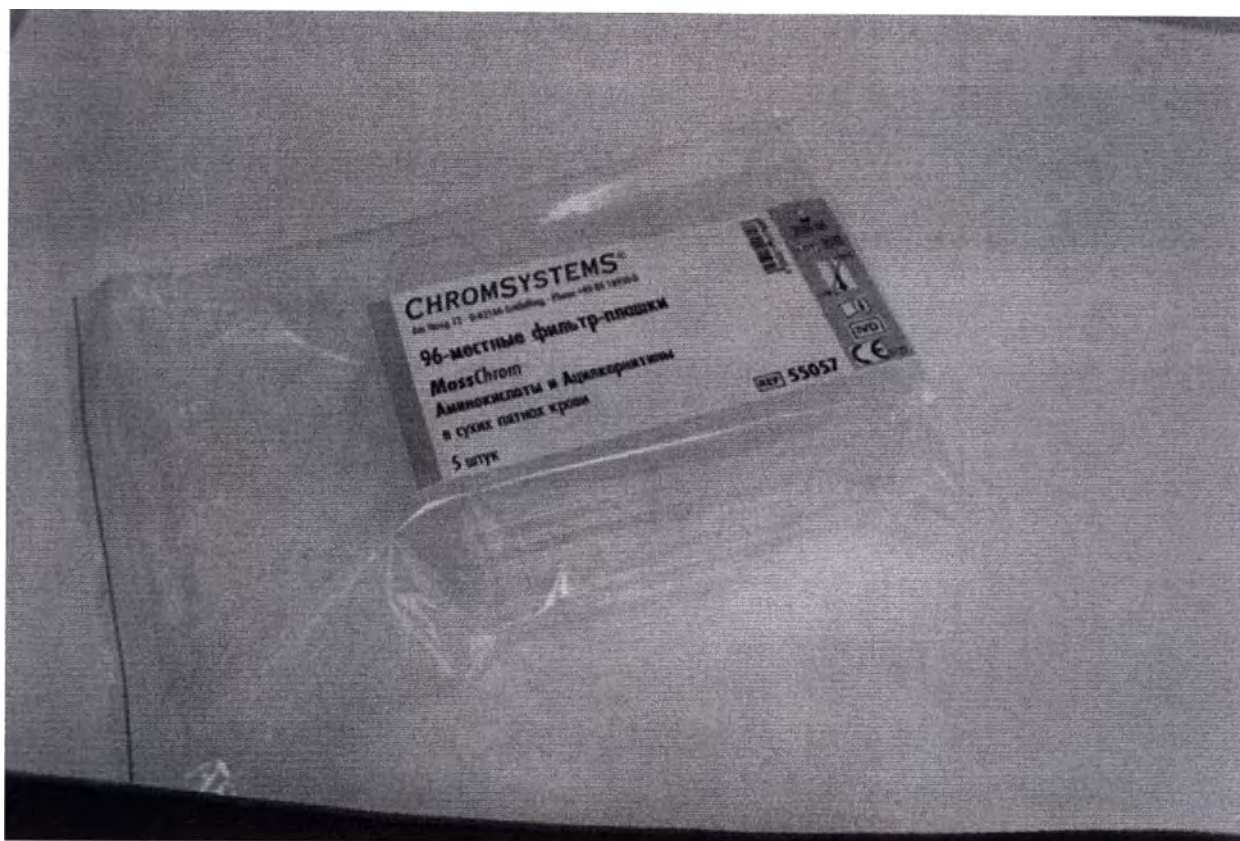


14. Прокалываемый адгезивный уплотнитель для 96-луночных планшетов

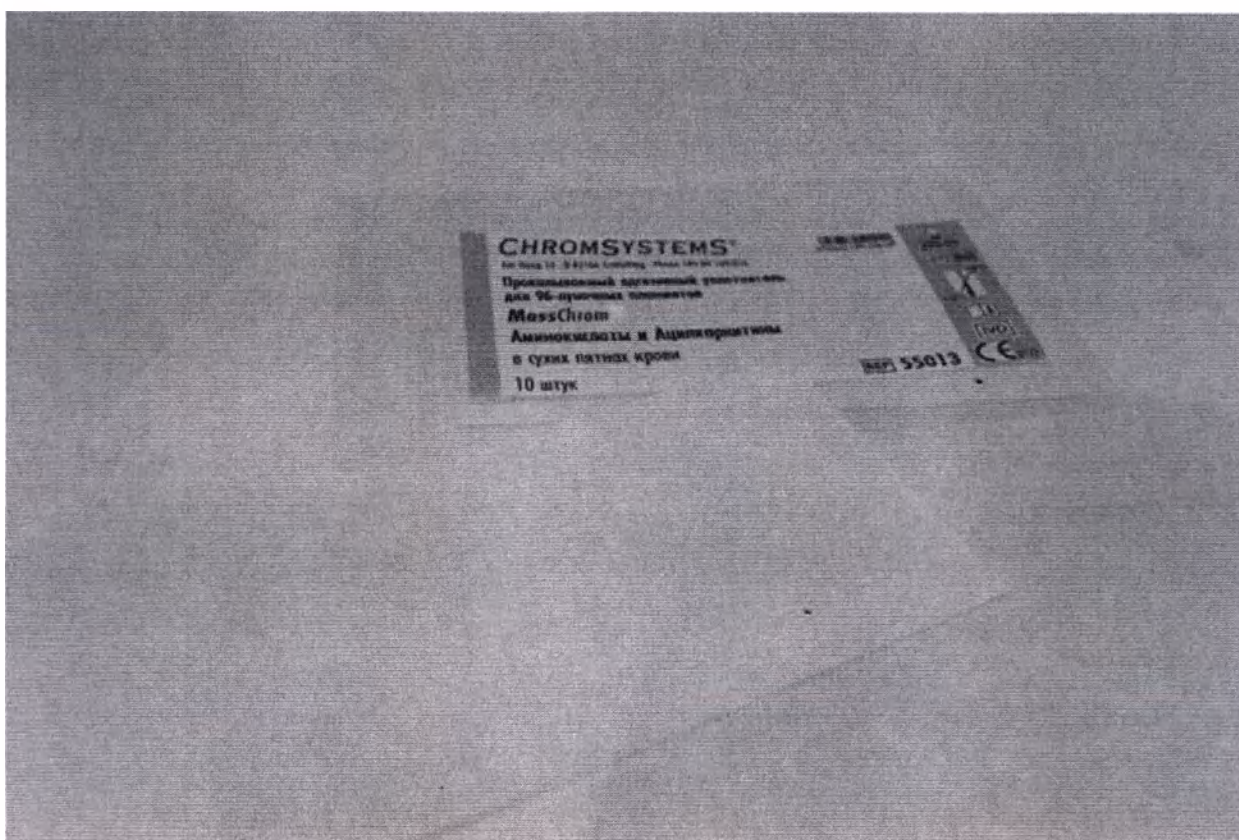
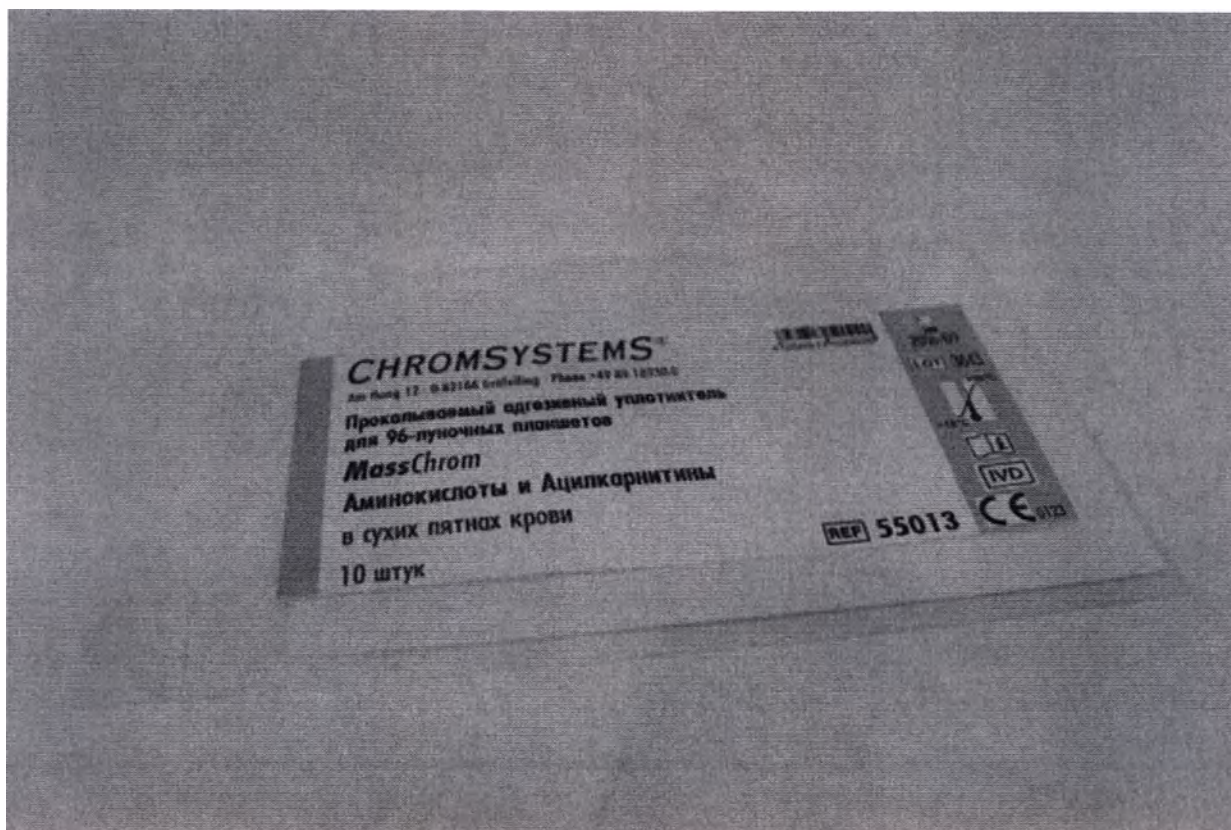


15. Калибровочная смесь для сукцинилацетона

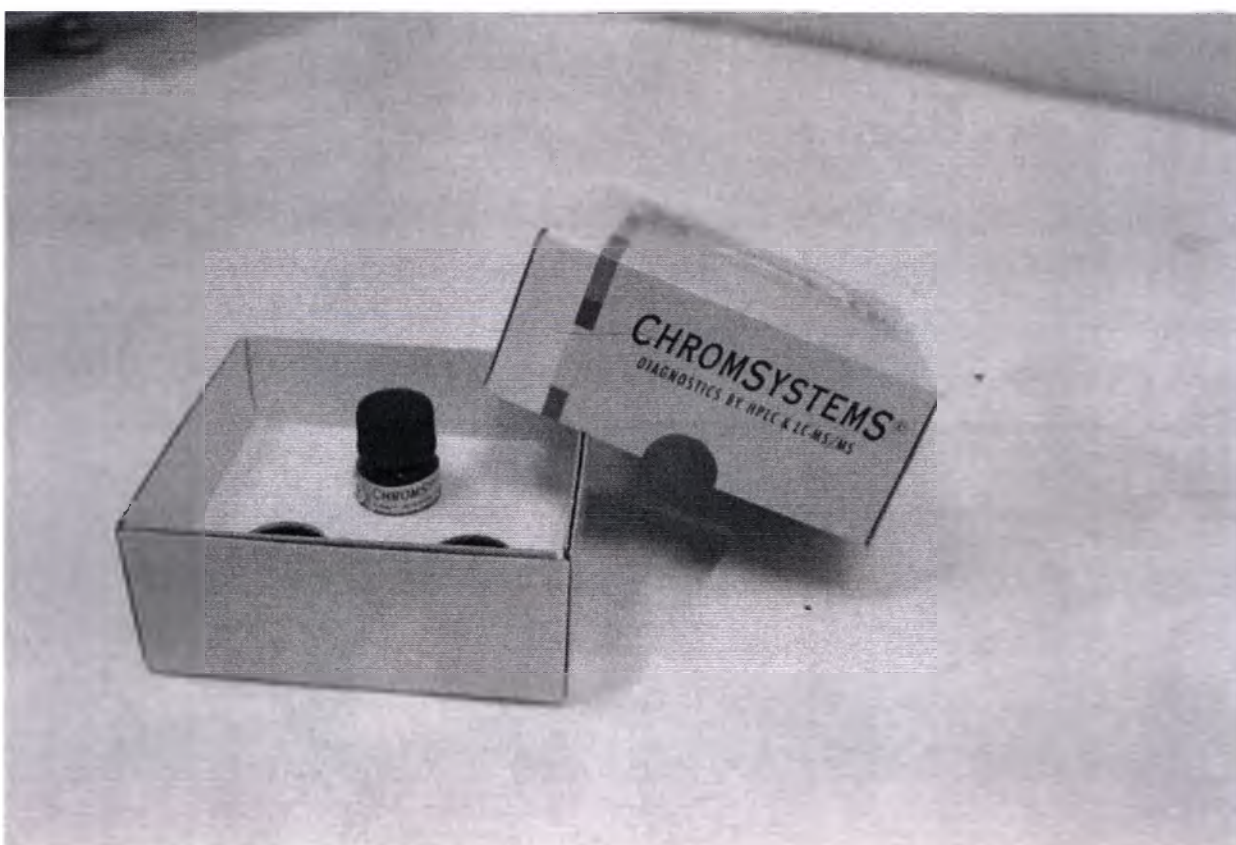

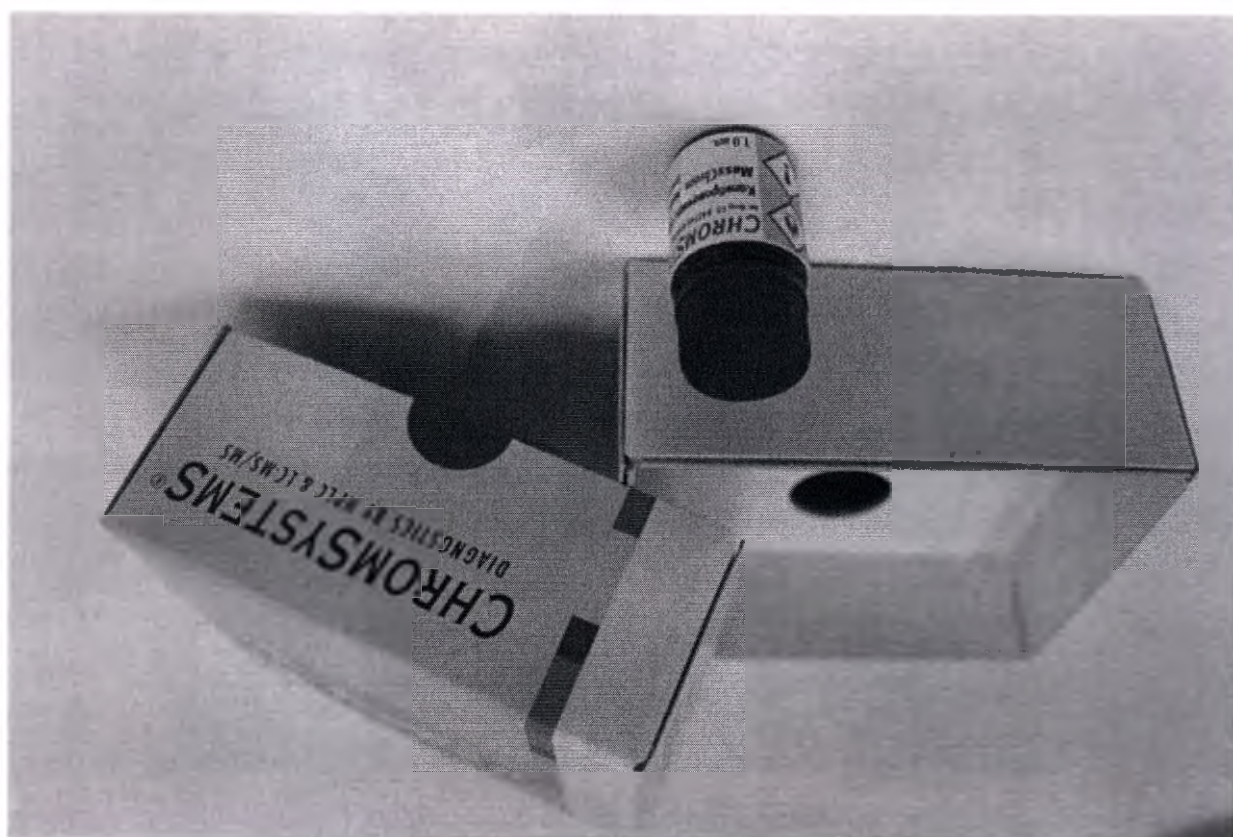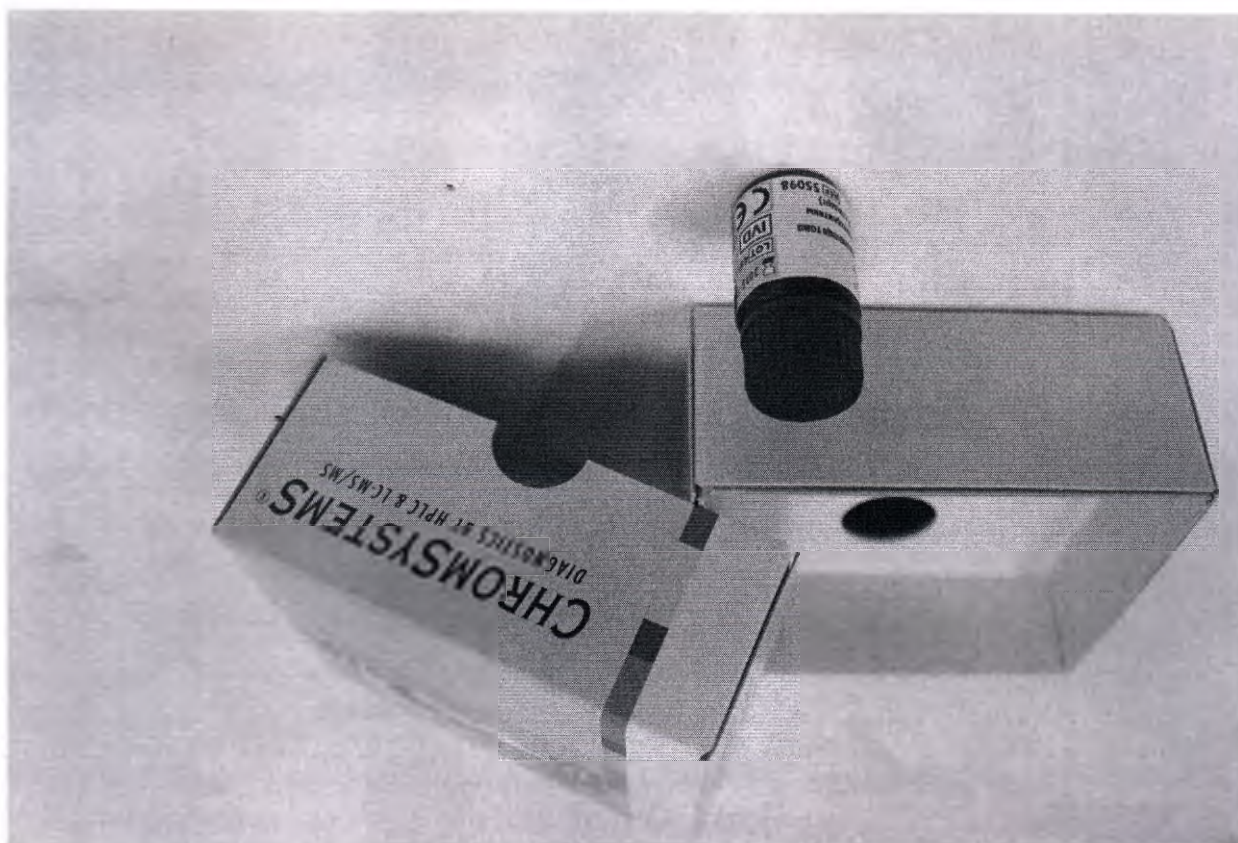

16. Калибровочная смесь для сукцинилацетона (все аналиты)

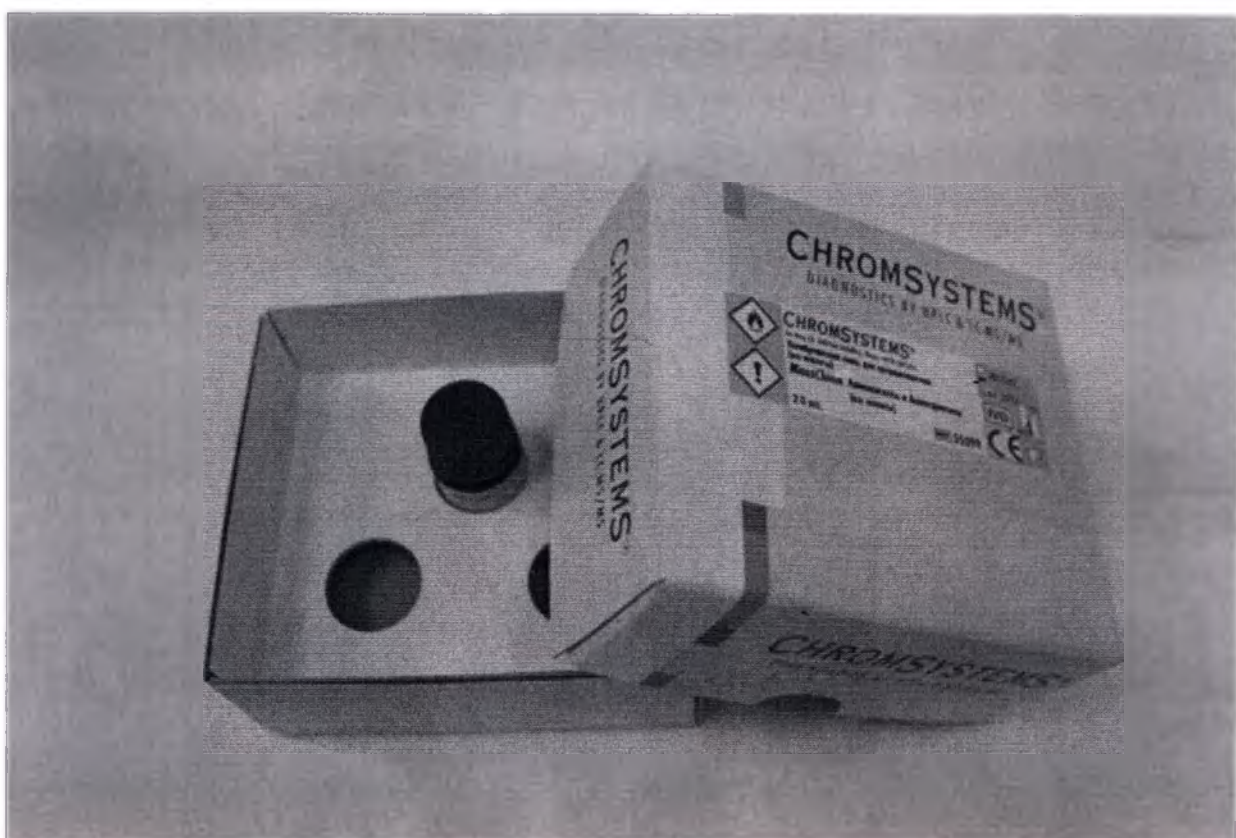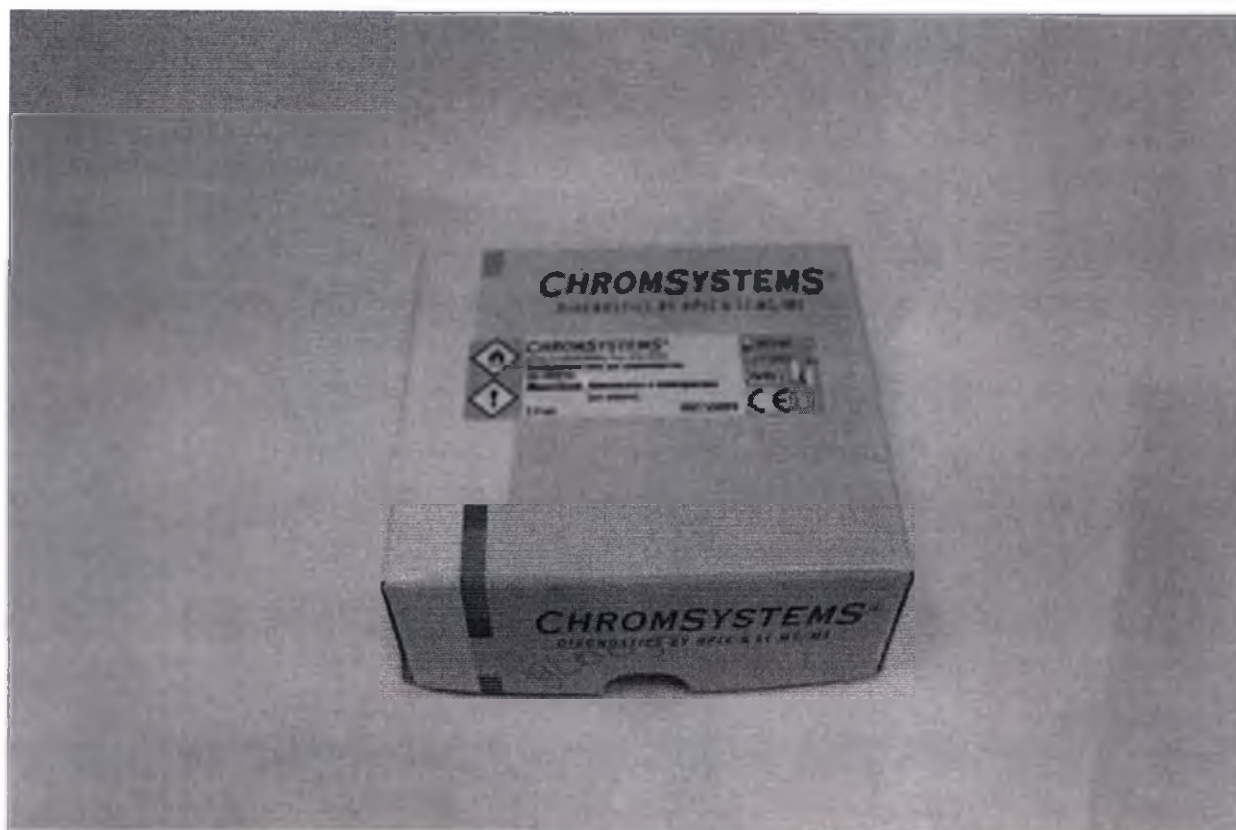



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью

23

листов

Генеральный директор ООО «ХромсистемсЛаб»

Глаговский П.Б.

