




УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «АльфаЛаб»

М.А. Суворова
2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов

для выявления в клиническом материале ДНК *Ureaplasma parvum* и
Ureaplasma urealyticum и их дифференциации методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией
в режиме реального времени

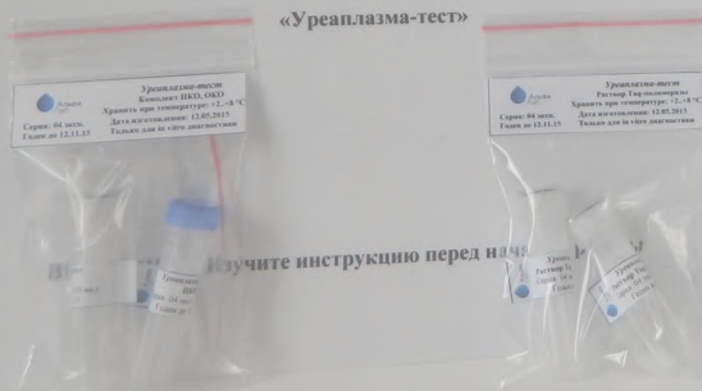

ООО «АльфаЛаб»	Паспорт качества № 130515-04	Стр. 1 из 1
Название набора	Набор реагентов для выявления в клиническом материале ДНК <i>Ureaplasma parvum</i> и <i>Ureaplasma urealyticum</i> и их дифференциации методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «Уреаплазма-тест»	


Дата изготовления: 12.05.2015
Серия набора: 04 эксп.
Количество наборов в серии: 10
Срок годности: 12.11.2015
Условия хранения: 2-8 °C

Результаты контроля ОТК:

Органолептические показатели:		
Смесь для амплификации	Прозрачная бесцветная жидкость	
Раствор Taq-полимеразы	Прозрачная бесцветная жидкость	
Положительный контрольный образец ПКО	Прозрачная бесцветная жидкость	
Отрицательный контрольный образец (ОКО)	Прозрачная бесцветная жидкость	

Технические характеристики:


	Параметры оценки	Канал	Наличие флуоресценции
Положительный контрольный образец (ПКО)	Регистрация экспоненциального роста флуоресцентного сигнала по каналам FAM, ROX и HEX	FAM/ROX / HEX	+++
Отрицательный контрольный образец (ОКО)	Отсутствие флуоресцентного сигнала в каналах FAM, ROX и HEX	FAM/ROX / HEX	---



Не более 1000 копий/мл

Заключение: соответствует требов.
ТУ 9398-008-01058639-2015

Дата выдачи паспорта: 12.05.2015
Штамп ОТК:

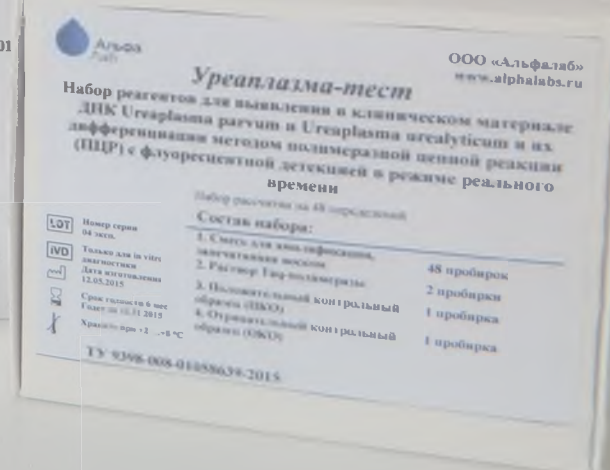



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «АльфаЛаб»


М.А. Суворова
2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ


по применению набора реагентов
для выявления в клиническом материале ДНК *Ureaplasma parvum* и
Ureaplasma urealyticum и их дифференциации методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией
в режиме реального времени

«Уреаплазма-тест»

Уреаплазма-тест
Комплект ИКД, ОКД
Хранить при температуре: +2...+8 °С
Серия: 04 экз.
Дата изготовления: 12.05.2015
Годен до 12.11.15



Уреаплазма-тест
Комплект ИКД, ОКД
Хранить при температуре: +2...+8 °С
Серия: 04 экз.
Дата изготовления: 12.05.2015
Годен до 12.11.15



учтите инструкцию перед на

ООО «АльфаЛаб»	Паспорт качества № 130515-04	Стр 1 из 1
Название набора	Набор реагентов для выявления в клиническом материале ДНК <i>Ureaplasma parvum</i> и <i>Ureaplasma urealyticum</i> и их дифференциации методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «Уреаплазма-тест»	

Дата изготовления: 12.05.2015
Серия набора: 04 экз.
Количество наборов в серии: 10
Срок годности: 12.11.2015
Условия хранения: 2-8 °С

Результаты контроля ОТК:

Органолептические показатели:	
Смесь для амплификации	Прозрачная бесцветная жидкость
Раствор Taq-полимеразы	Прозрачная бесцветная жидкость
Положительный контрольный образец ПКО	Прозрачная бесцветная жидкость
Отрицательный контрольный образец (ОКО)	Прозрачная бесцветная жидкость

Технические характеристики:			
	Параметры оценки	Канал	Наличие флуоресценции
Положительный контрольный образец	Регистрация экспоненциального роста флуоресцентного сигнала по каналам FAM, ROX и HEX	FAM/ROX/HEX	есть
Уреаплазма-тест	Отсутствие флуоресцентного сигнала по каналам FAM, ROX и HEX	FAM/ROX/HEX	нет

Заключение: соответствует требованиям
ТУ 9398-008-01058639-2015

Выдана серия: 04 экз.
Годен до 12.11.15



Альфа Лаб

Уреаплазма-тест

Набор реагентов для выявления в клиническом материале ДНК *Ureaplasma parvum* и *Ureaplasma urealyticum* и их дифференциации методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени

Набор рассчитан на 96 определений

Состав набора:

1. Смесь для амплификации, замораживающее вещество	96 пробирок
2. Раствор Taq-полимеразы	96 пробирок
3. Положительный контрольный образец (ПКО)	4 пробирки
4. Отрицательный контрольный образец (ОКО)	2 пробирки

ТУ 9398-008-01058639-2015

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «АльфаЛаб»



М.А. Суворова
2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
для выявления в клиническом материале ДНК *Ureaplasma parvum* и
Ureaplasma urealyticum и их дифференциации методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией
в режиме реального времени

ООО «АльфаЛаб»	Паспорт качества № 130515-04	Стр. 1 из 1
Название набора	Набор реагентов для выявления в клиническом материале ДНК <i>Ureaplasma parvum</i> и <i>Ureaplasma urealyticum</i> и их дифференциации методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «Уреаплазма-тест»	

Дата изготовления: 12.05.2015
Серия набора: 04 эксп.
Количество наборов в серии: 10
Срок годности: 12.11.2015
Условия хранения: 2-8 °C

Результаты контроля ОТК:

Органолептические показатели:	
Смесь для амплификации	Прозрачная бесцветная жидкость
Раствор Taq-полимеразы	Прозрачная бесцветная жидкость
Положительный контрольный образец ПКО	Прозрачная бесцветная жидкость
Отрицательный контрольный образец (ОКО)	Прозрачная бесцветная жидкость

Технические характеристики:

	Параметры оценки	Канал	Наличие
Положительный контрольный (ПКО) образец	Регистрация экспоненциального роста флуоресцентного сигнала по каналам FAM, ROX и HEX	FAM/ROX/HEX	+
Отрицательный контрольный (ОКО) образец	Отсутствие флуоресцентного сигнала каналам FAM, ROX и HEX	FAM/ROX/HEX	-
Аналитическая чувствительность	Не более 1000 копий/мл		

Заключение: соответствует требованиям
ТУ 9398 – 008 – 01058639 – 2015

«Уреаплазма-тест»

Уреаплазма-тест
Контроль для серии – 4 шт.
Хранить при температуре: 2-8 °C
Дата изготовления: 12.05.2015
Только для in vitro диагностики

Уреаплазма-тест
Раствор Taq-полимеразы
Хранить при температуре: 2-8 °C
Дата изготовления: 12.05.2015
Только для in vitro диагностики

Уреаплазма-тест
Комплект ПКО, ОКО
Хранить при температуре: 2-8 °C
Дата изготовления: 12.05.2015
Только для in vitro диагностики

АльфаЛаб
Уреаплазма-тест
Набор реагентов для выявления в клиническом материале ДНК *Ureaplasma parvum* и *Ureaplasma urealyticum* и их дифференциации методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени

Набор рассчитан на 11 проб

Состав набора:	Количество
1. Смесь для амплификации, полимеразная смесь	6 шт. по 8 проб
2. Раствор Taq-полимеразы	2 проб
3. Положительный контрольный образец (ПКО)	1 пробирка
4. Отрицательный контрольный образец (ОКО)	1 пробирка

Всего: 10 шт.
Только для in vitro диагностики
Дата изготовления: 12.05.2015
Срок годности: 6 мес
Годен до: 12.11.2015
Хранить при 2-8 °C

ТУ 9398-008-01058639-2015

те инструкцию перед началом ра...


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «АльфаЛаб»



М.А. Суворова
2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
для выявления в клиническом материале ДНК *Ureaplasma parvum* и
Ureaplasma urealyticum и их дифференциации методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуорес-
ценцией в режиме реального времени



«Уреаплазма-тест»

инструкция к набору реагентов

ООО «АльфаЛаб»	Паспорт качества № 130515-04	Стр. 1 из 1
Название набора	Набор реагентов для выявления в клиническом материале ДНК <i>Ureaplasma parvum</i> и <i>Ureaplasma urealyticum</i> и их дифференциации методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «Уреаплазма-тест»	



Дата изготовления: 12.05.2015
Серия набора: 04 эксп.
Количество наборов в серии: 10
Срок годности: 12.11.2015
Условия хранения: 2-8 °C

Результаты контроля ОТК:

Органолептические показатели:	
Смесь для амплификации	Прозрачная бесцветная жидкость
Раствор Taq-полимеразы	Прозрачная бесцветная жидкость
Положительный контрольный образец ПКО	Прозрачная бесцветная жидкость
Отрицательный контрольный образец (ОКО)	Прозрачная бесцветная жидкость

Технические характеристики:		Канал	Наименование
Положительный контрольный образец (ПКО)	Регистрация экспоненциального роста флуоресцентного сигнала по каналам FAM, ROX и HEX	FAM/ROX/HEX	
Отрицательный контрольный образец (ОКО)	Отсутствие флуоресцентного сигнала в каналах FAM, ROX и HEX	FAM/ROX/HEX	
Аналитическая чувствительность	Не более 1000 копий		

Заказываемые комплектующие и расходные материалы:
ТУ 9398-008-01058639-2015

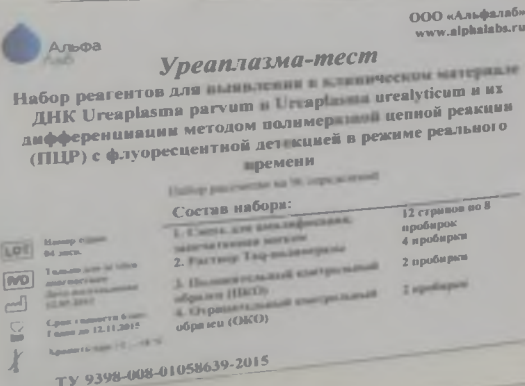

Прошито и пронумеровано 4
В количестве _____ листов

Генеральный директор ООО «Альфалаб»

Суворова М.А.



000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU