



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

**«Система для внутрисосудистых ультразвуковых исследований Volcano (IMAGING SYSTEM), в вариантах исполнения: Volcano s5, Volcano s5i с принадлежностями»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор по нормативно-правовому  
регулированию и качеству

ООО «ФИЛИПС»

О.В.Бахвалова




2016 г.




1. Volcano s5 в составе:




1.1 Консоль аппарата: - блок управления аппаратом;

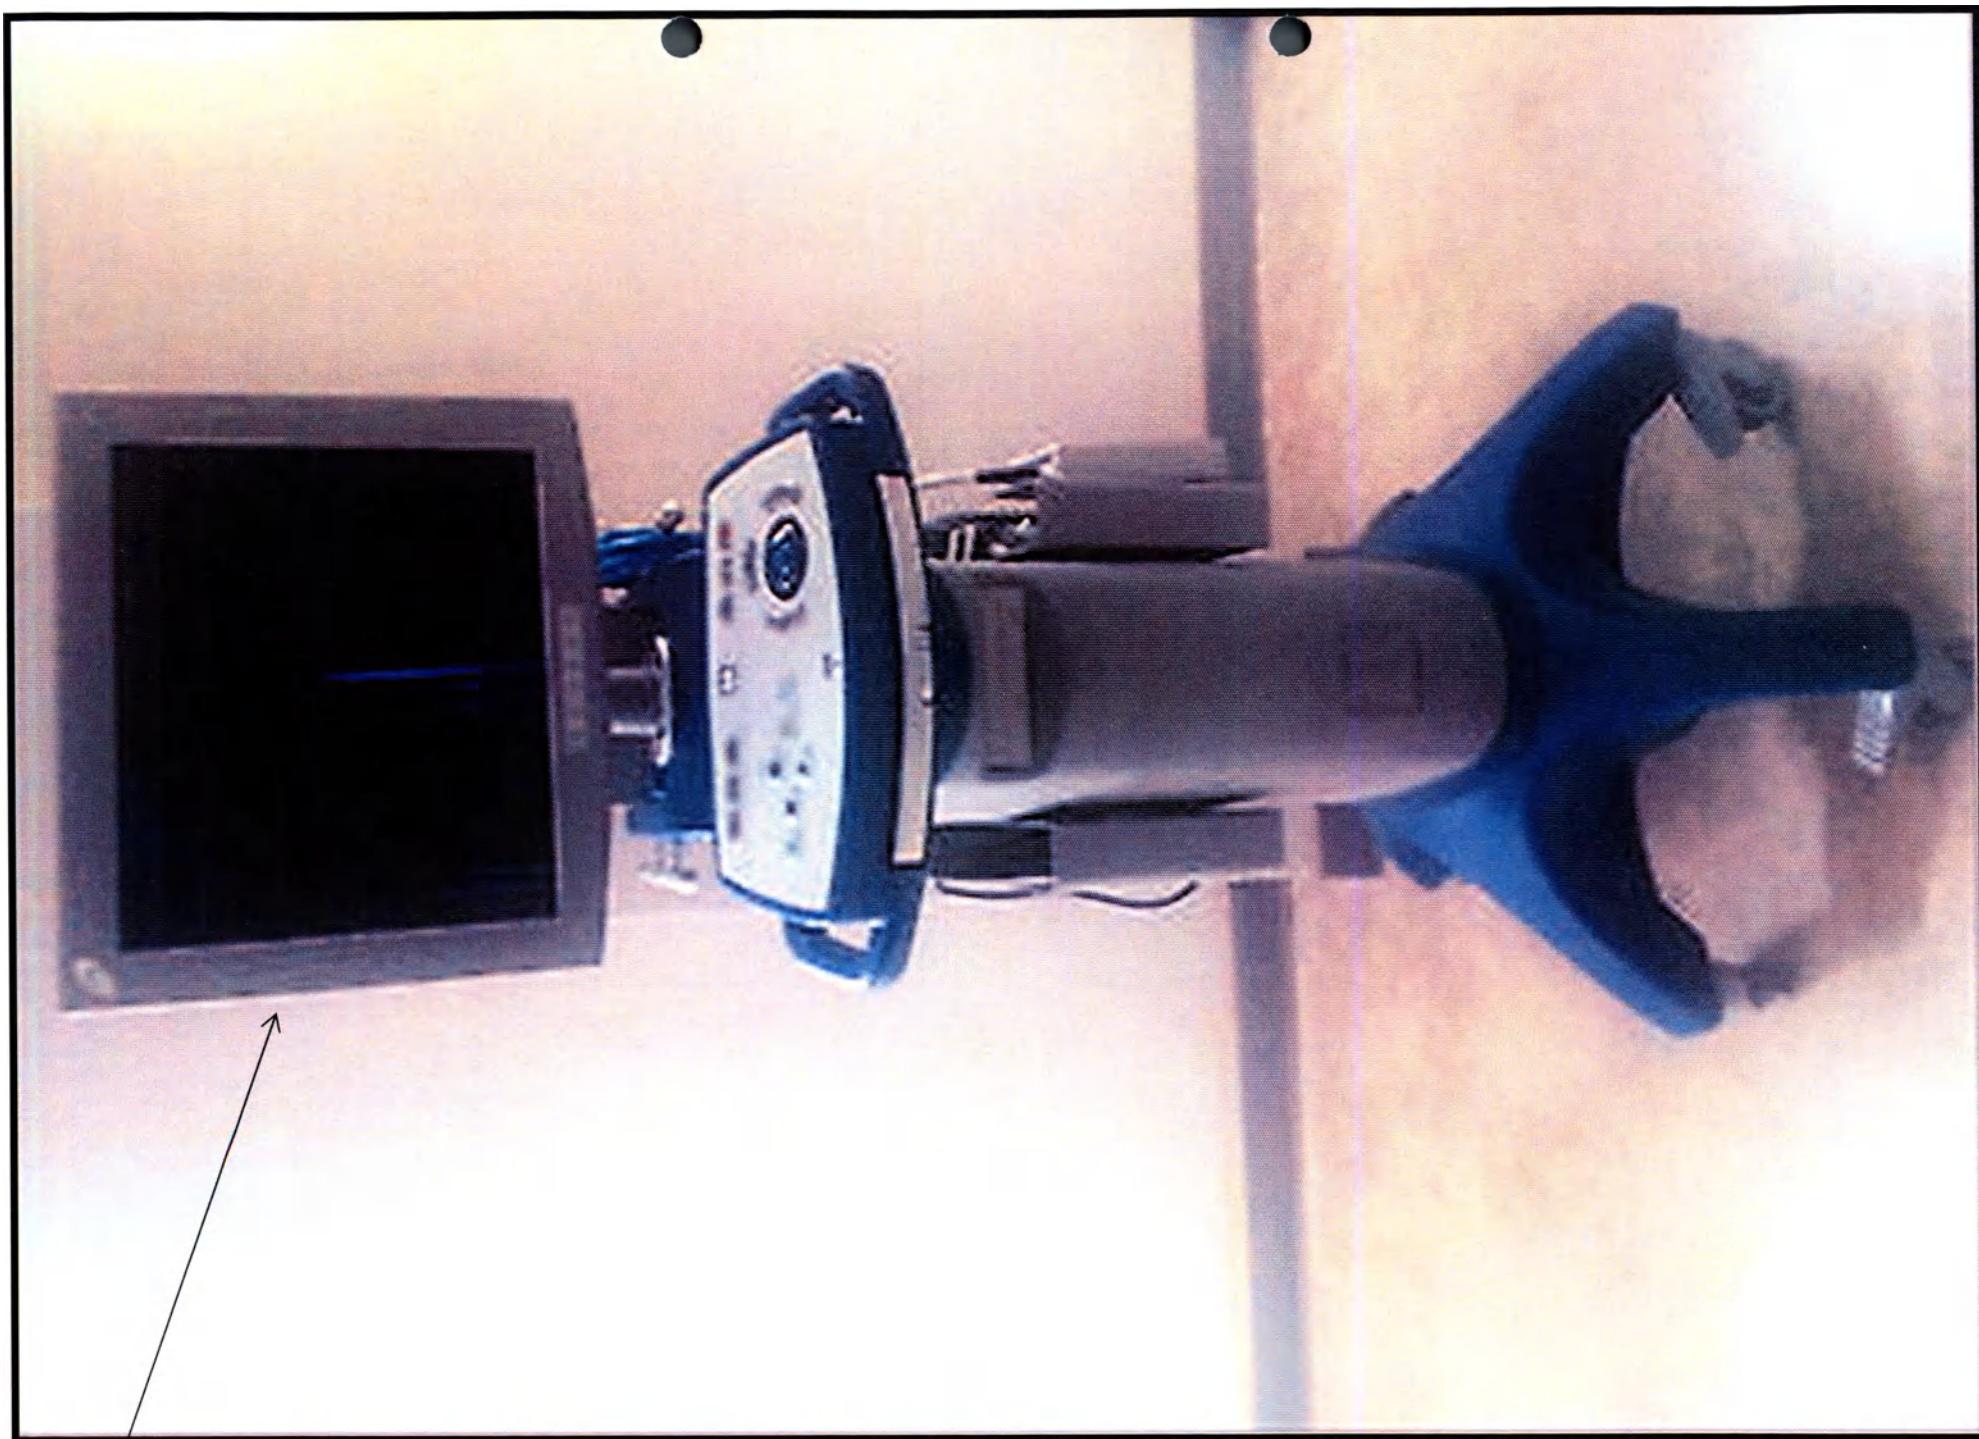



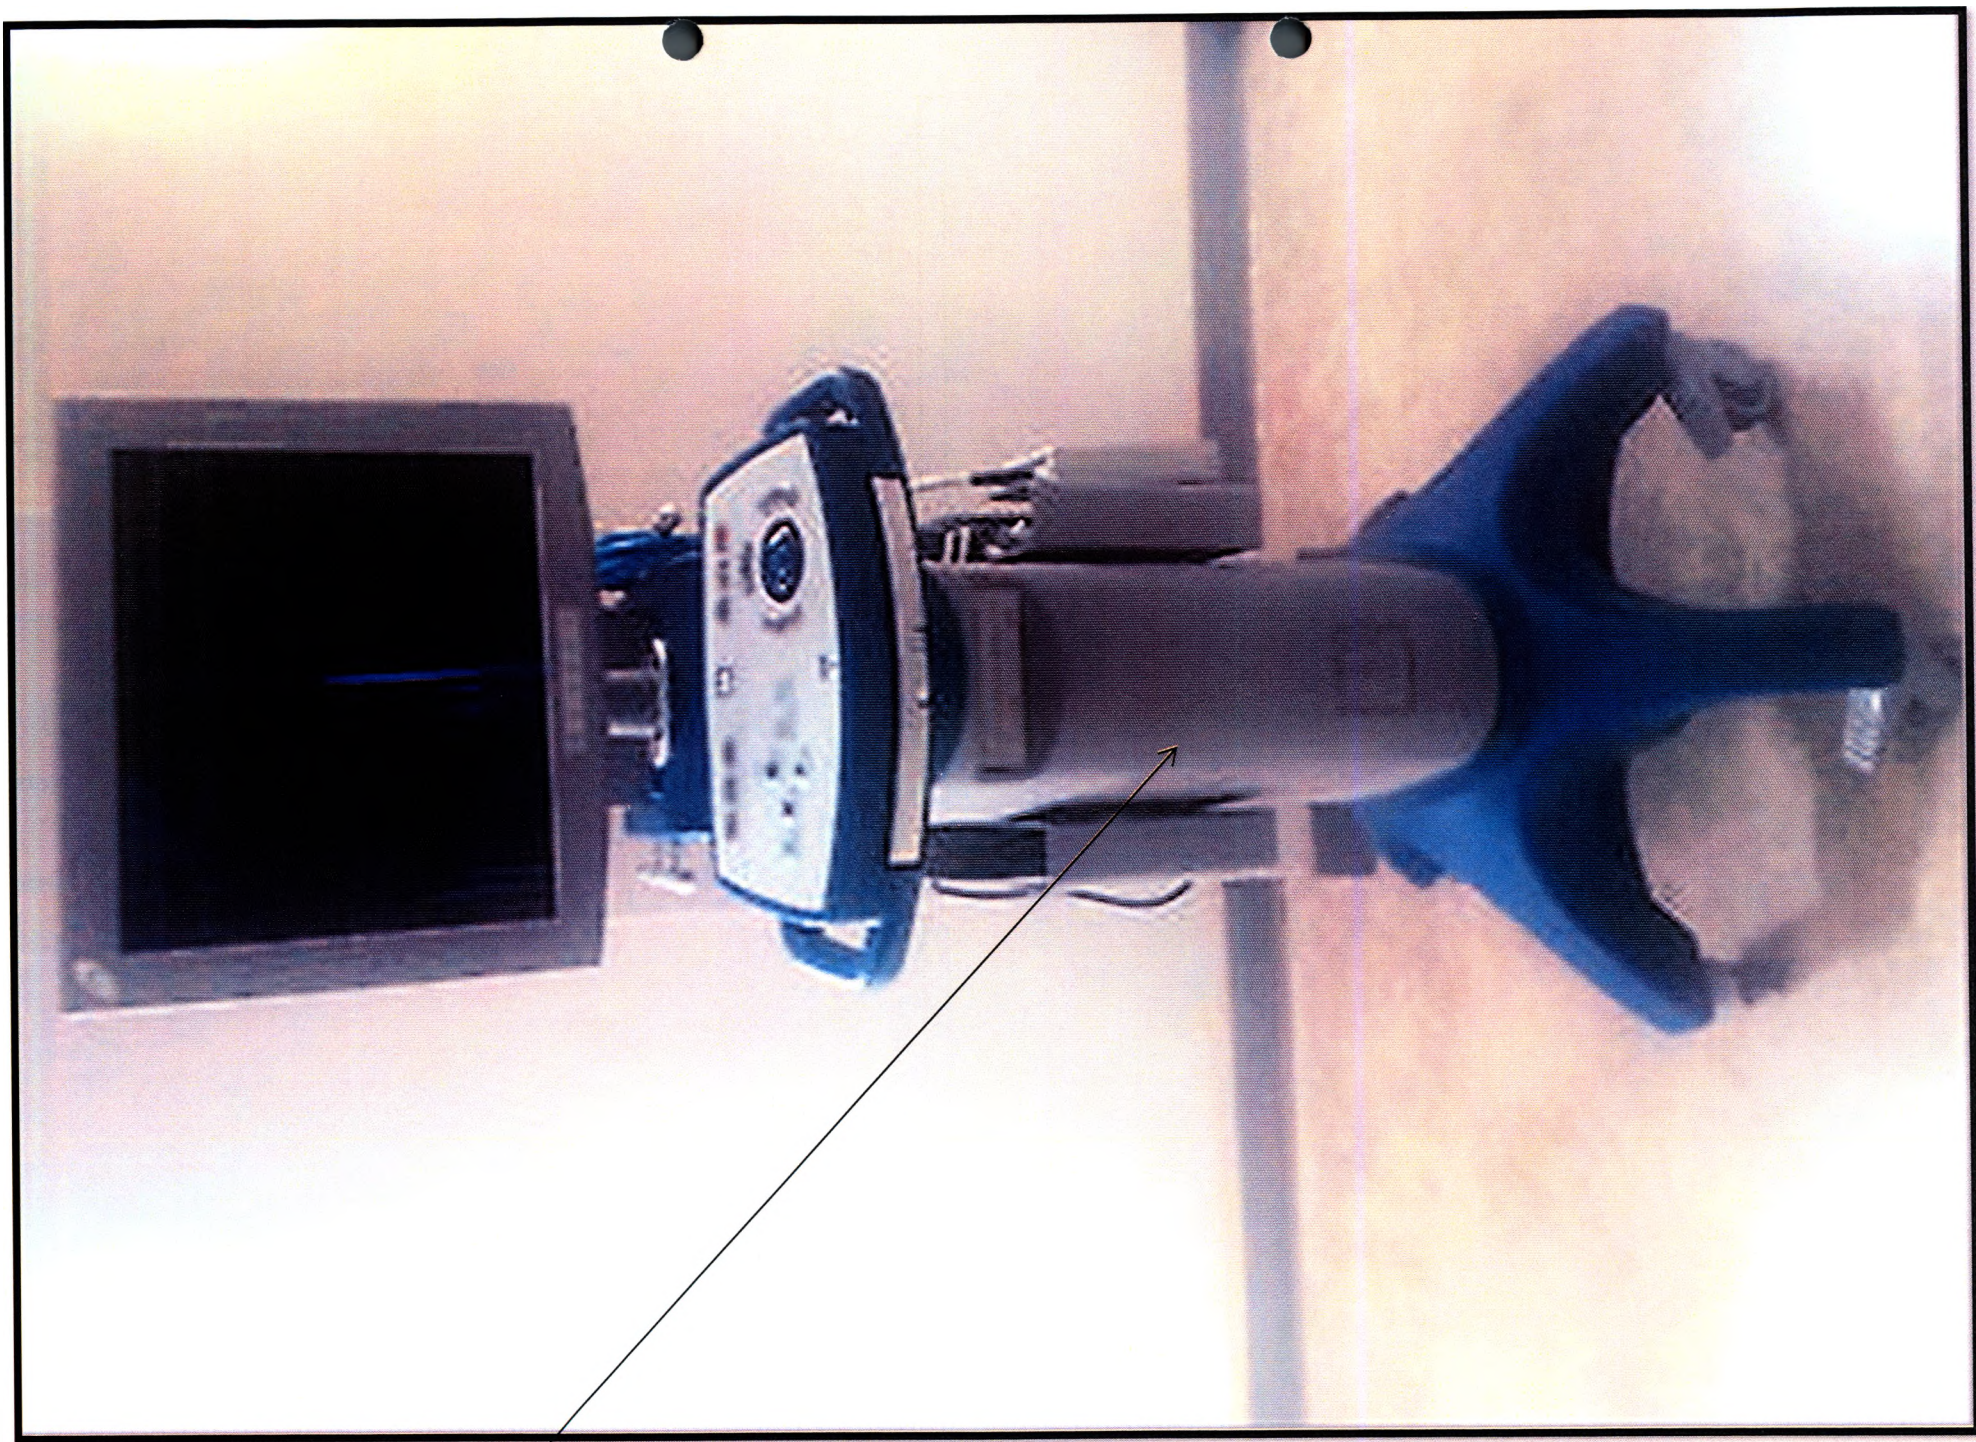

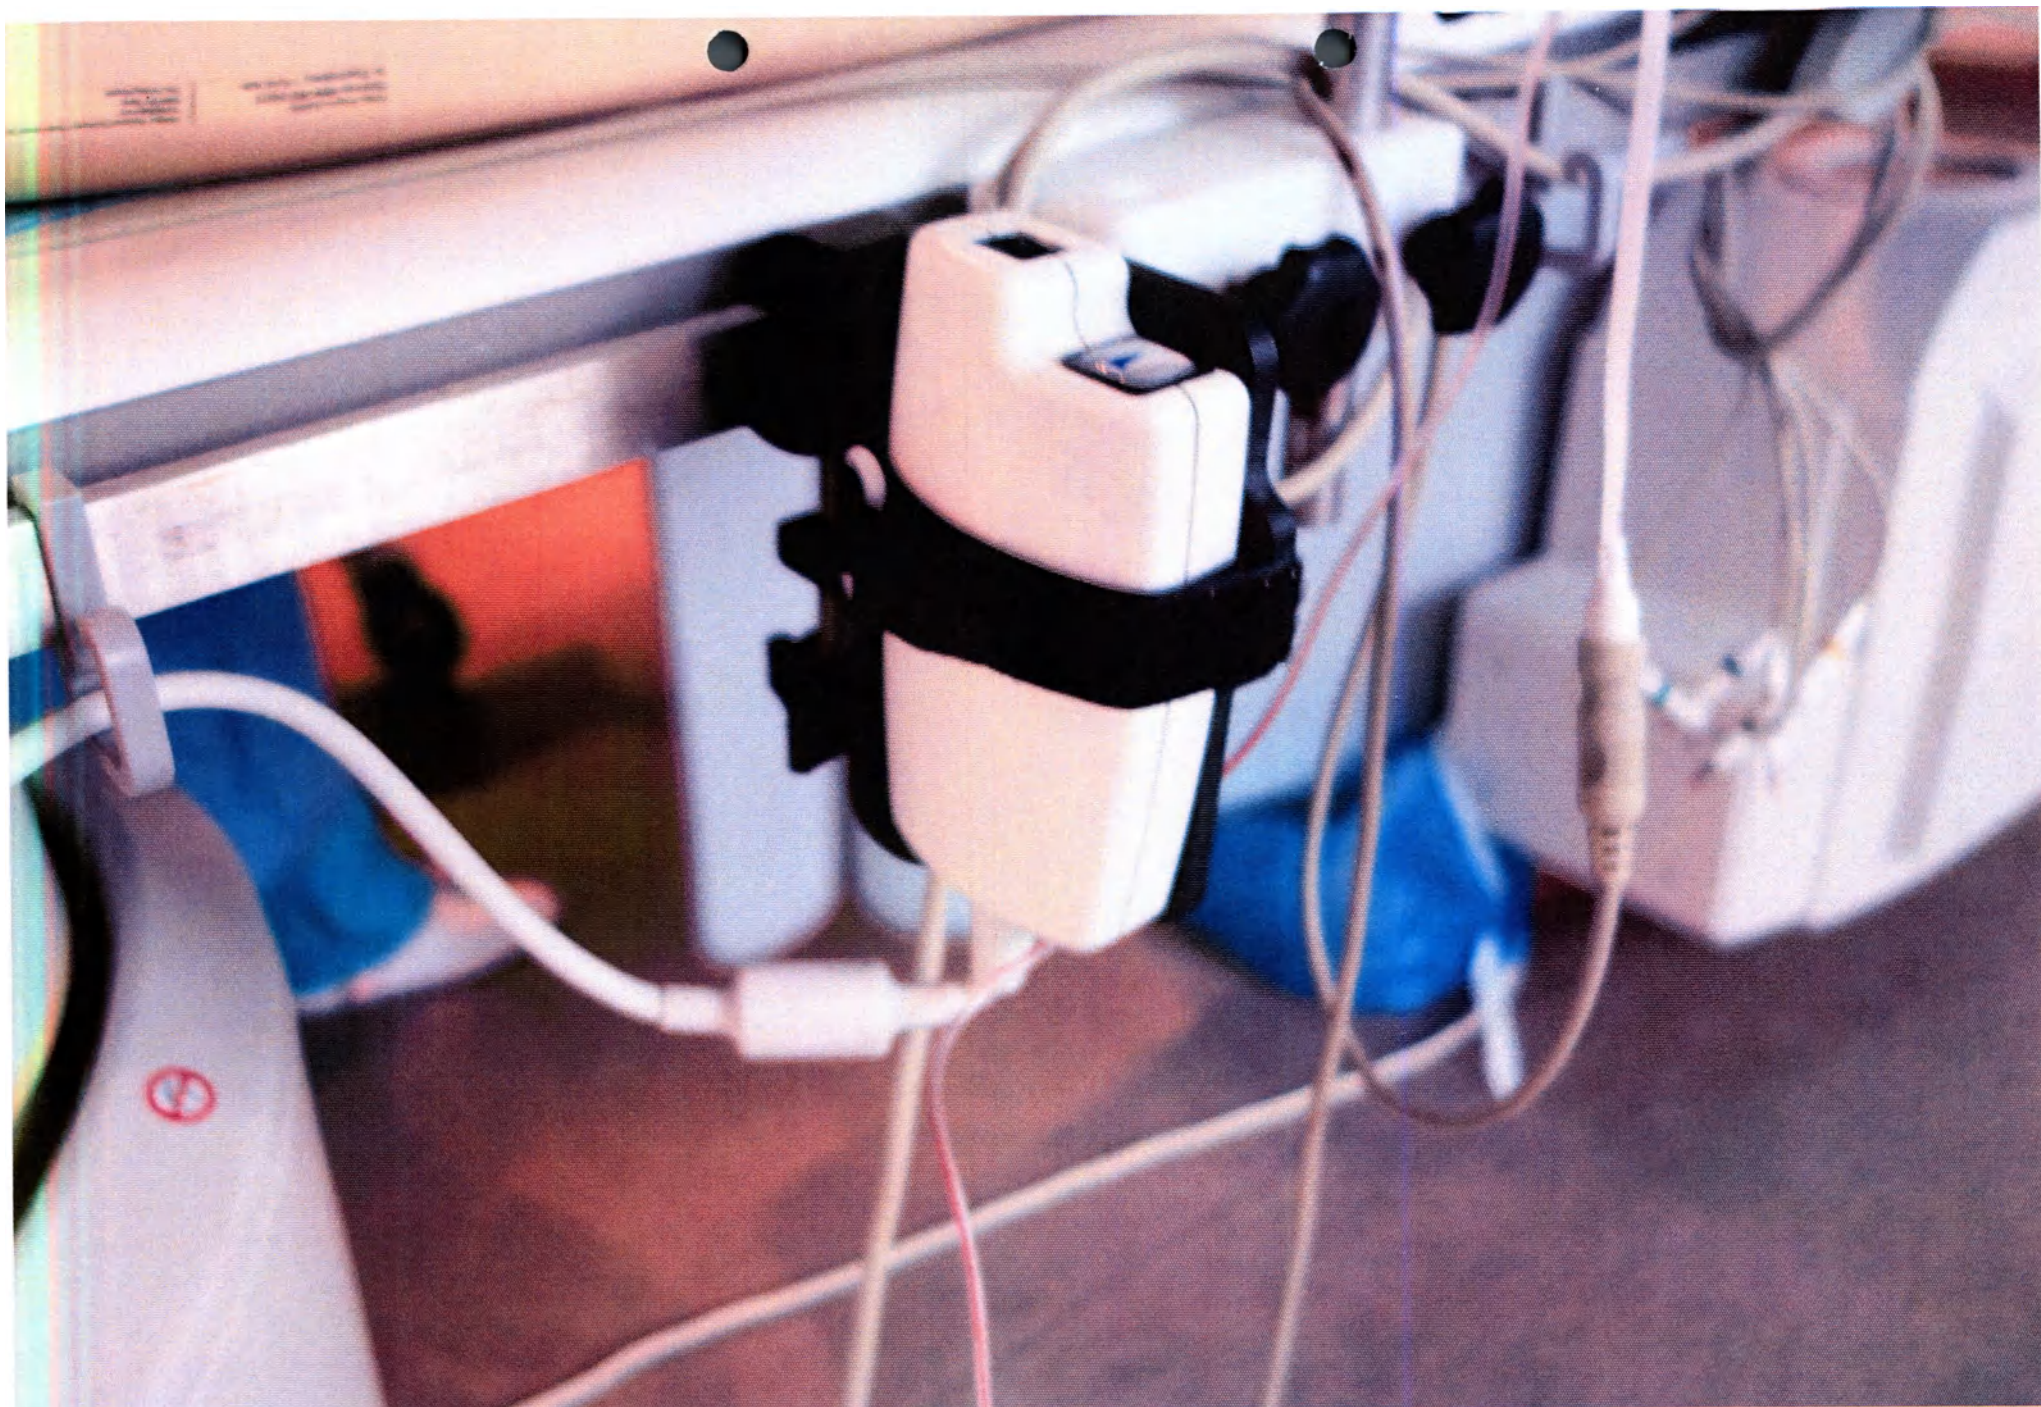


1.2 Интерфейсный модуль пациента (PIM) для подключения ультразвуковых внутрисосудистых датчиков с креплением и блоком соединительных кабелей










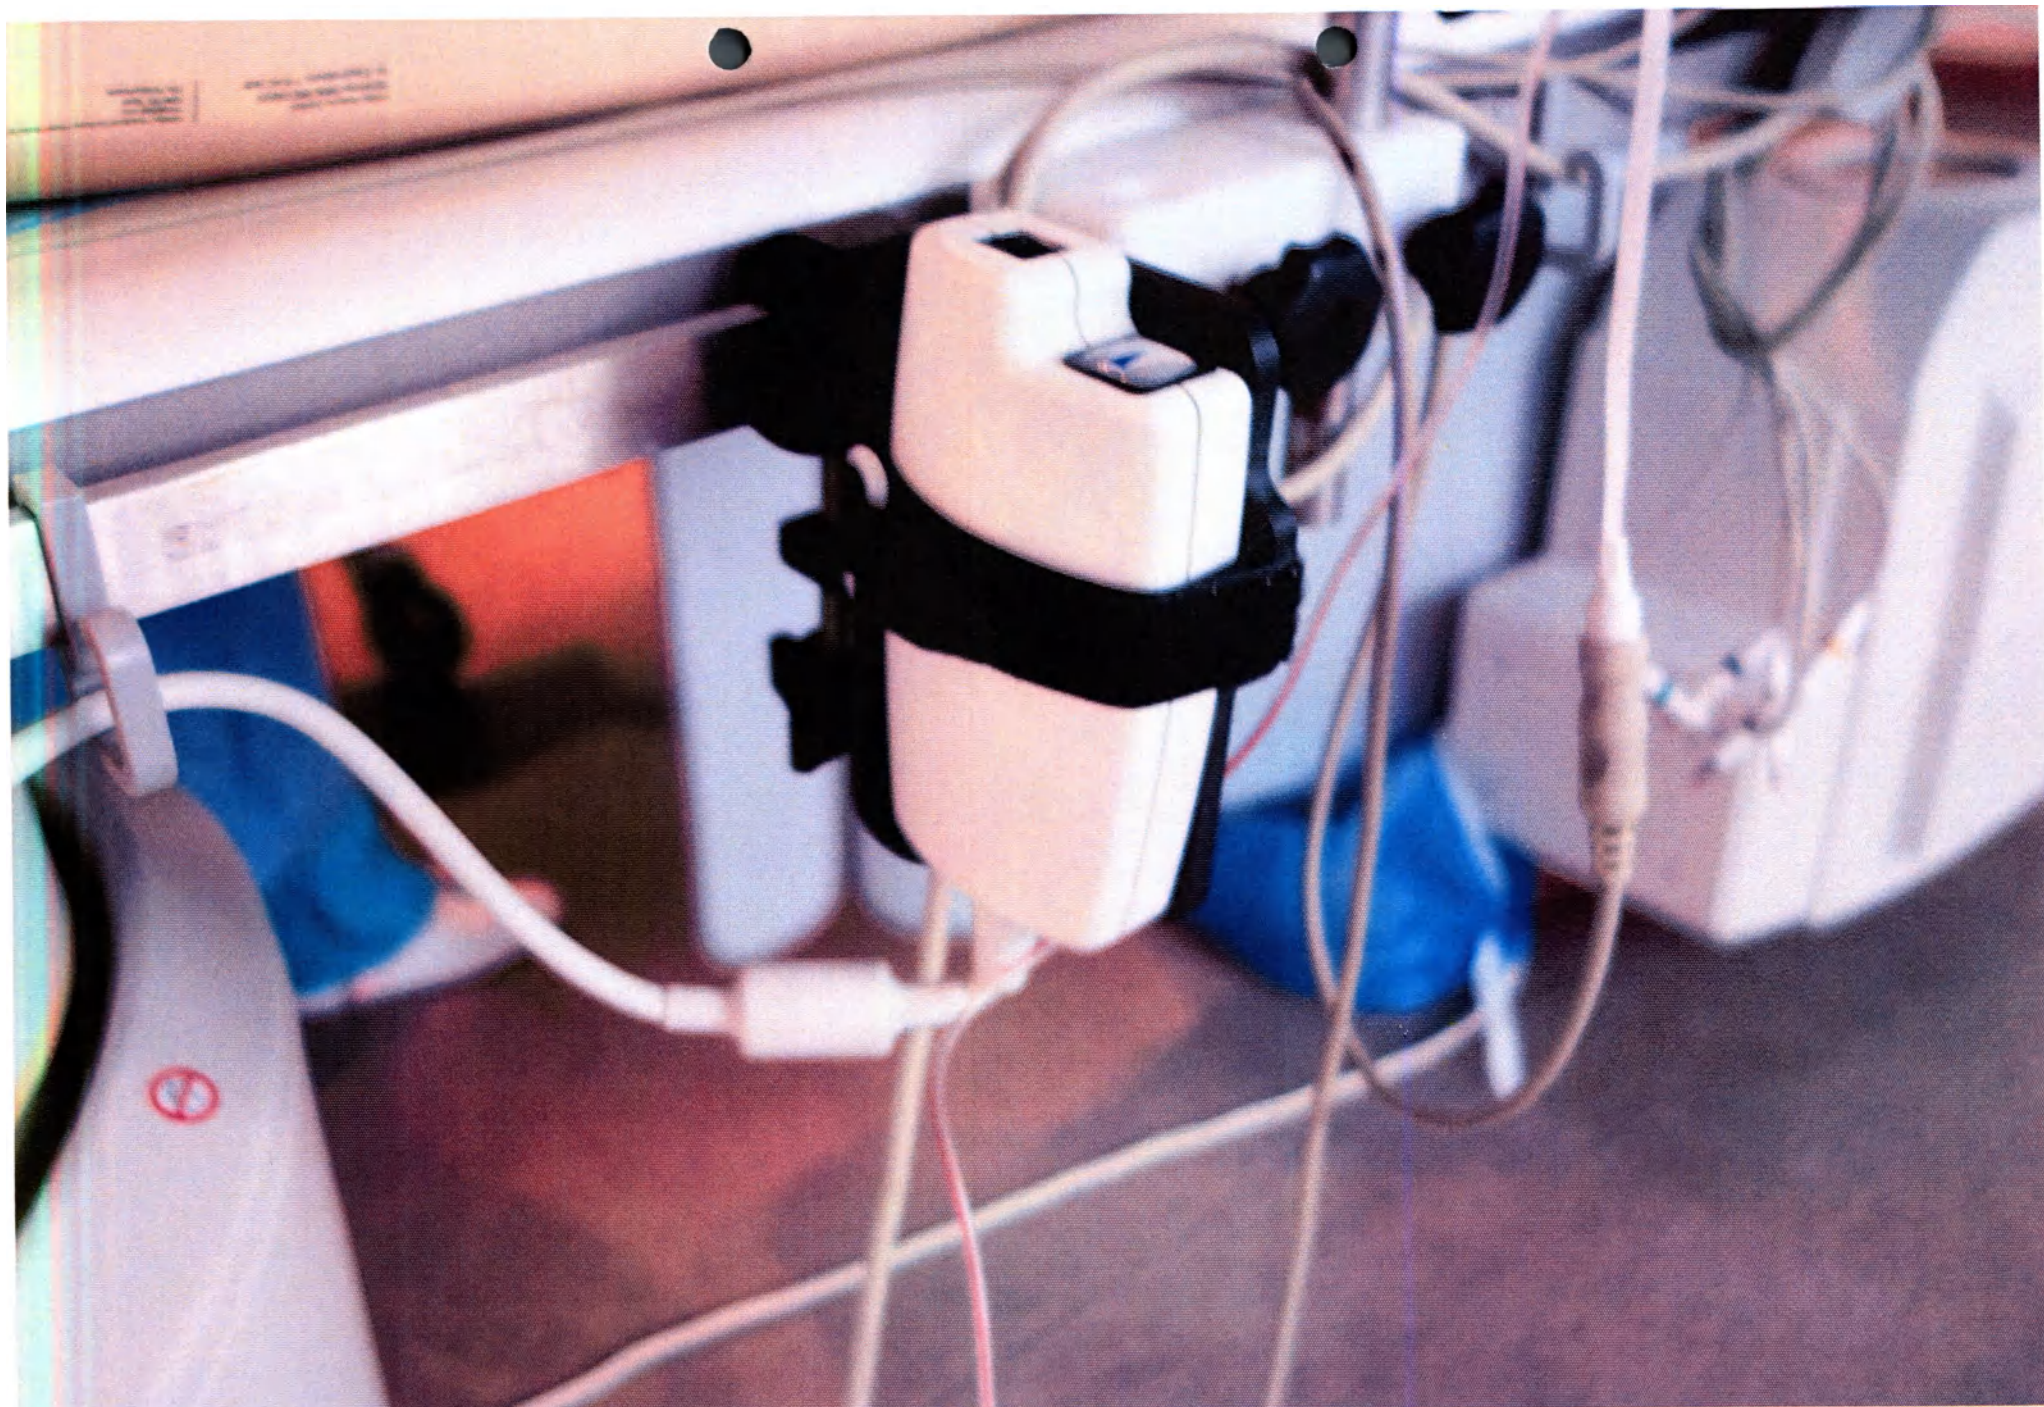


- интерфейсный модуль пациента (PIM) для подключения ультразвуковых внутрисосудистых датчиков с креплением и комплектом

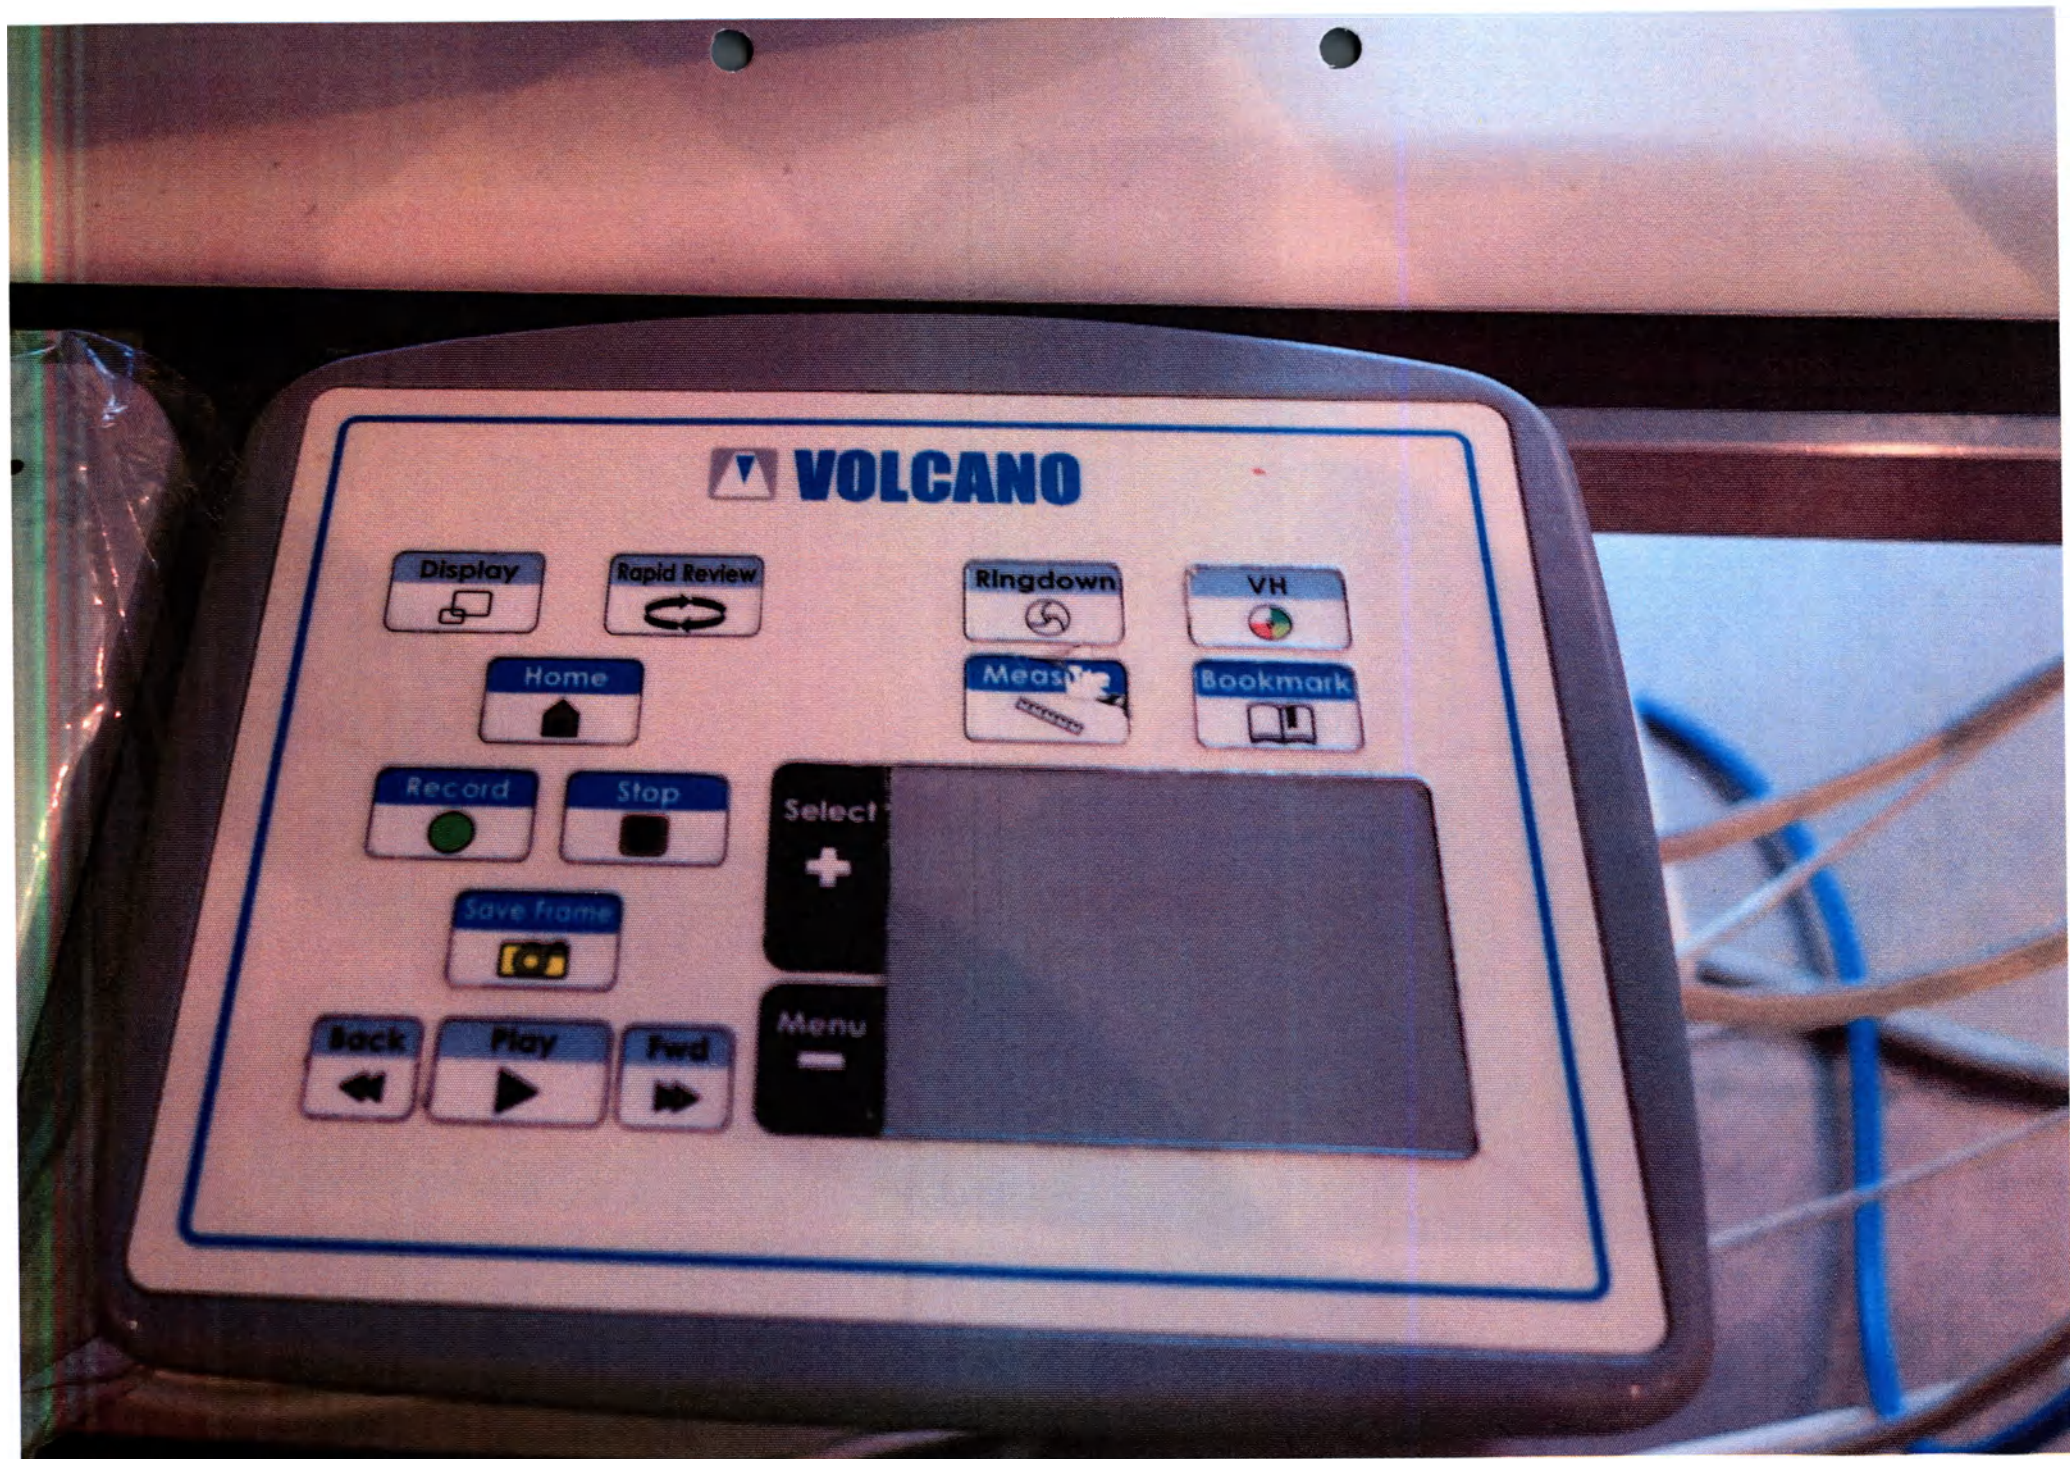









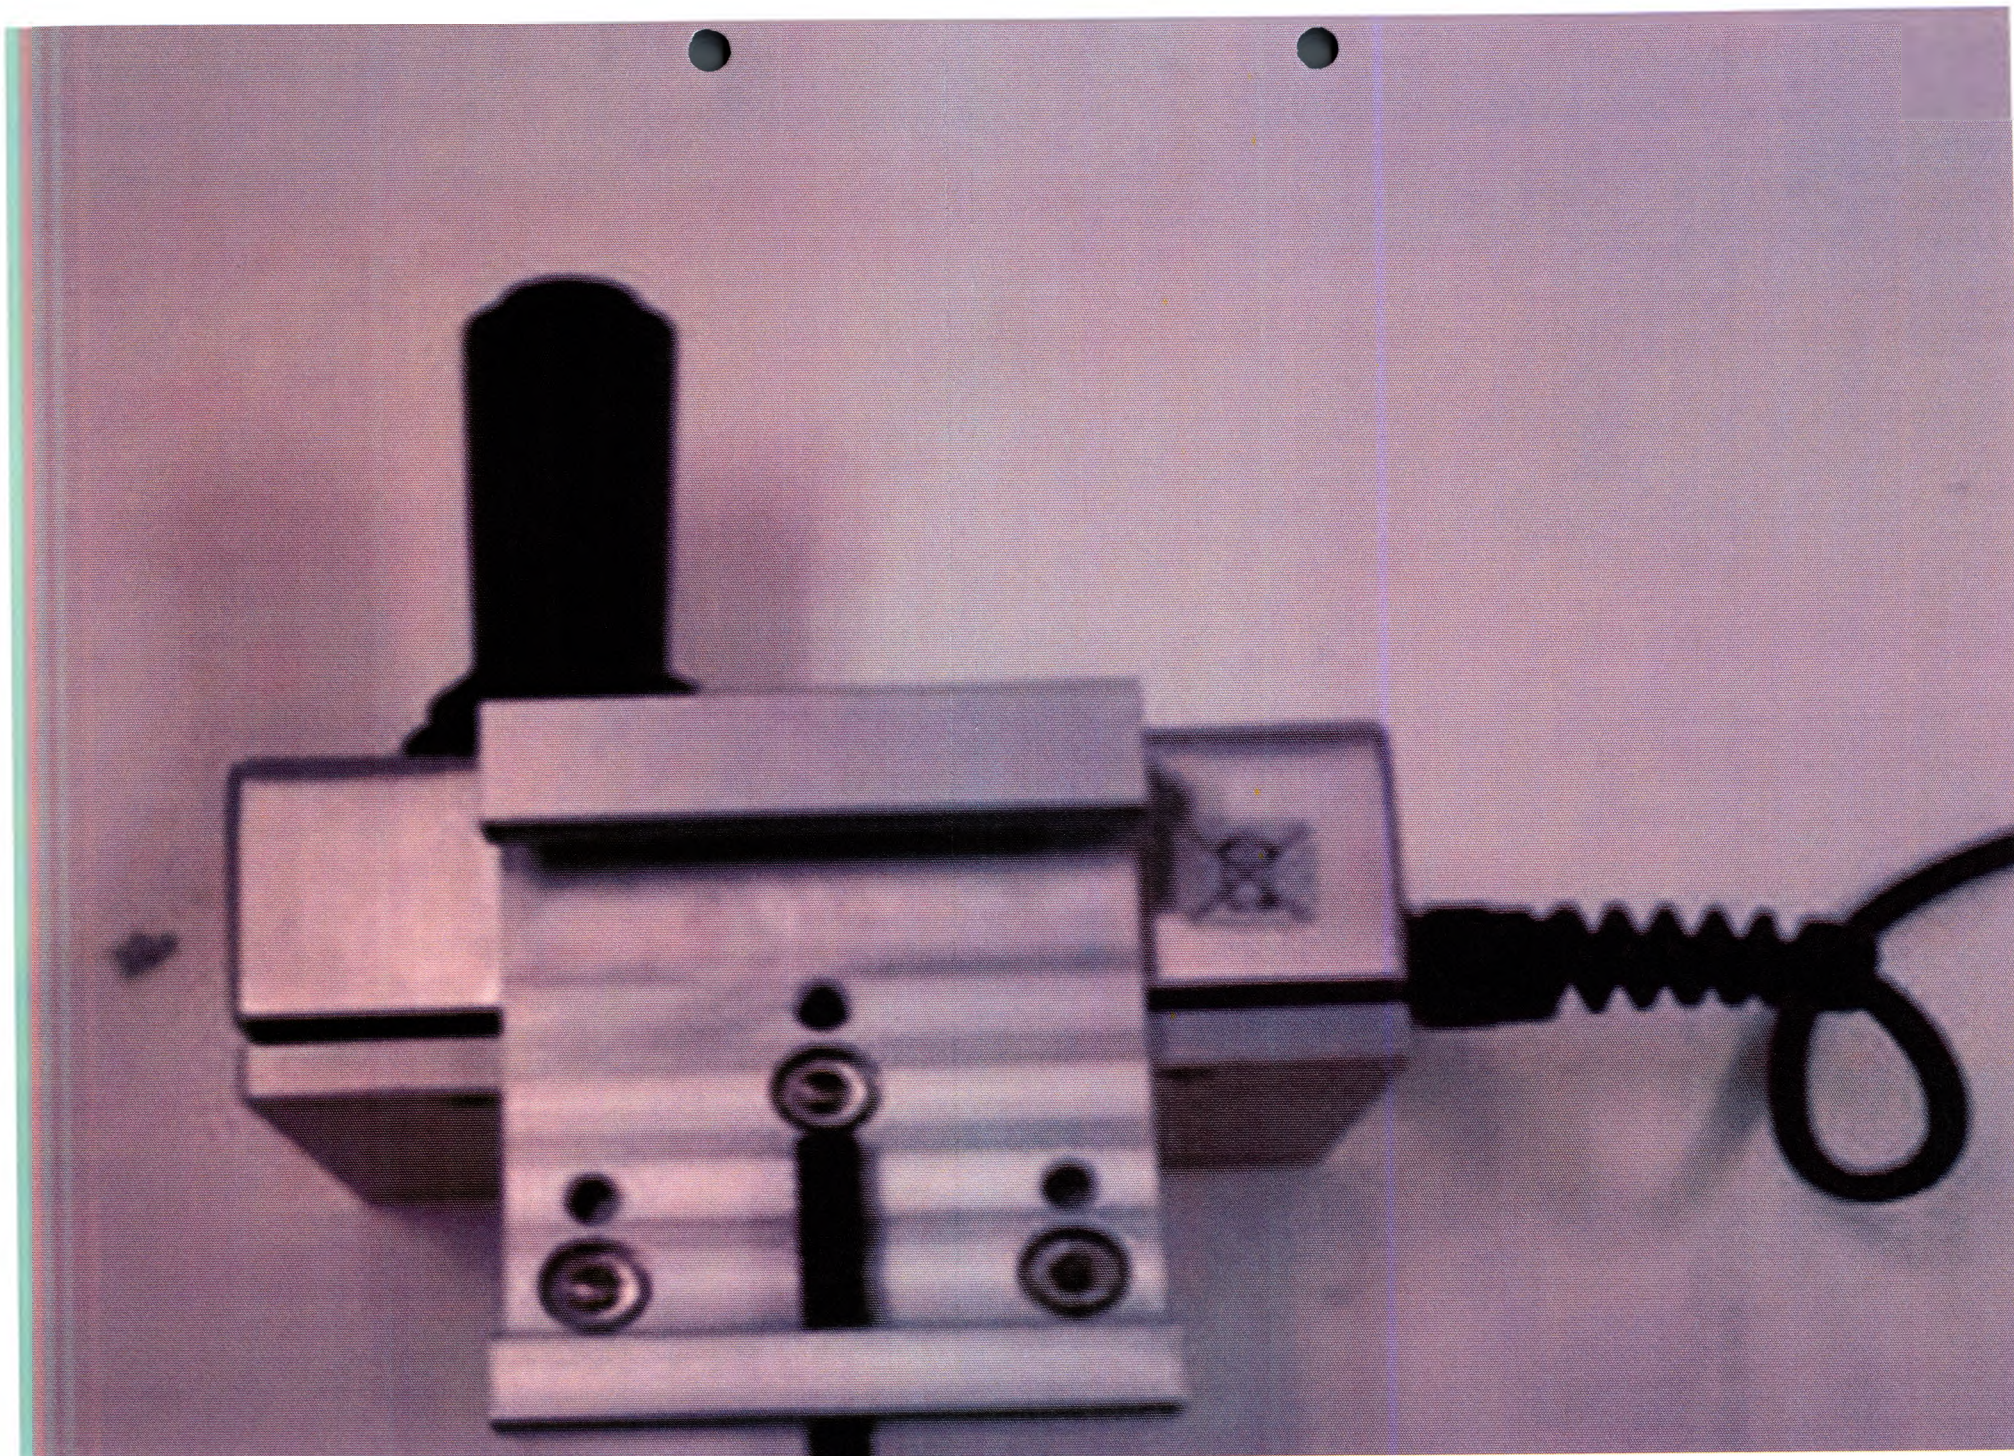

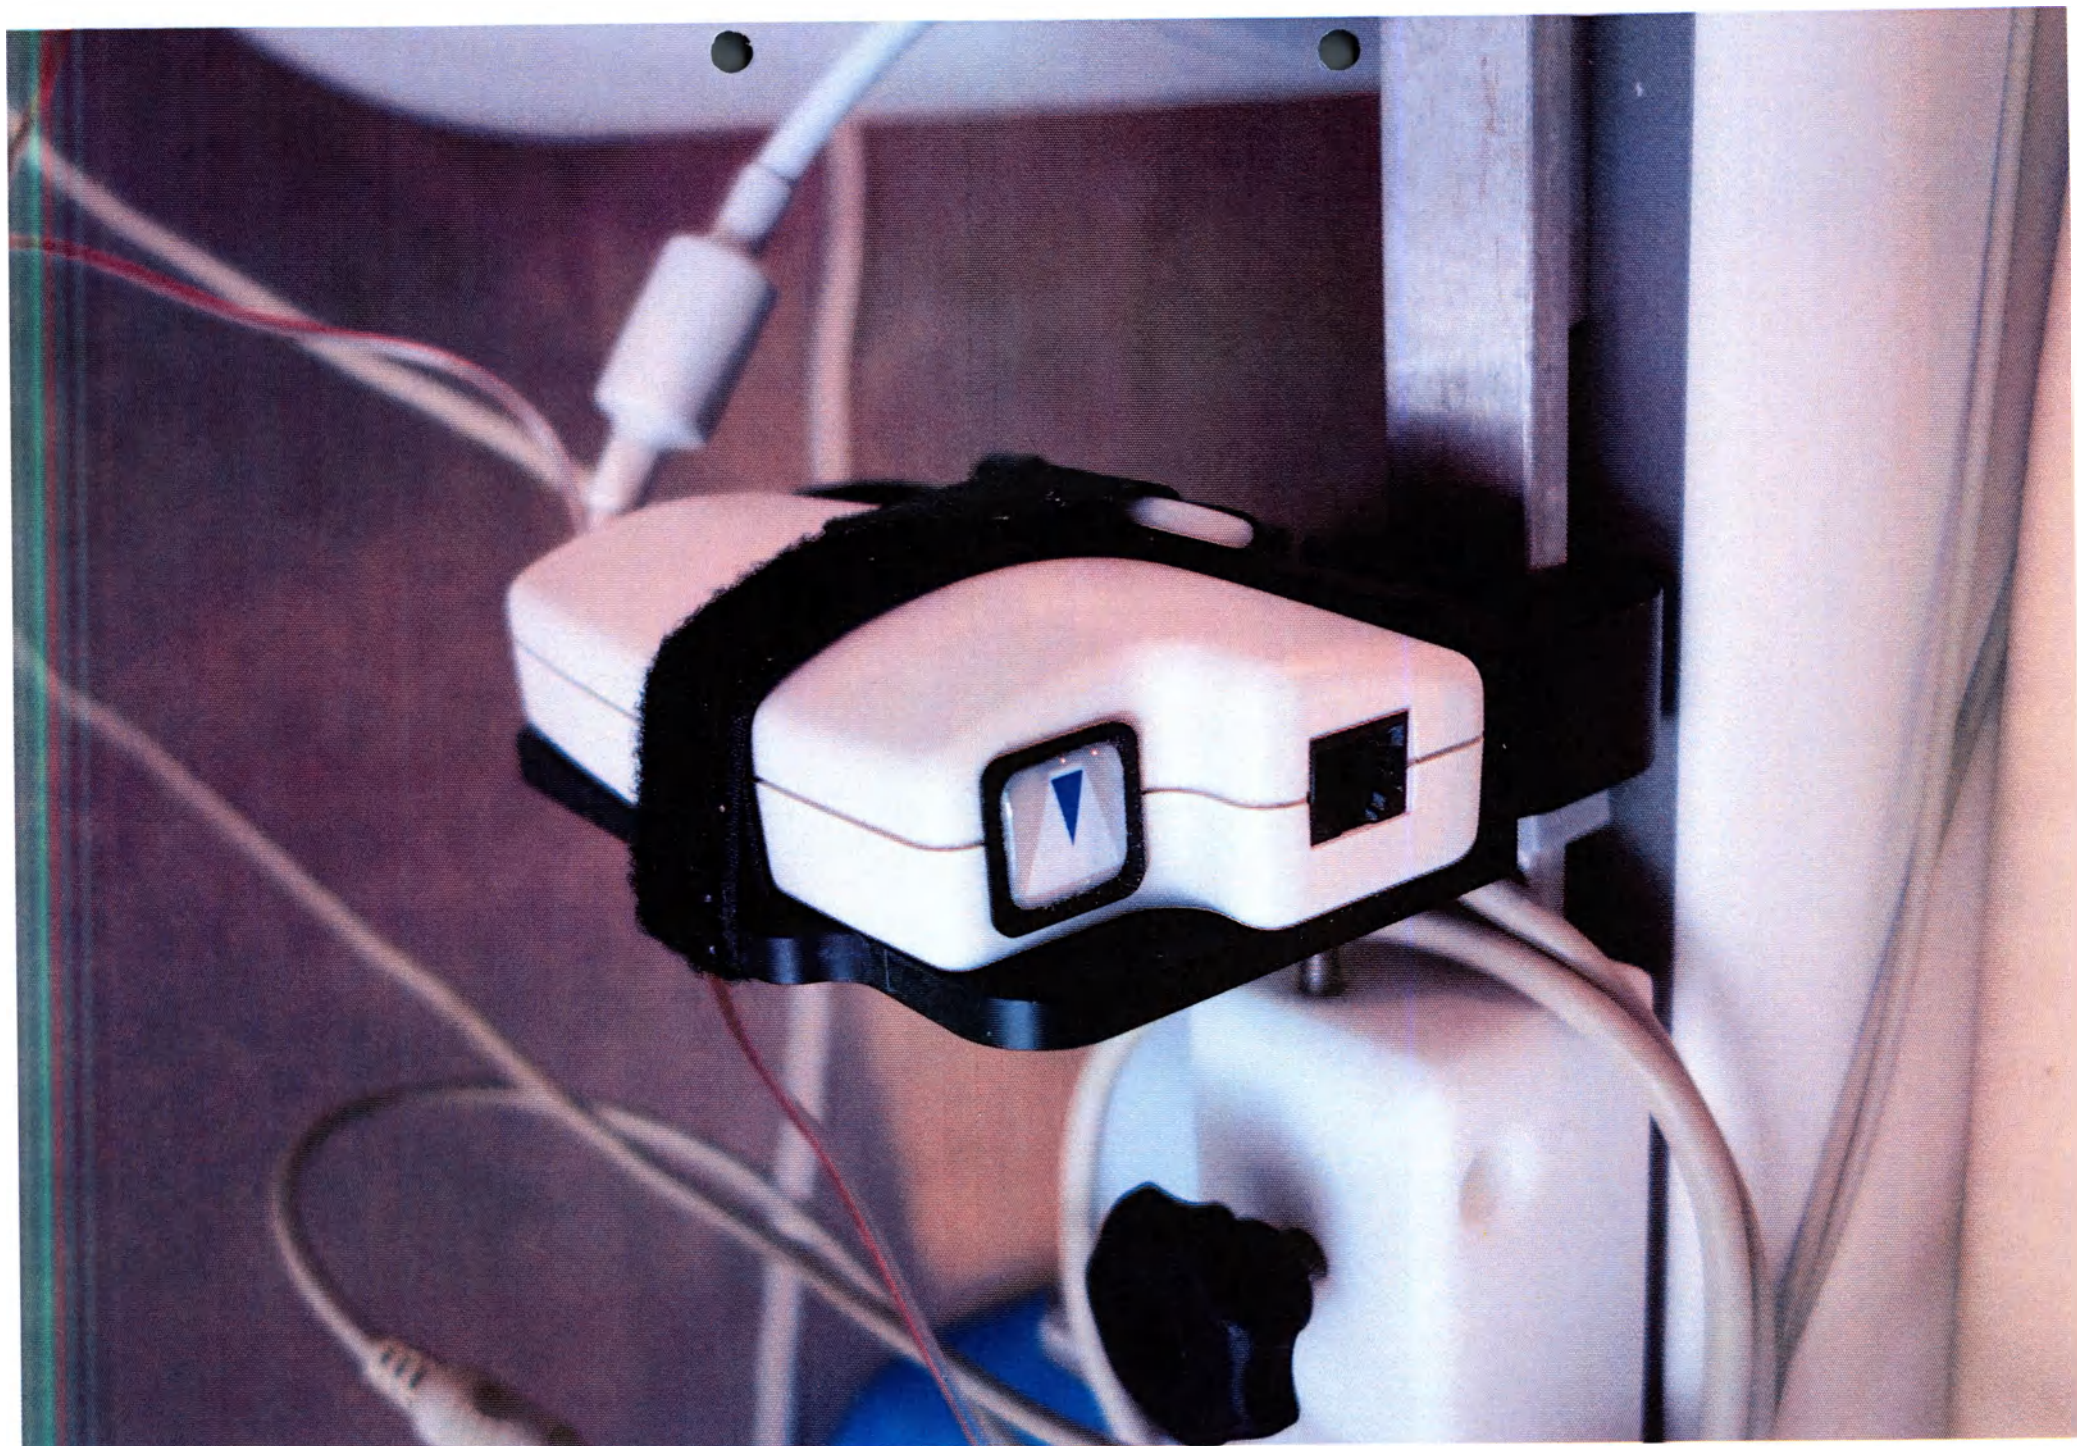



6. Интерфейсный модуль пациента PIMMETTE (FFR PIM).




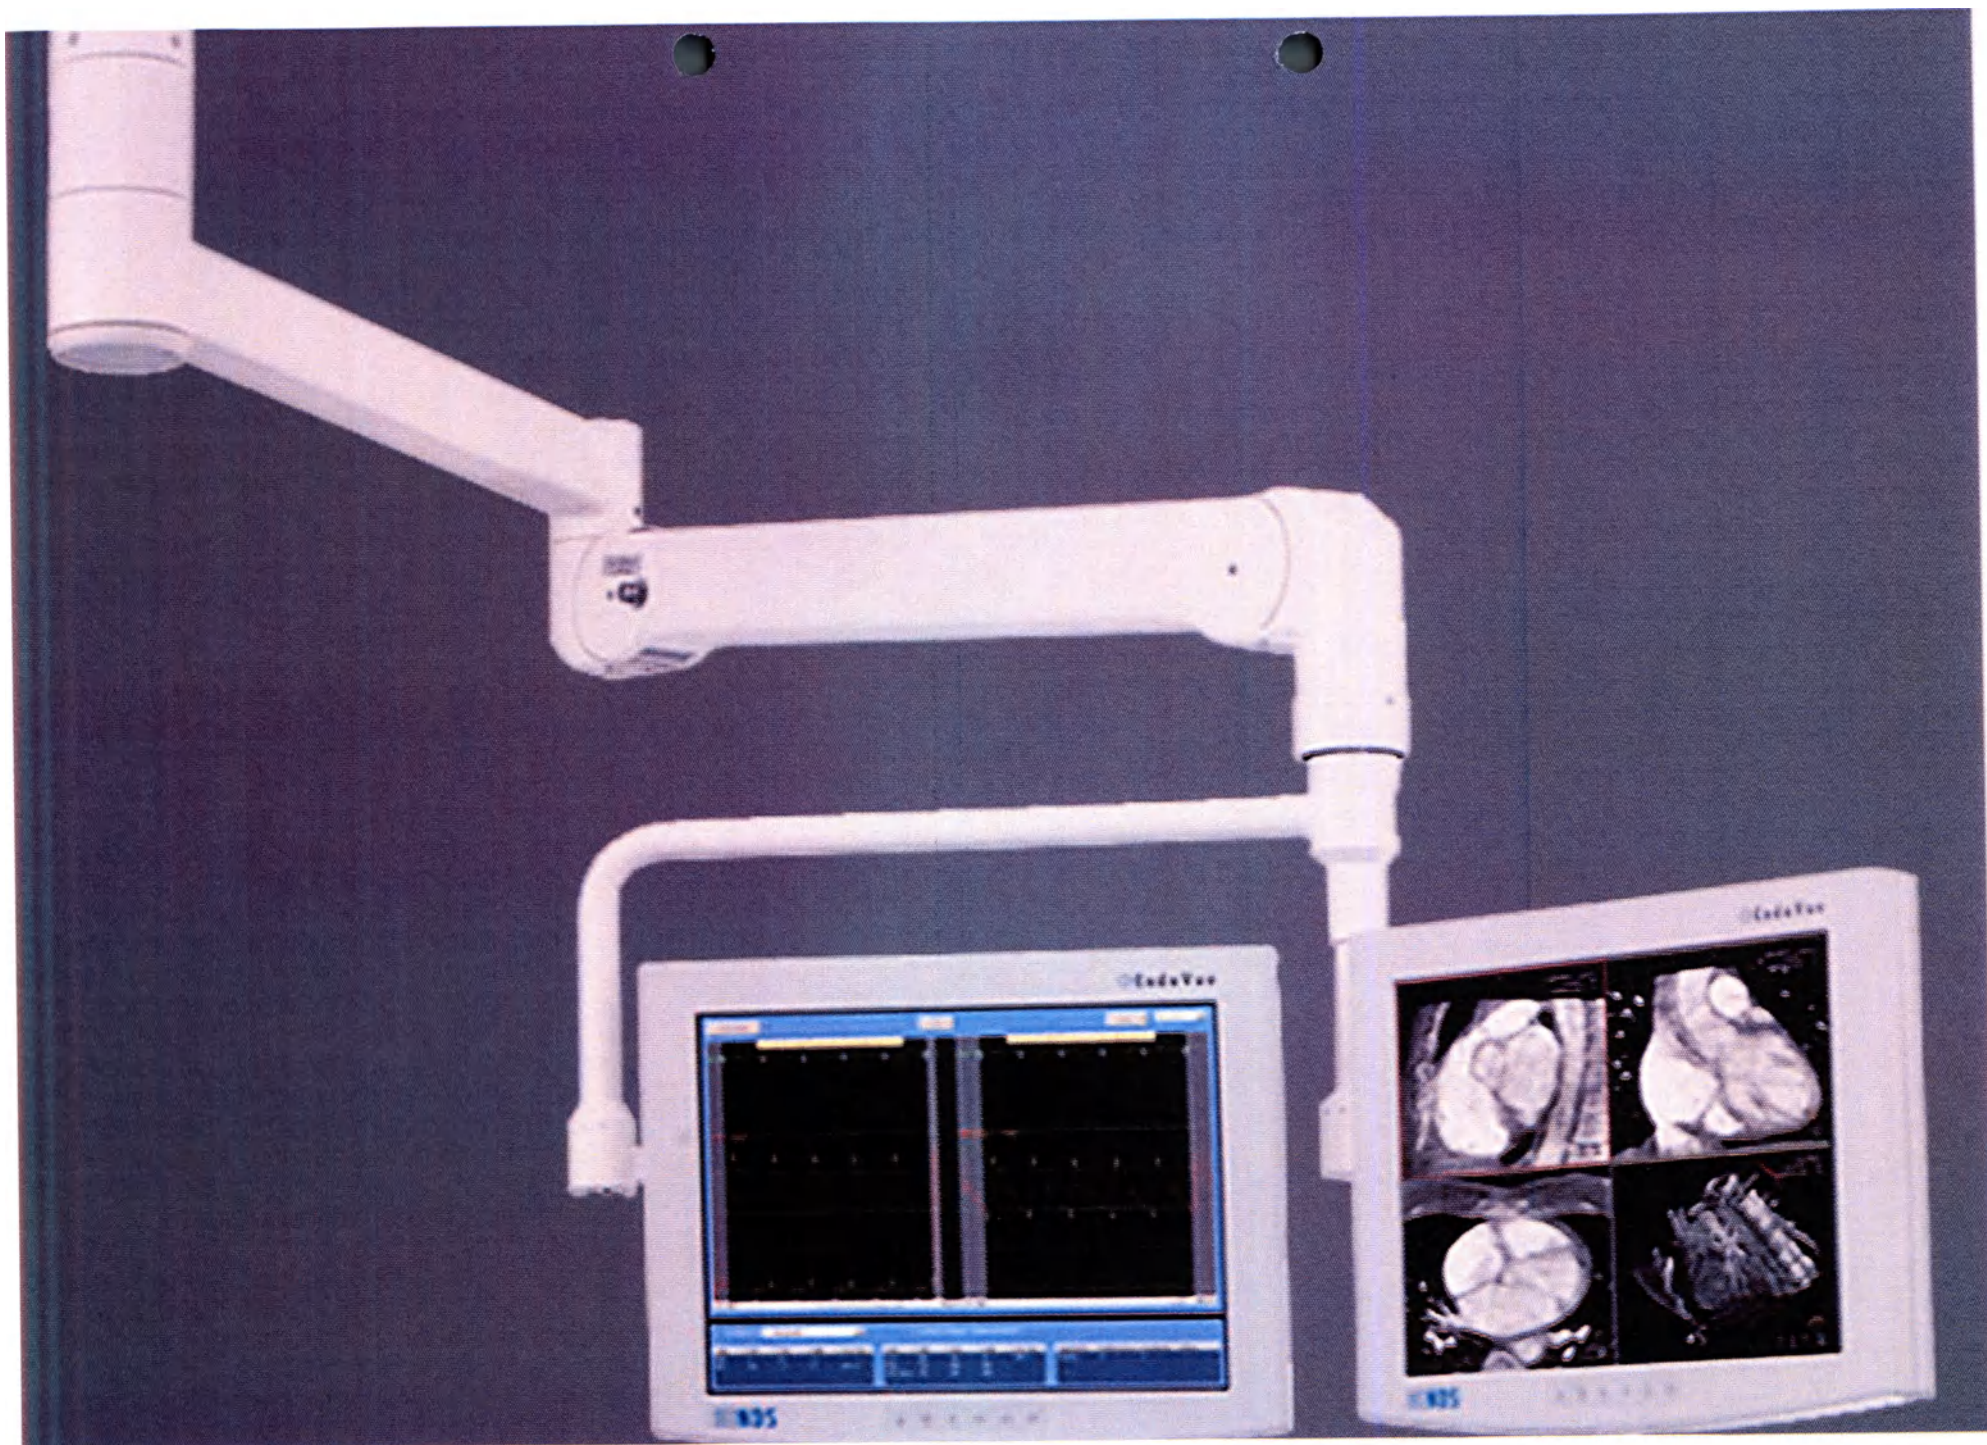




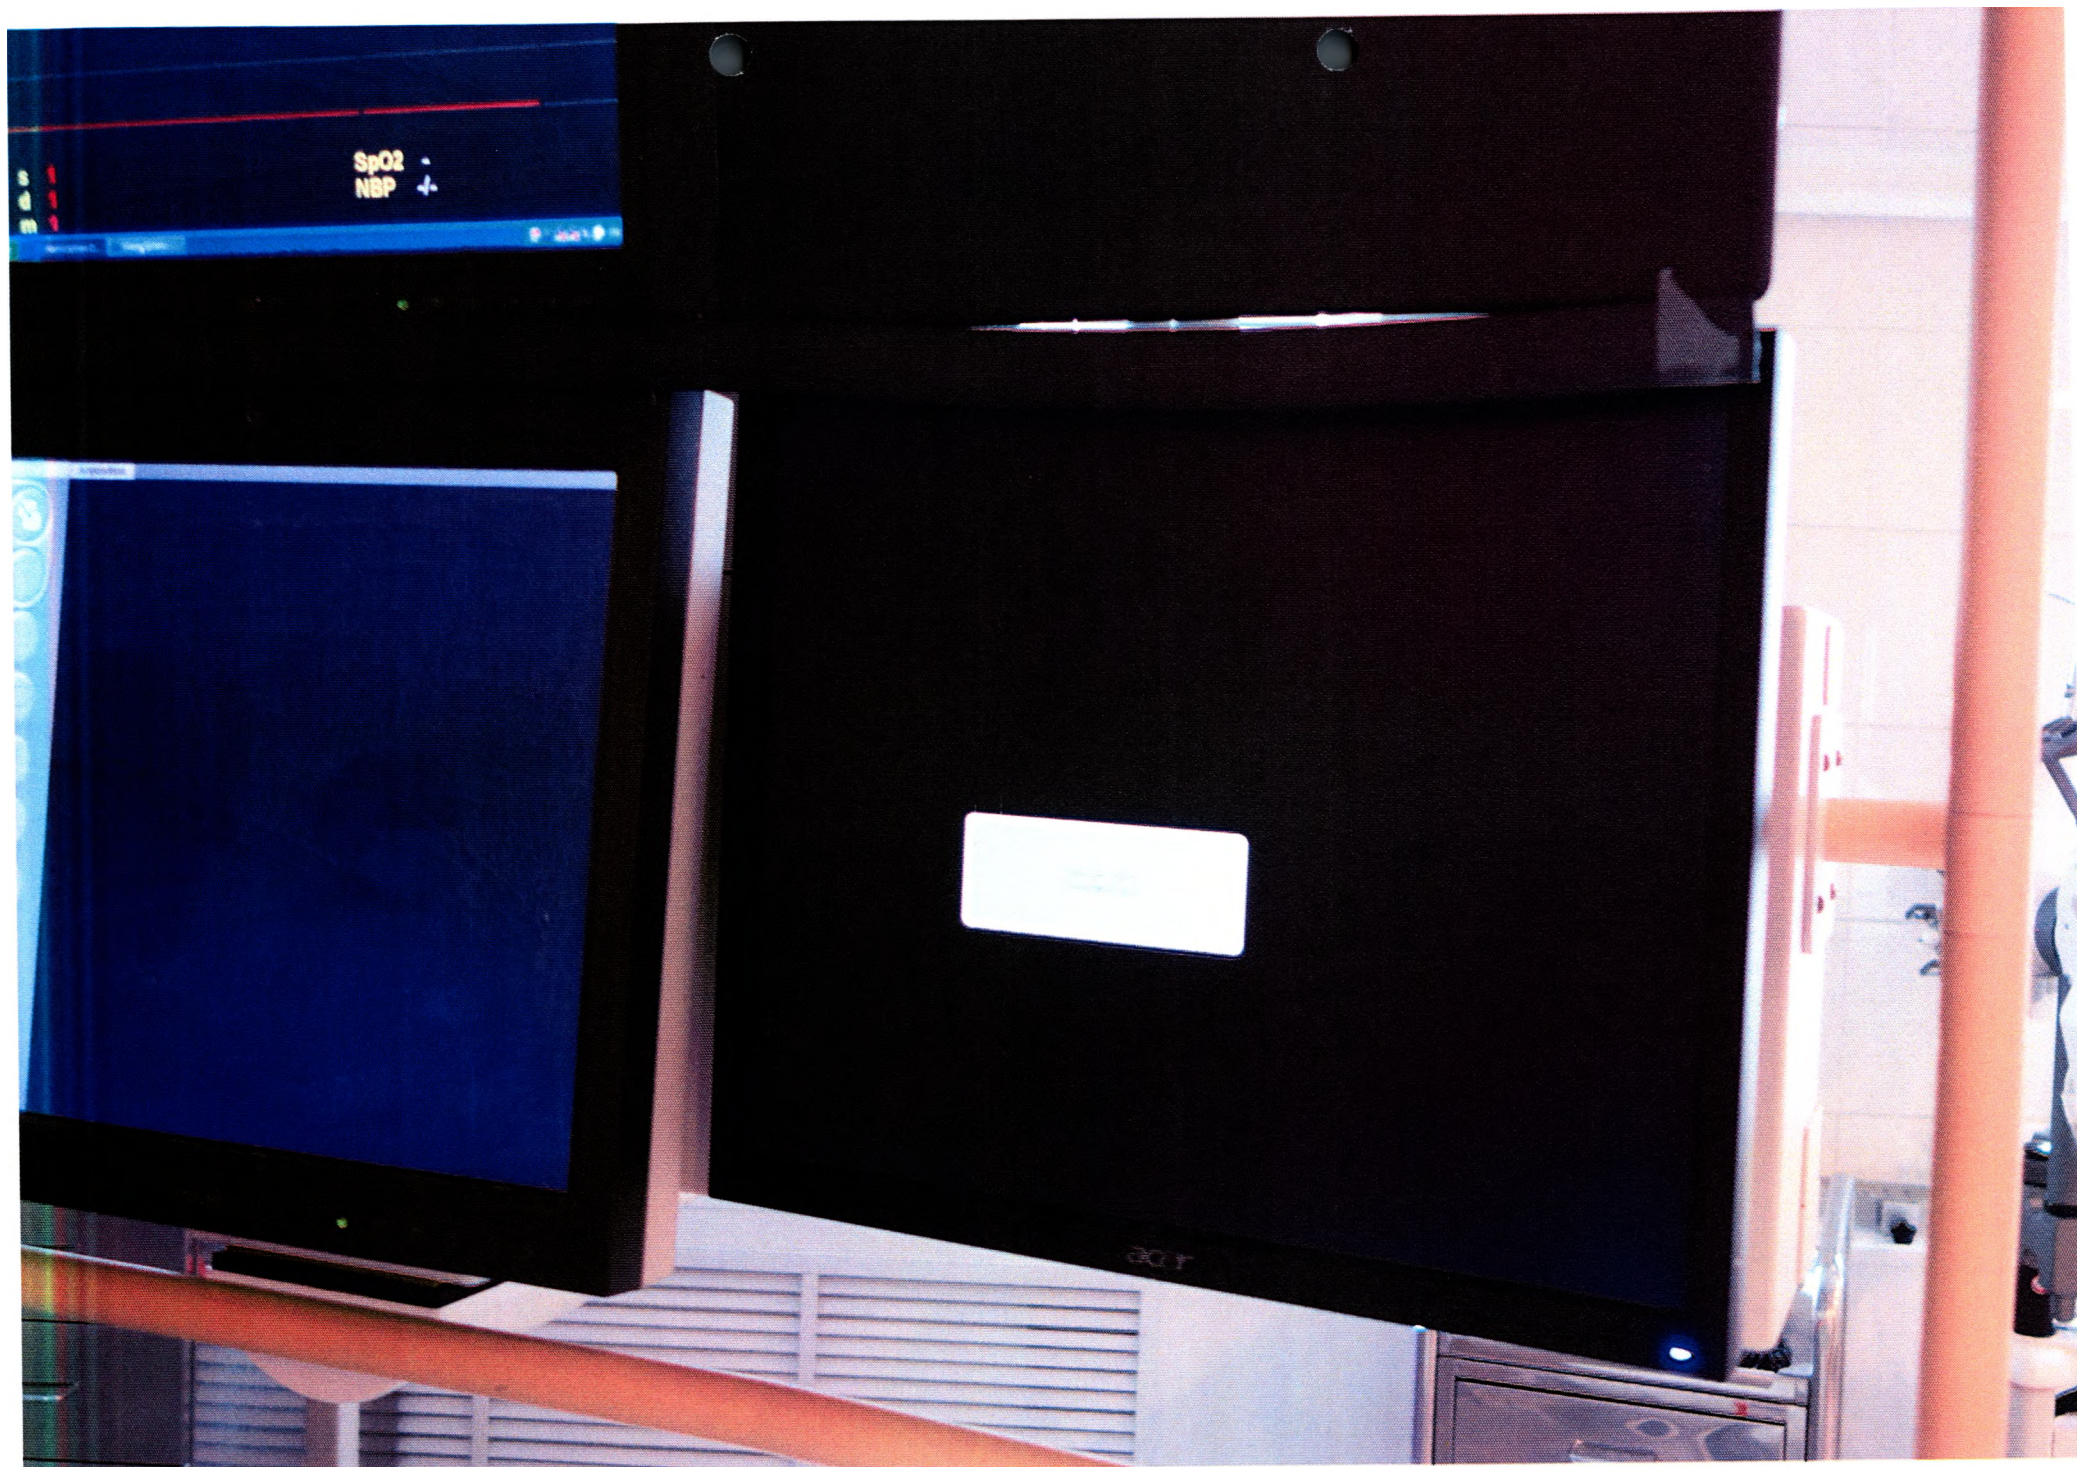

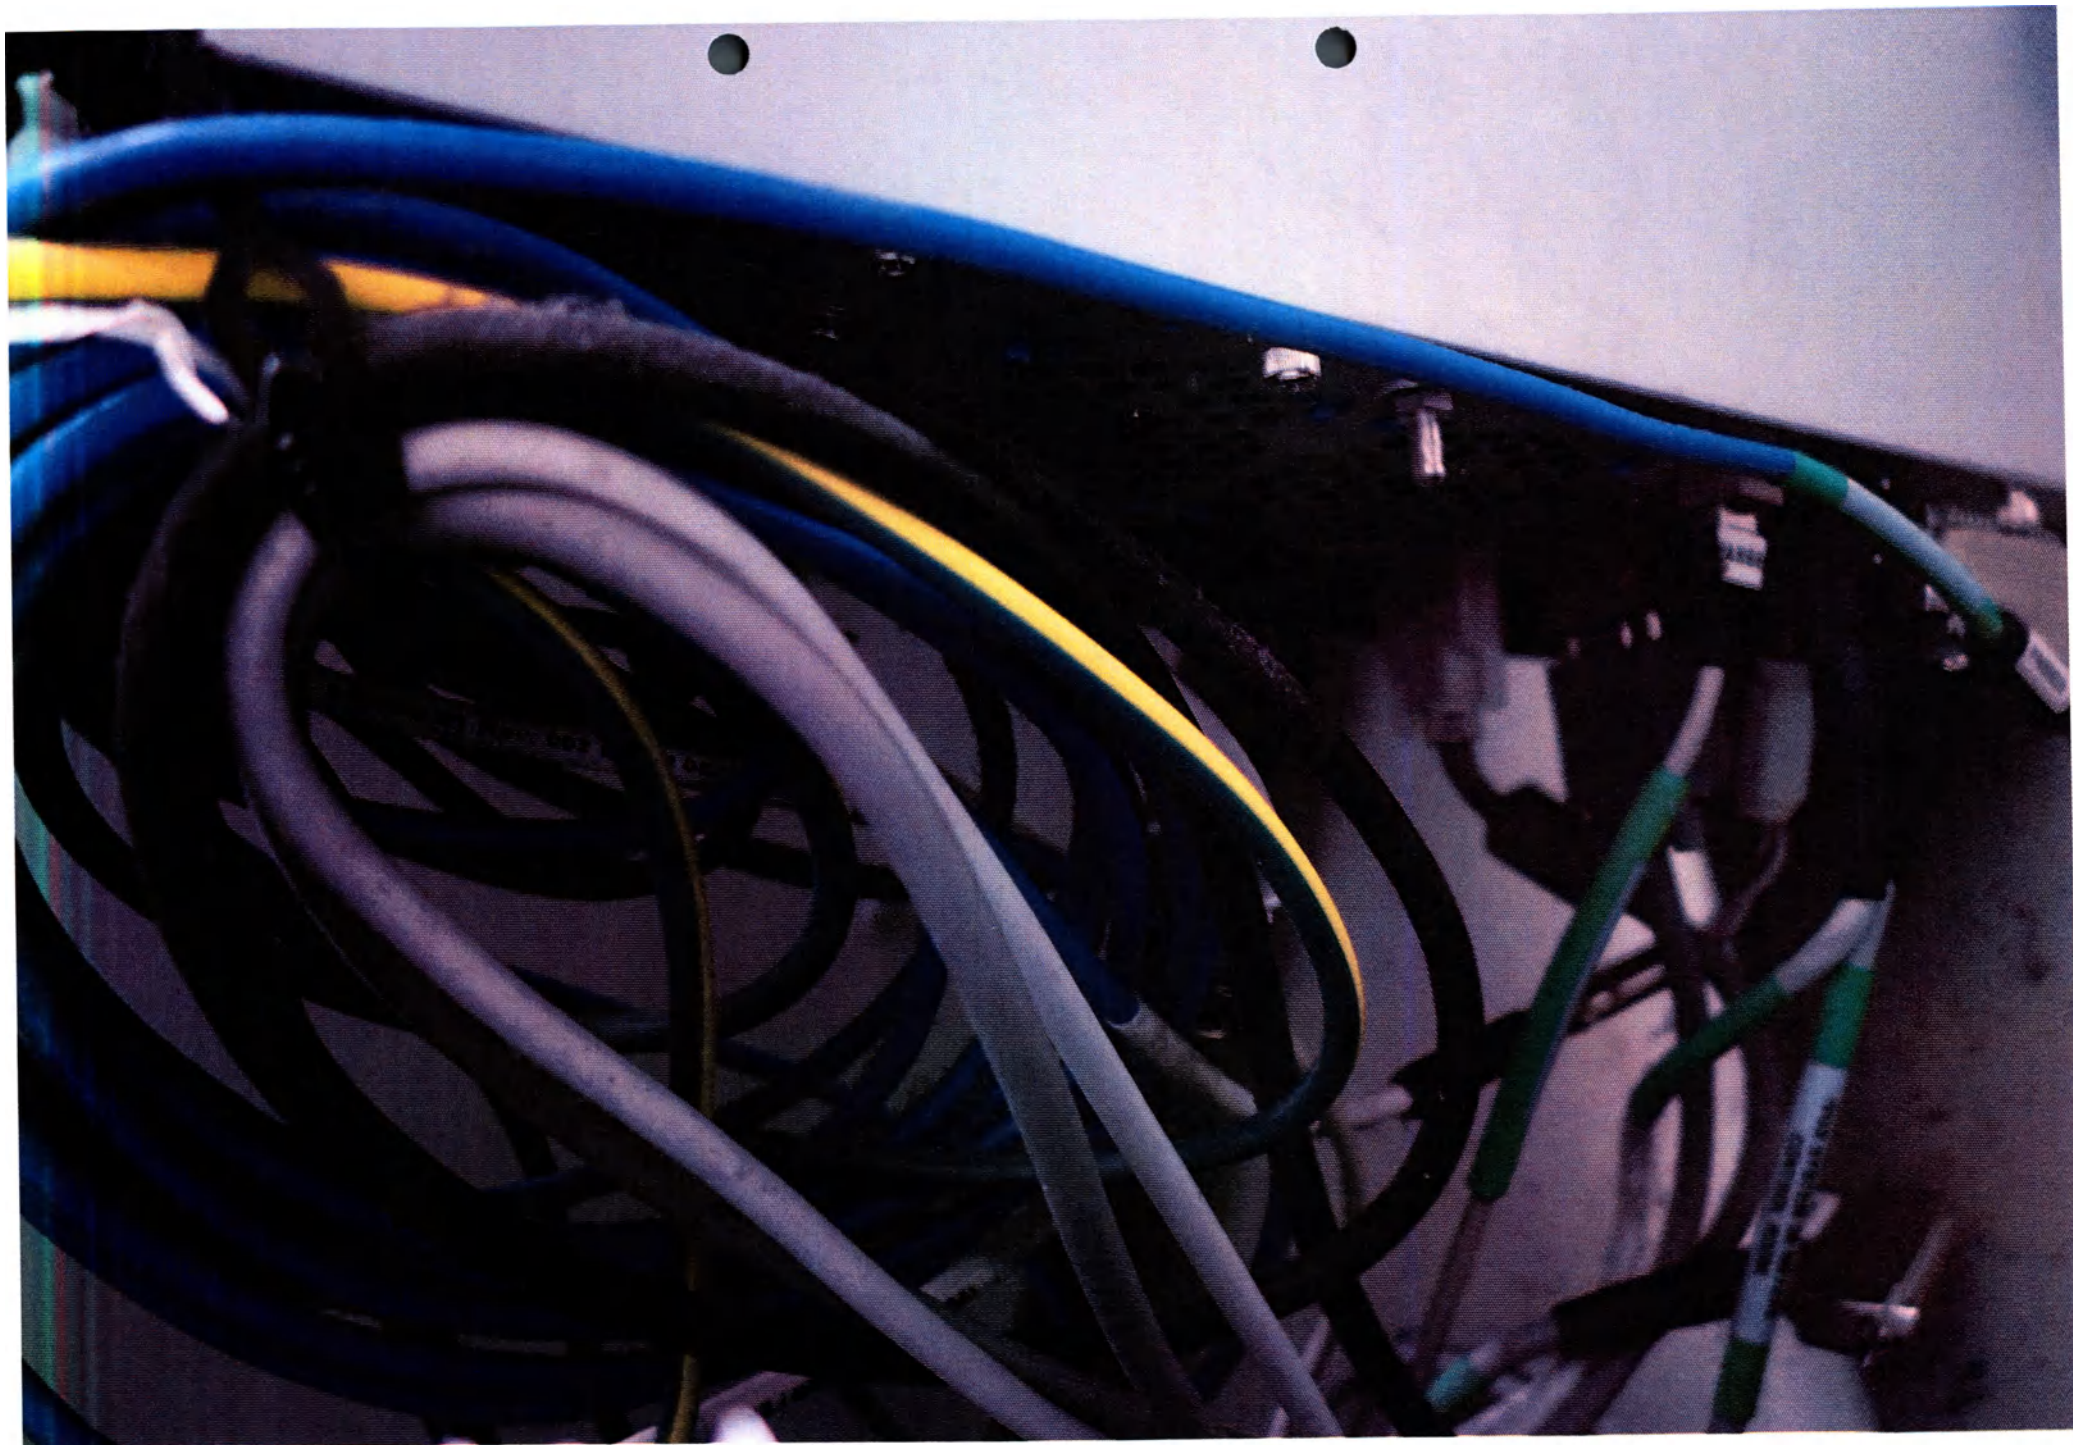

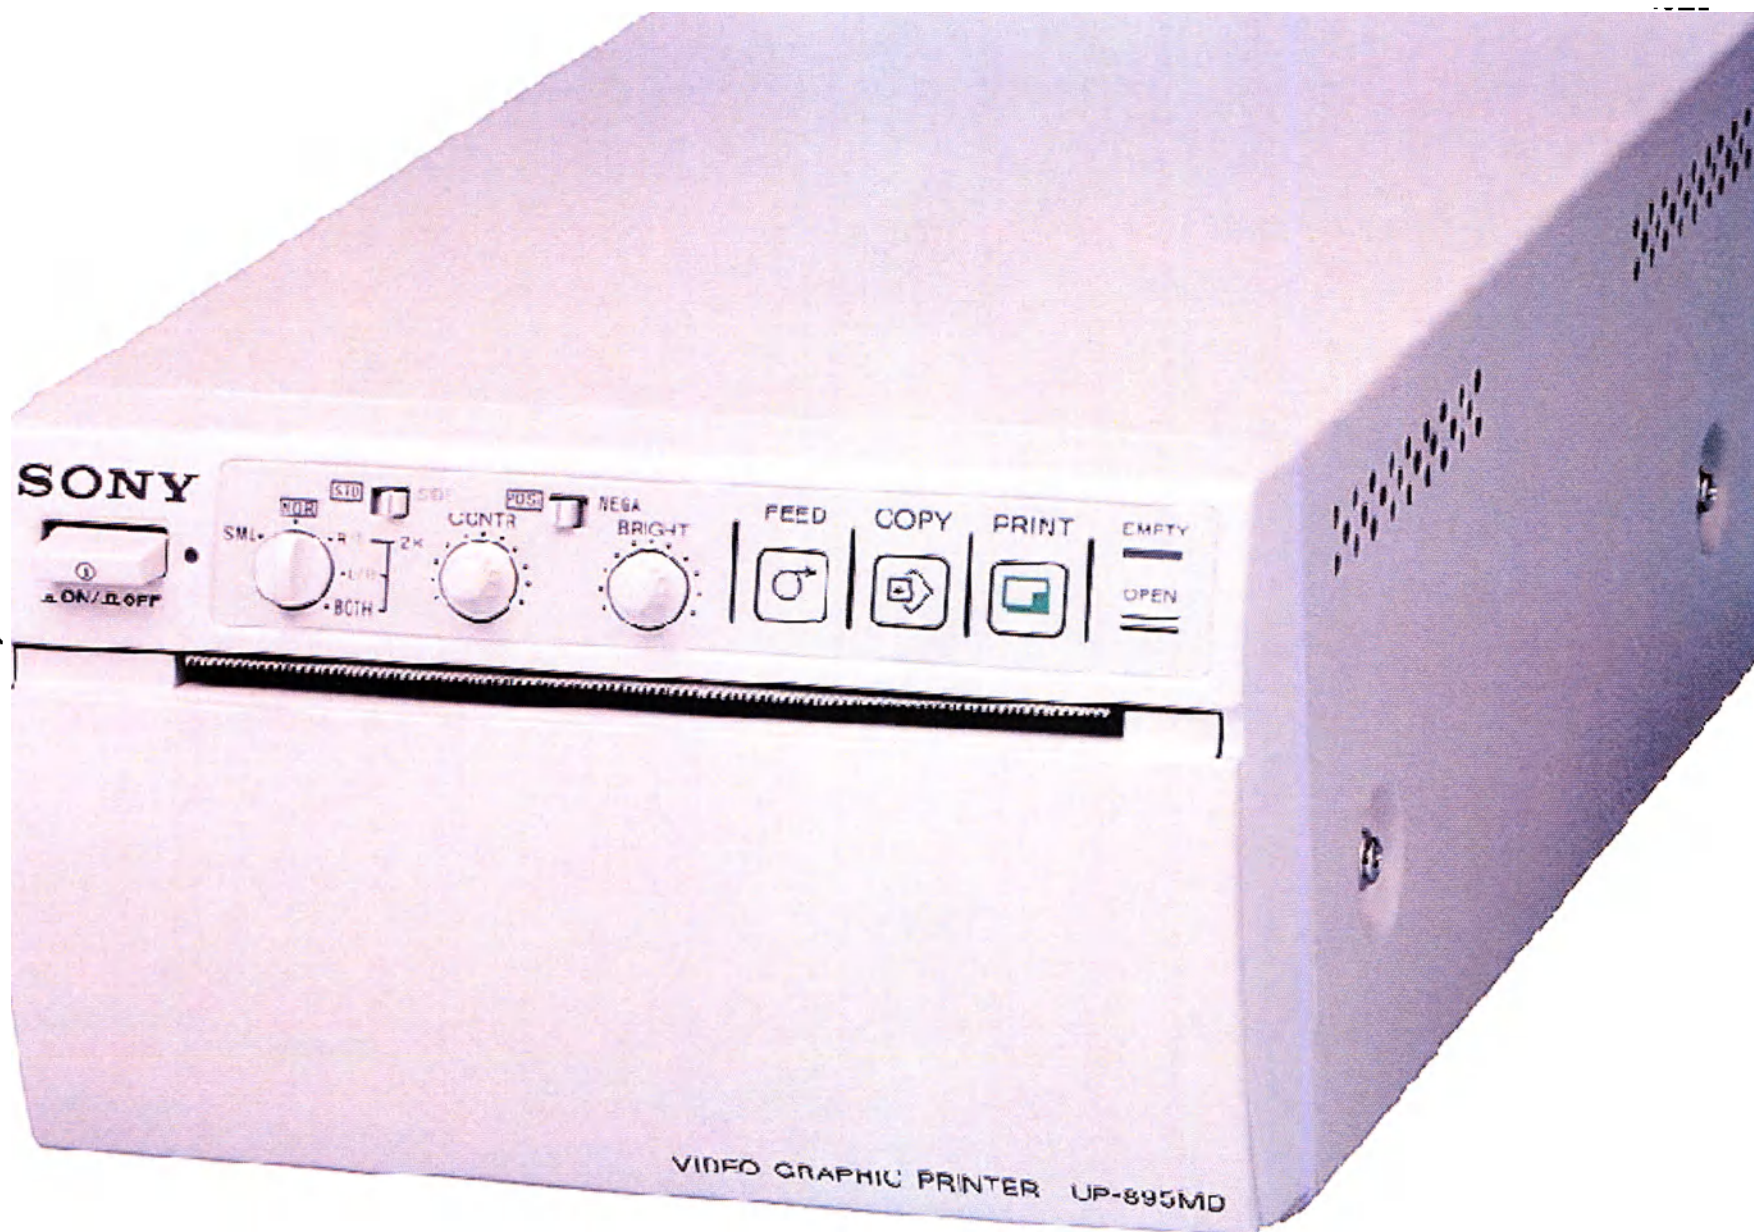

12. Цветной термопринтер.

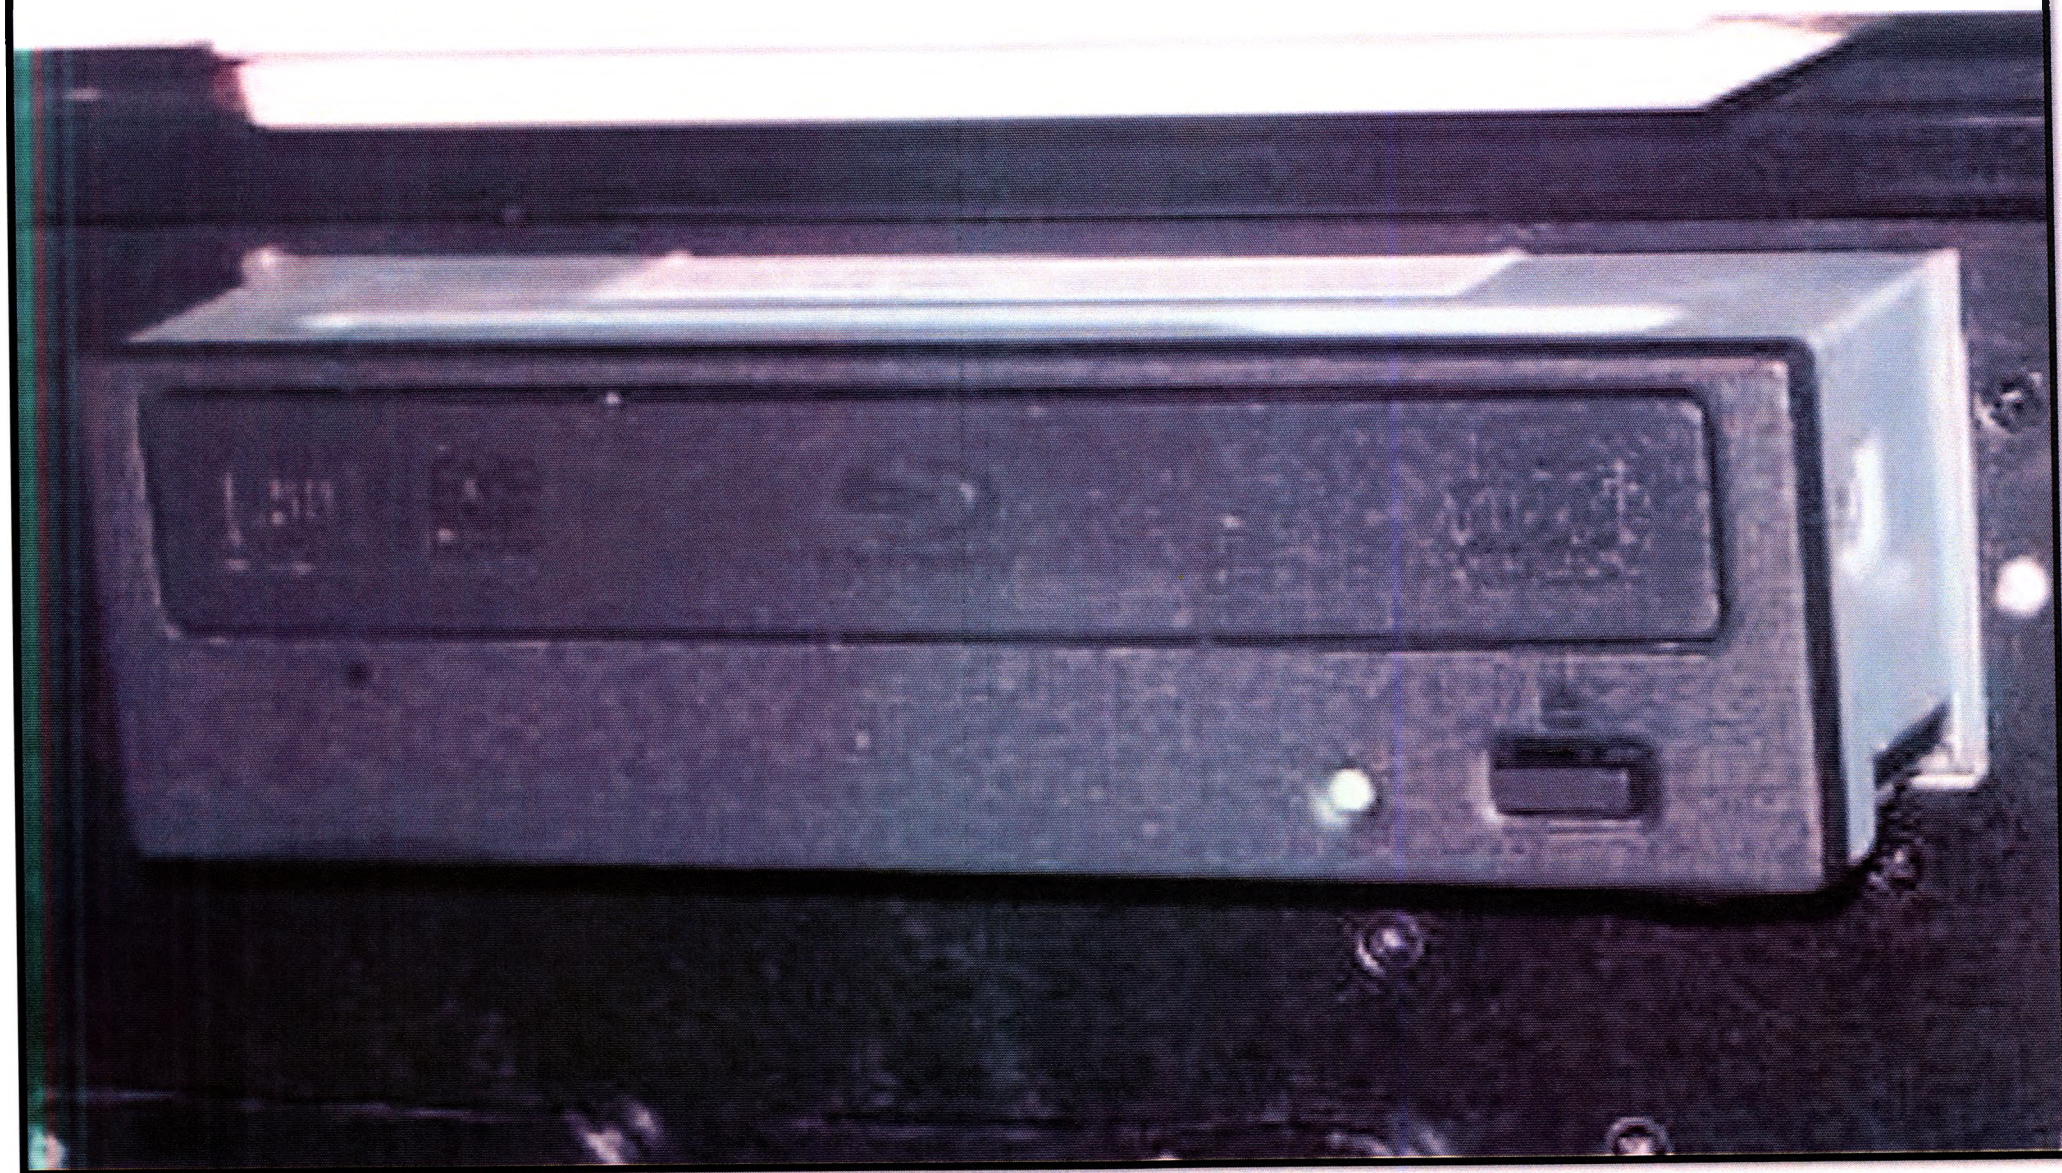



0:05

iFR™

0.91

List of Runs


iFR

FFR

10:56:43

0.91

LAD

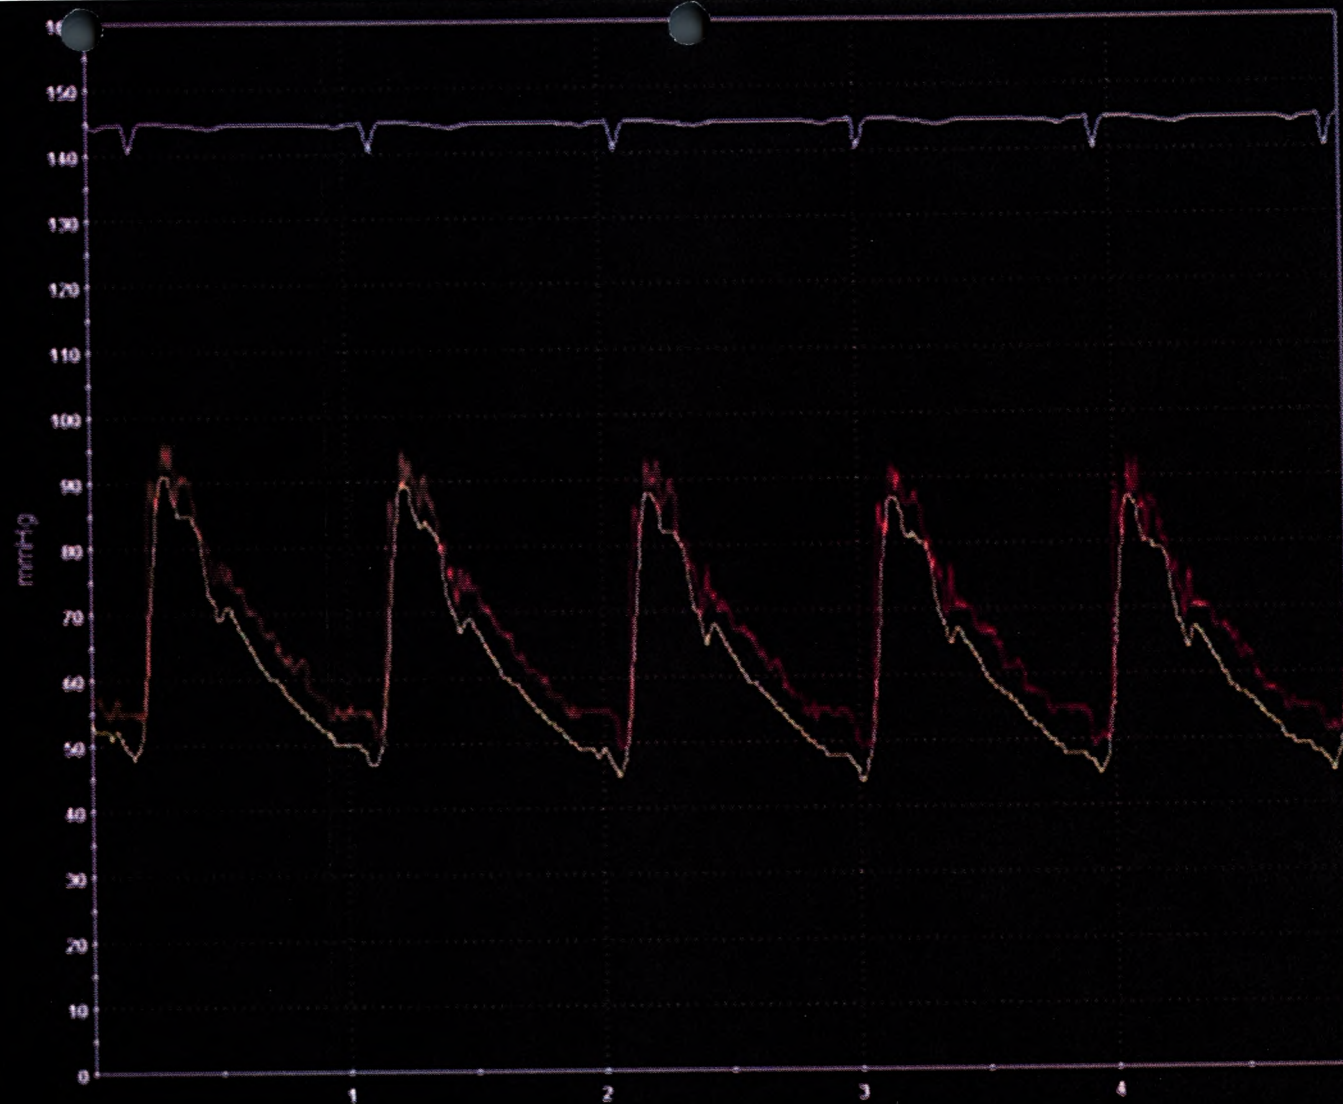

Live

Options

Save Frame

Select  
Mode

Settings


Patient

FFR

iFR™


iFR measurement complete


FFR PIM

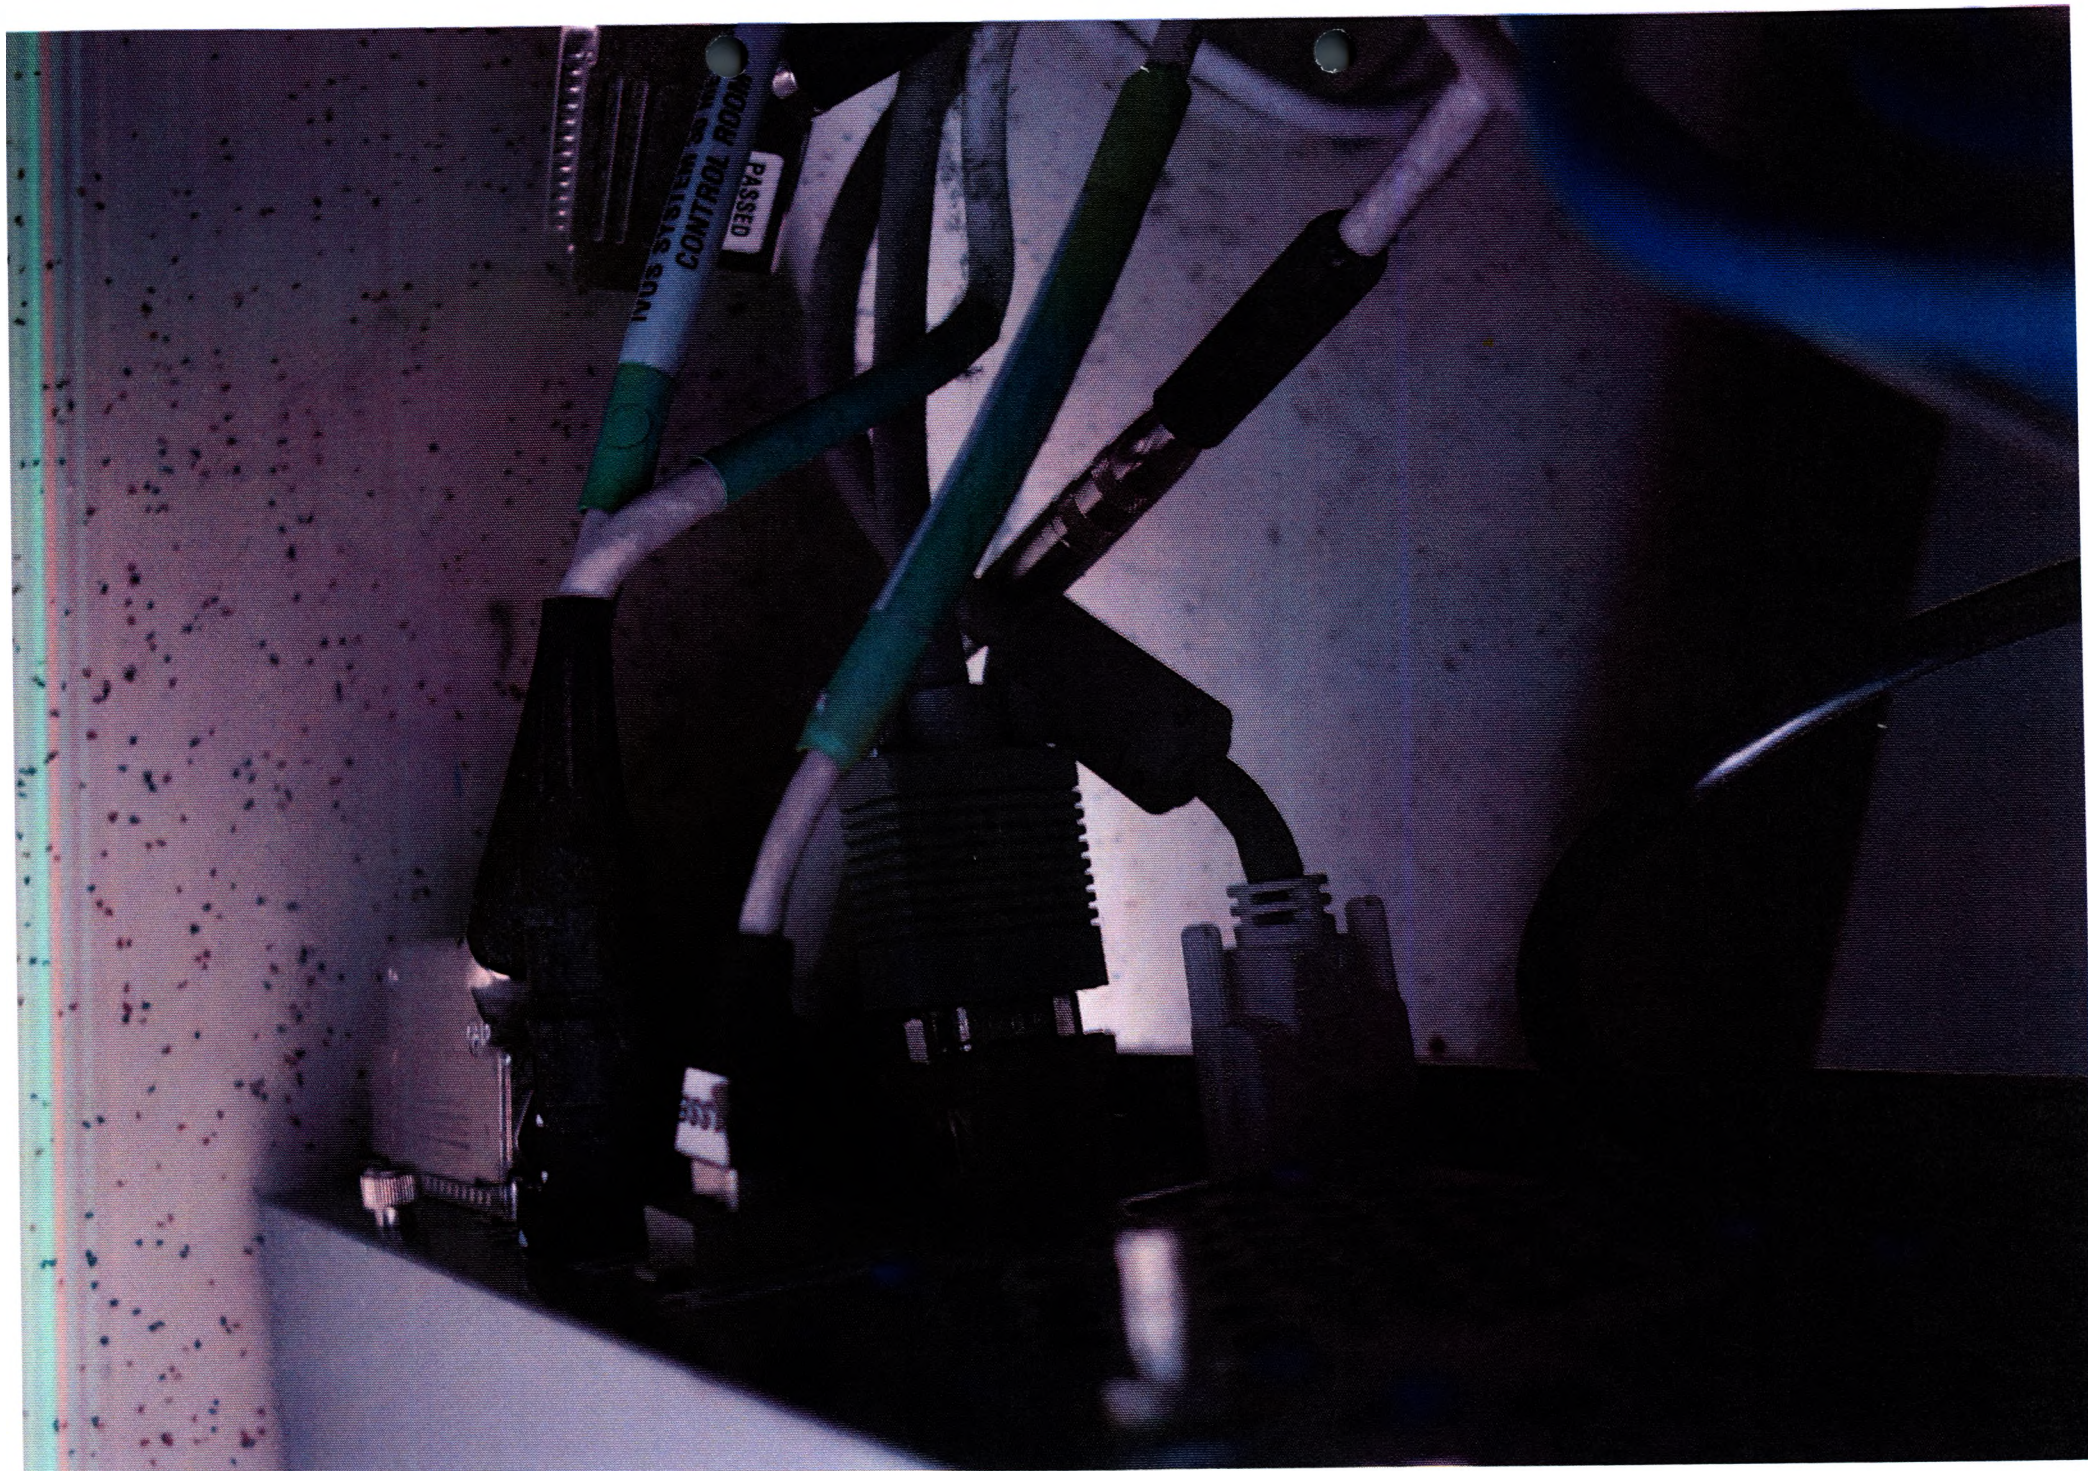






17. Блок переключения сигнала.

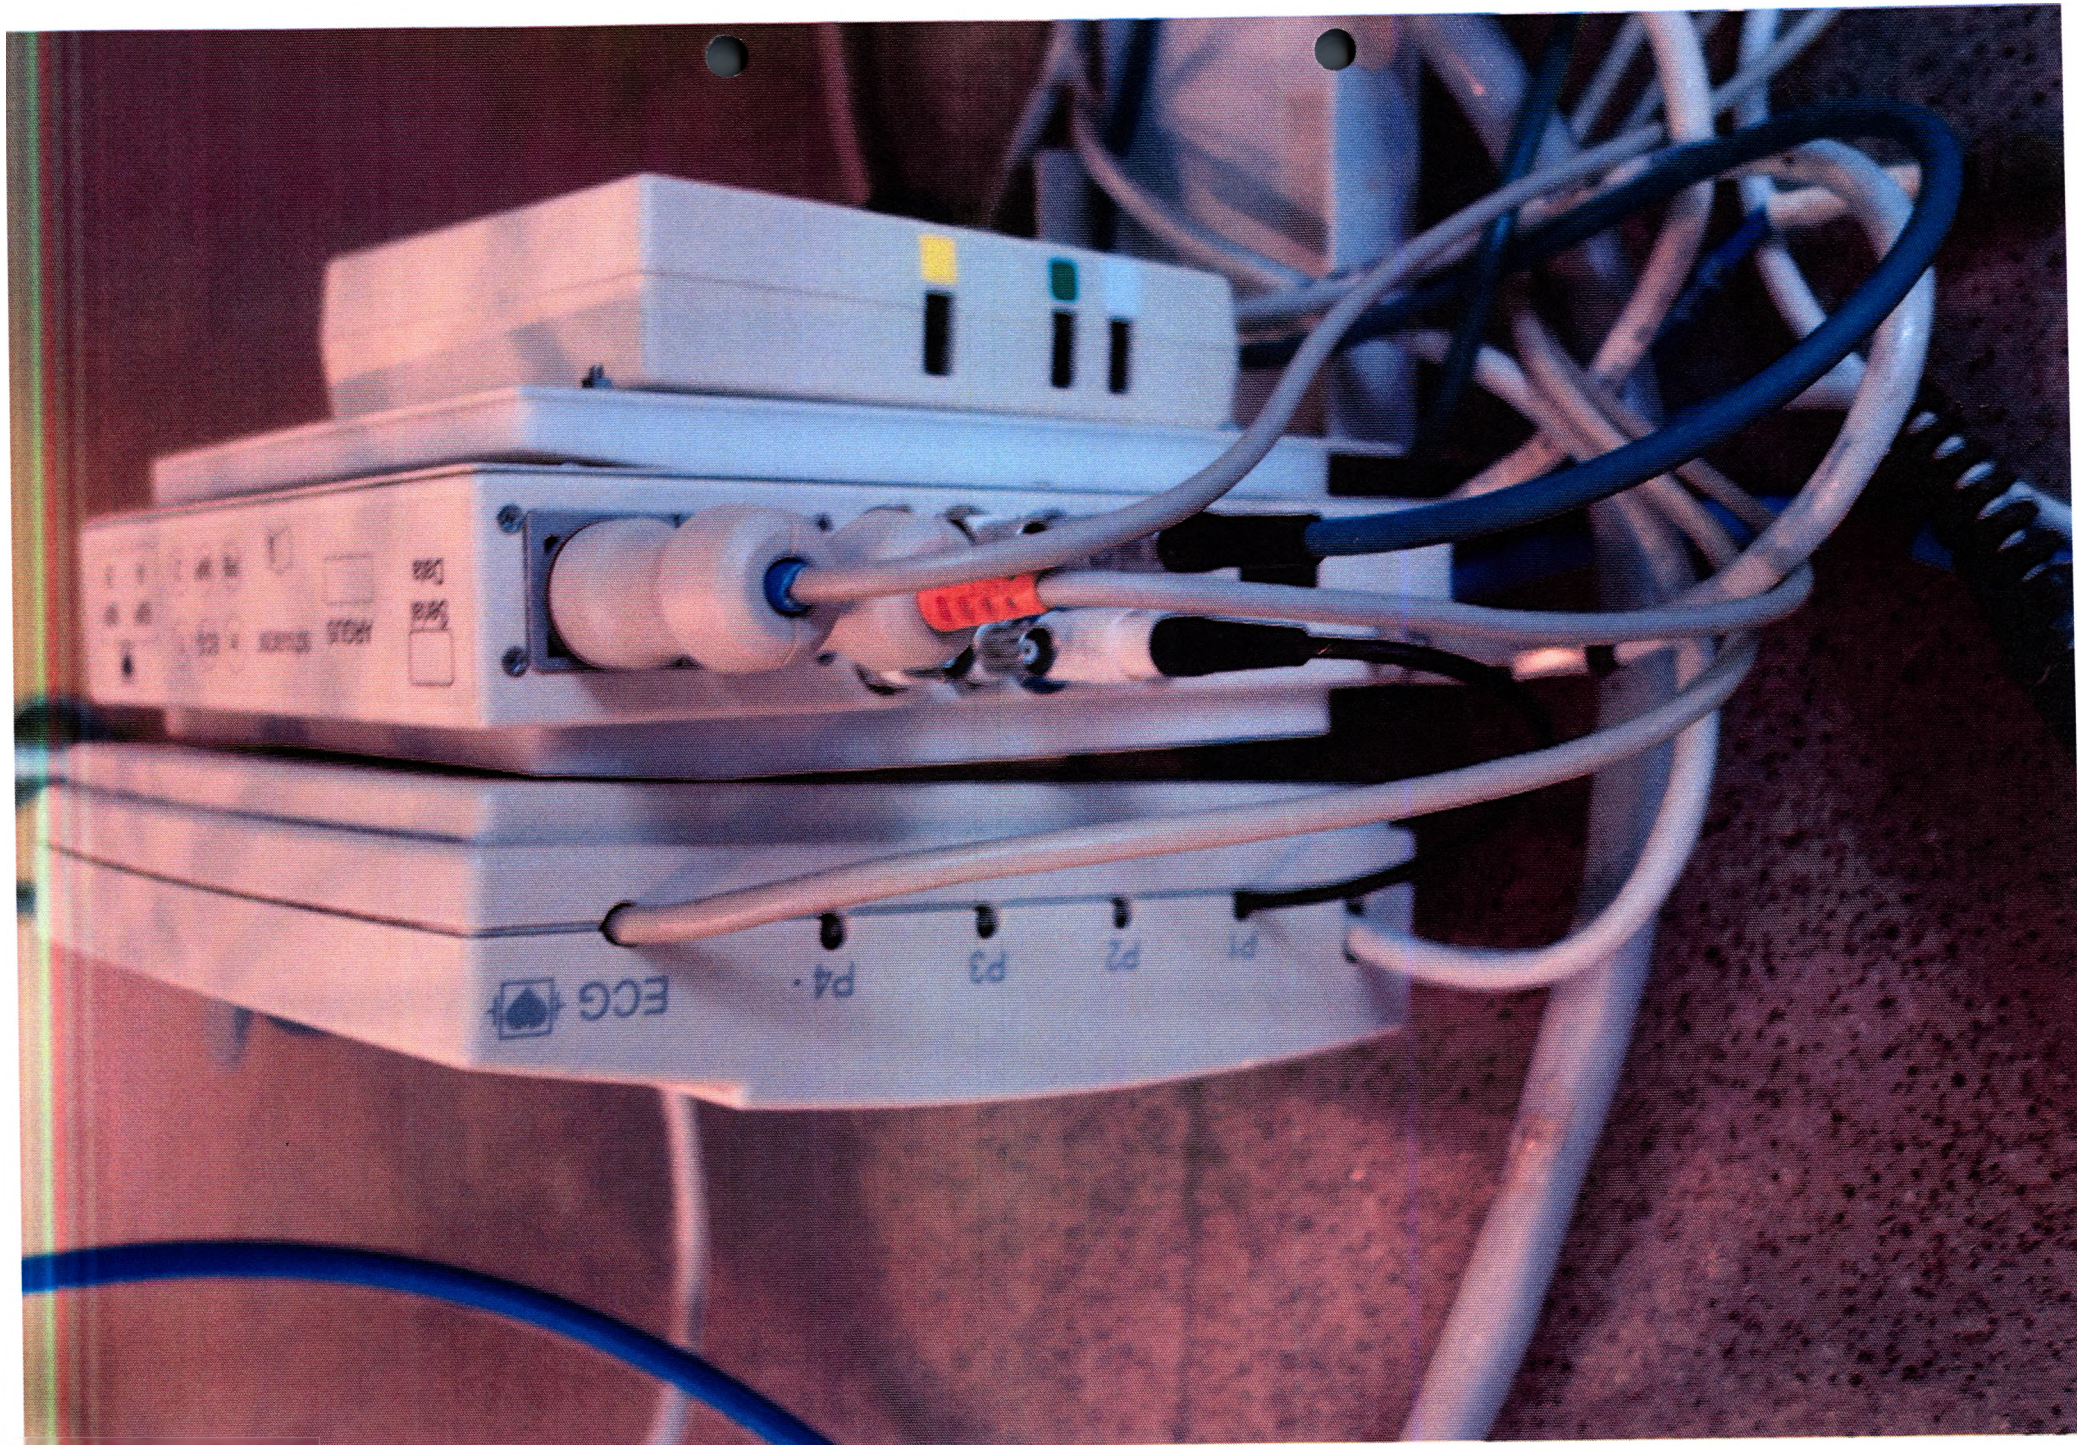


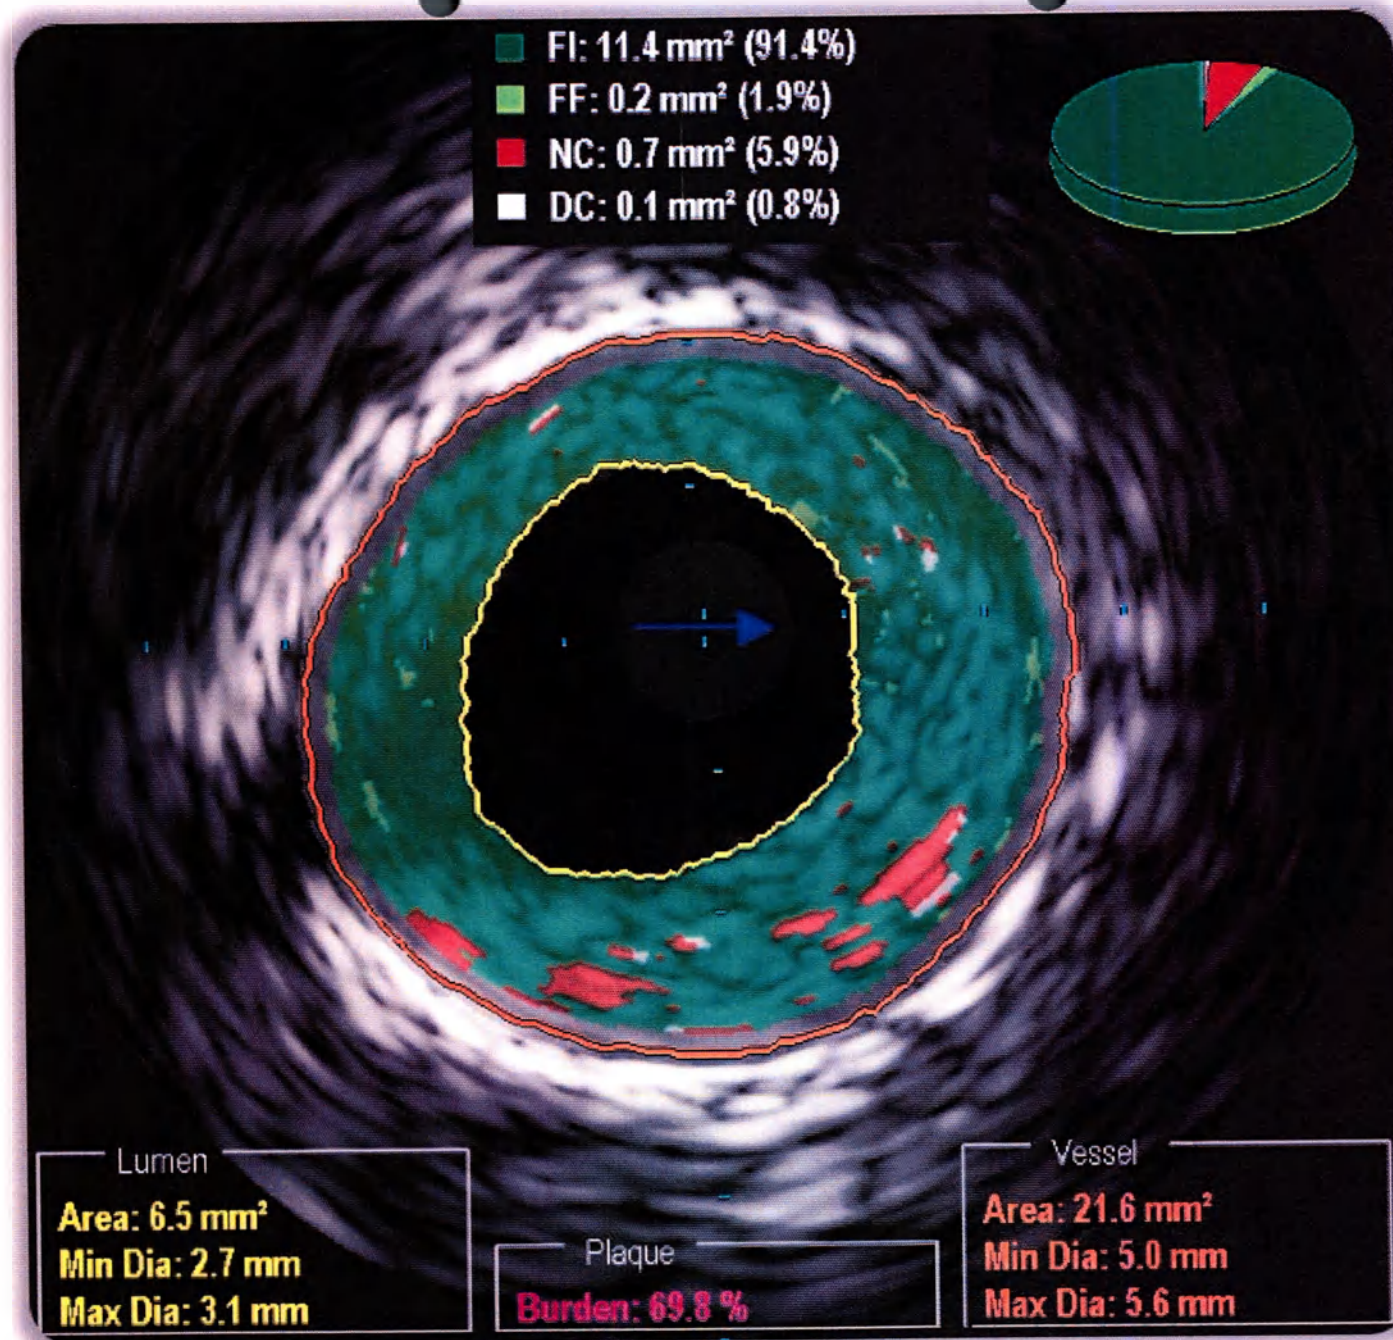

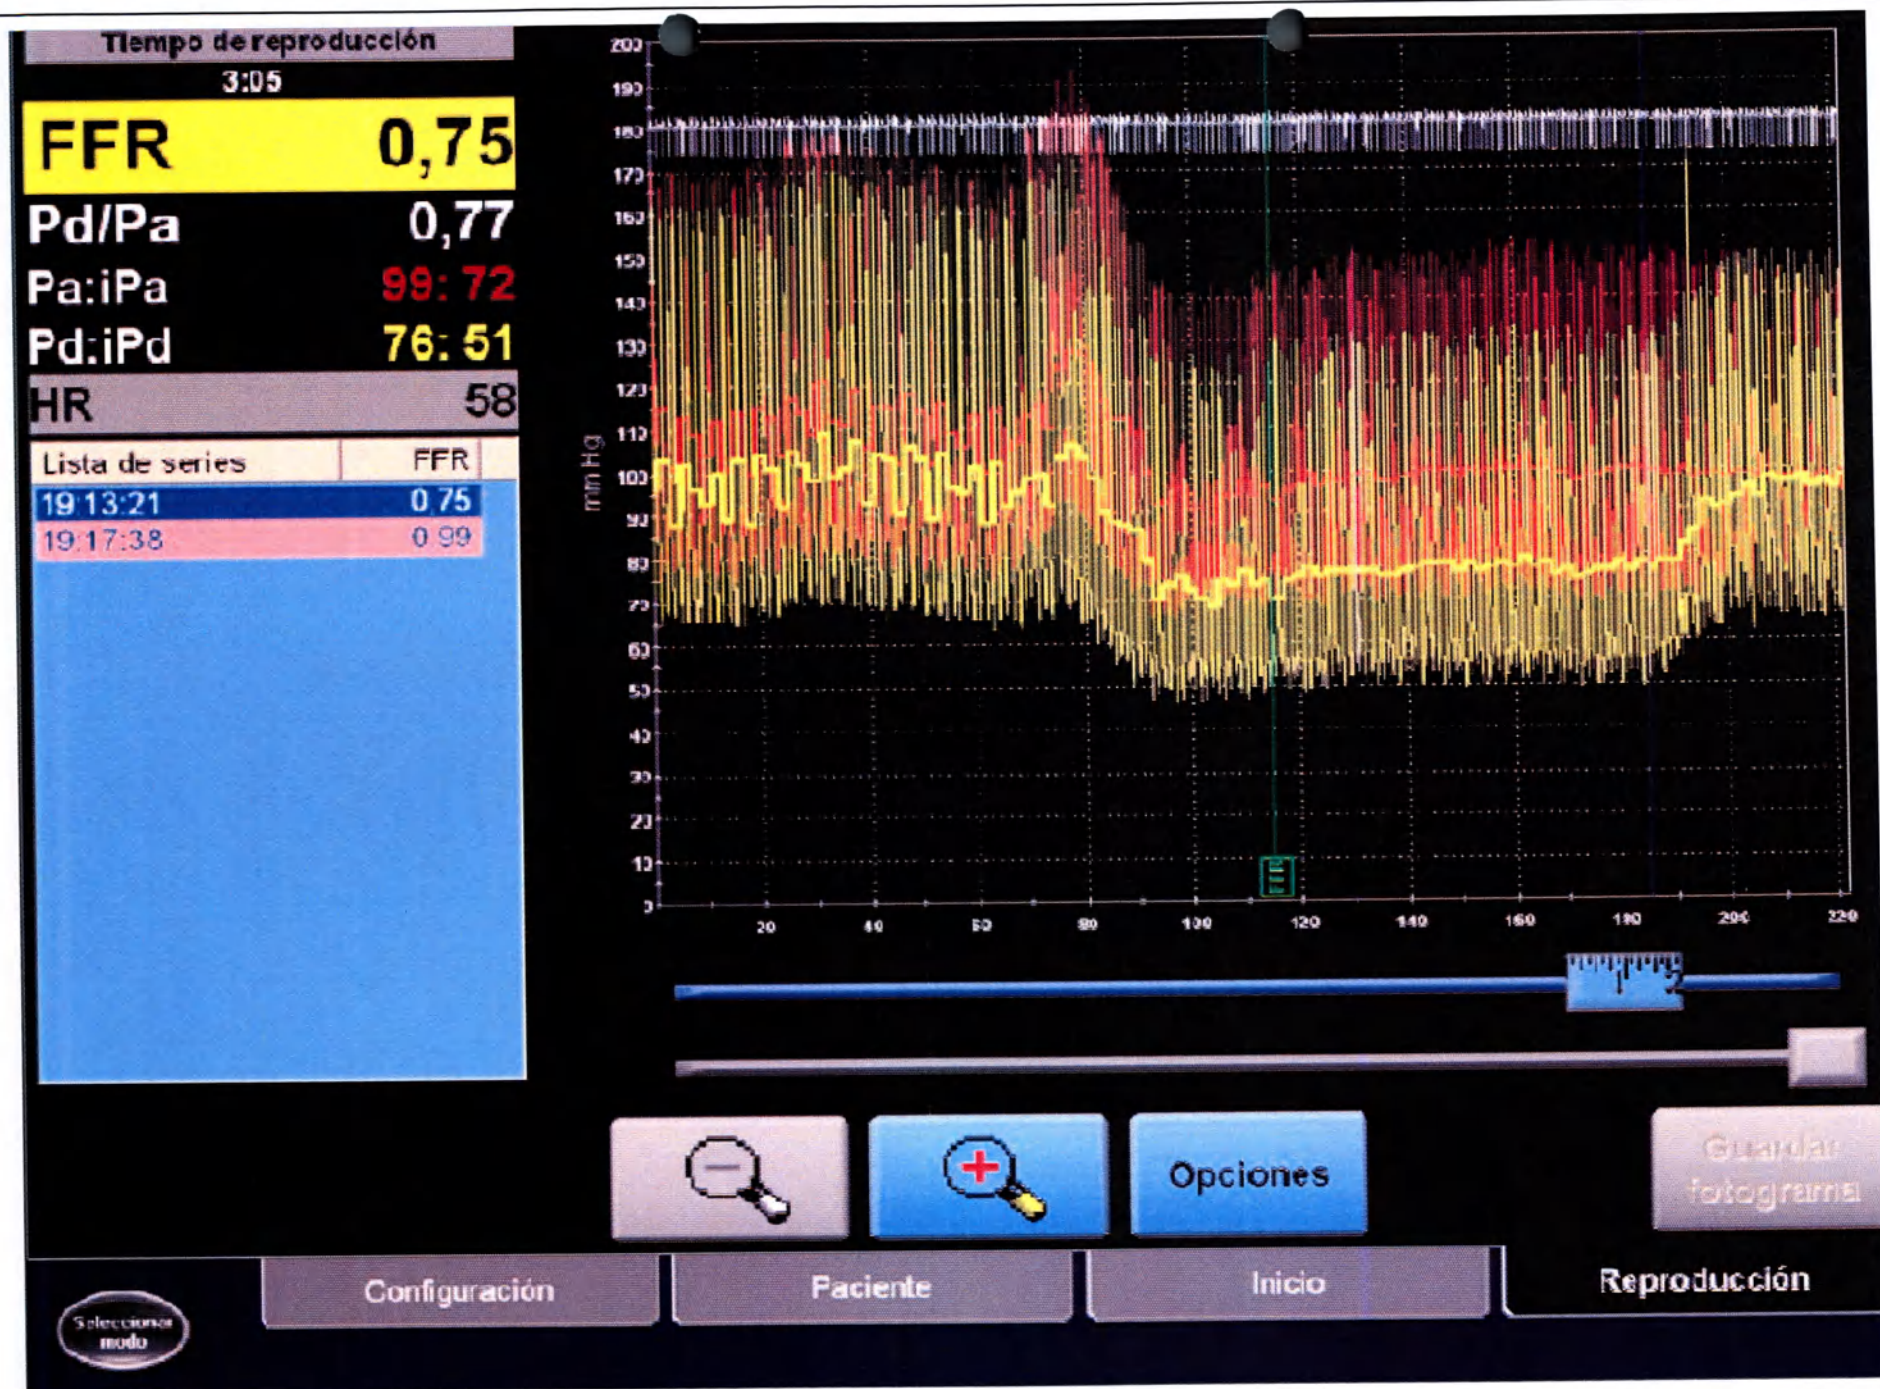



20. Функция измерения фракционного резерва кровотока (Опция FFR Option Kit).

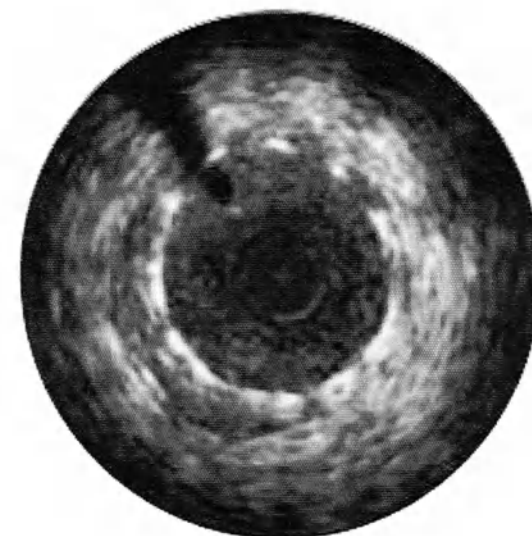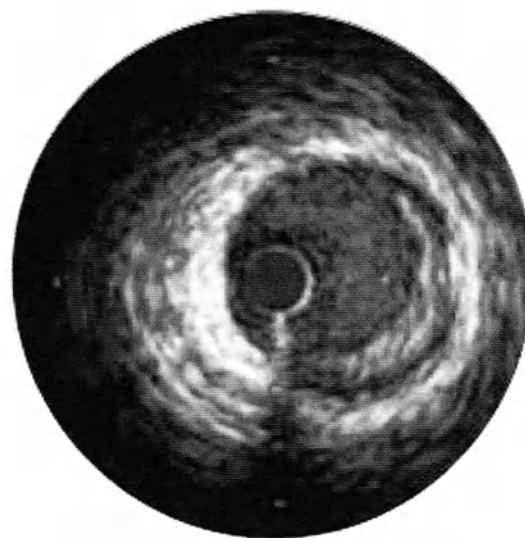

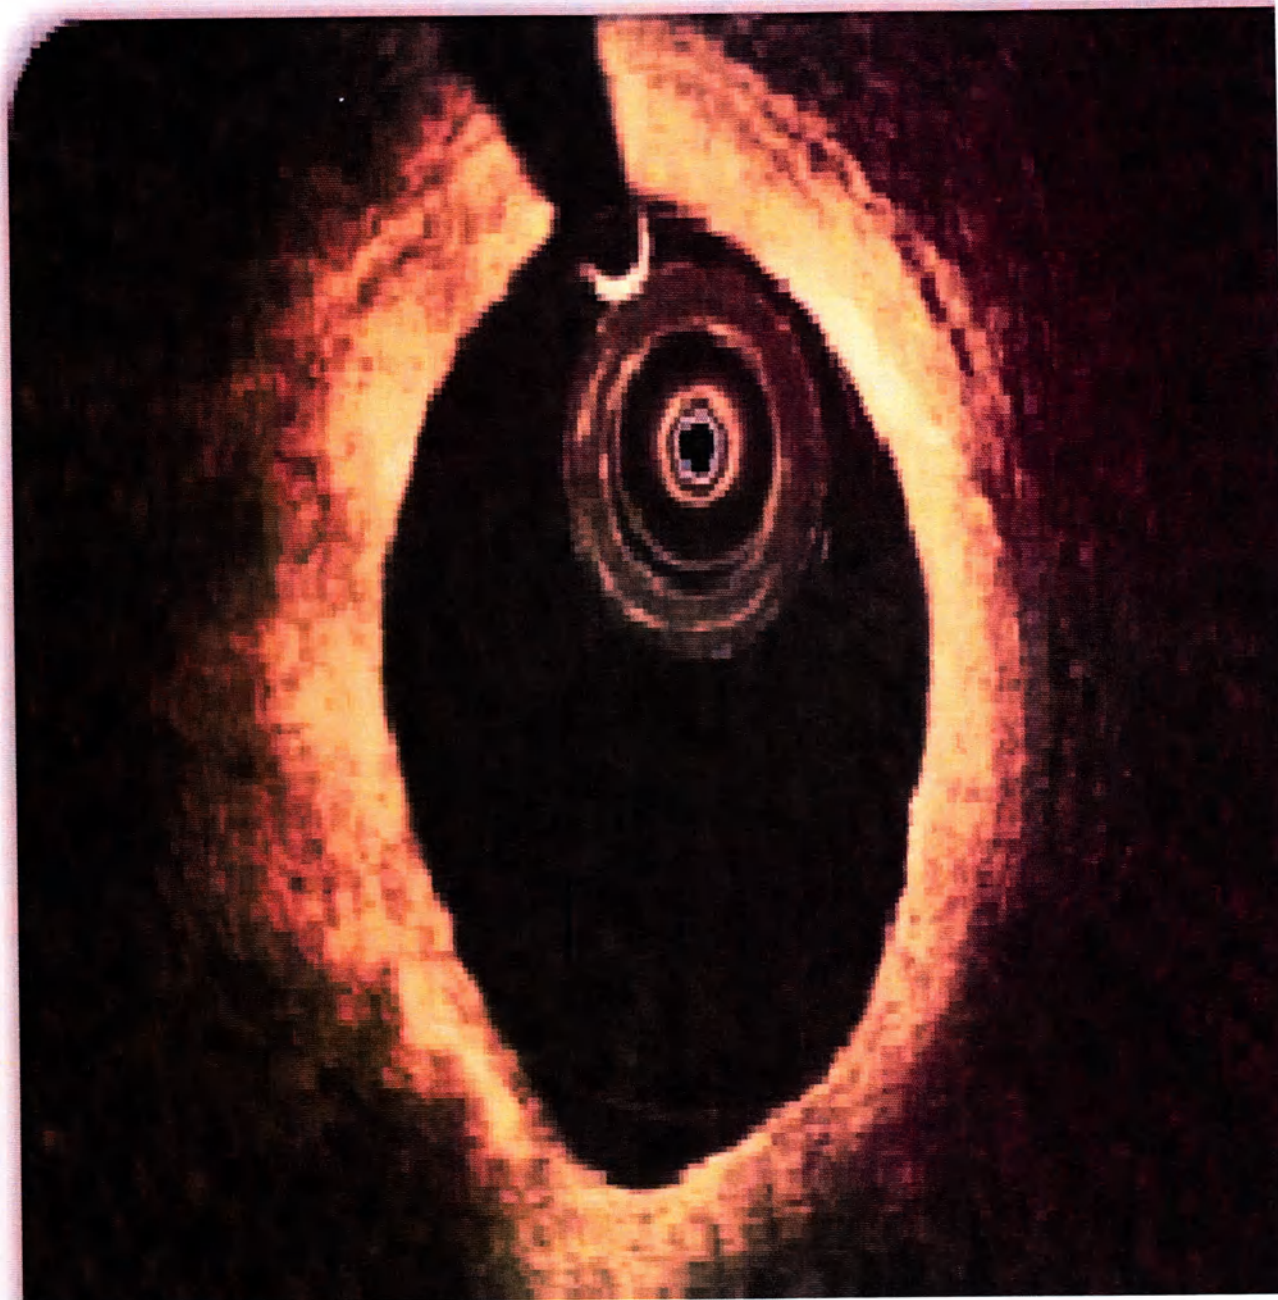


22. Опция ОСТ.

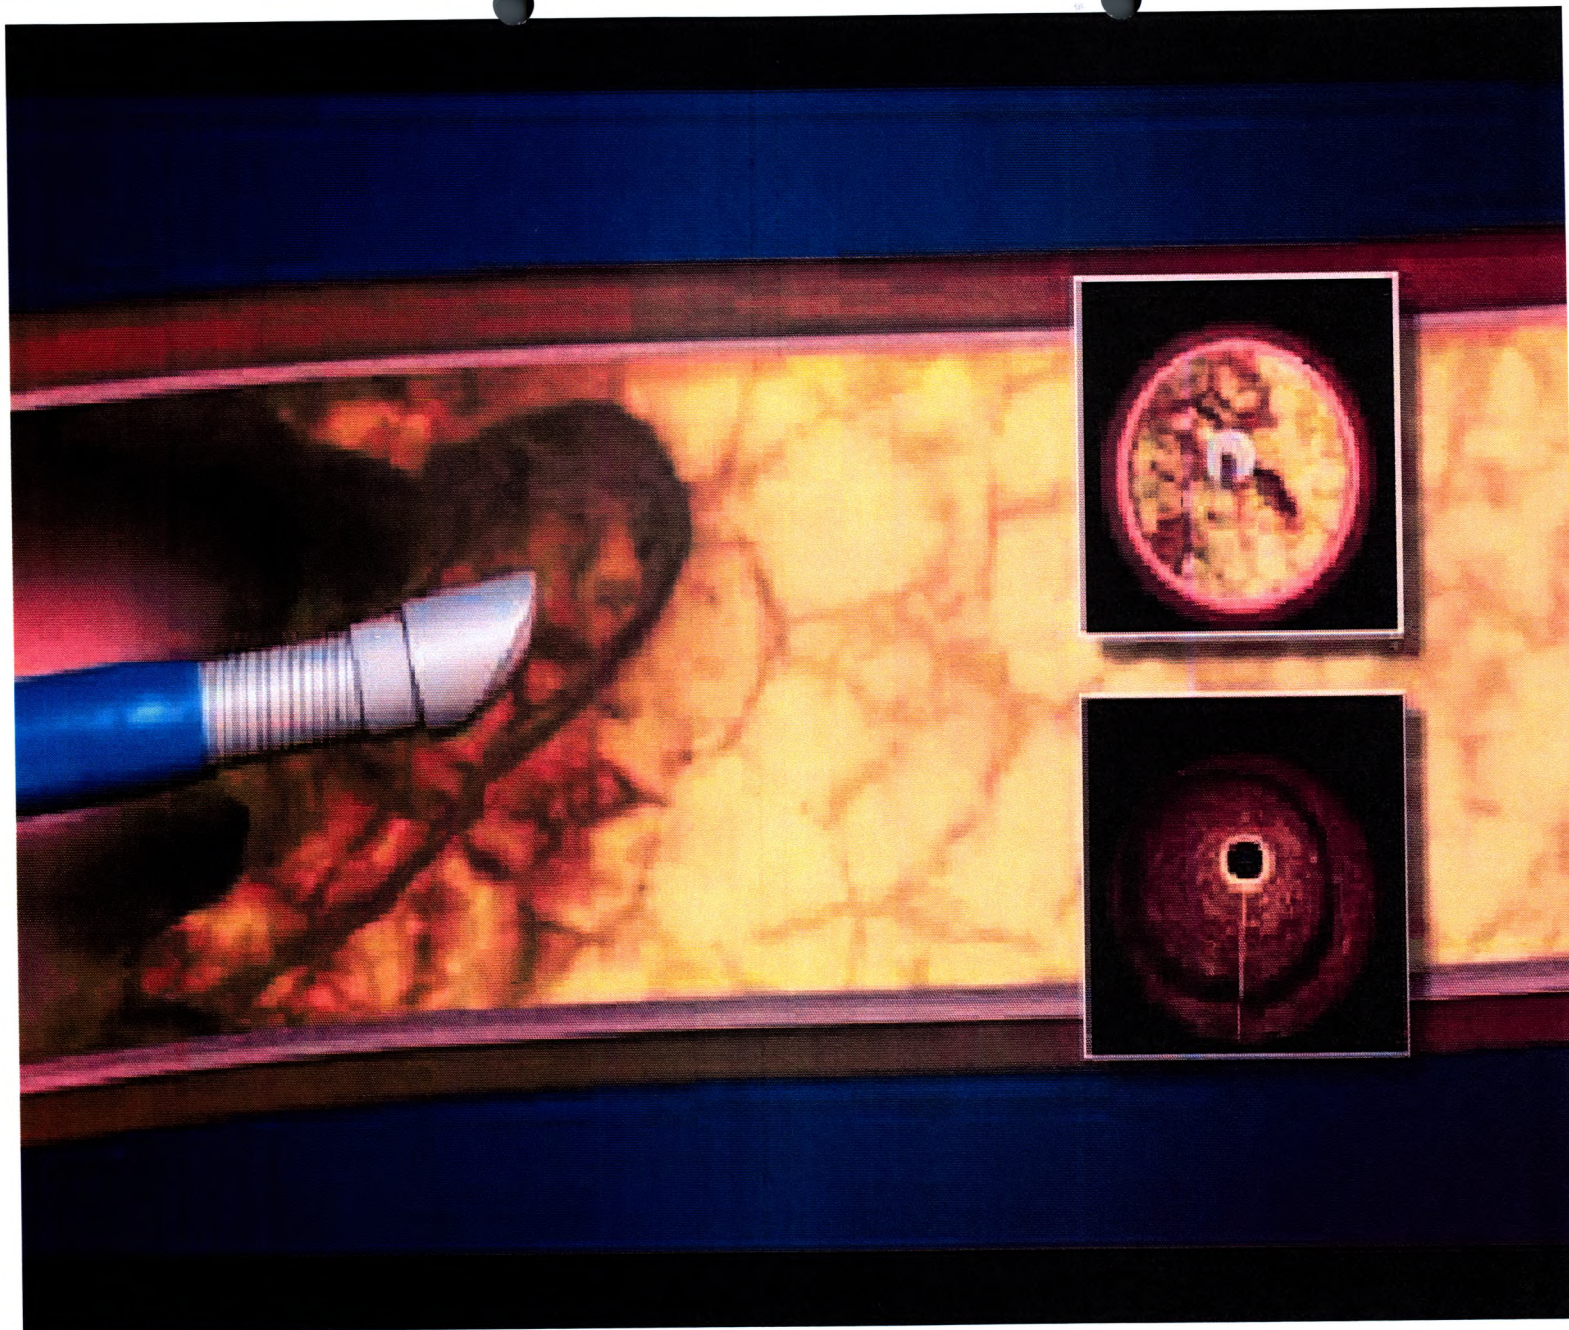


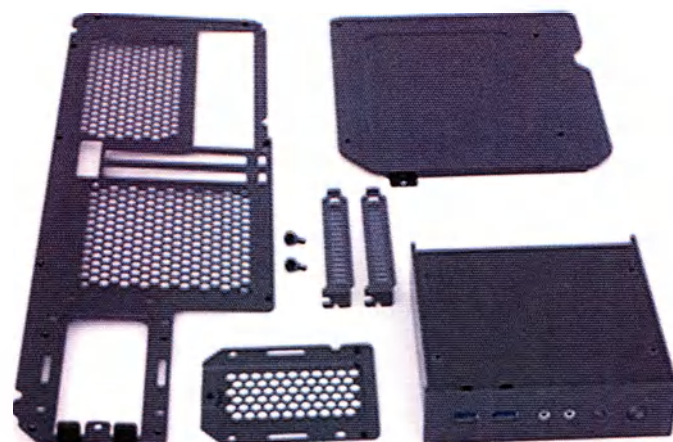




25. Программное обеспечение ChromaFlo.

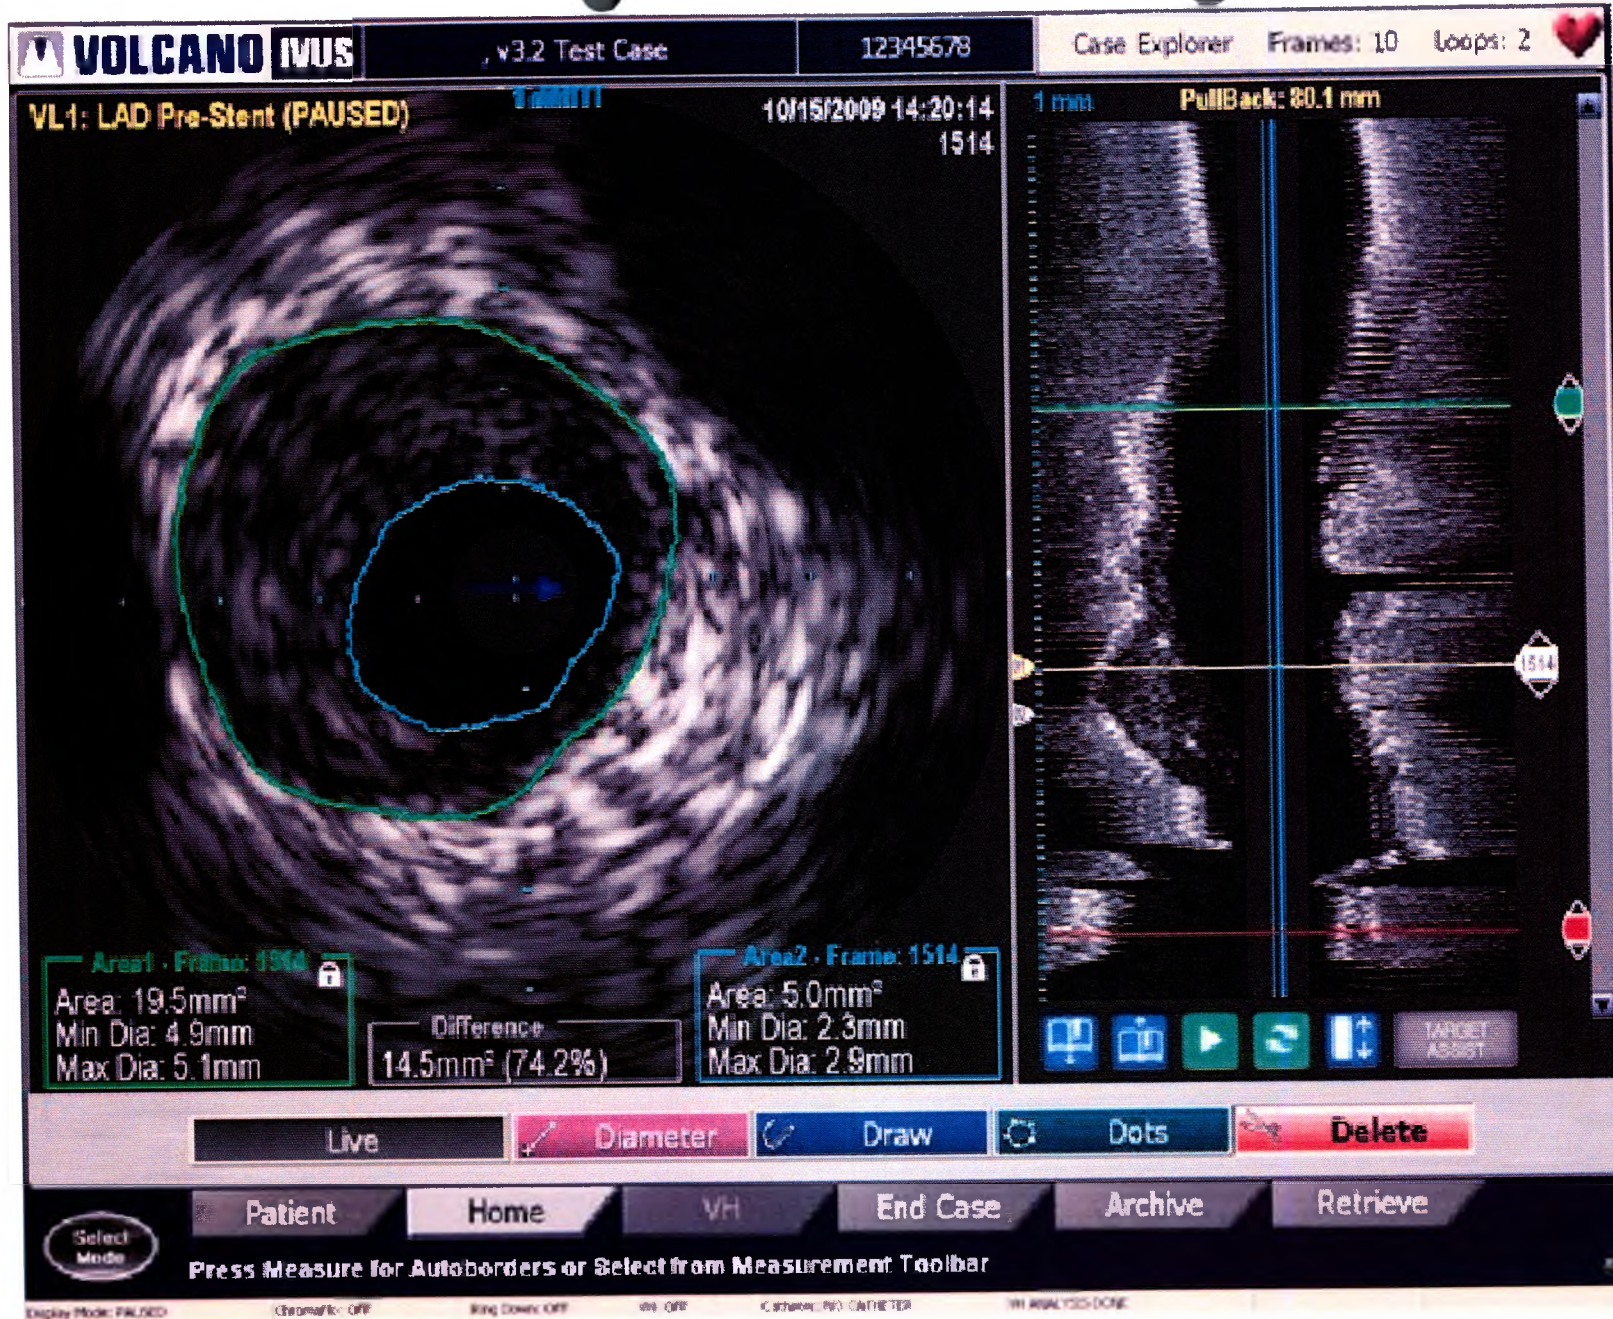


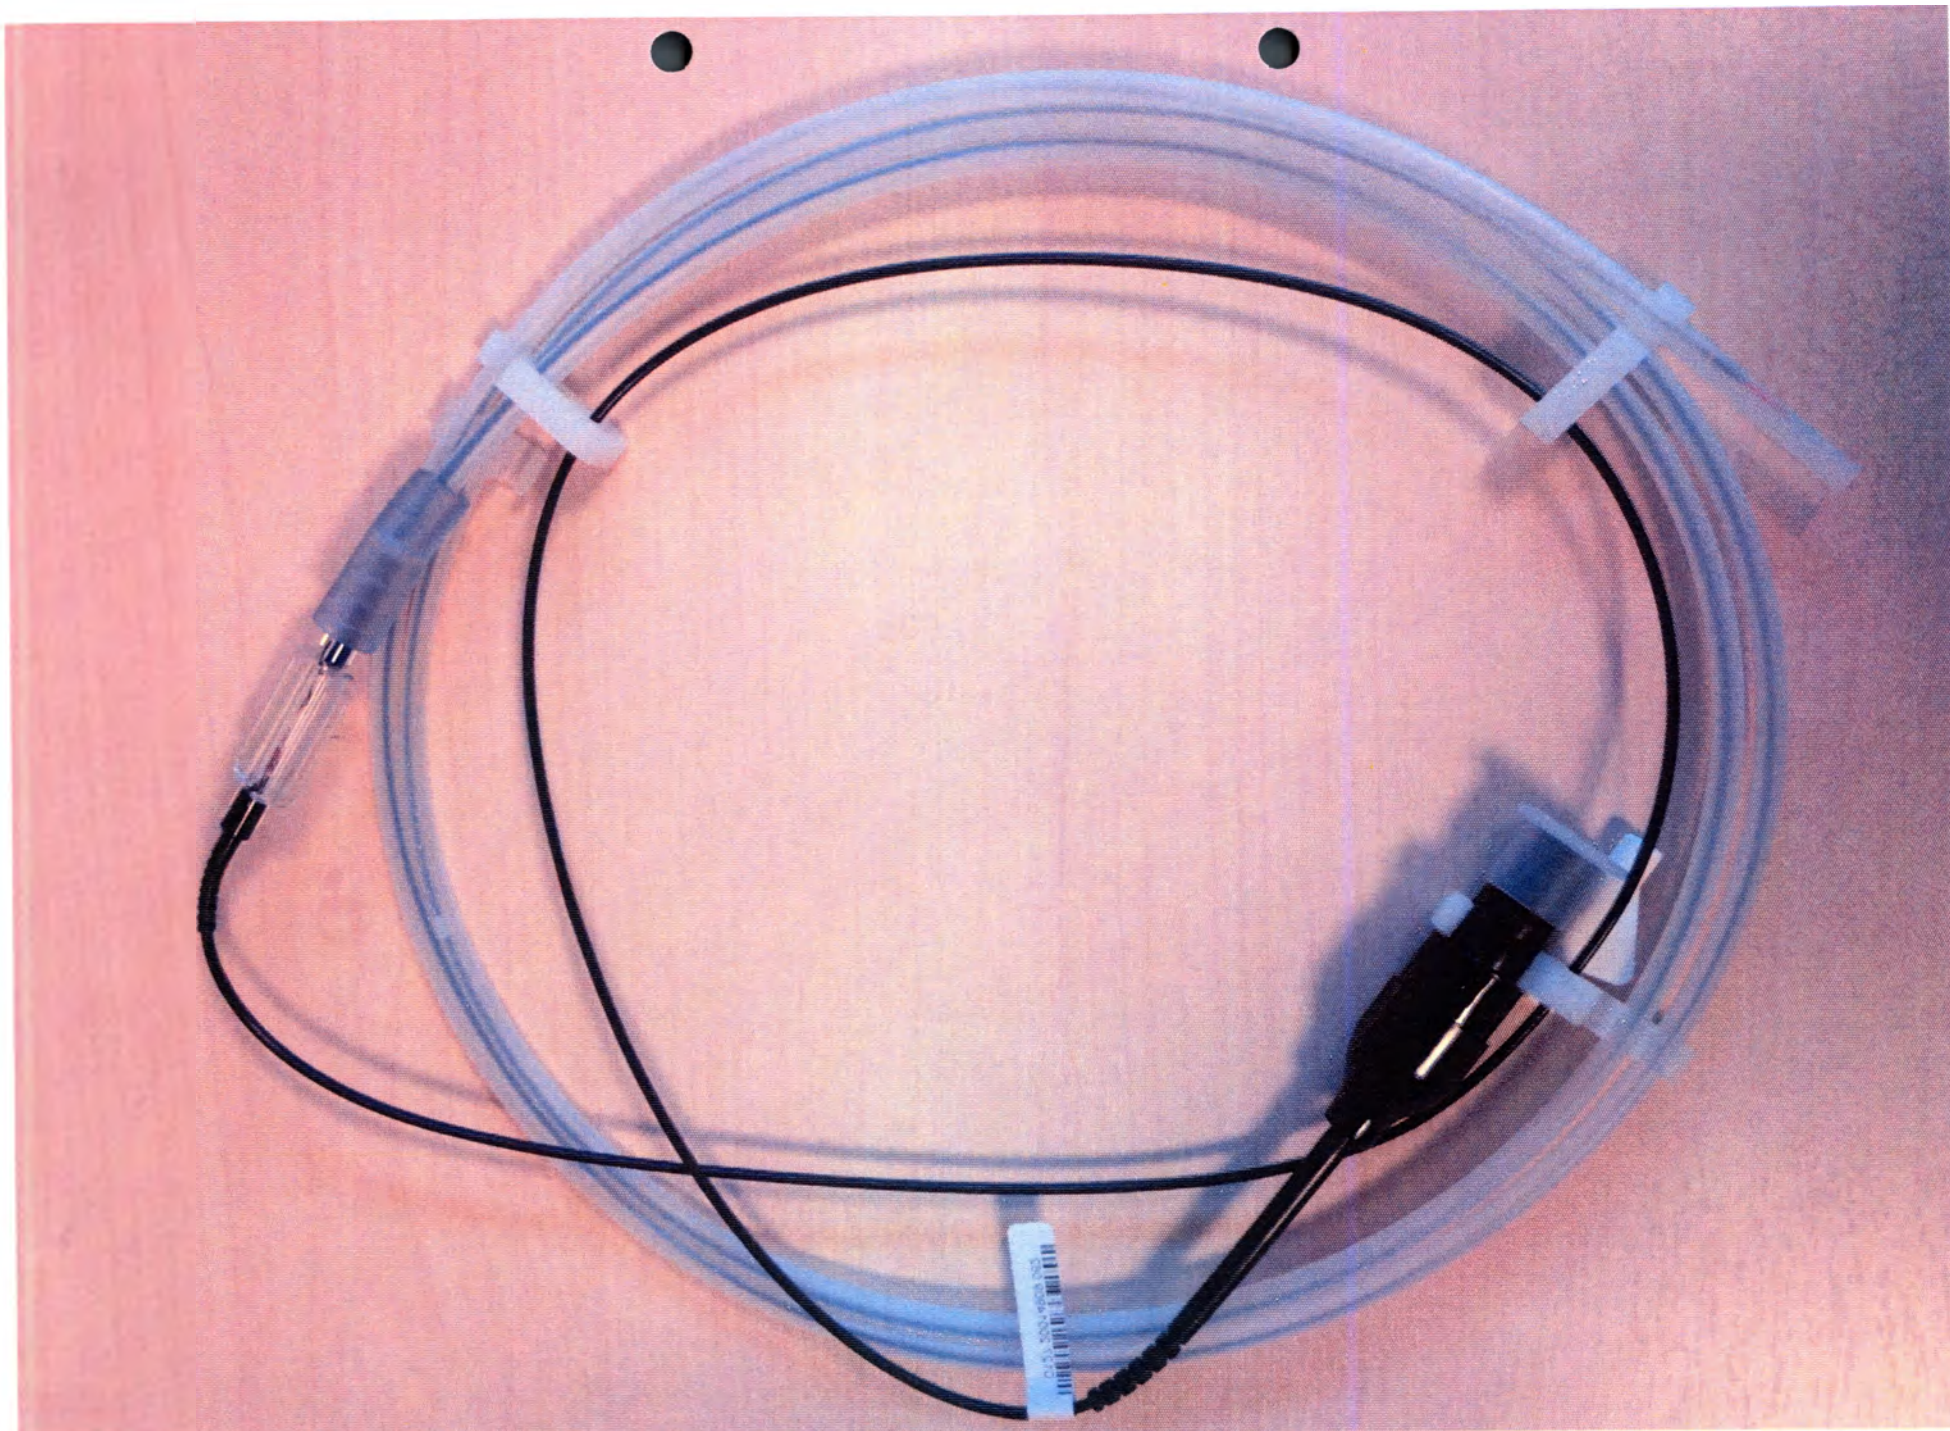



27. Катетер для внутрисосудистых ультразвуковых исследований Revolution - от 1 до 100 шт.

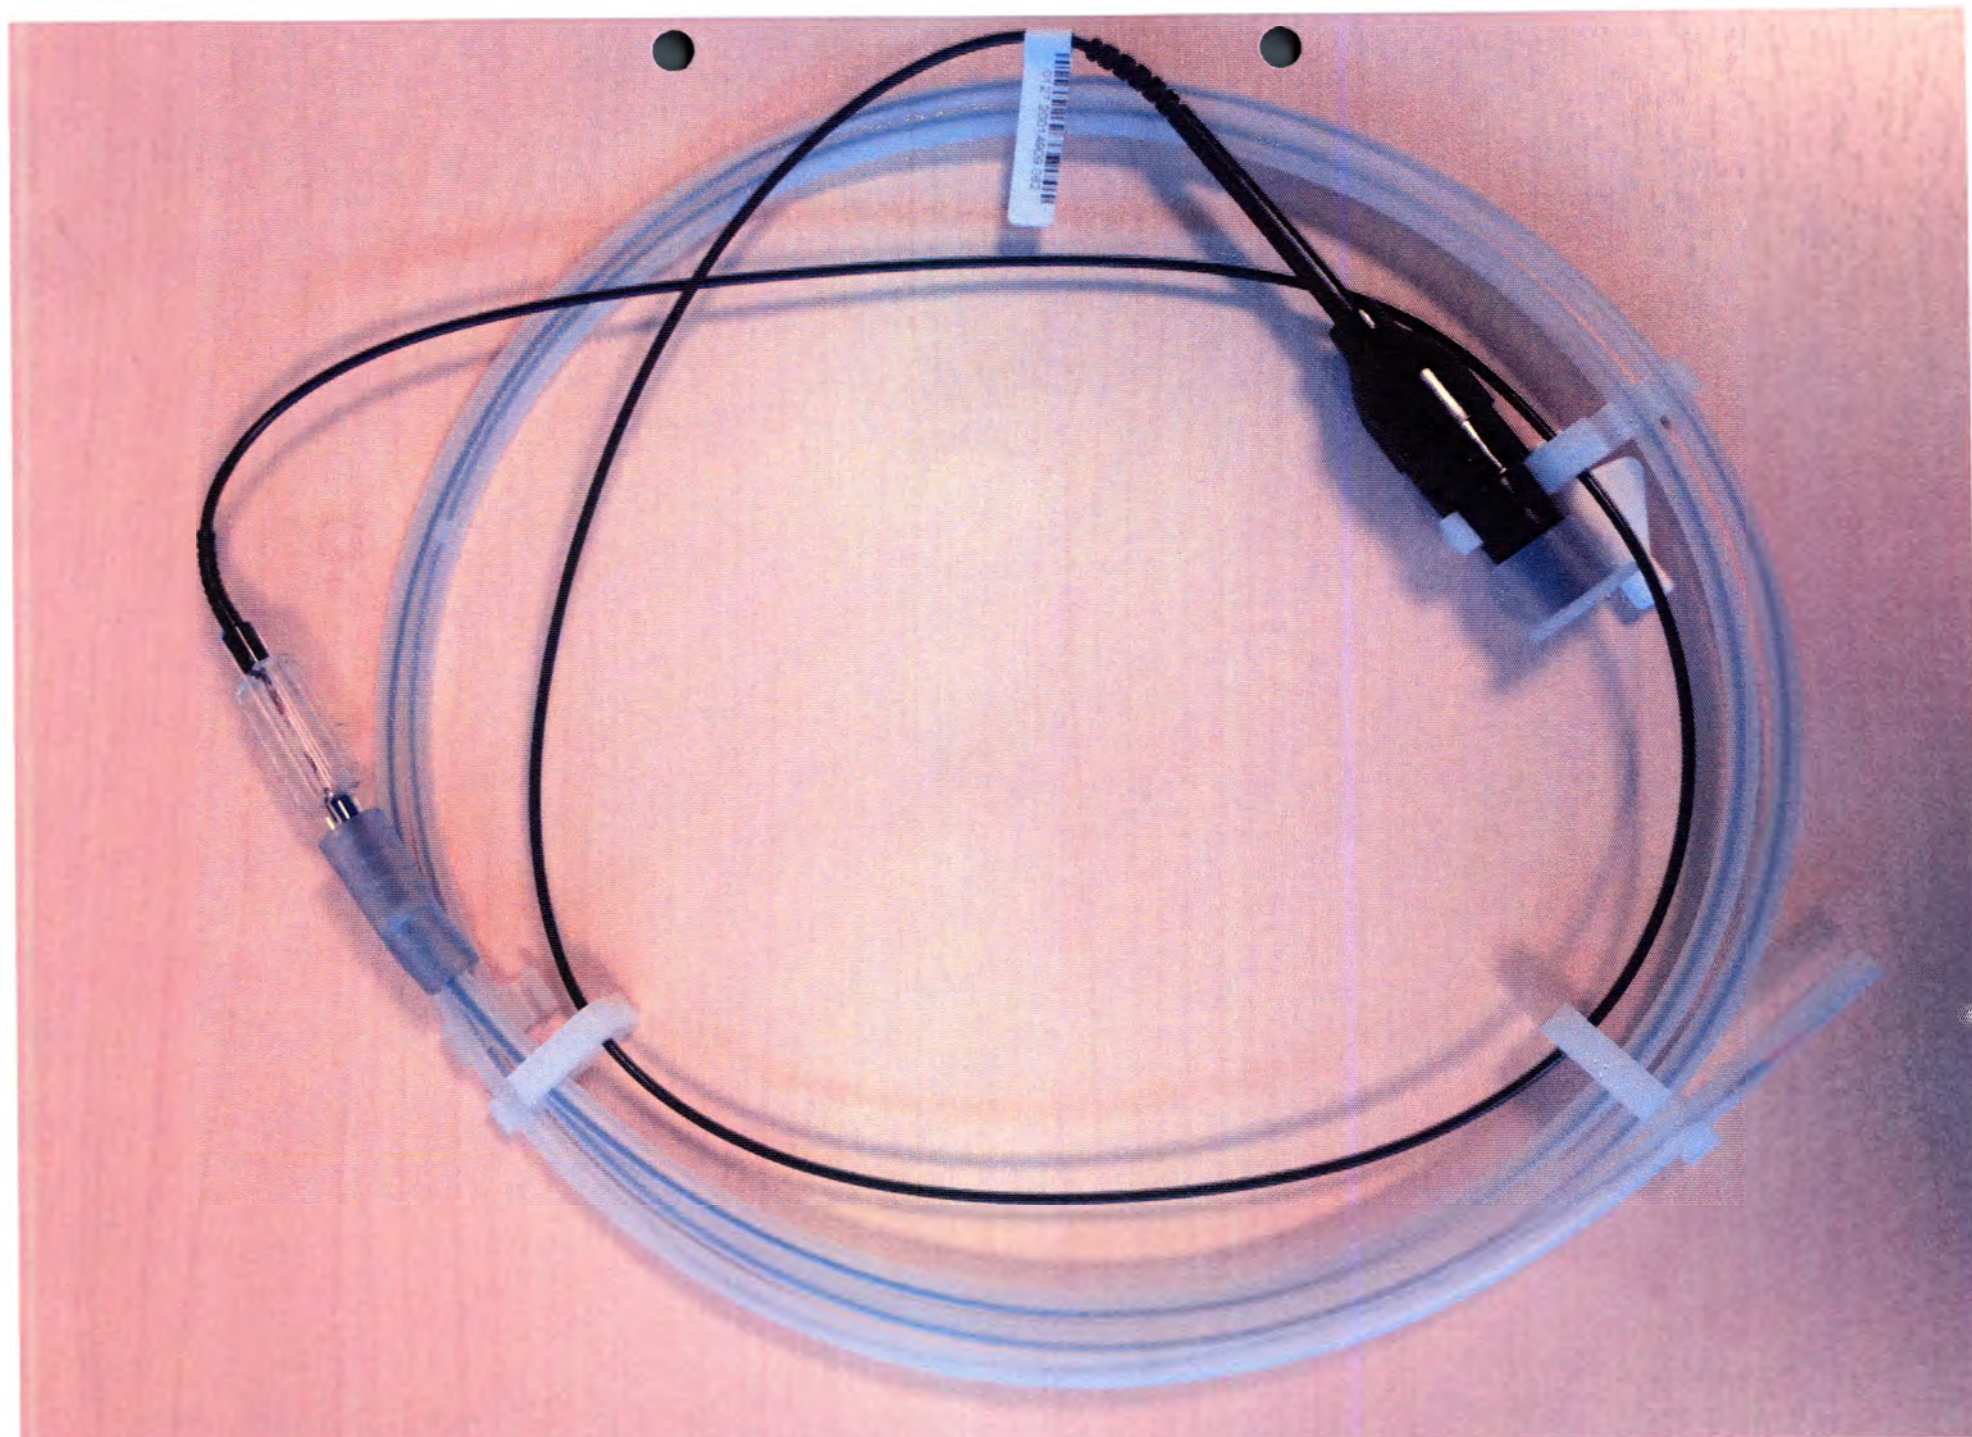



28. Катетер для внутрисосудистых ультразвуковых исследований Eagle Eye Platinum - от 1 до 200 шт.

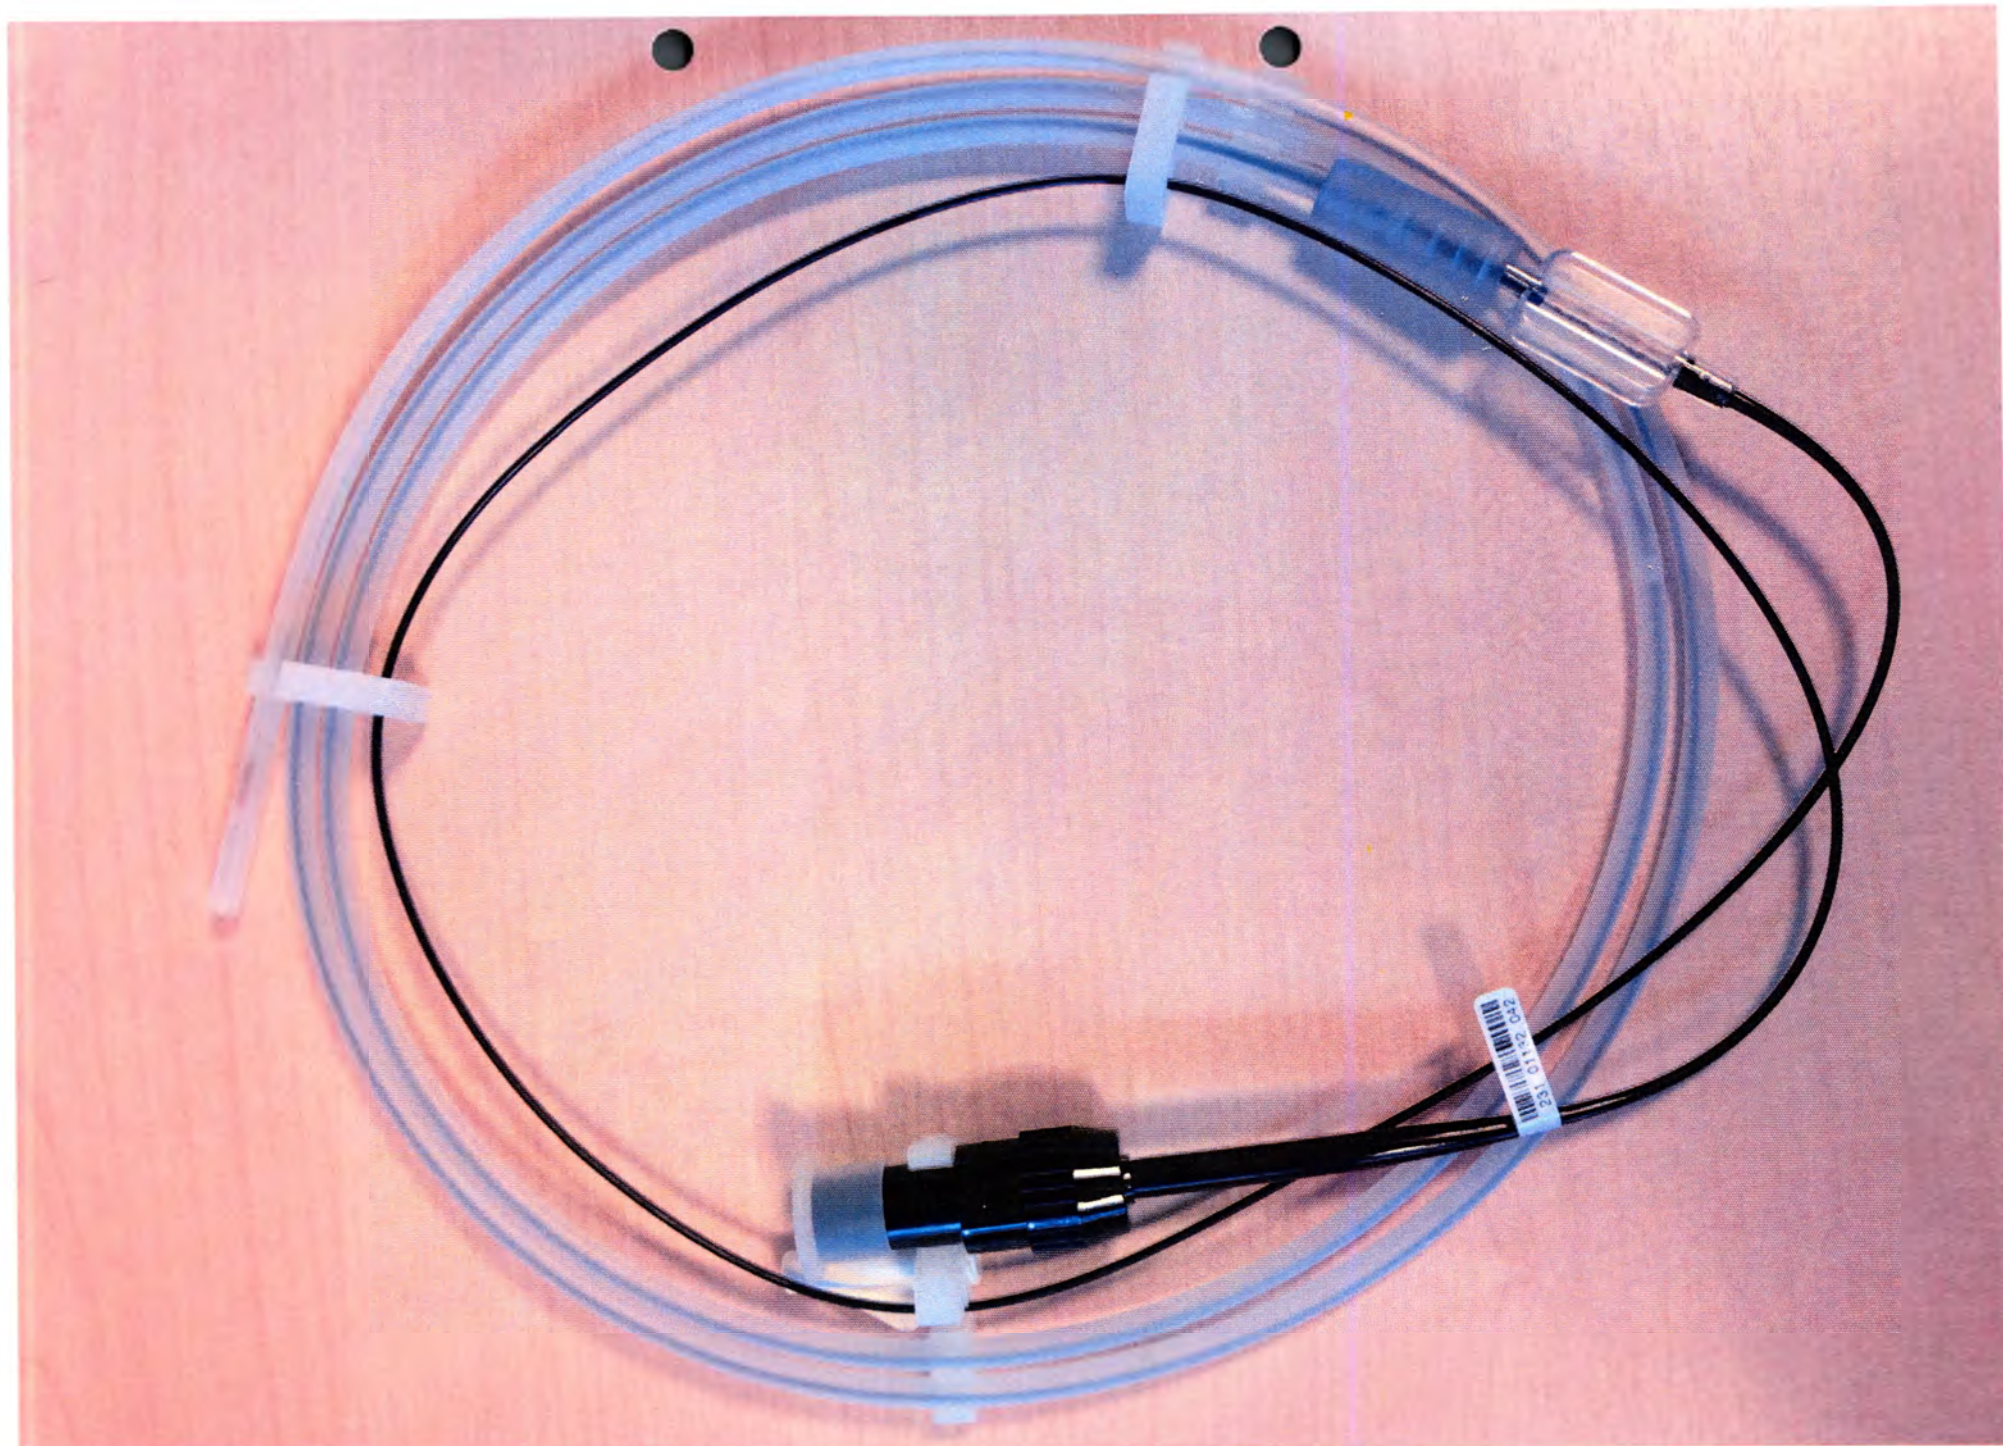

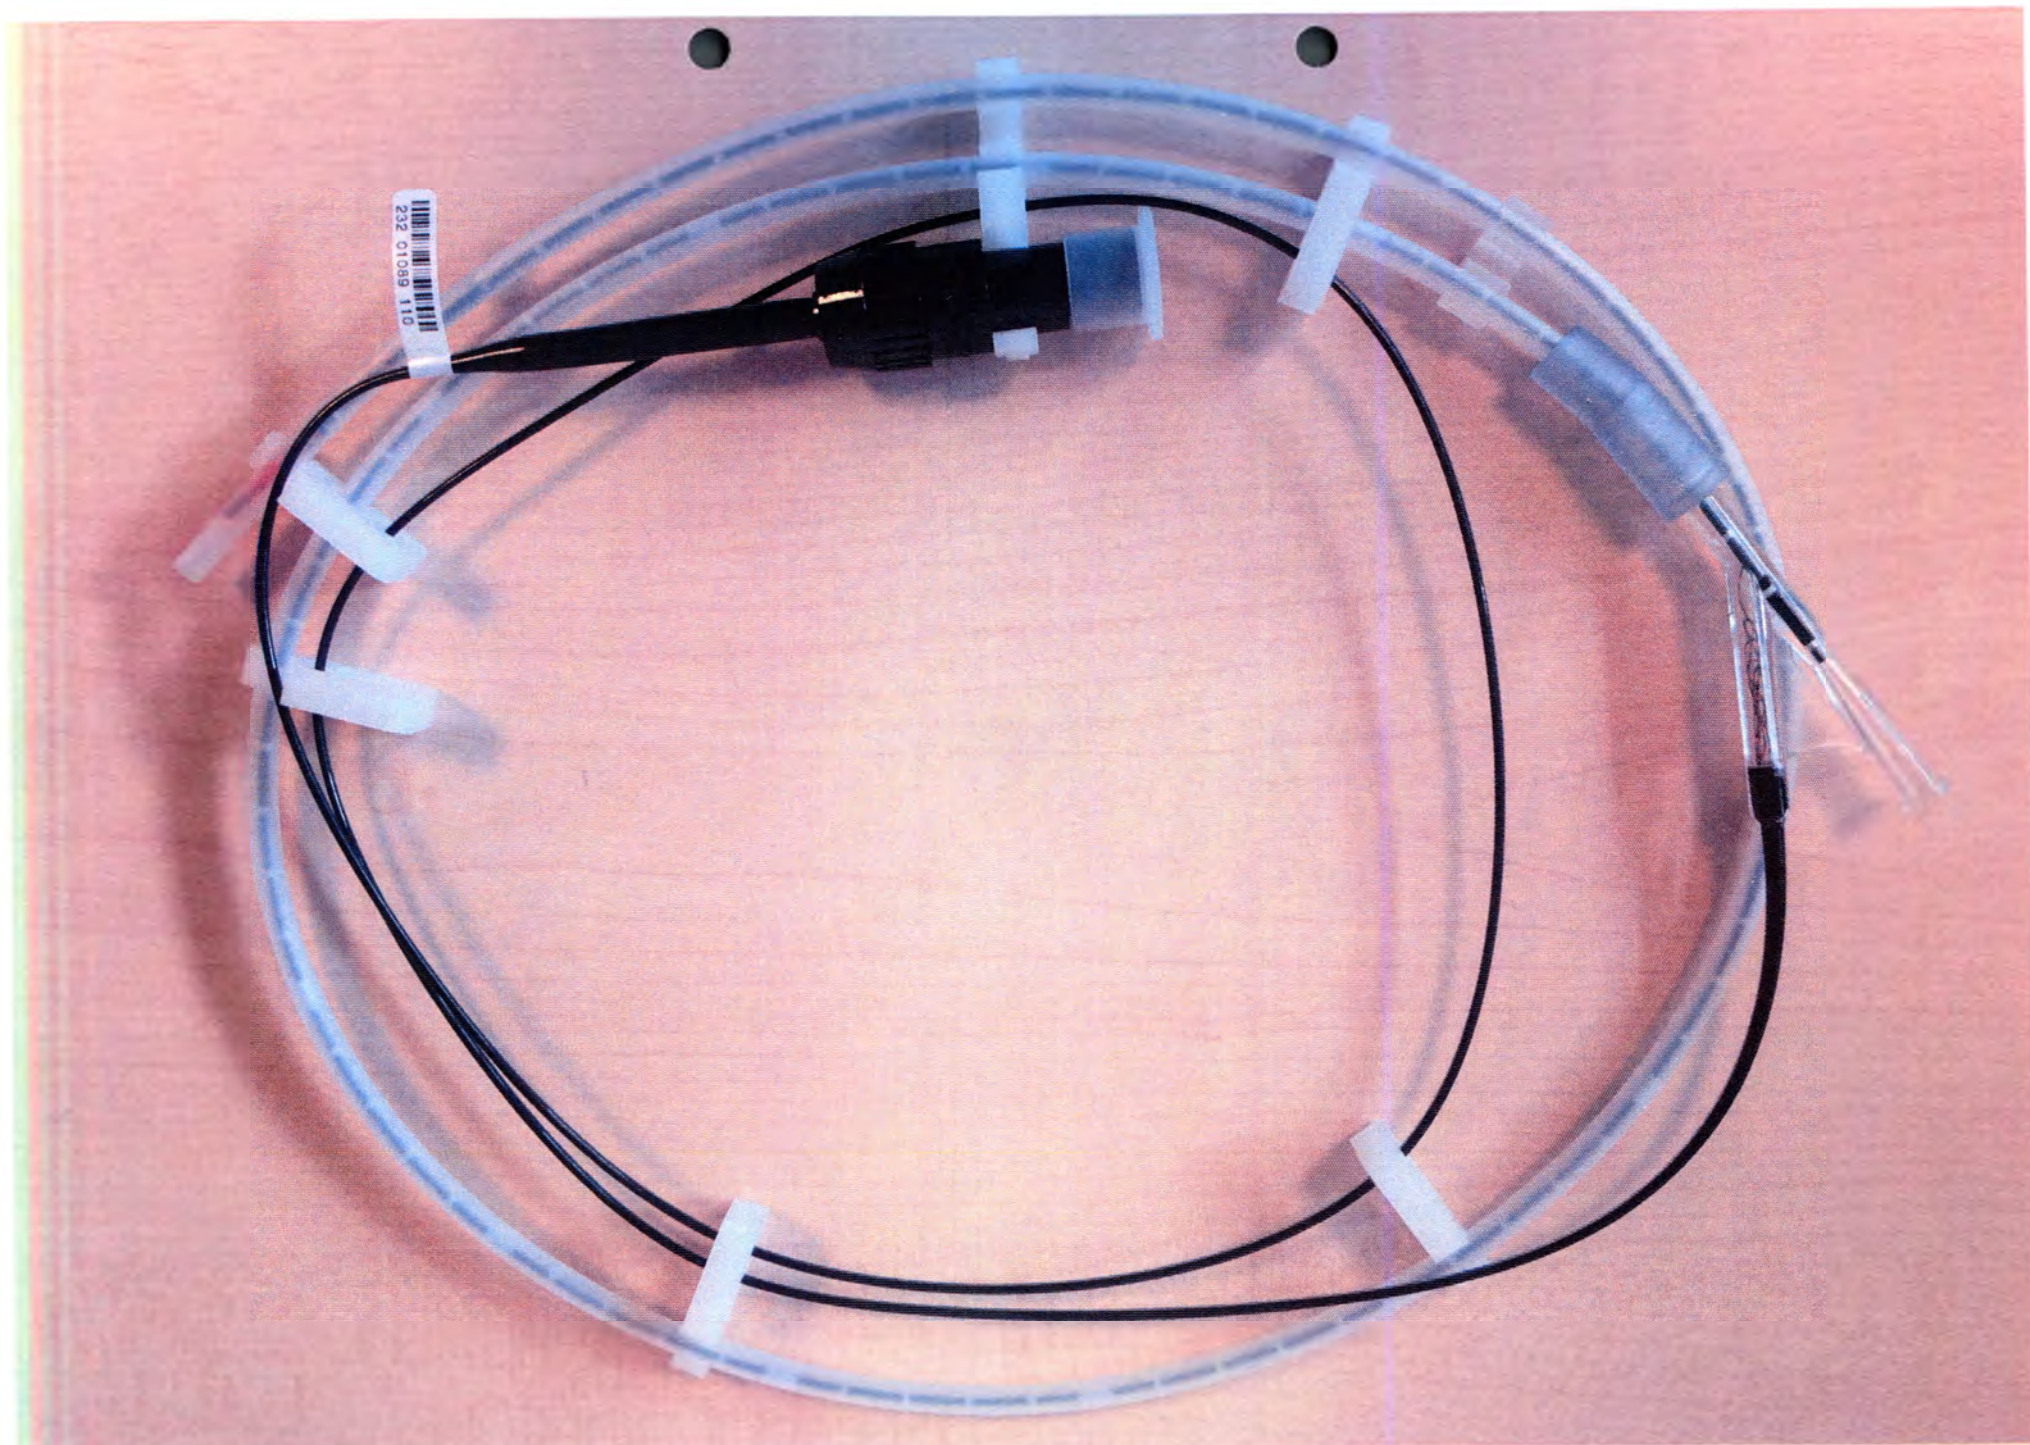


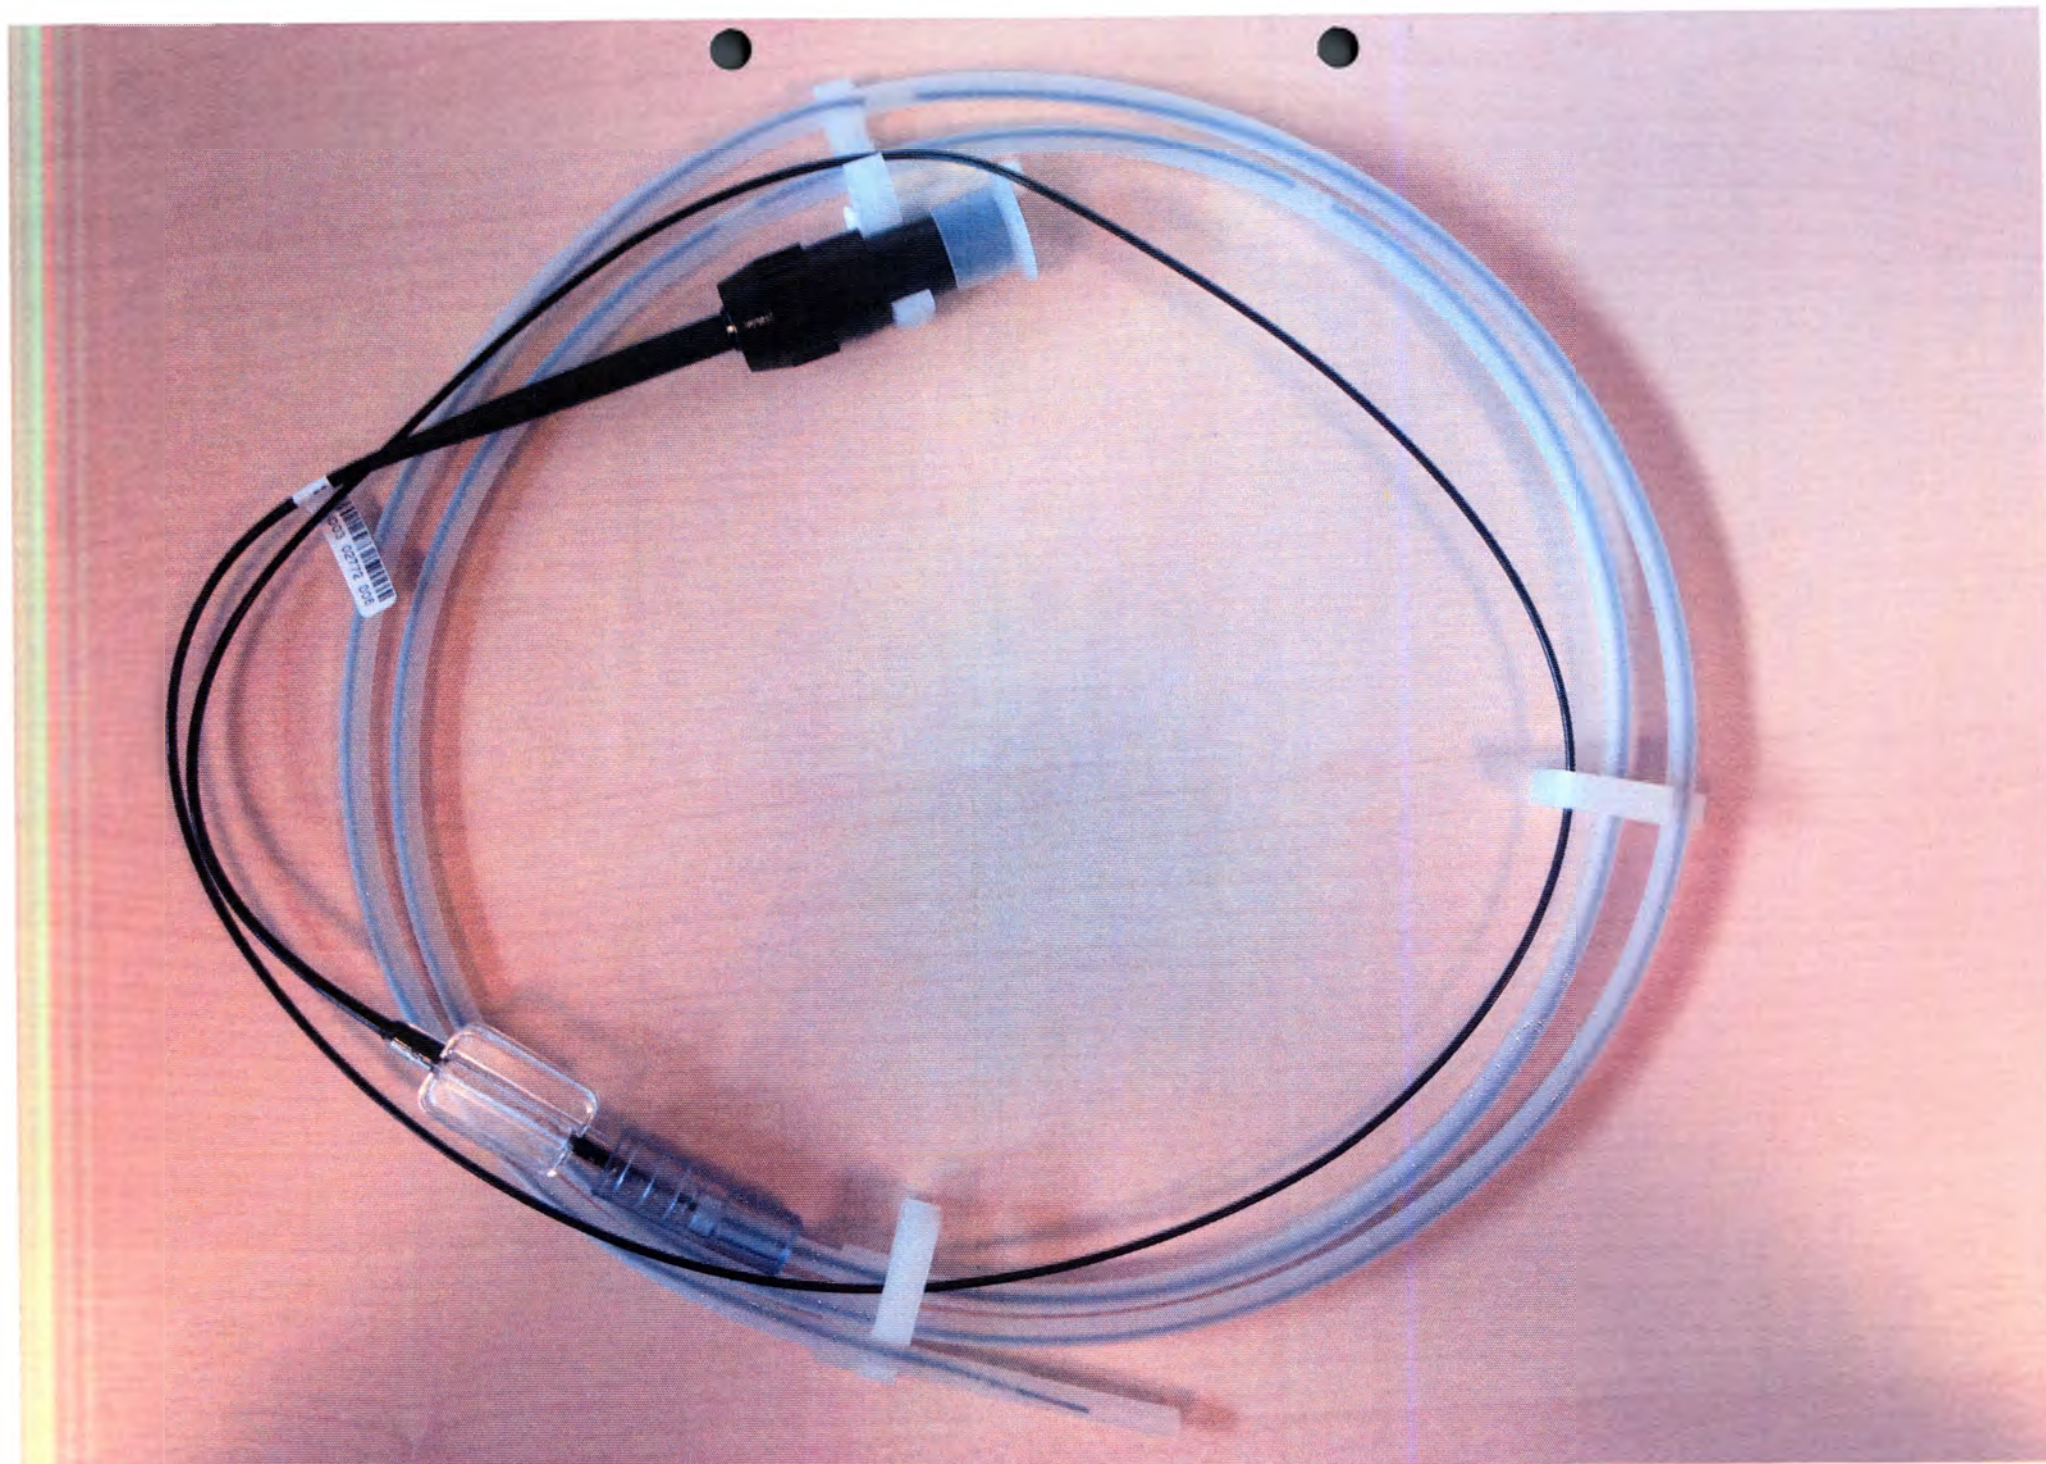


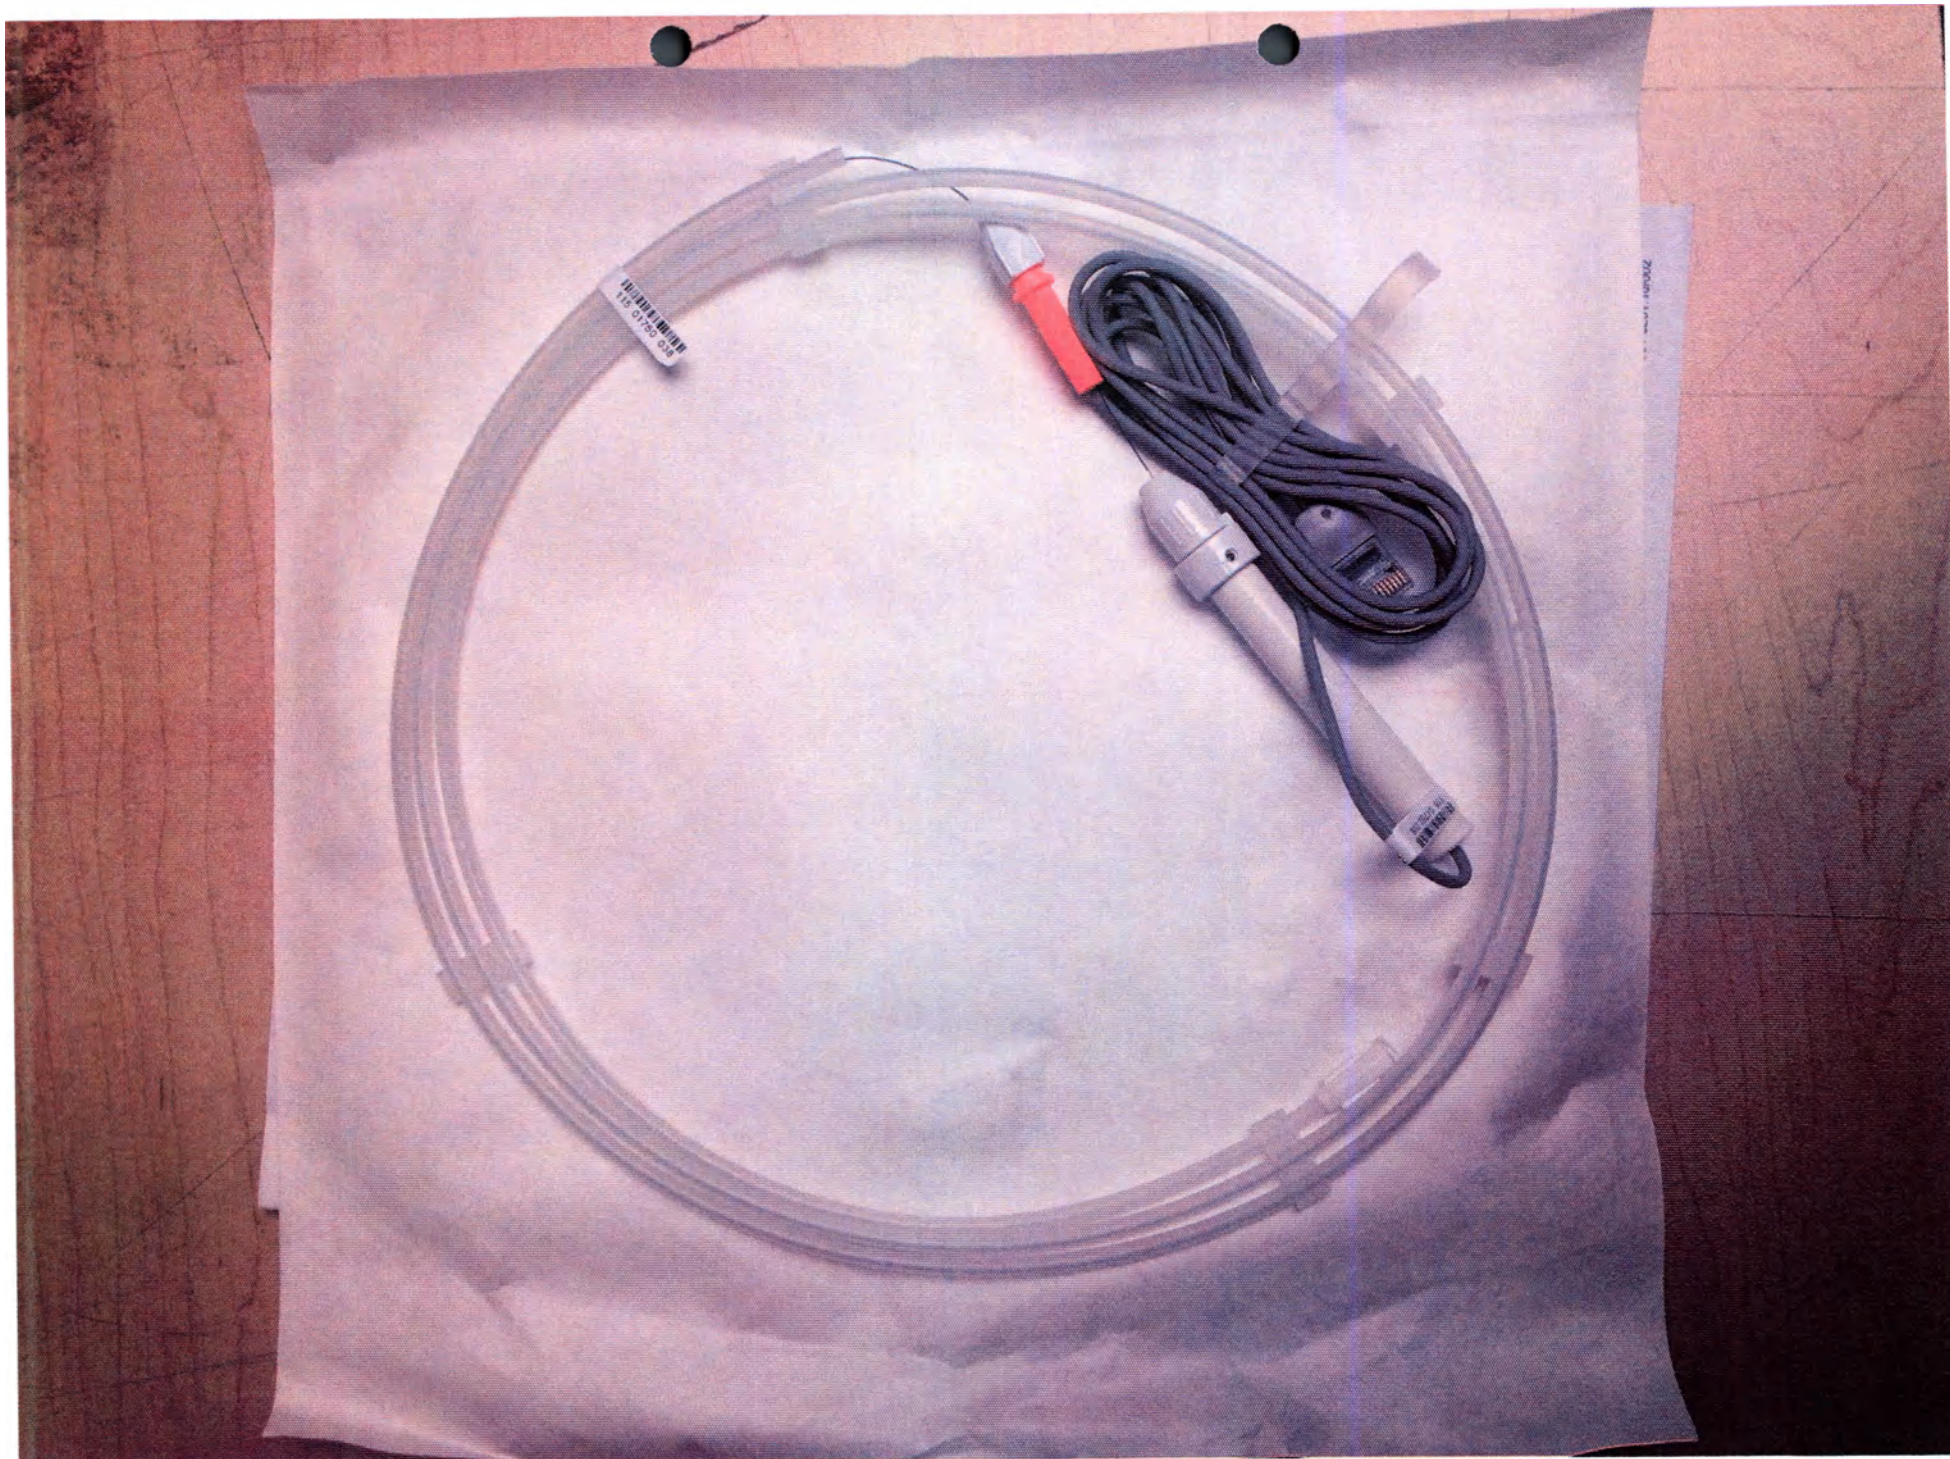


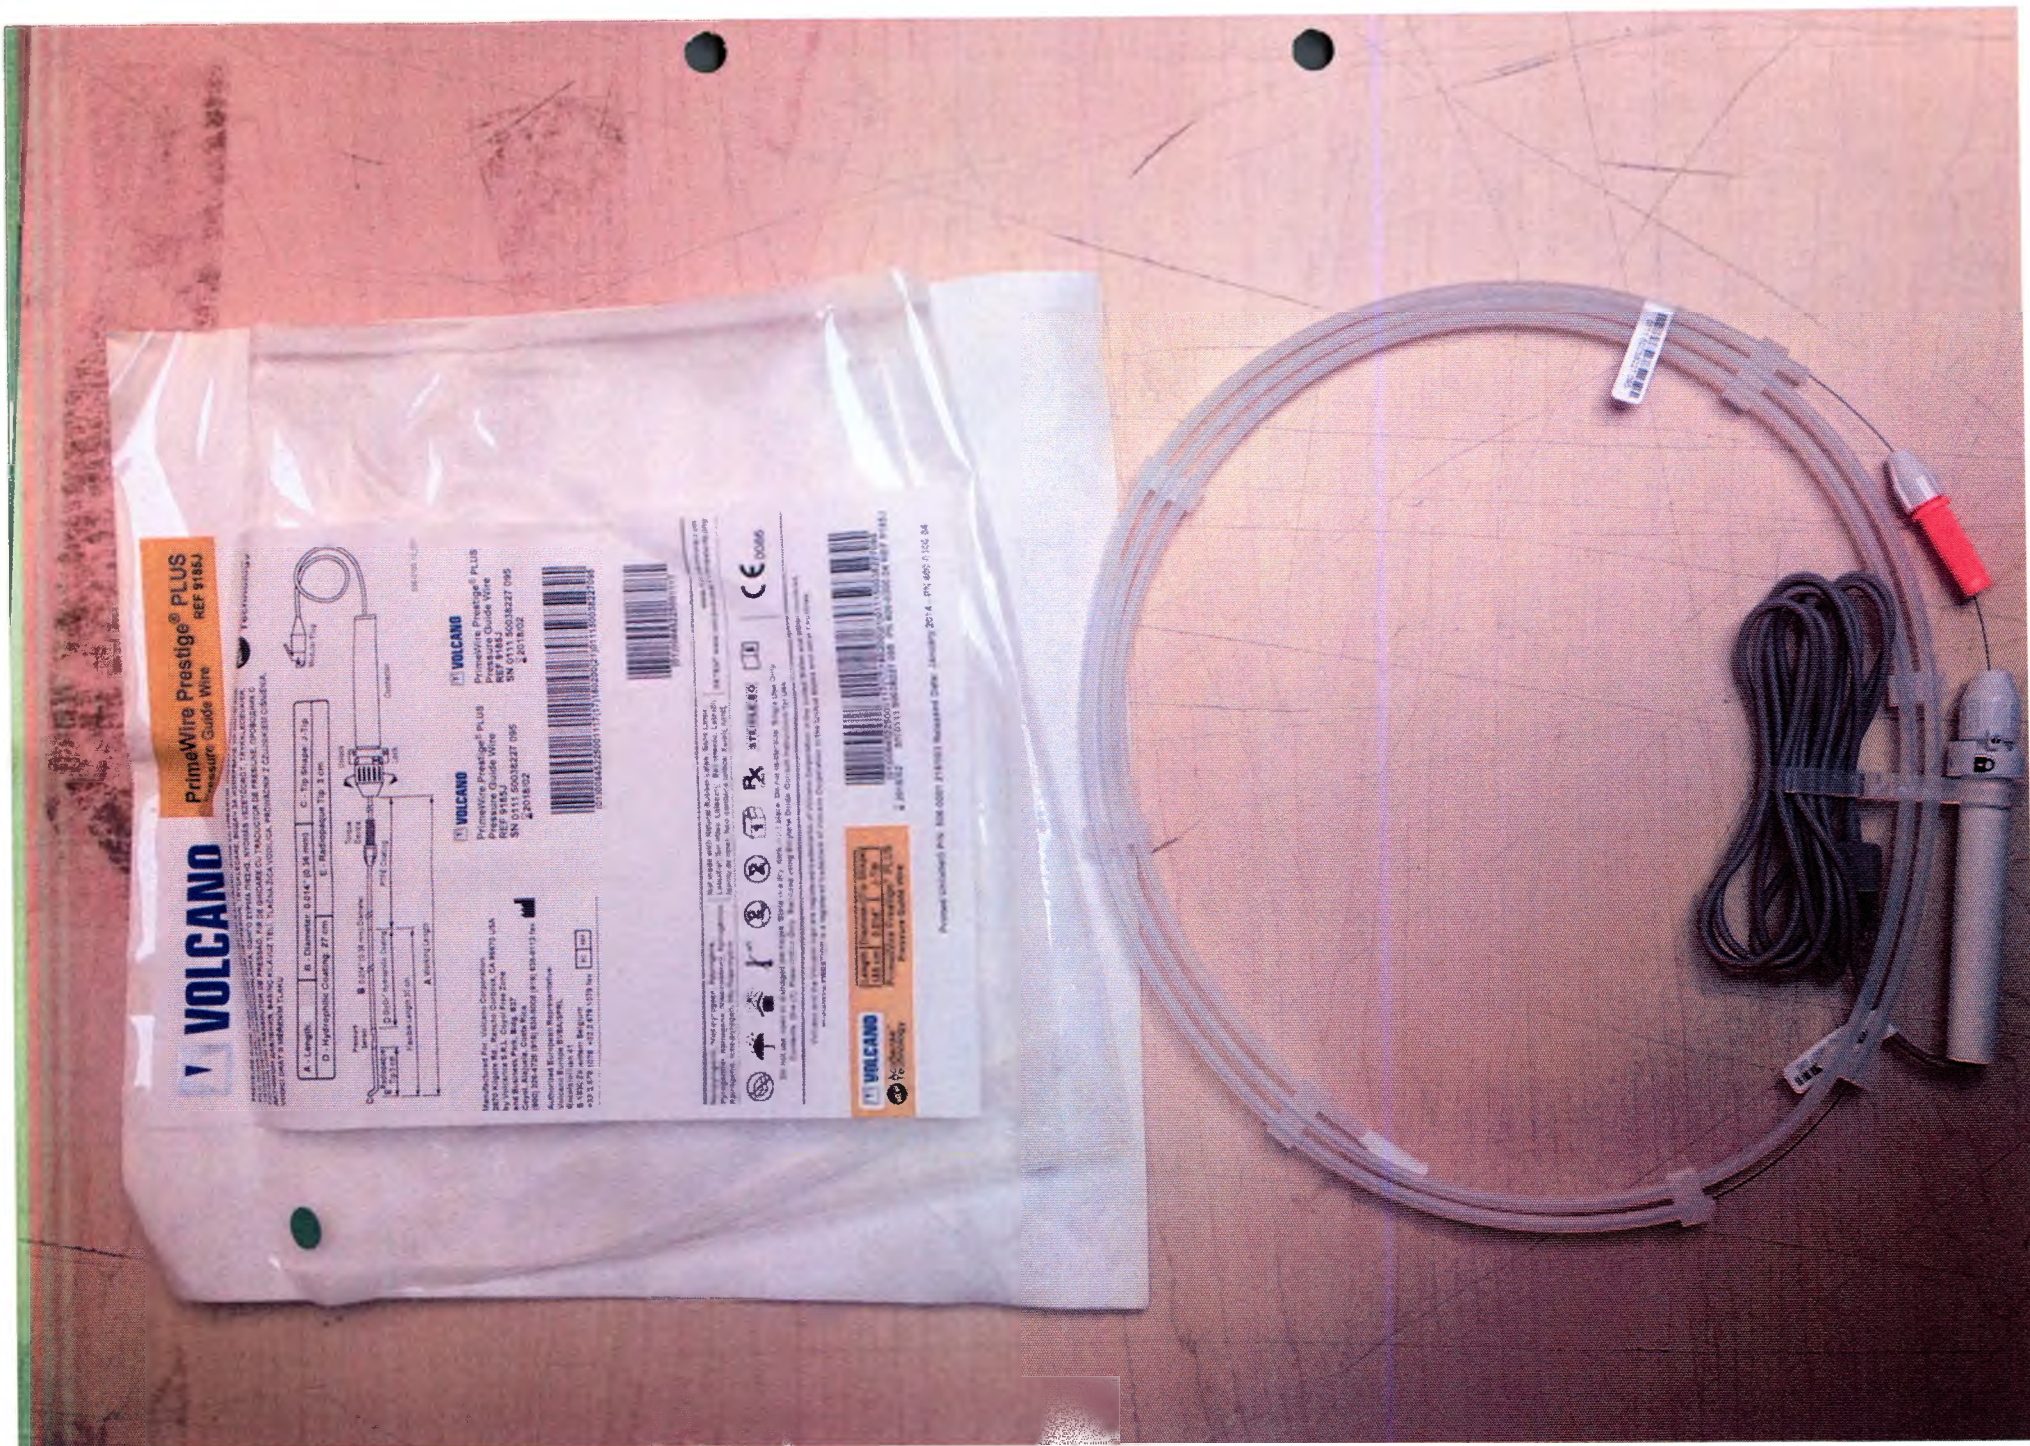

33. Проводник с датчиком давления PrimeWire Prestige Plus - от 1 до 200 шт

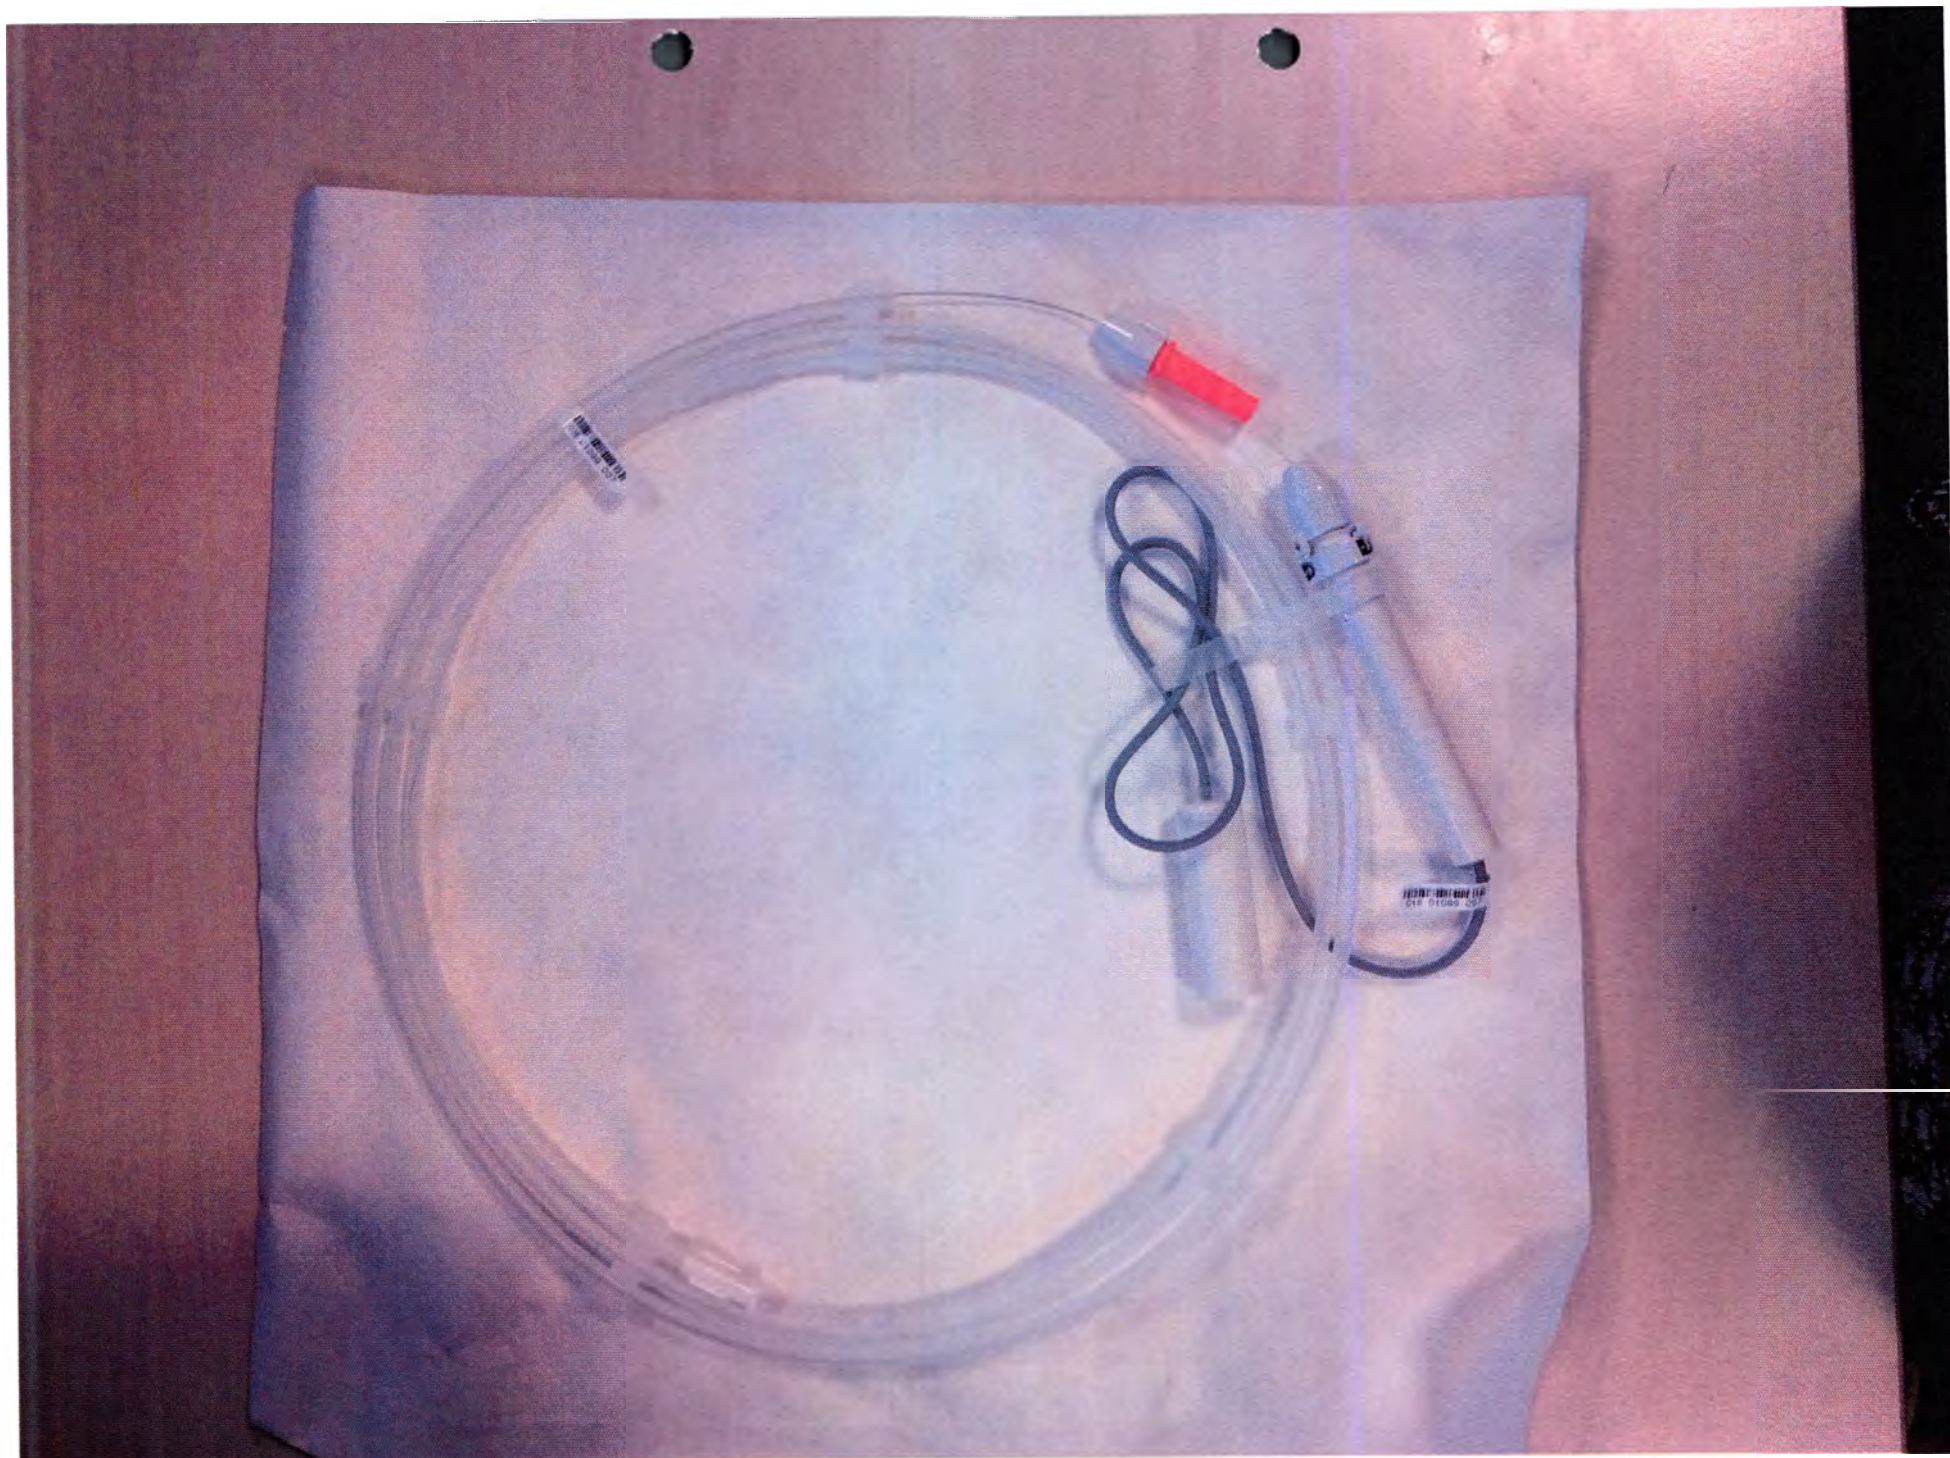

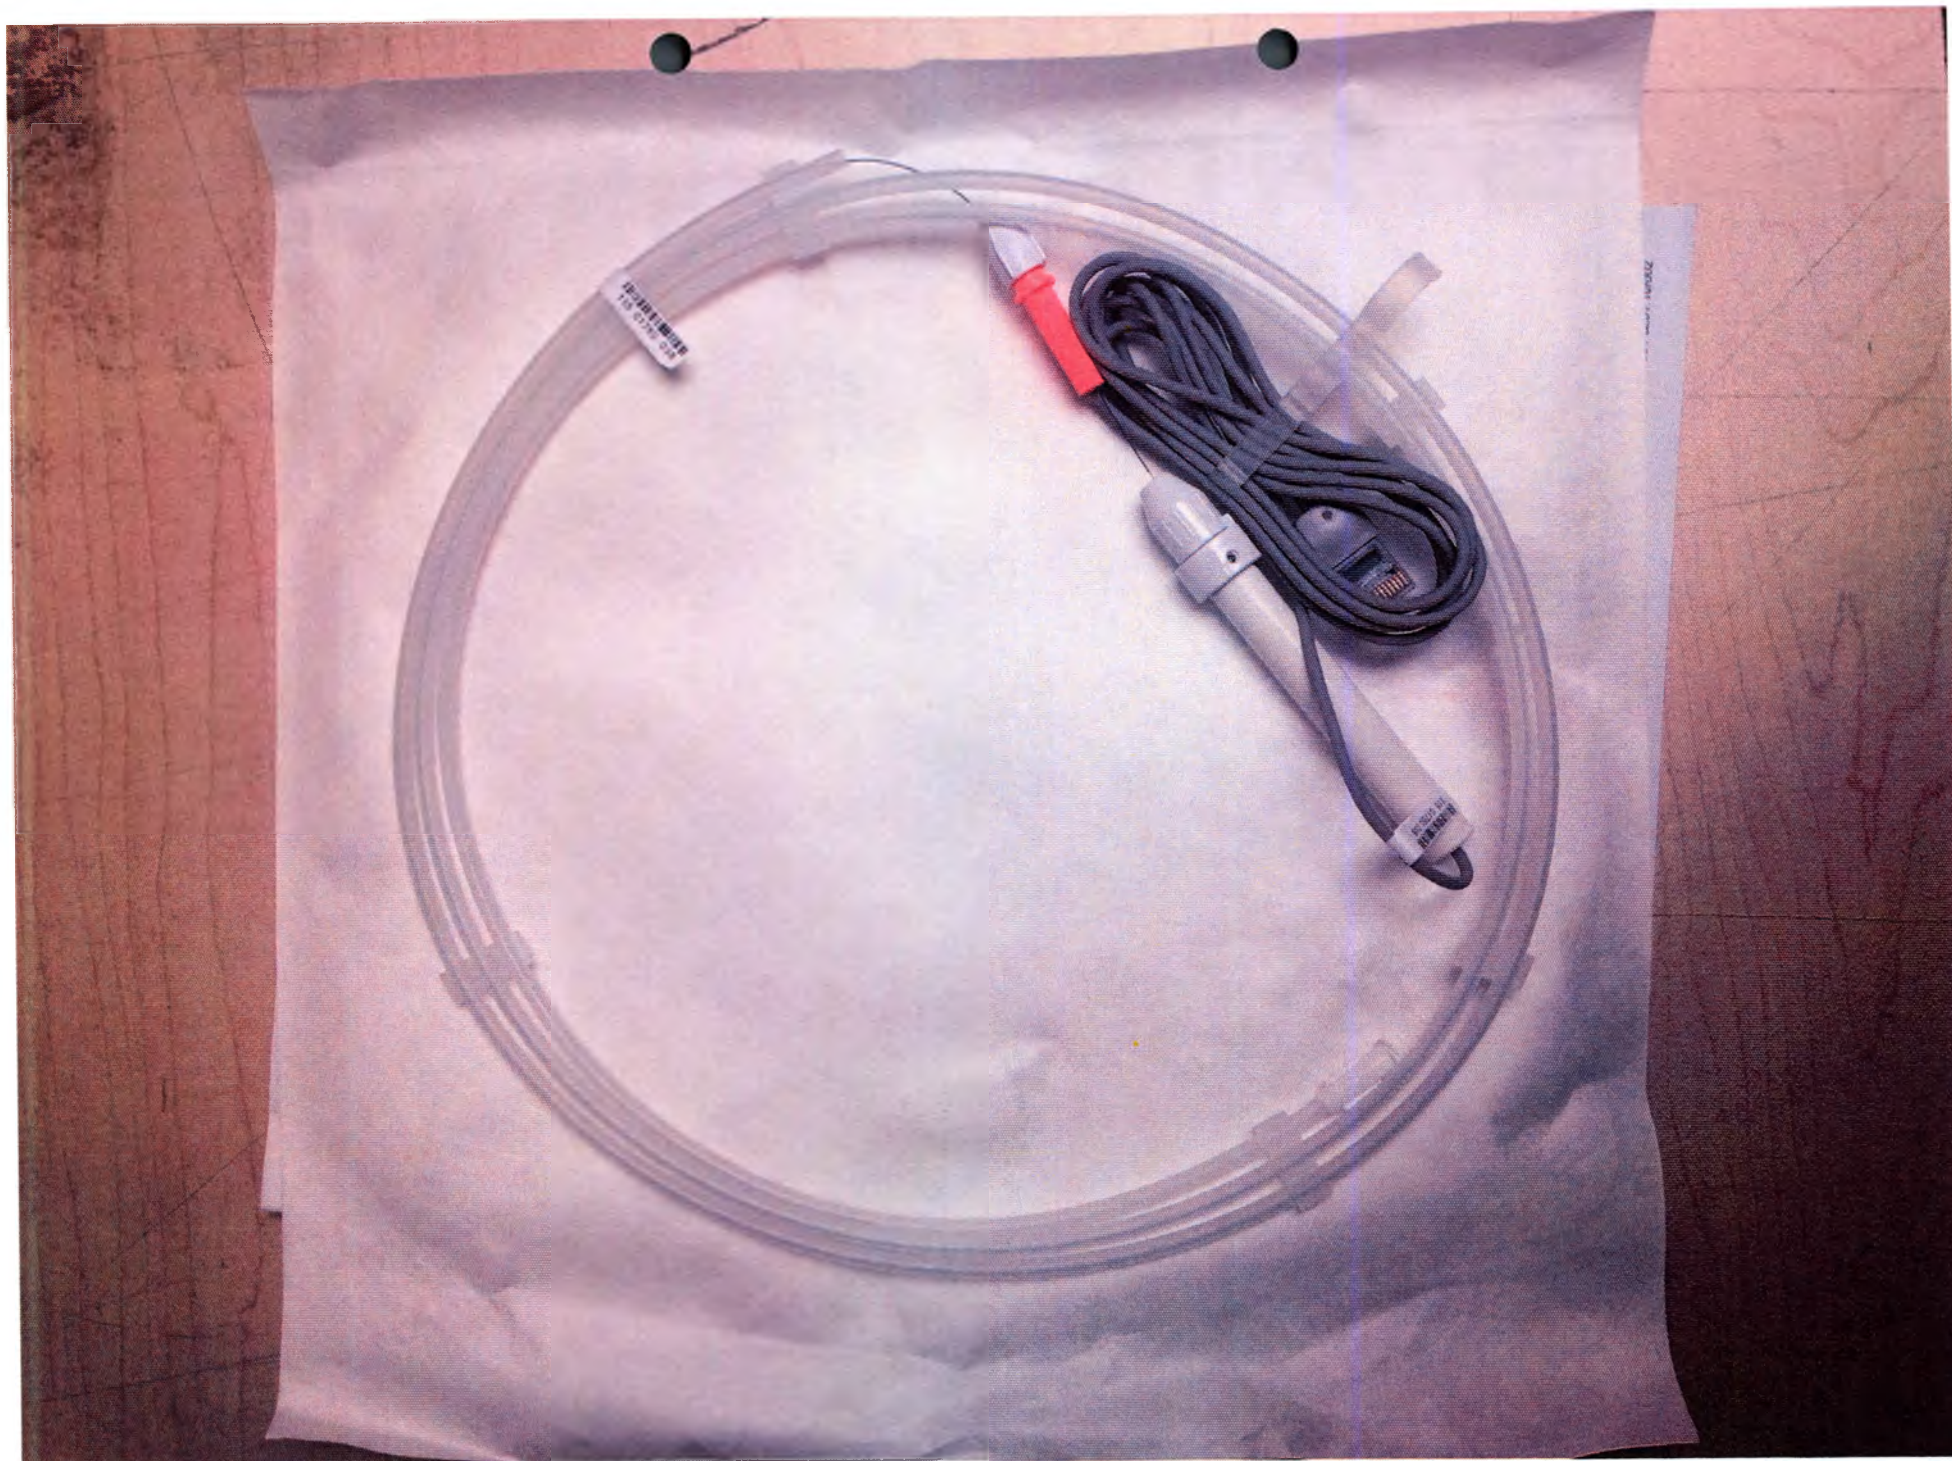

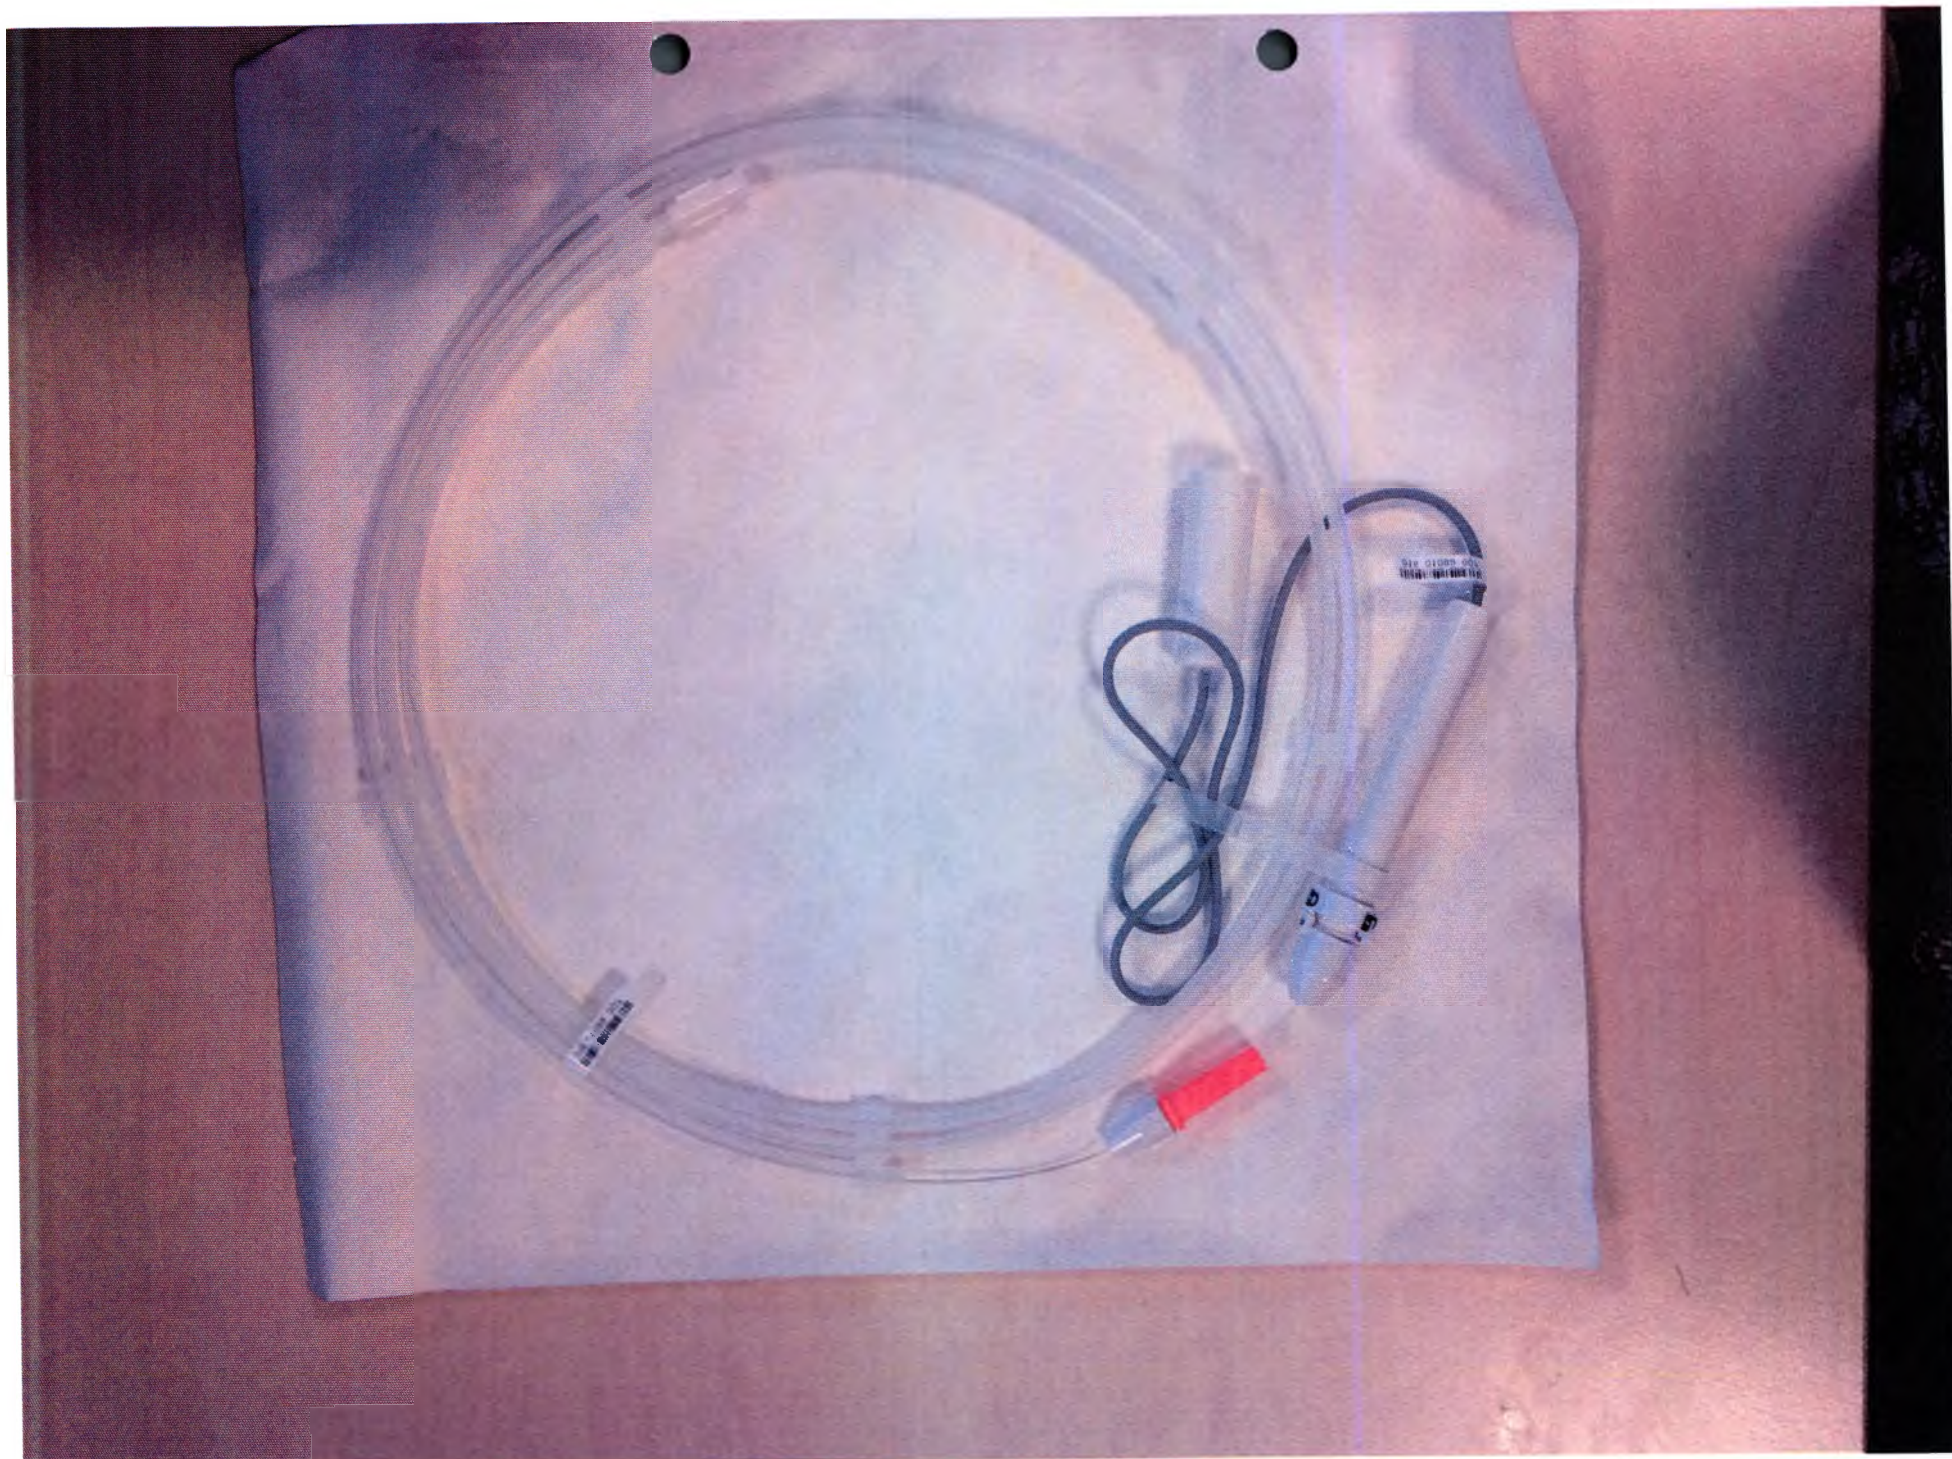




PEEL DOWN

**MUST BE ASEPTICALLY OPENED**

CAUTION: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician

**CONTENTS STERILE**

UNLESS SEAL IS BROKEN OR PACKAGE IS PUNCTURED



**R-100 STERILE EQUIPMENT COVER**  
72" x 20"

Store in a dry, cool place  
Refer to the R-100 Instructions For Use  
For Single use only Rx Only

Class 1 Flammability Rating according to 16 CFR Part 1610

REF


PBKBG

QTY

1

LOT

DA71885



-54°C




2012-07



Volcano Corporation  
2870 Kilgore Road  
Rancho Cordova, CA 95670 USA  
1-800-228-4728

Authorized European Representative:  
Volcano Europe SA/NV  
Excelstorlaan 41  
B-1910 Zaventem Belgium  
+32.2.678.1076 Fax: +32.2.678.1079

Manufactured for Volcano Corporation in the Dominican Republic 805177-003-0002

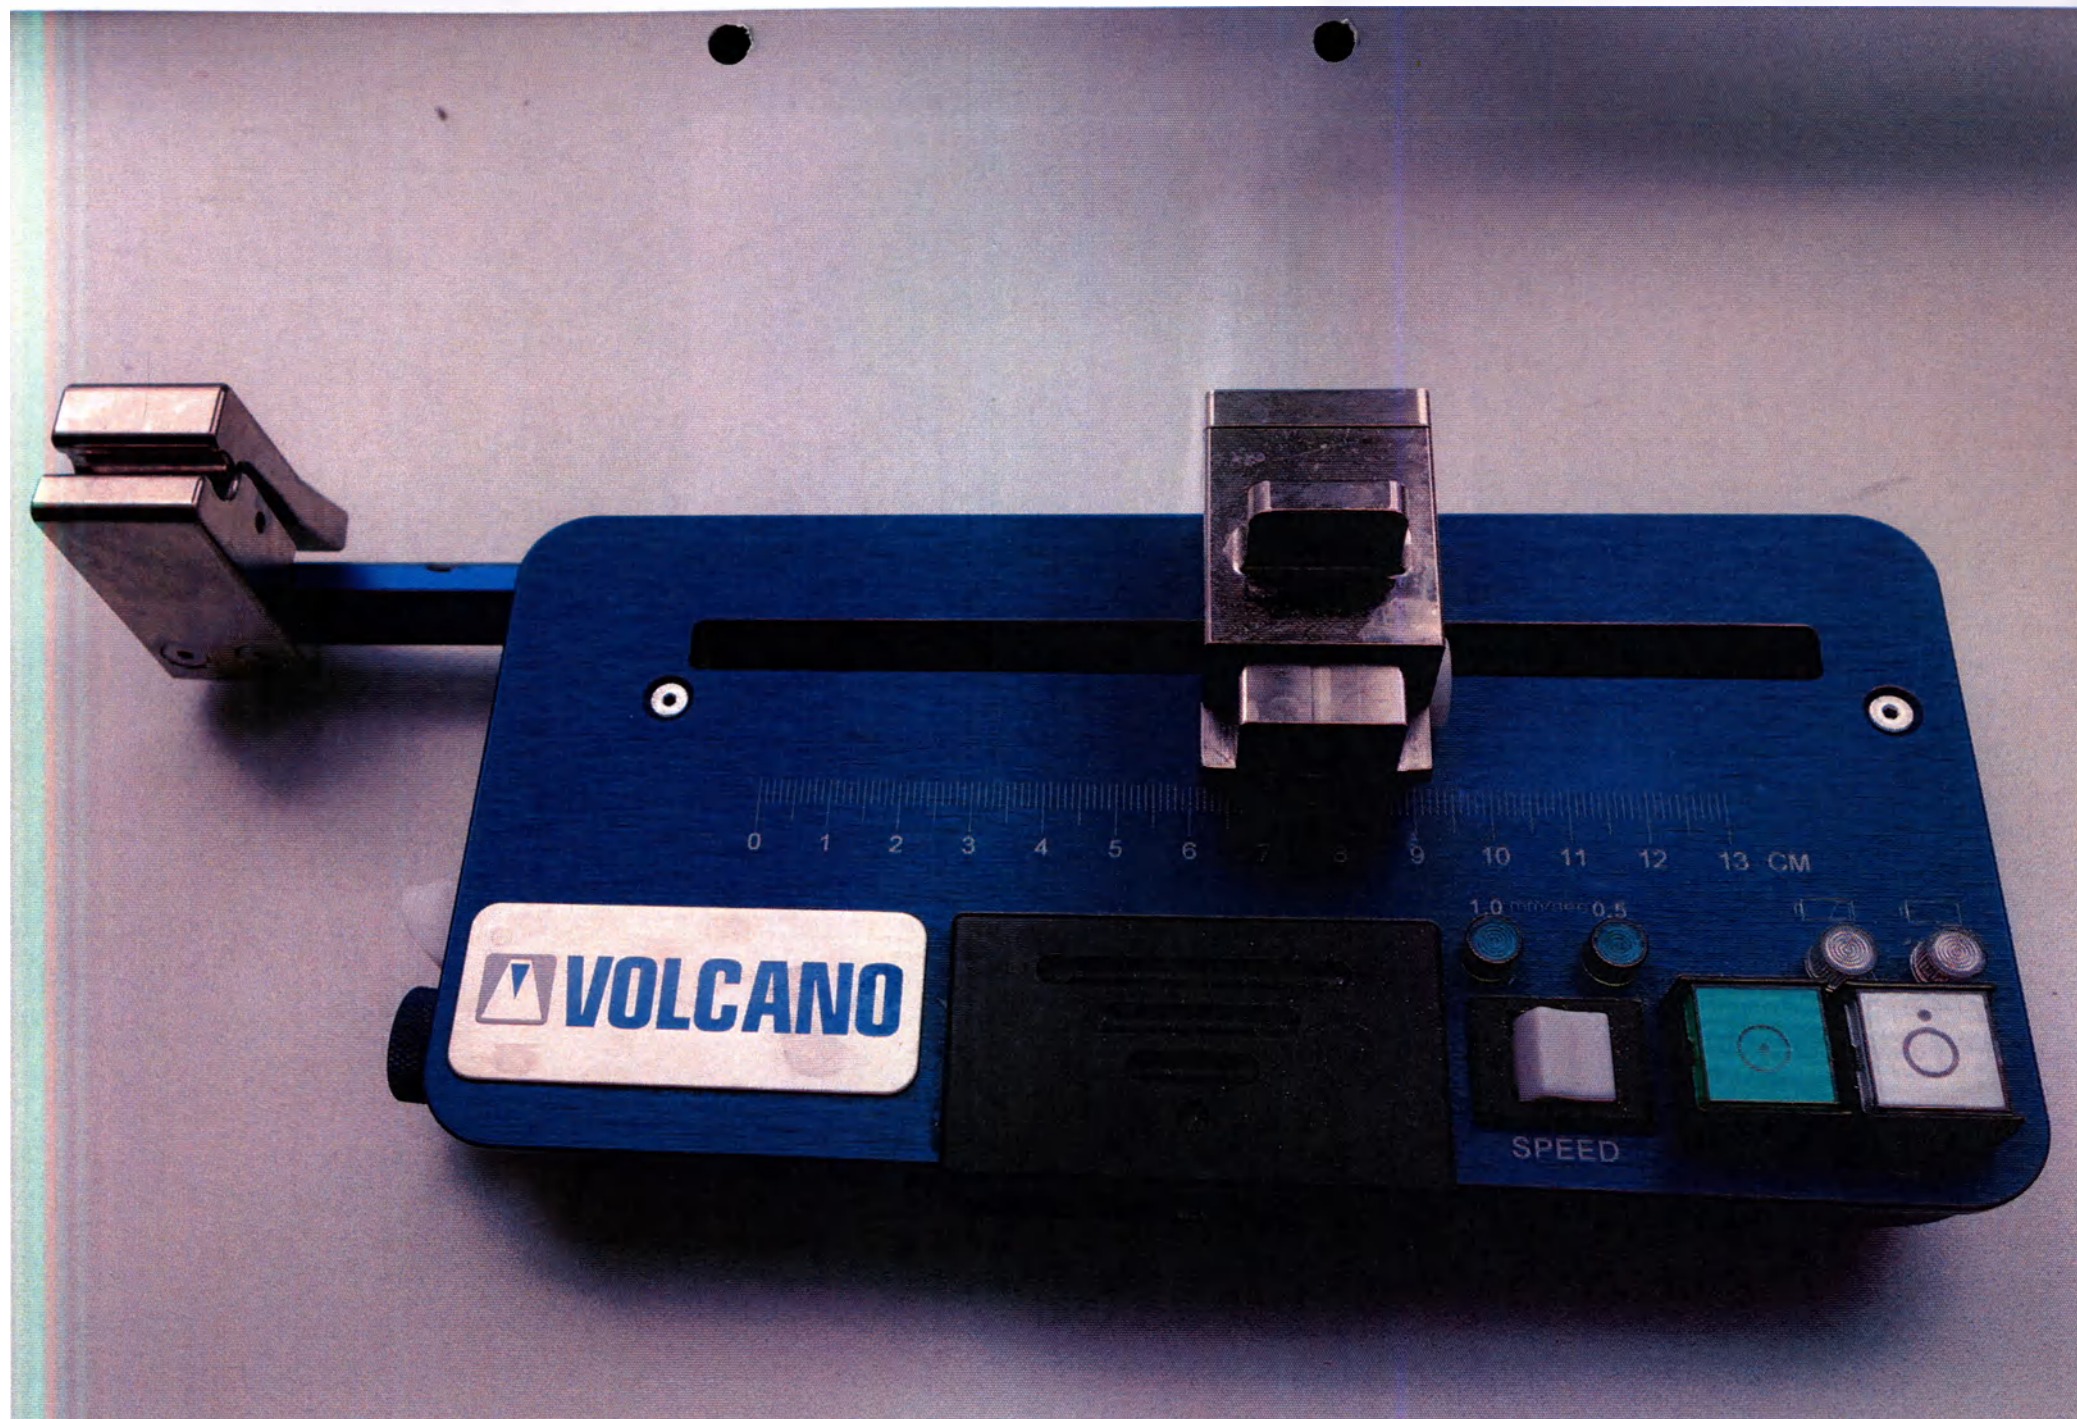

38. Устройство для протяжки датчика R-100.  
ООО ЦИРМИ [info@cirmi.ru](mailto:info@cirmi.ru) [www.goszdravnadzor.ru](http://www.goszdravnadzor.ru)

Филиппов и сыновья  
перевозчик 50 (необ-  
ходим) двинув

