


Фотографические изображения

I. Ультразвуковая диагностическая система SmartSONO MS-09 с принадлежностями





1. Блок базовый SmartSONO MS-09

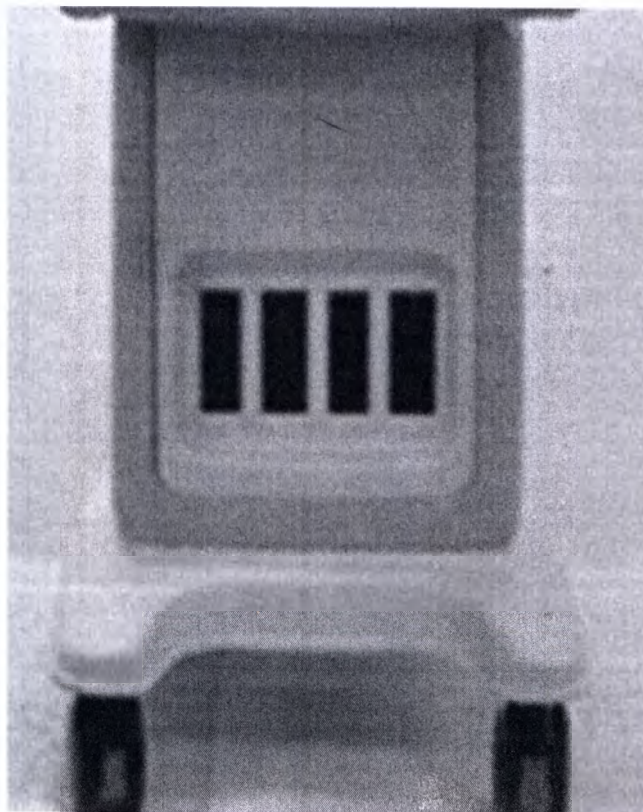

2. ЖК монитор 15"




3. Панель управления




II. Принадлежности:


1. Датчик конвексный 3.5C50MA/2-5,5 МГц, не более 5 шт.

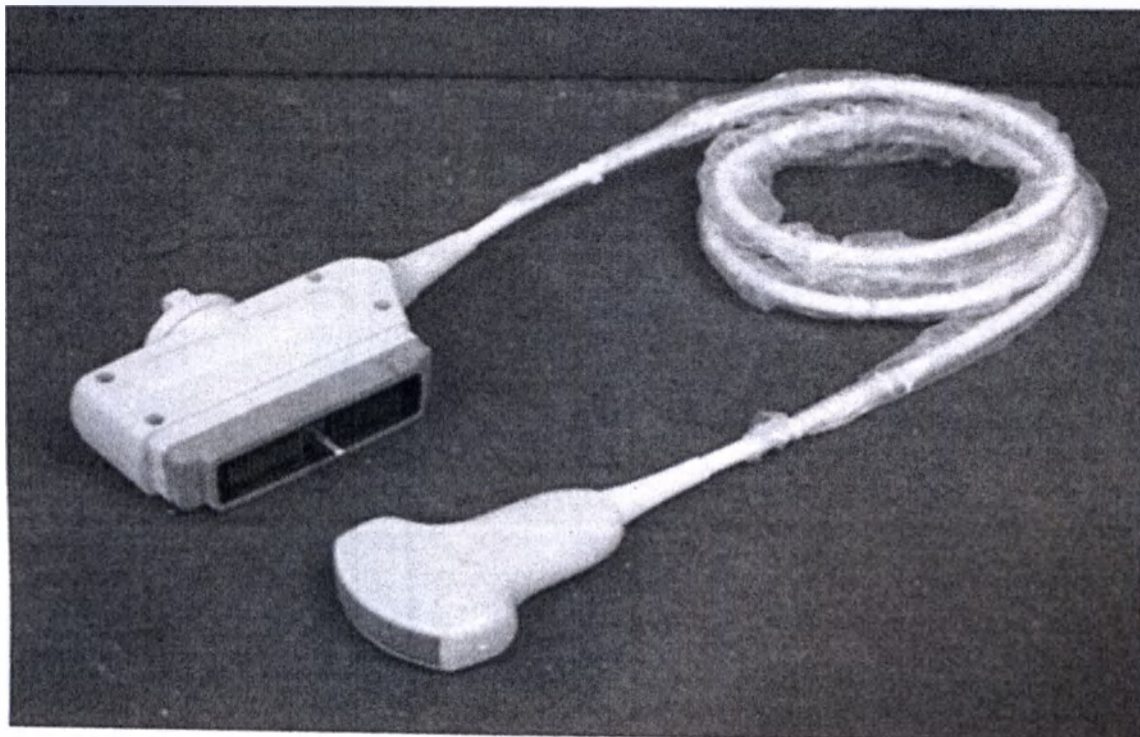


2. Датчик линейный 7.5L40MA/ 6-12 МГц, не более 5 шт.

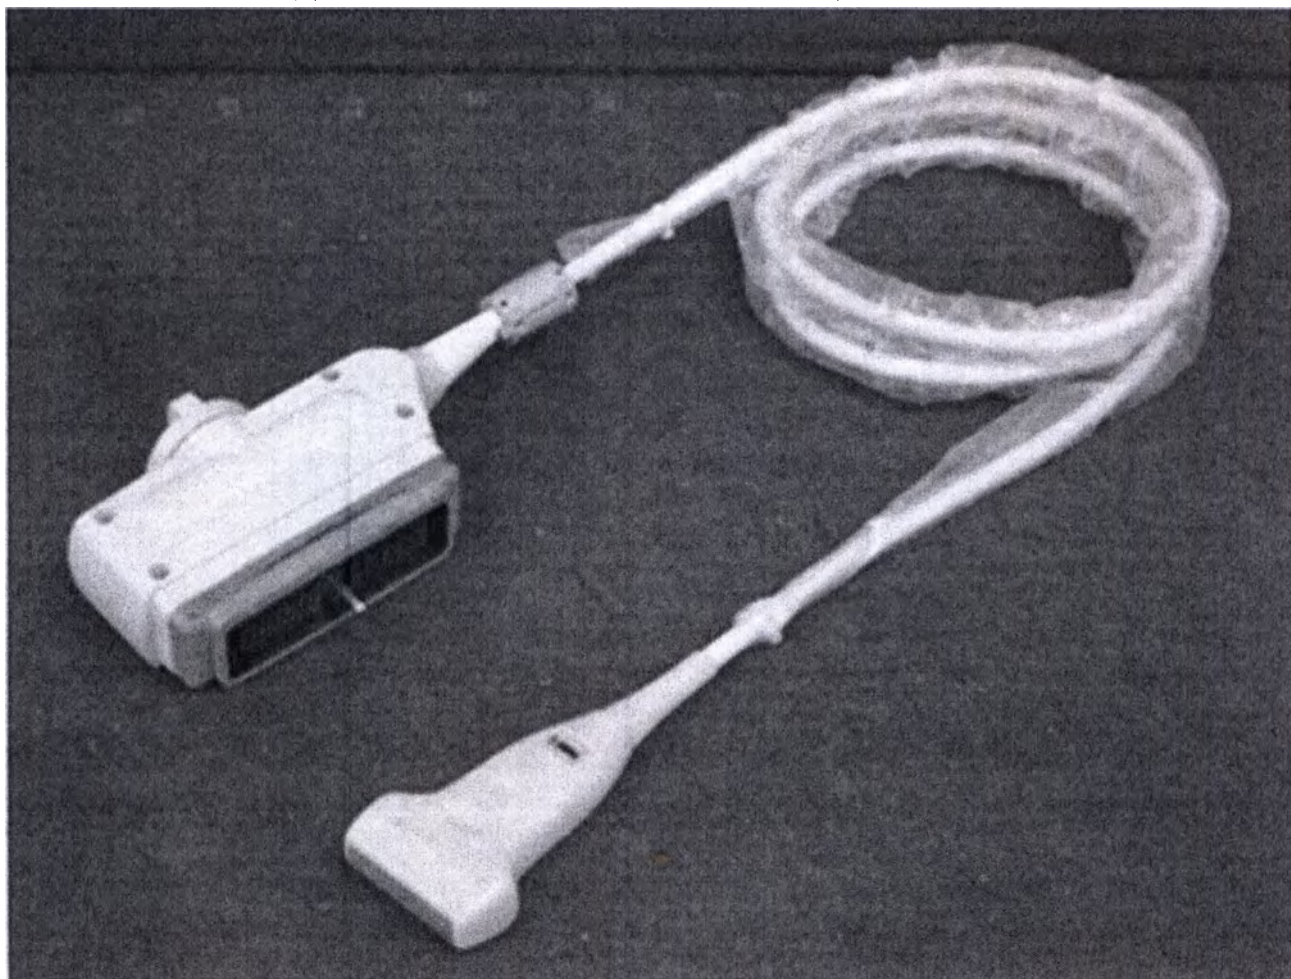


3. Датчик микроконвексный 3.5C20MA/2-5 МГц, не более 5 шт.

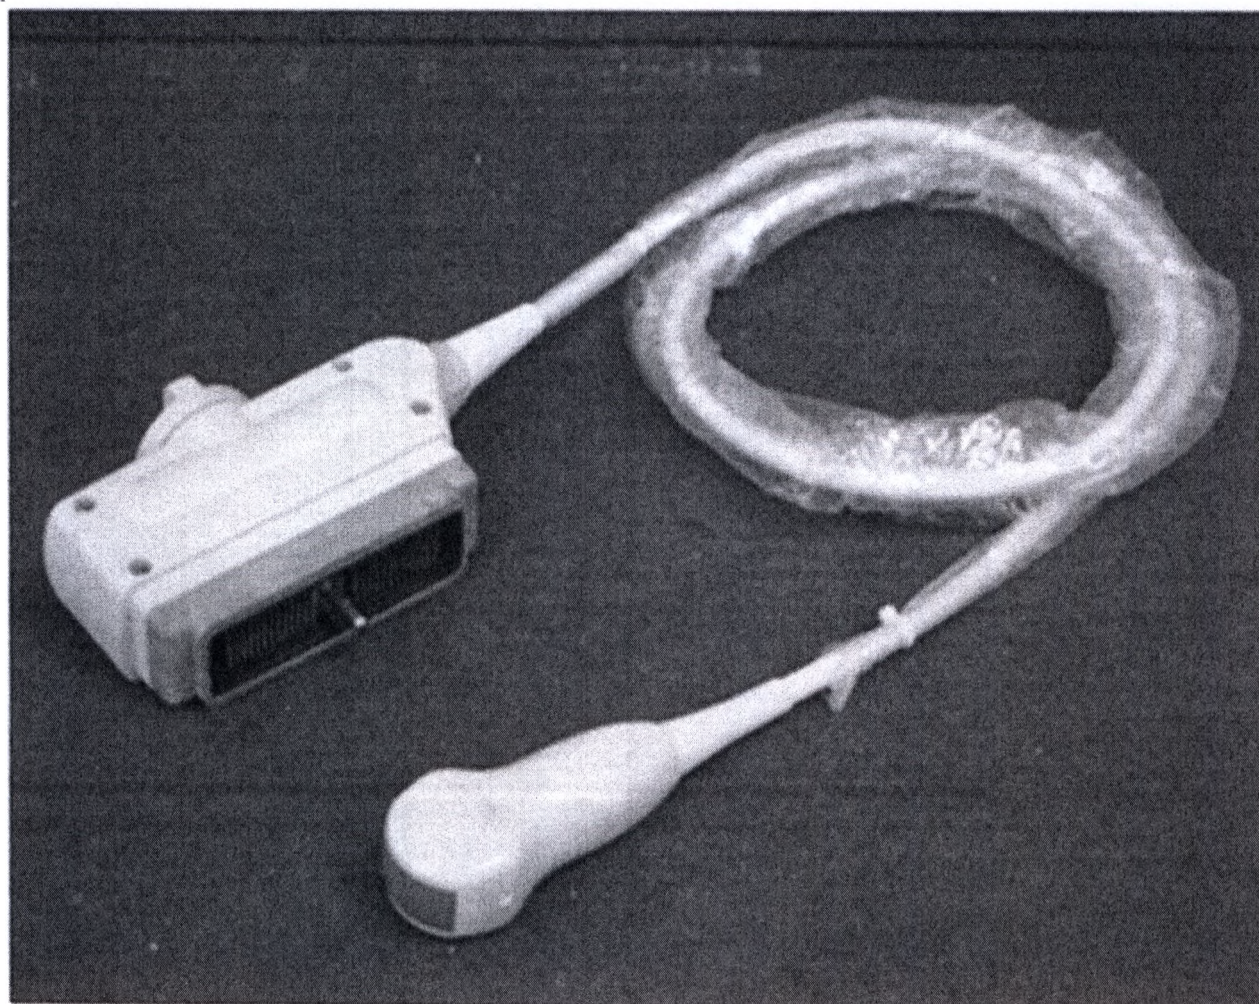


4. Датчик фазированный 3.0РА16МА/2-10 МГц, не более 5 шт.

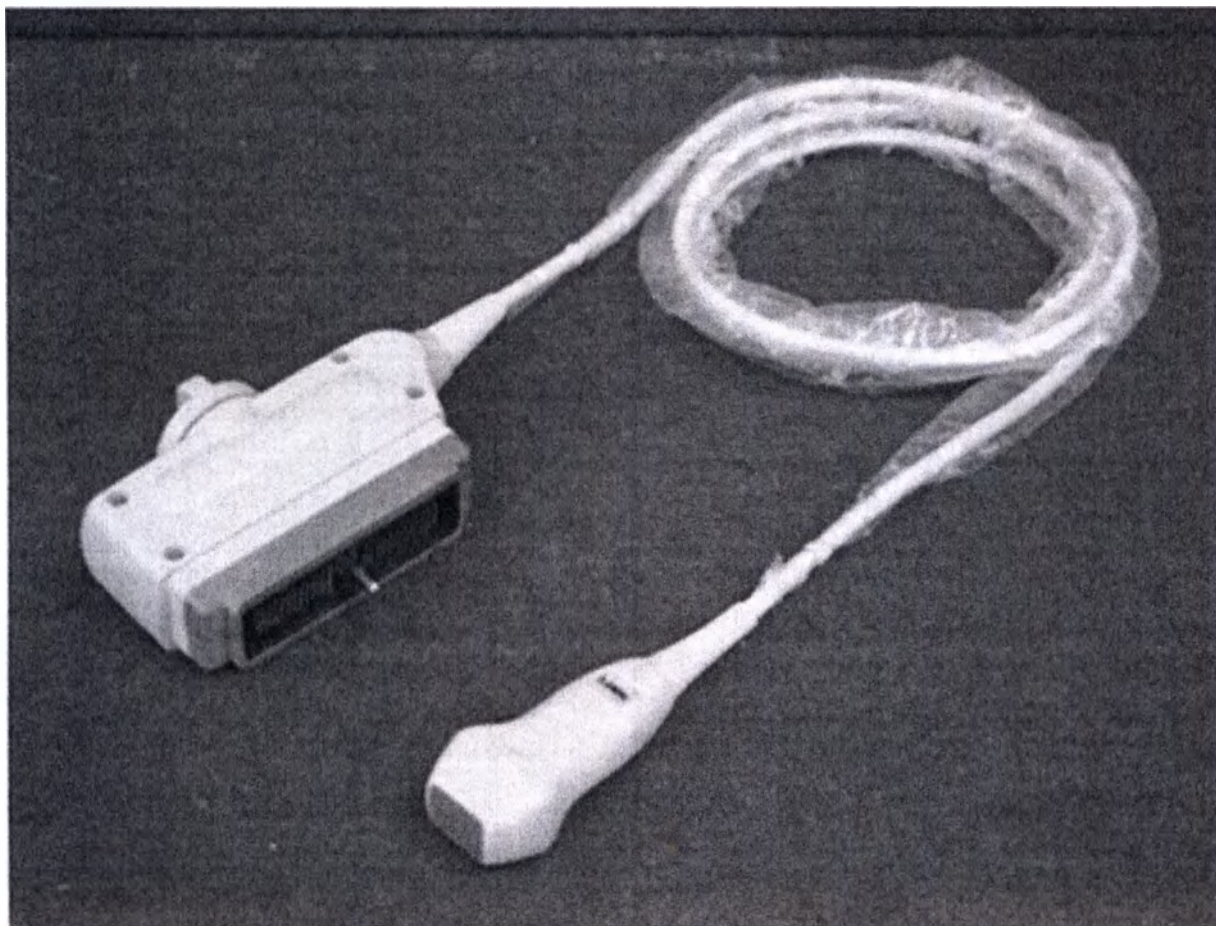

5. Датчик трансвагинальный 6.5С10МА/5-8 МГц, не более 5 шт.

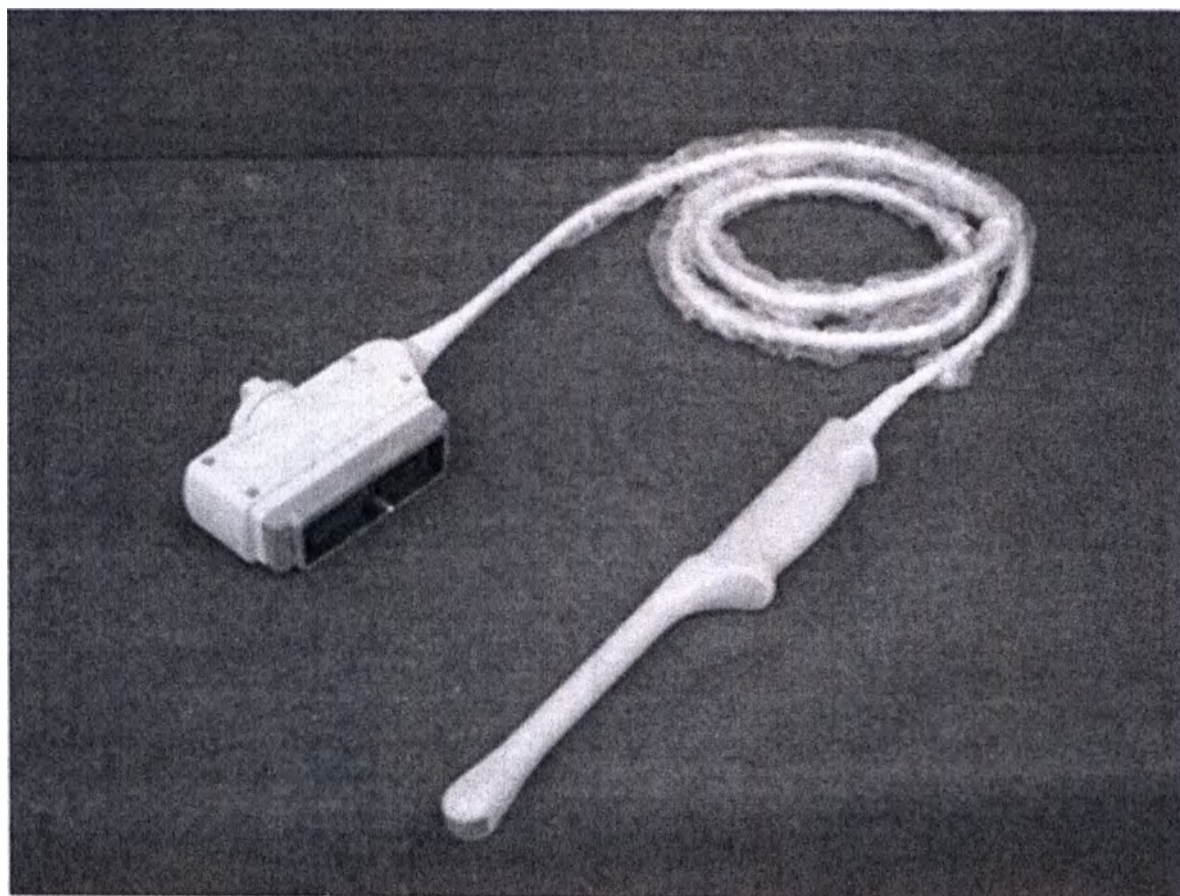

5. Кабель питания.

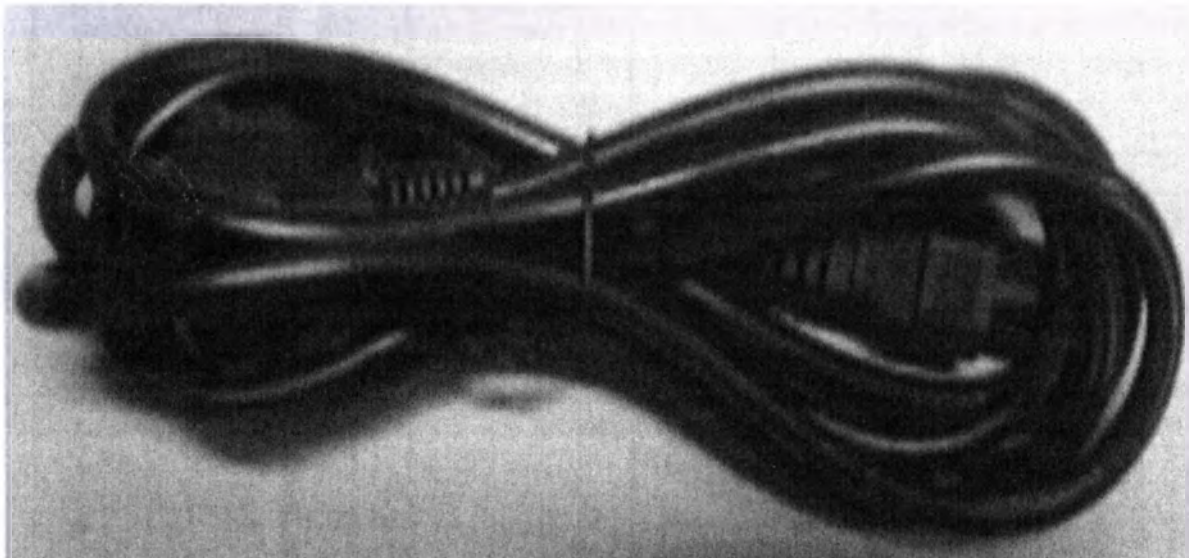

6. Руководство по эксплуатации.

Генеральный директор



Е.А.Сабурова

Всего прошнуровано
пронумеровано и скреплено
печатью

