


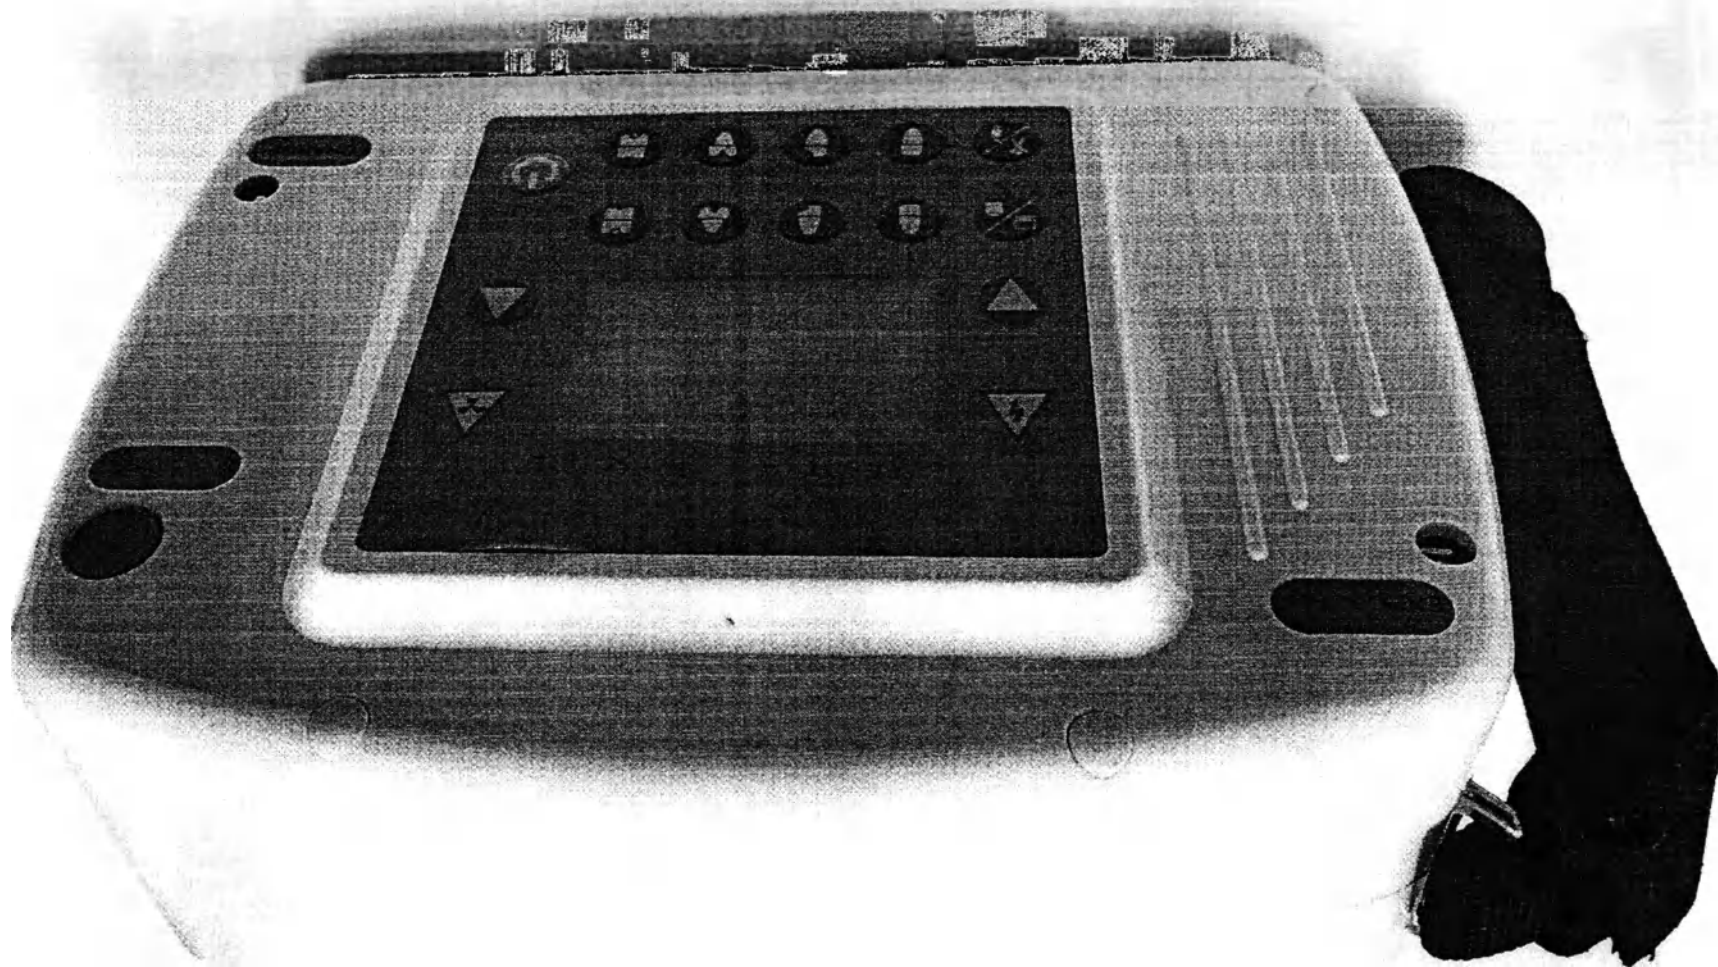

JYF-10A

Рентгеновская трубка: D-045 (Toshiba)

Постоянный ток - 16.8В, 2 А

Емкость аккумулятора 4400 мАч

Постоянная фильтрация 1,6 А

Номинальное значение фокусного пятна 0,4 мм

SN: 01504048

Дата производства: 2016-04-20

Производитель:

Guangzhou Zhongshan Haitian Medical Technology Co., Ltd
No. 26, Wushuichi Road, Shiba District, Guangzhou, 200035, China

