




МОТОмед muvi

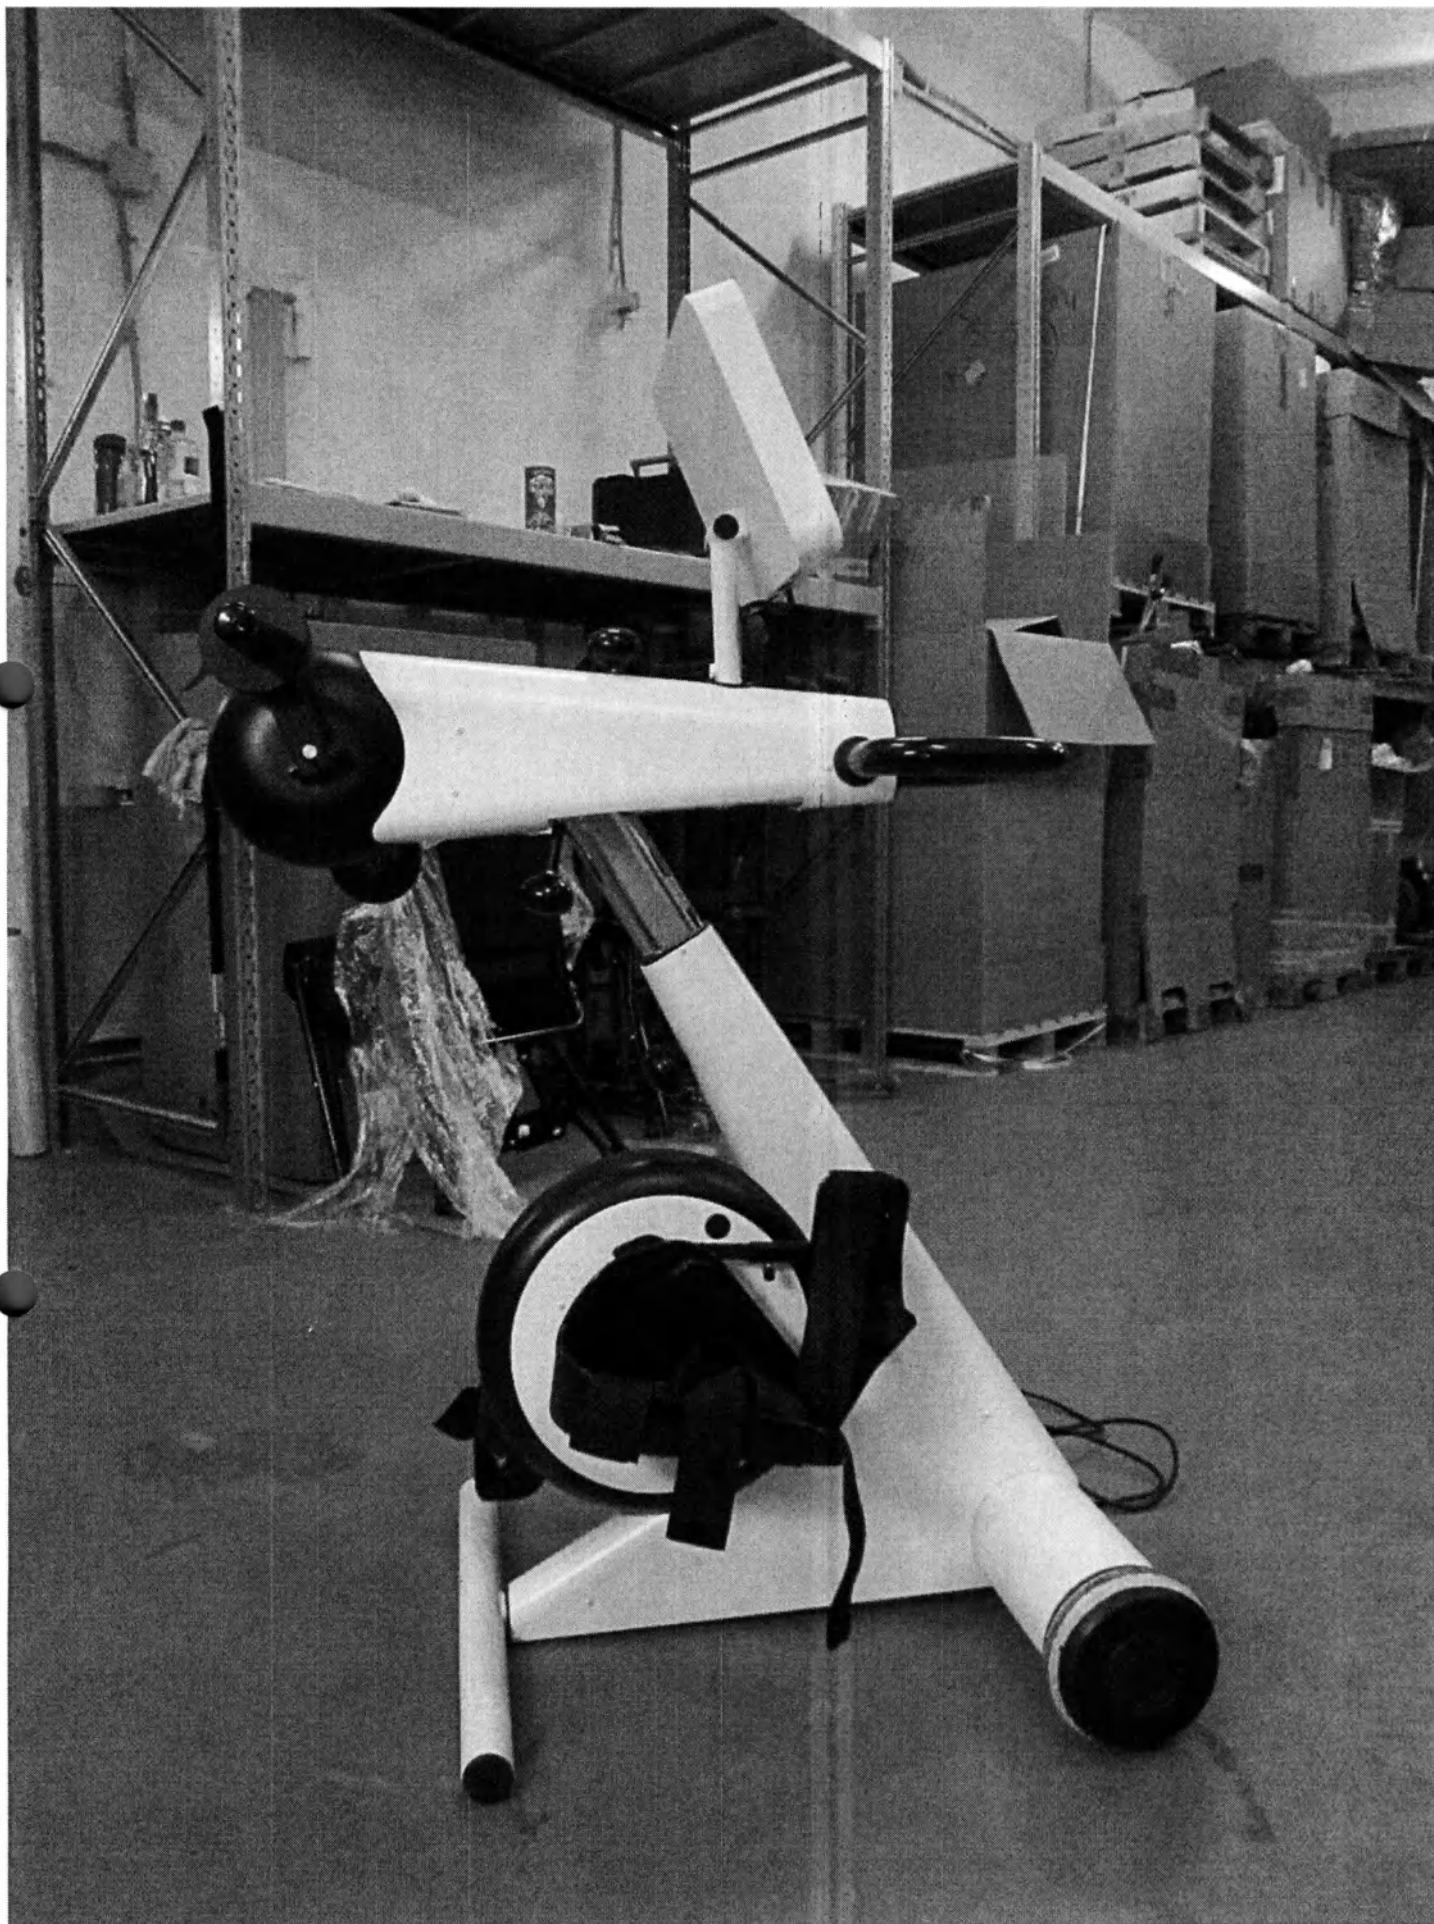


МОТОмед mivi


ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru




MOTOMED viva2

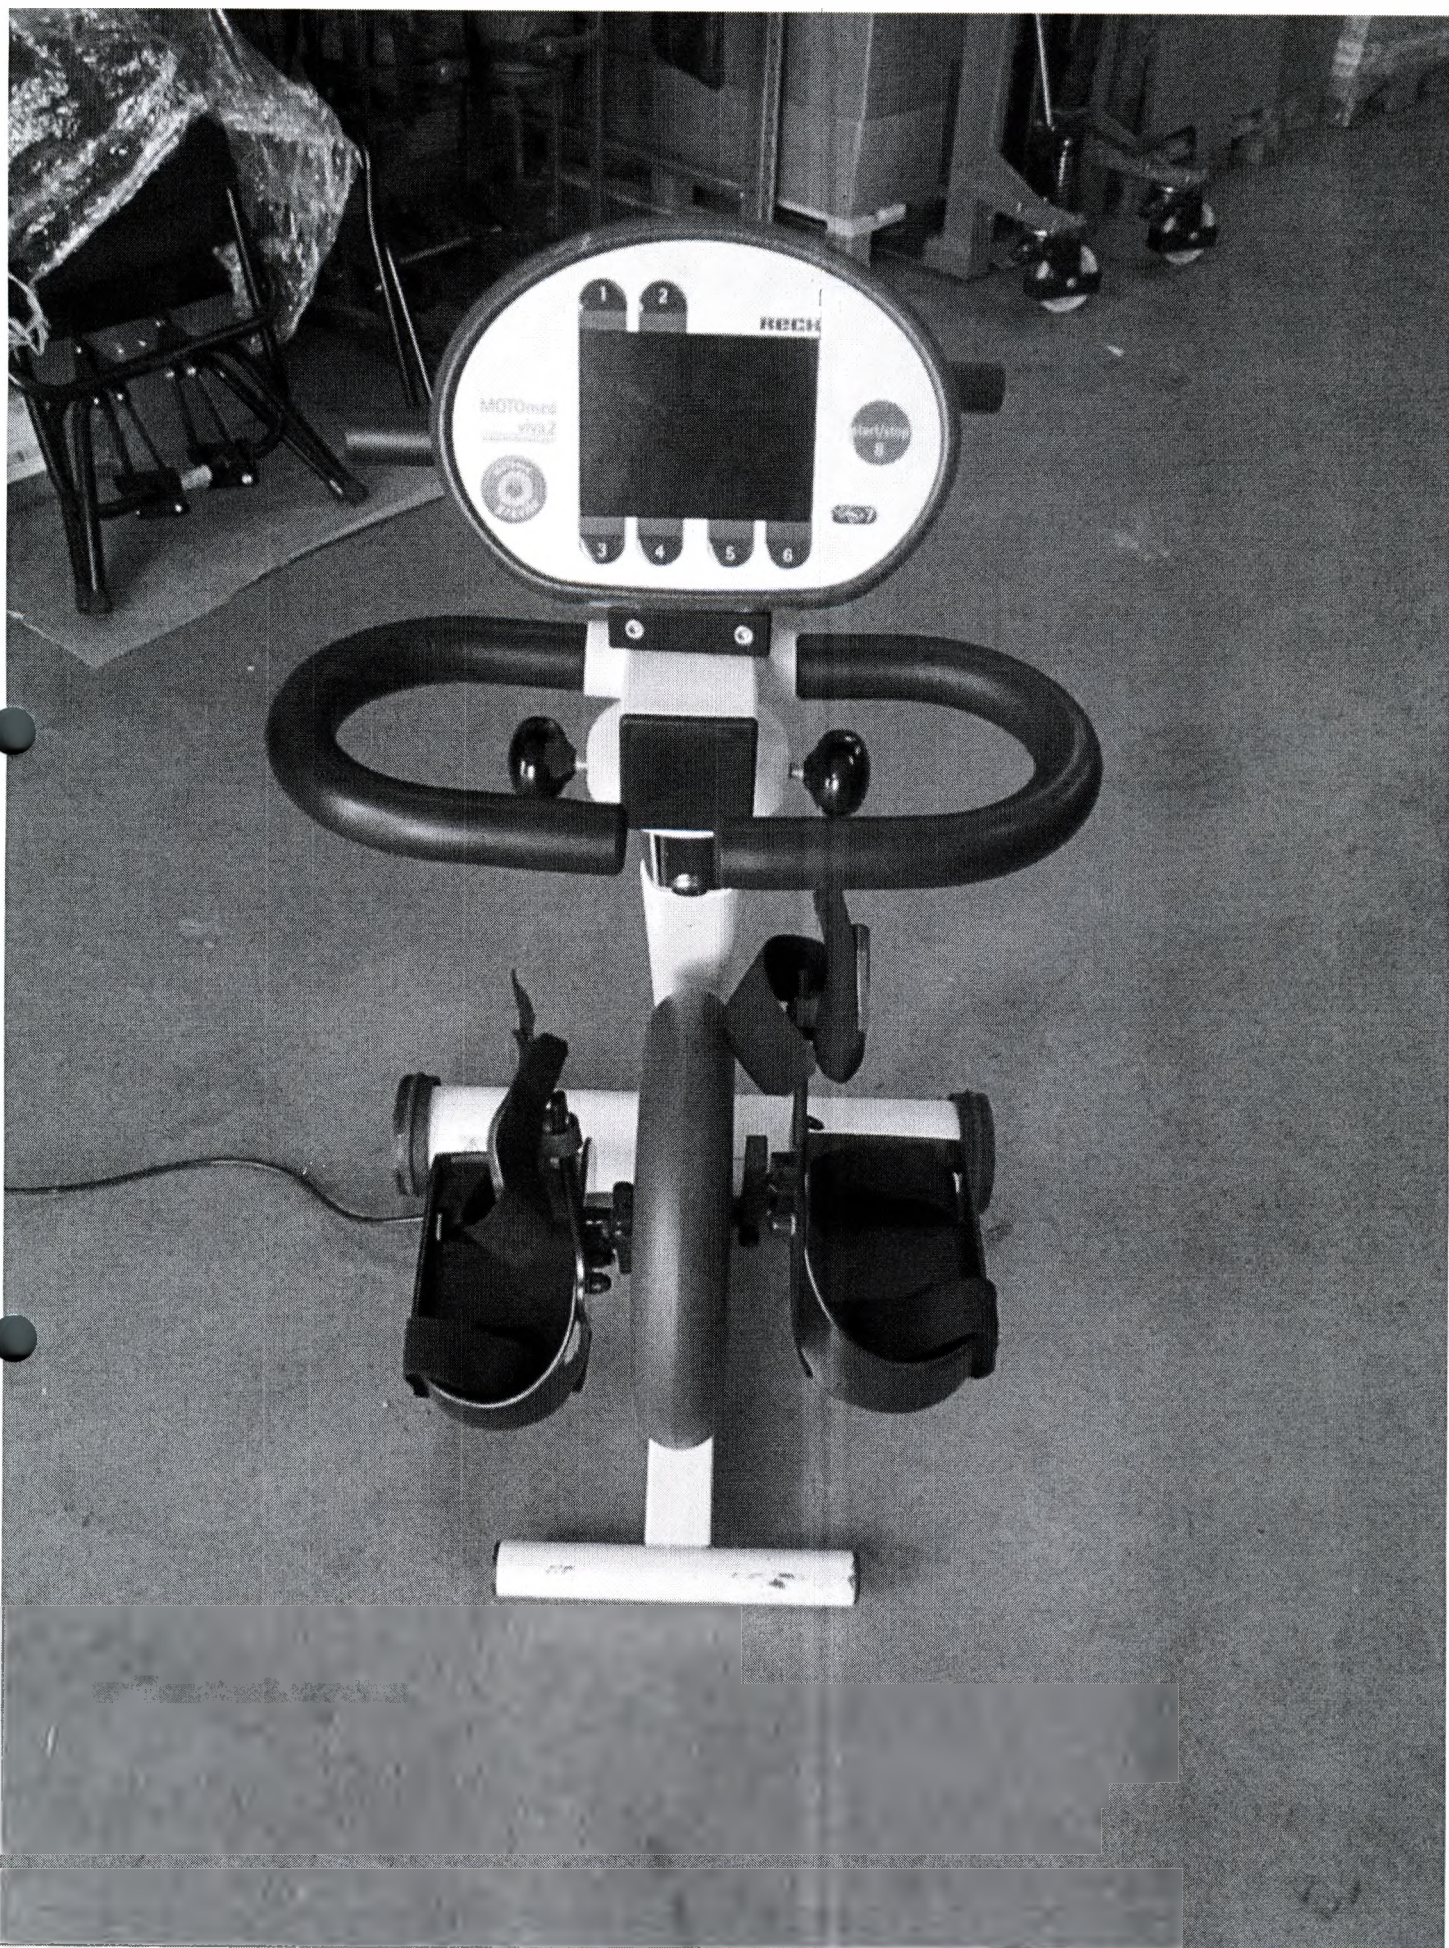

MOTOMED viva2

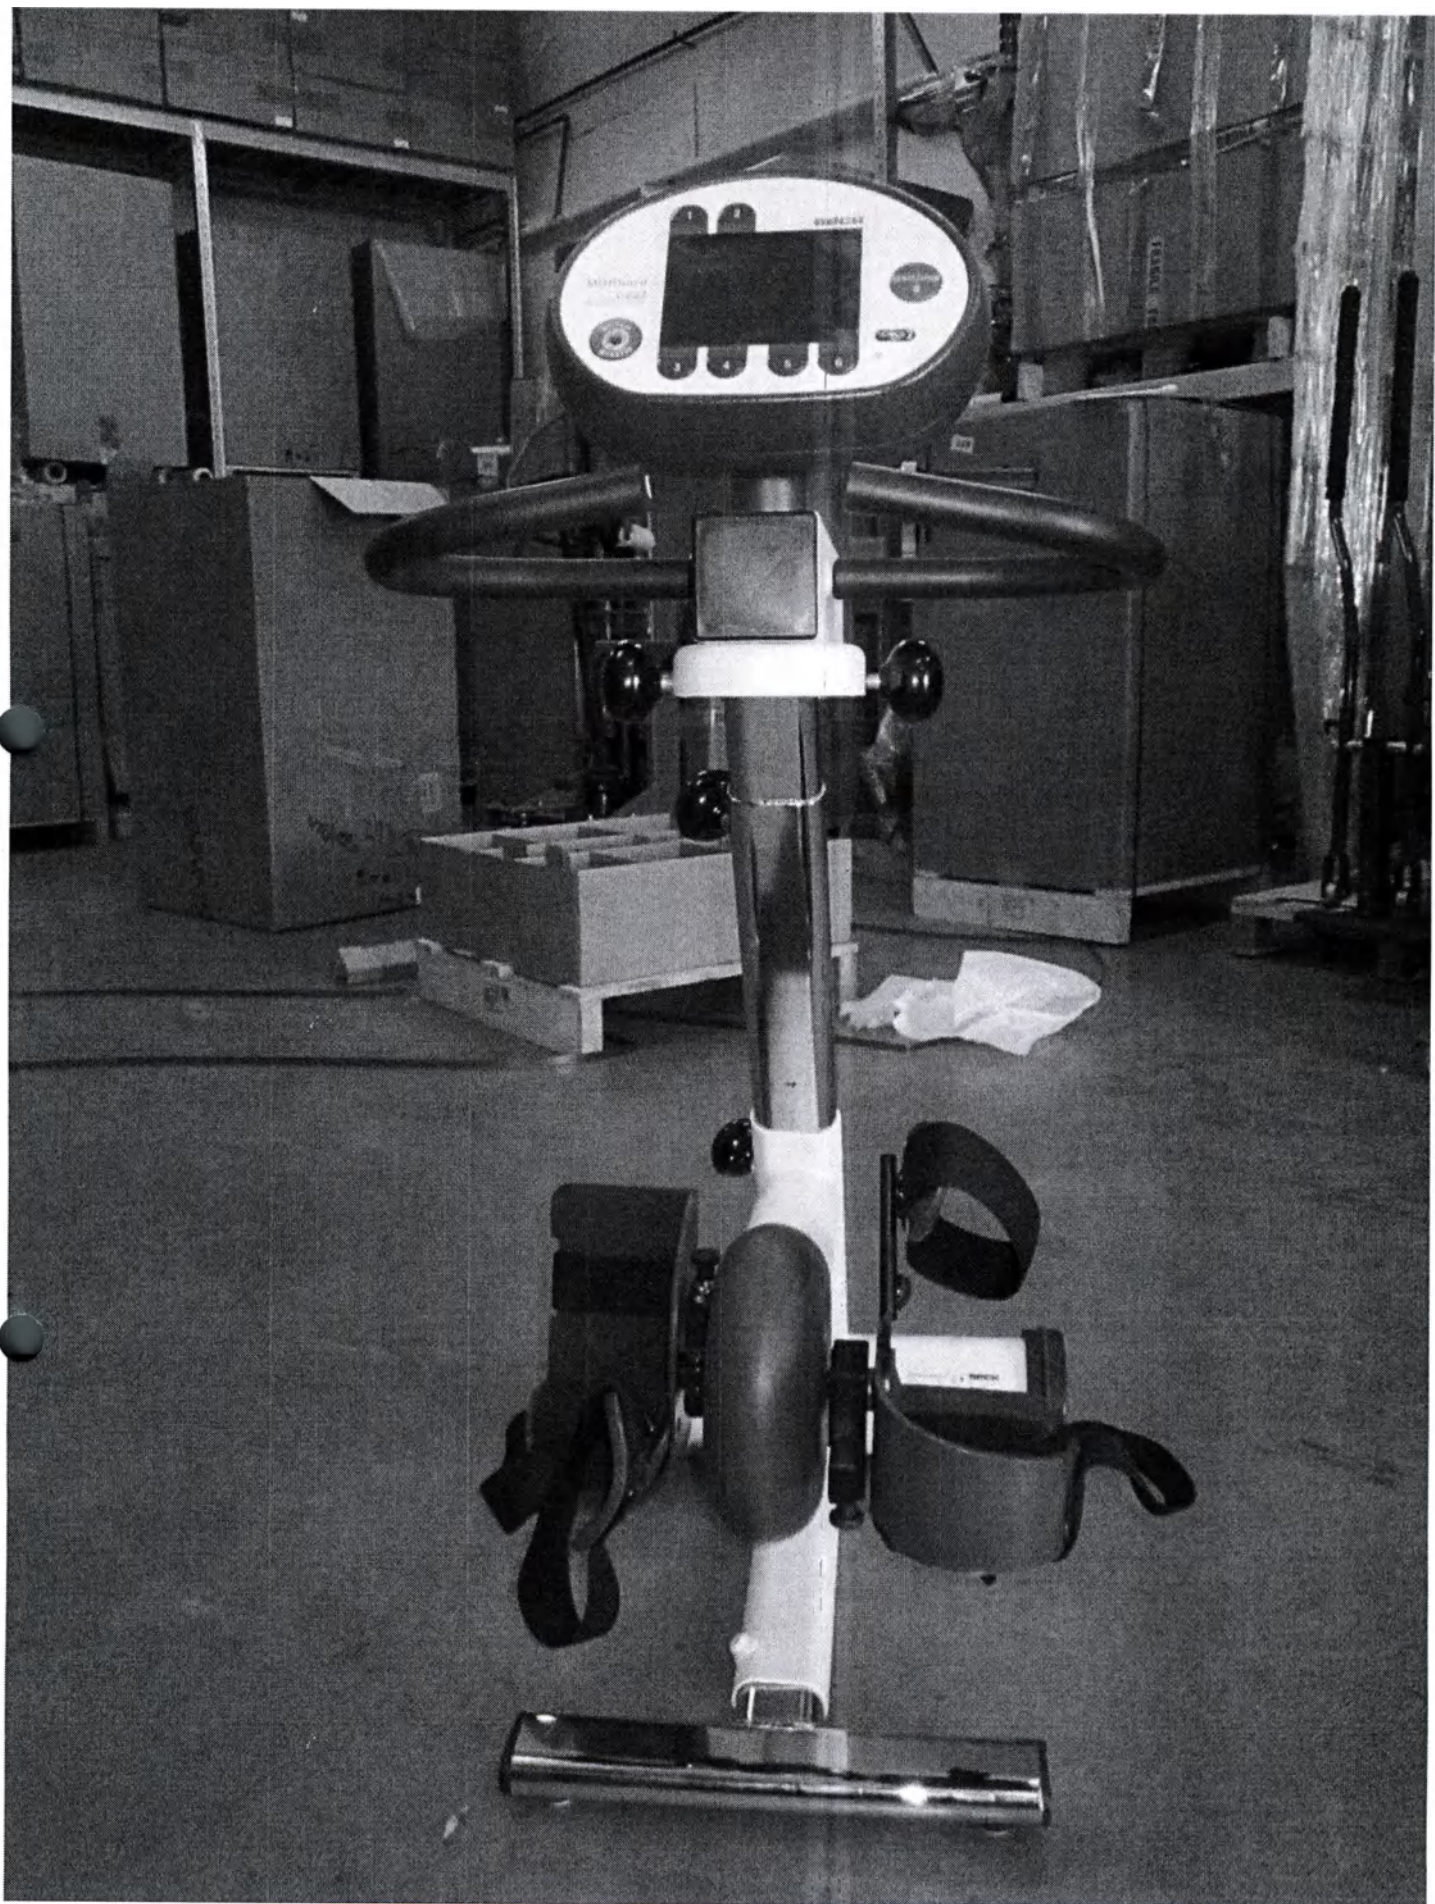


MOTOMед gracile12

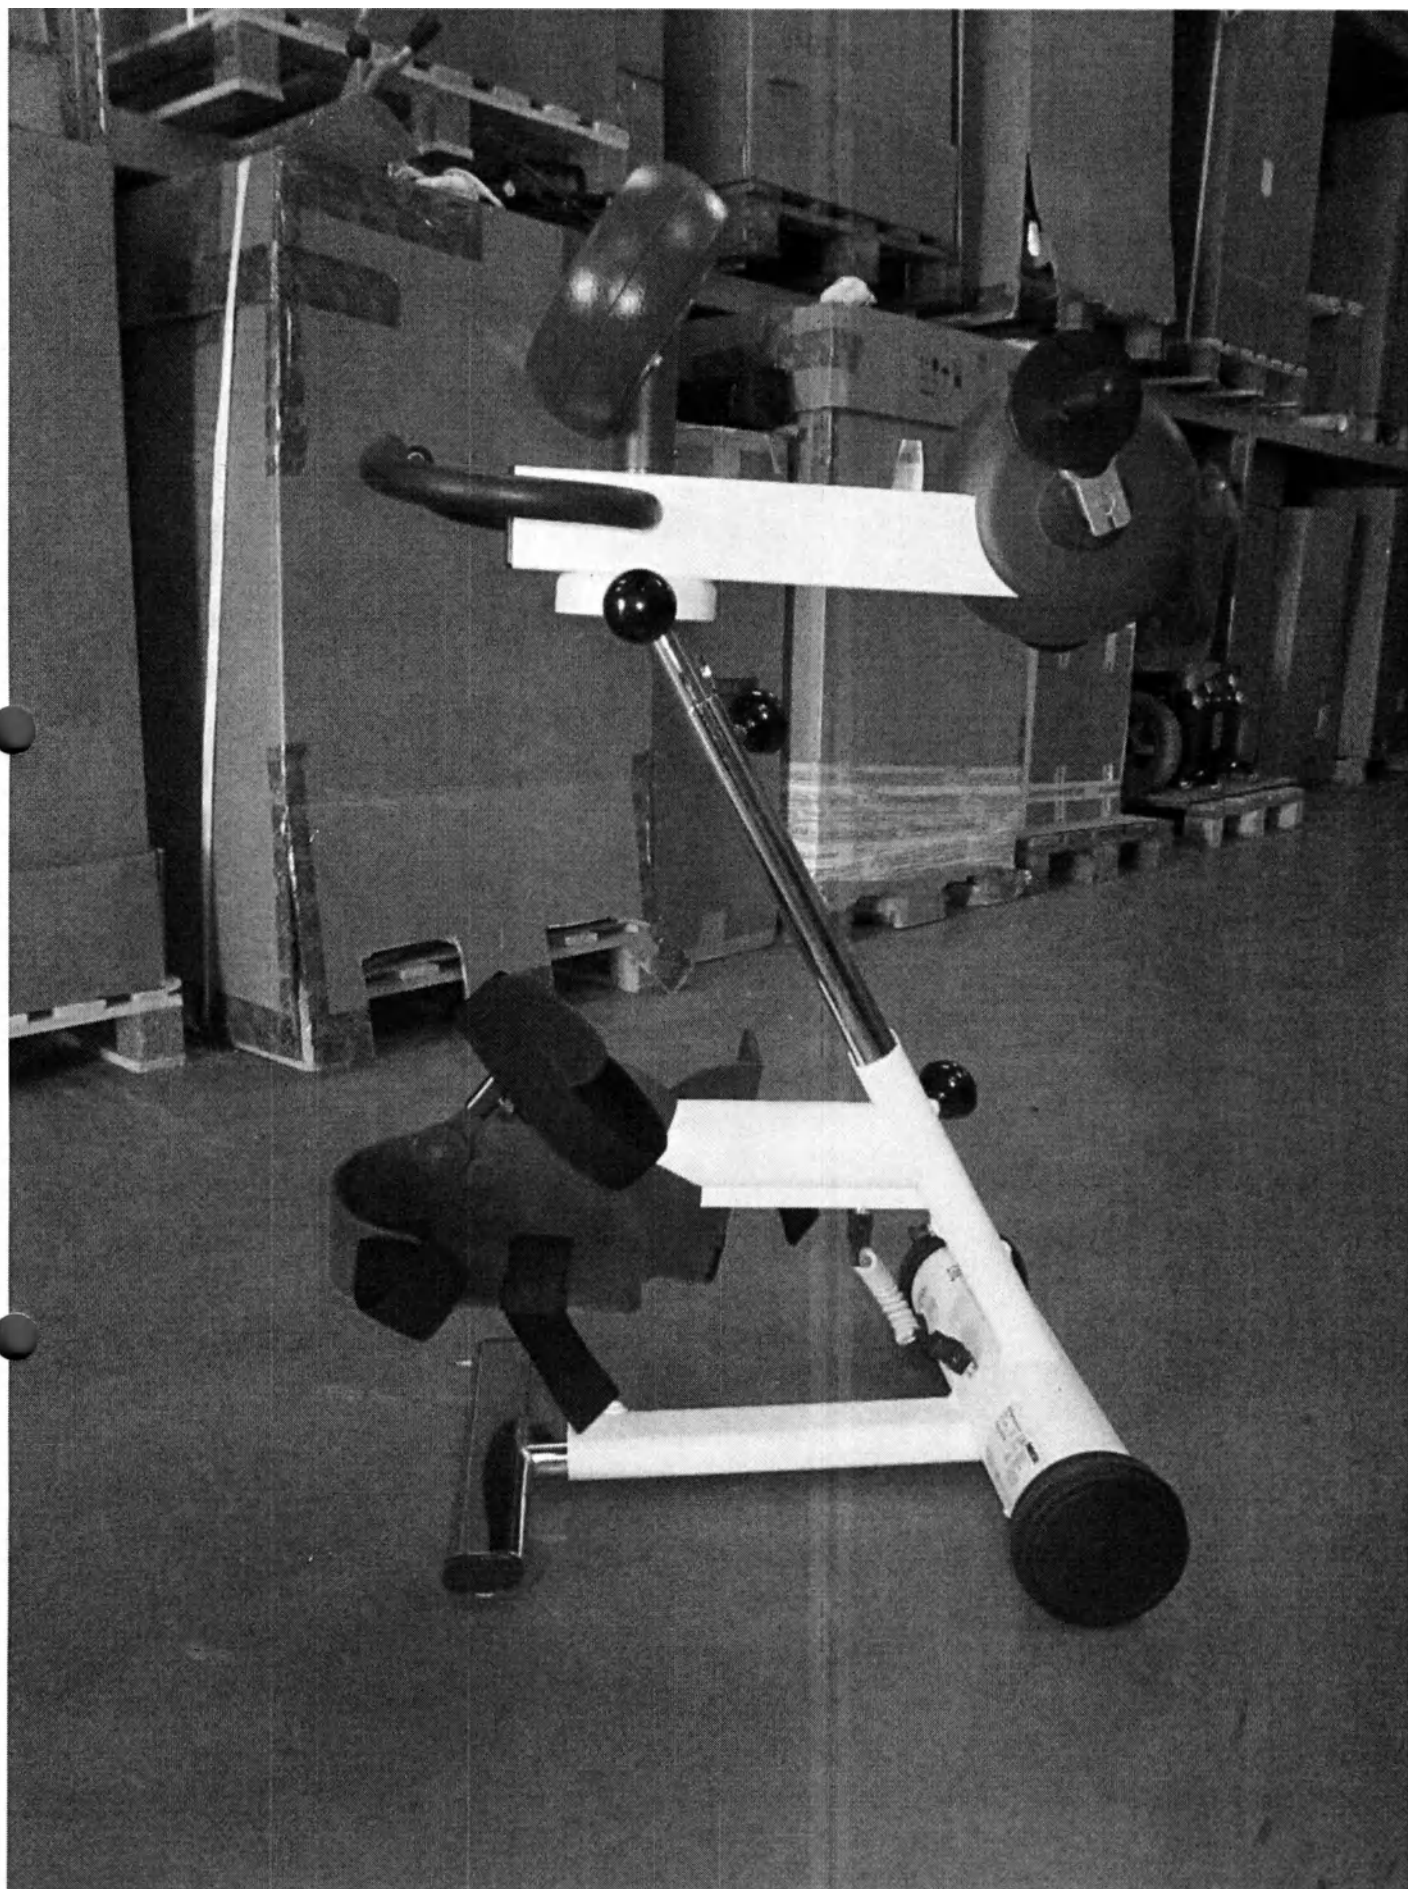

MOTOMED gracile12



МОТОмед letto2

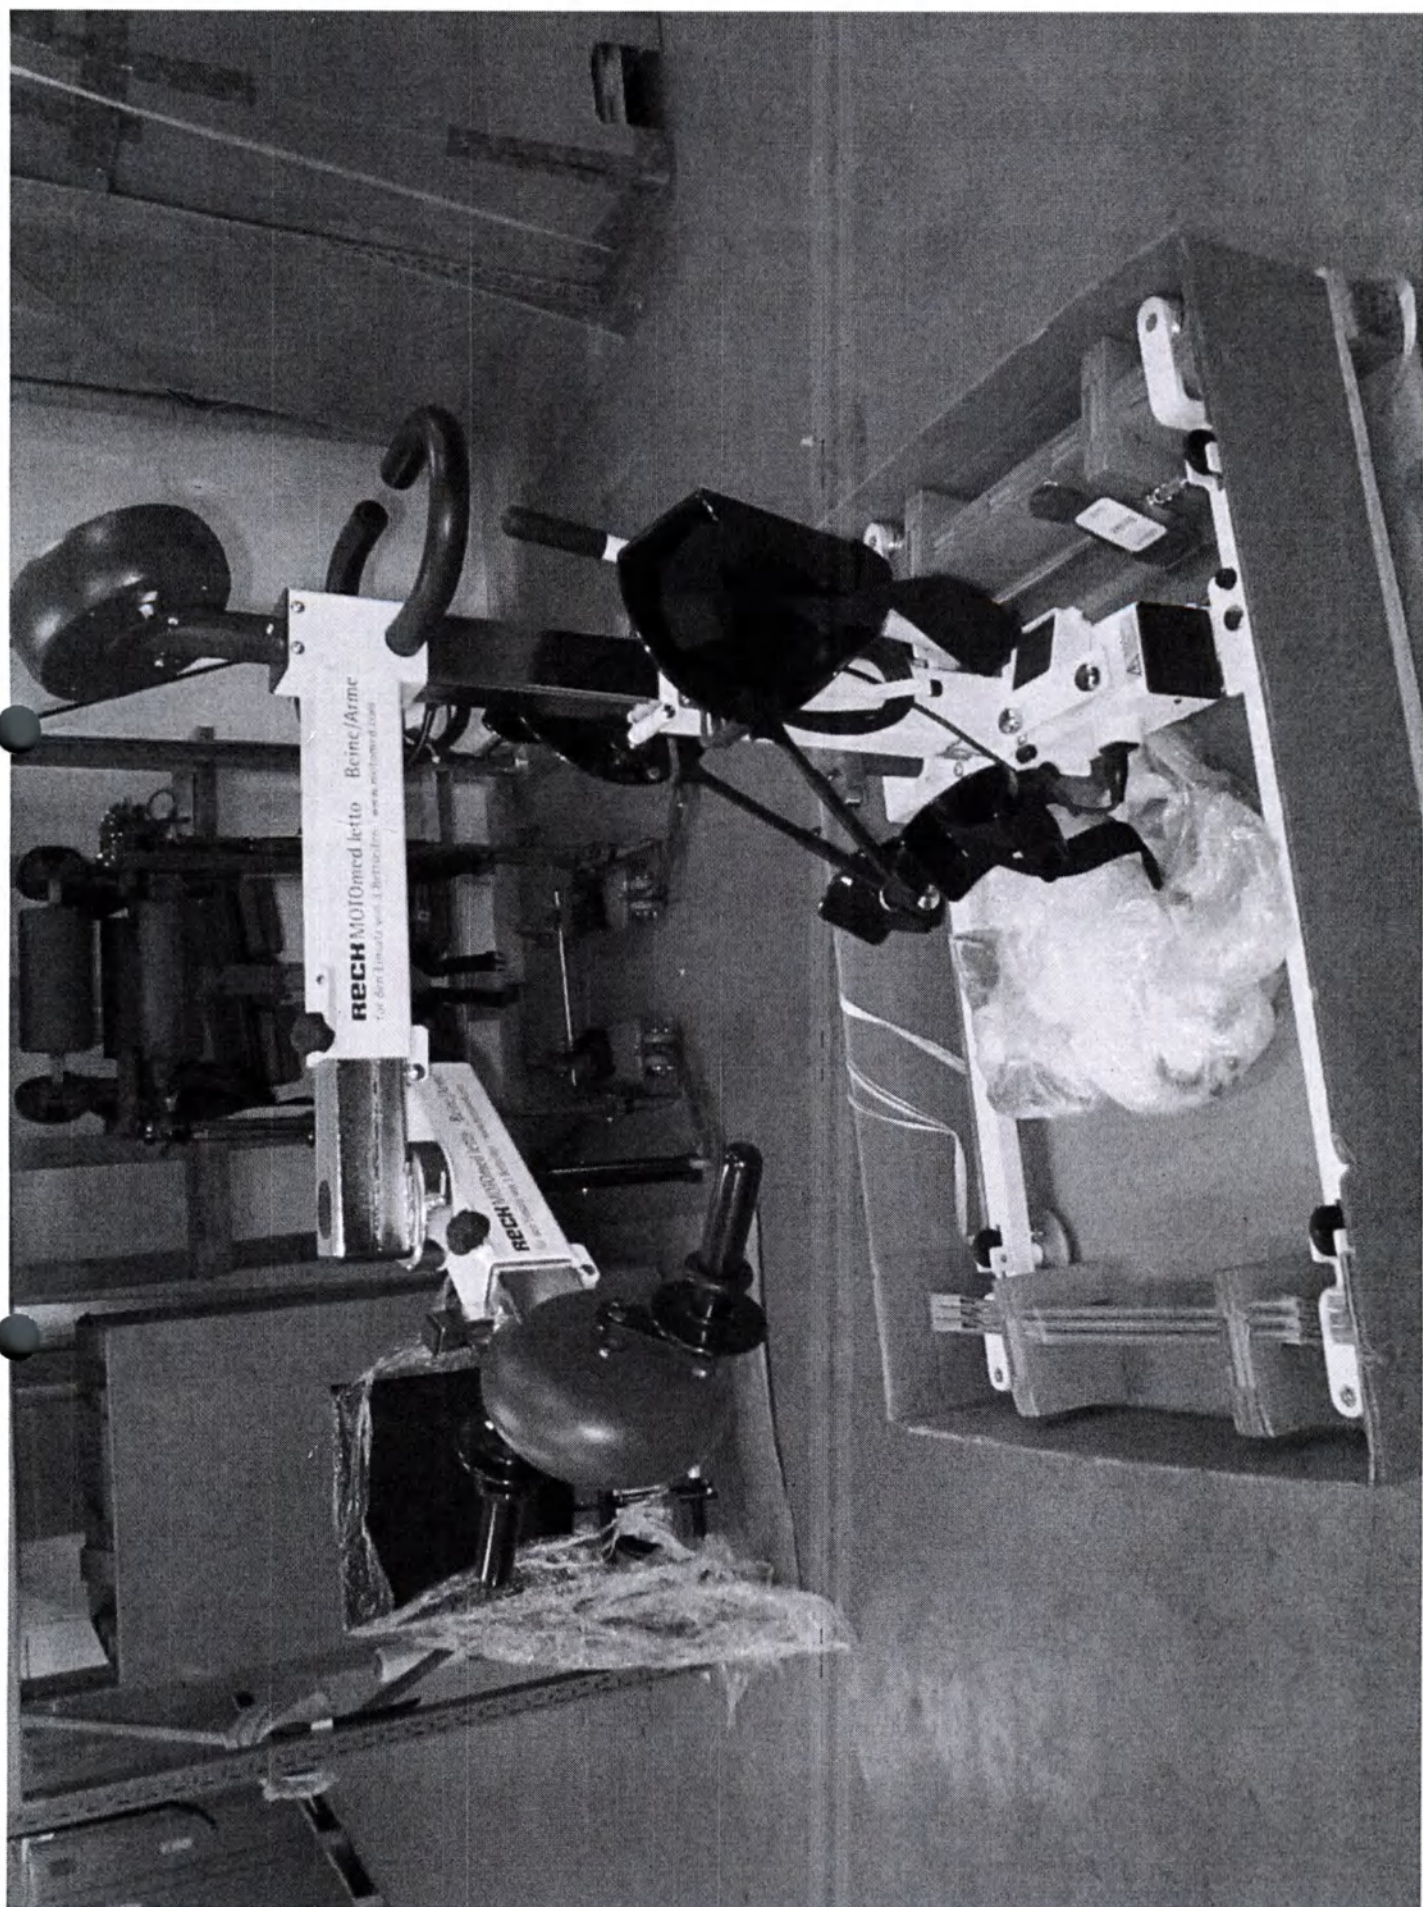


МОТОмед letto2




1. Педали безопасные (взрослые, педиатрические, дезинфицируемые)

16/06/2014

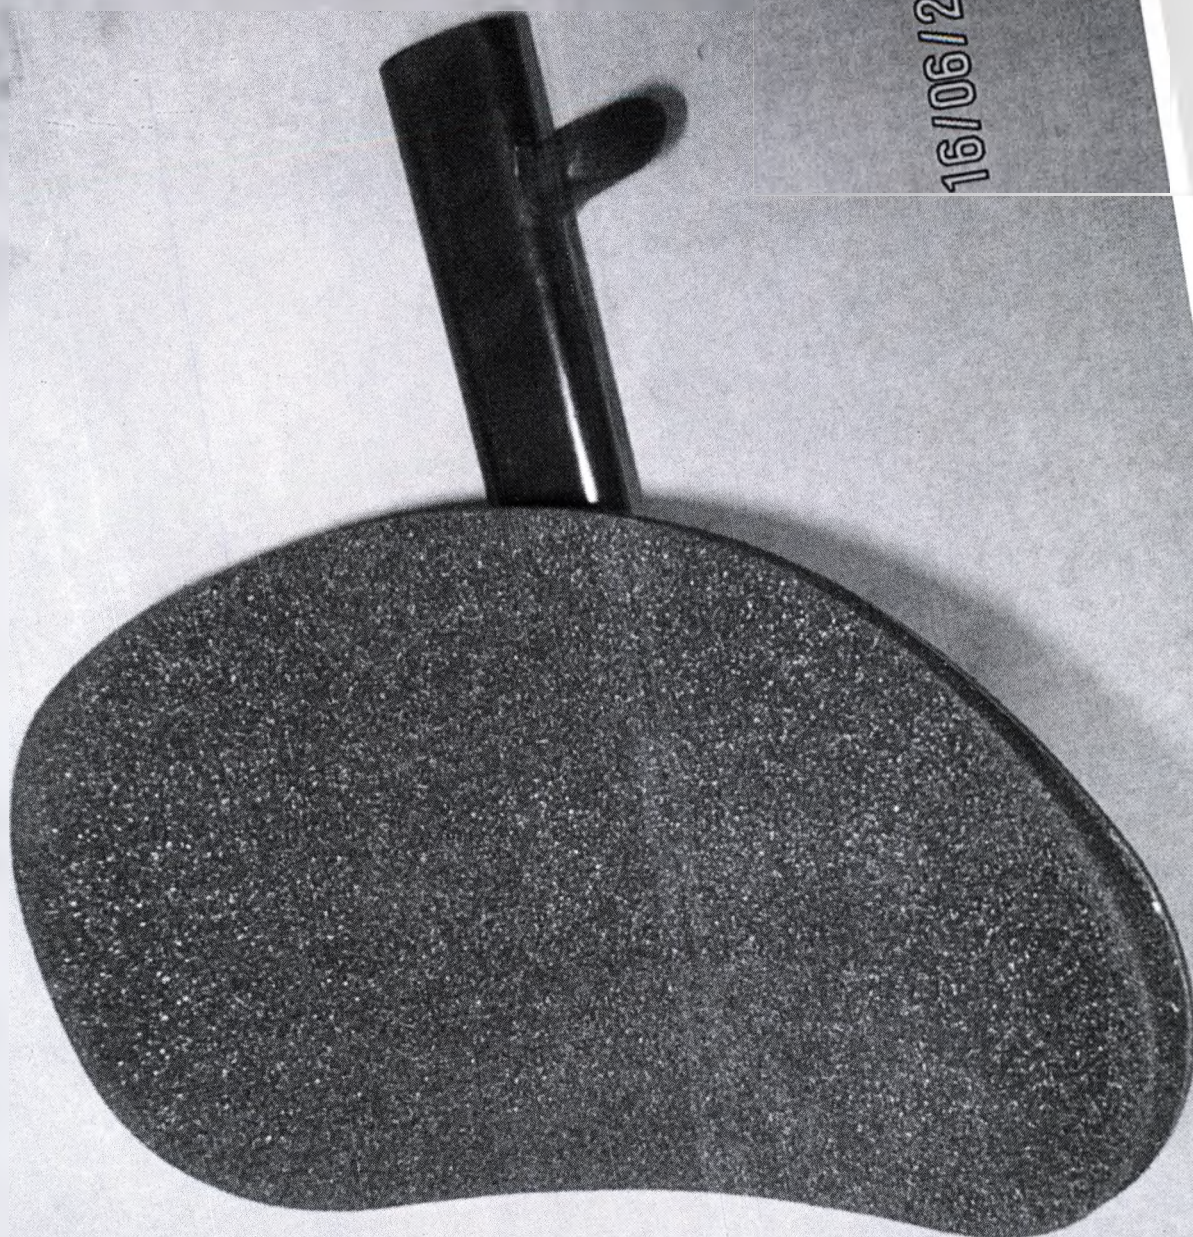

2. Фиксаторы для голени (взрослые, педиатрические, letto)

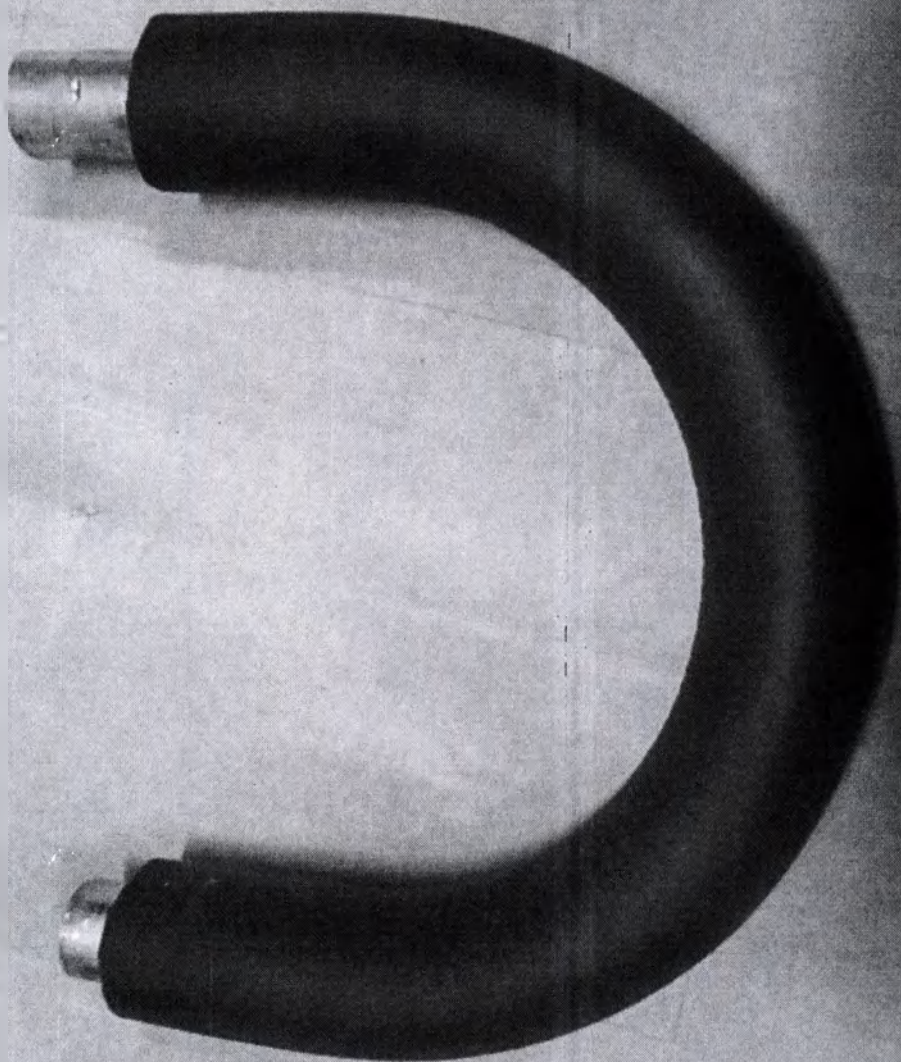


3. Опоры для рук различной формы



4. Приспособление для фиксации пульта ДУ



5. Самообслуживаемые держатели ног (взрослые, педиатрические, letto)

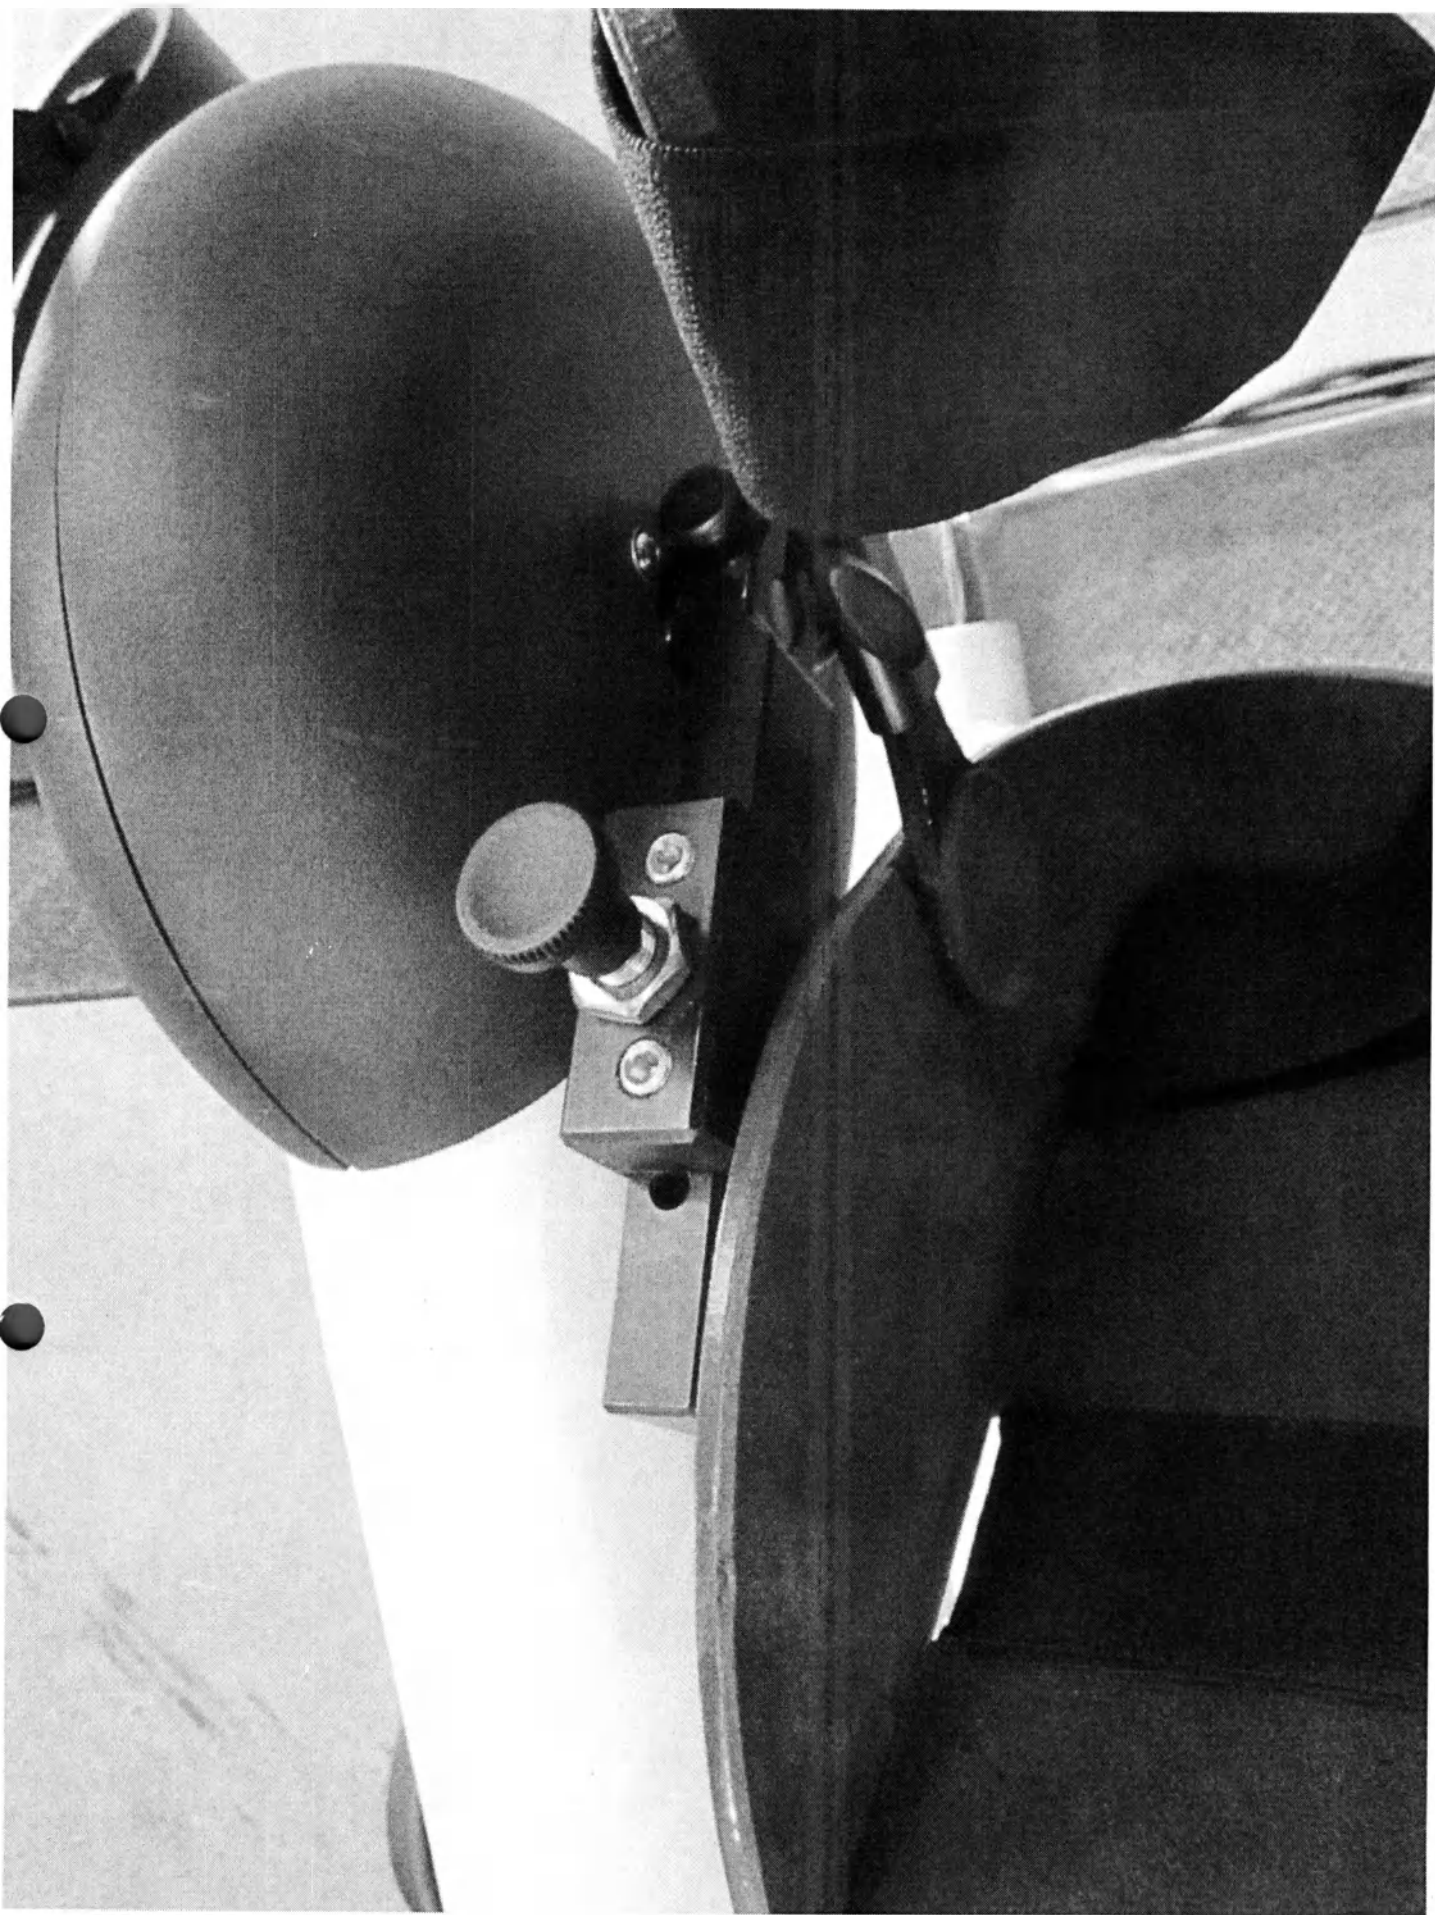


6. Устройство для быстрого изменения радиуса педалей для ног/рук



7. Тренажер для рук/верхней части туловища (viva1, viva2, Gracile, letto)



8. Программно-аппаратный комплект "Велогонка"

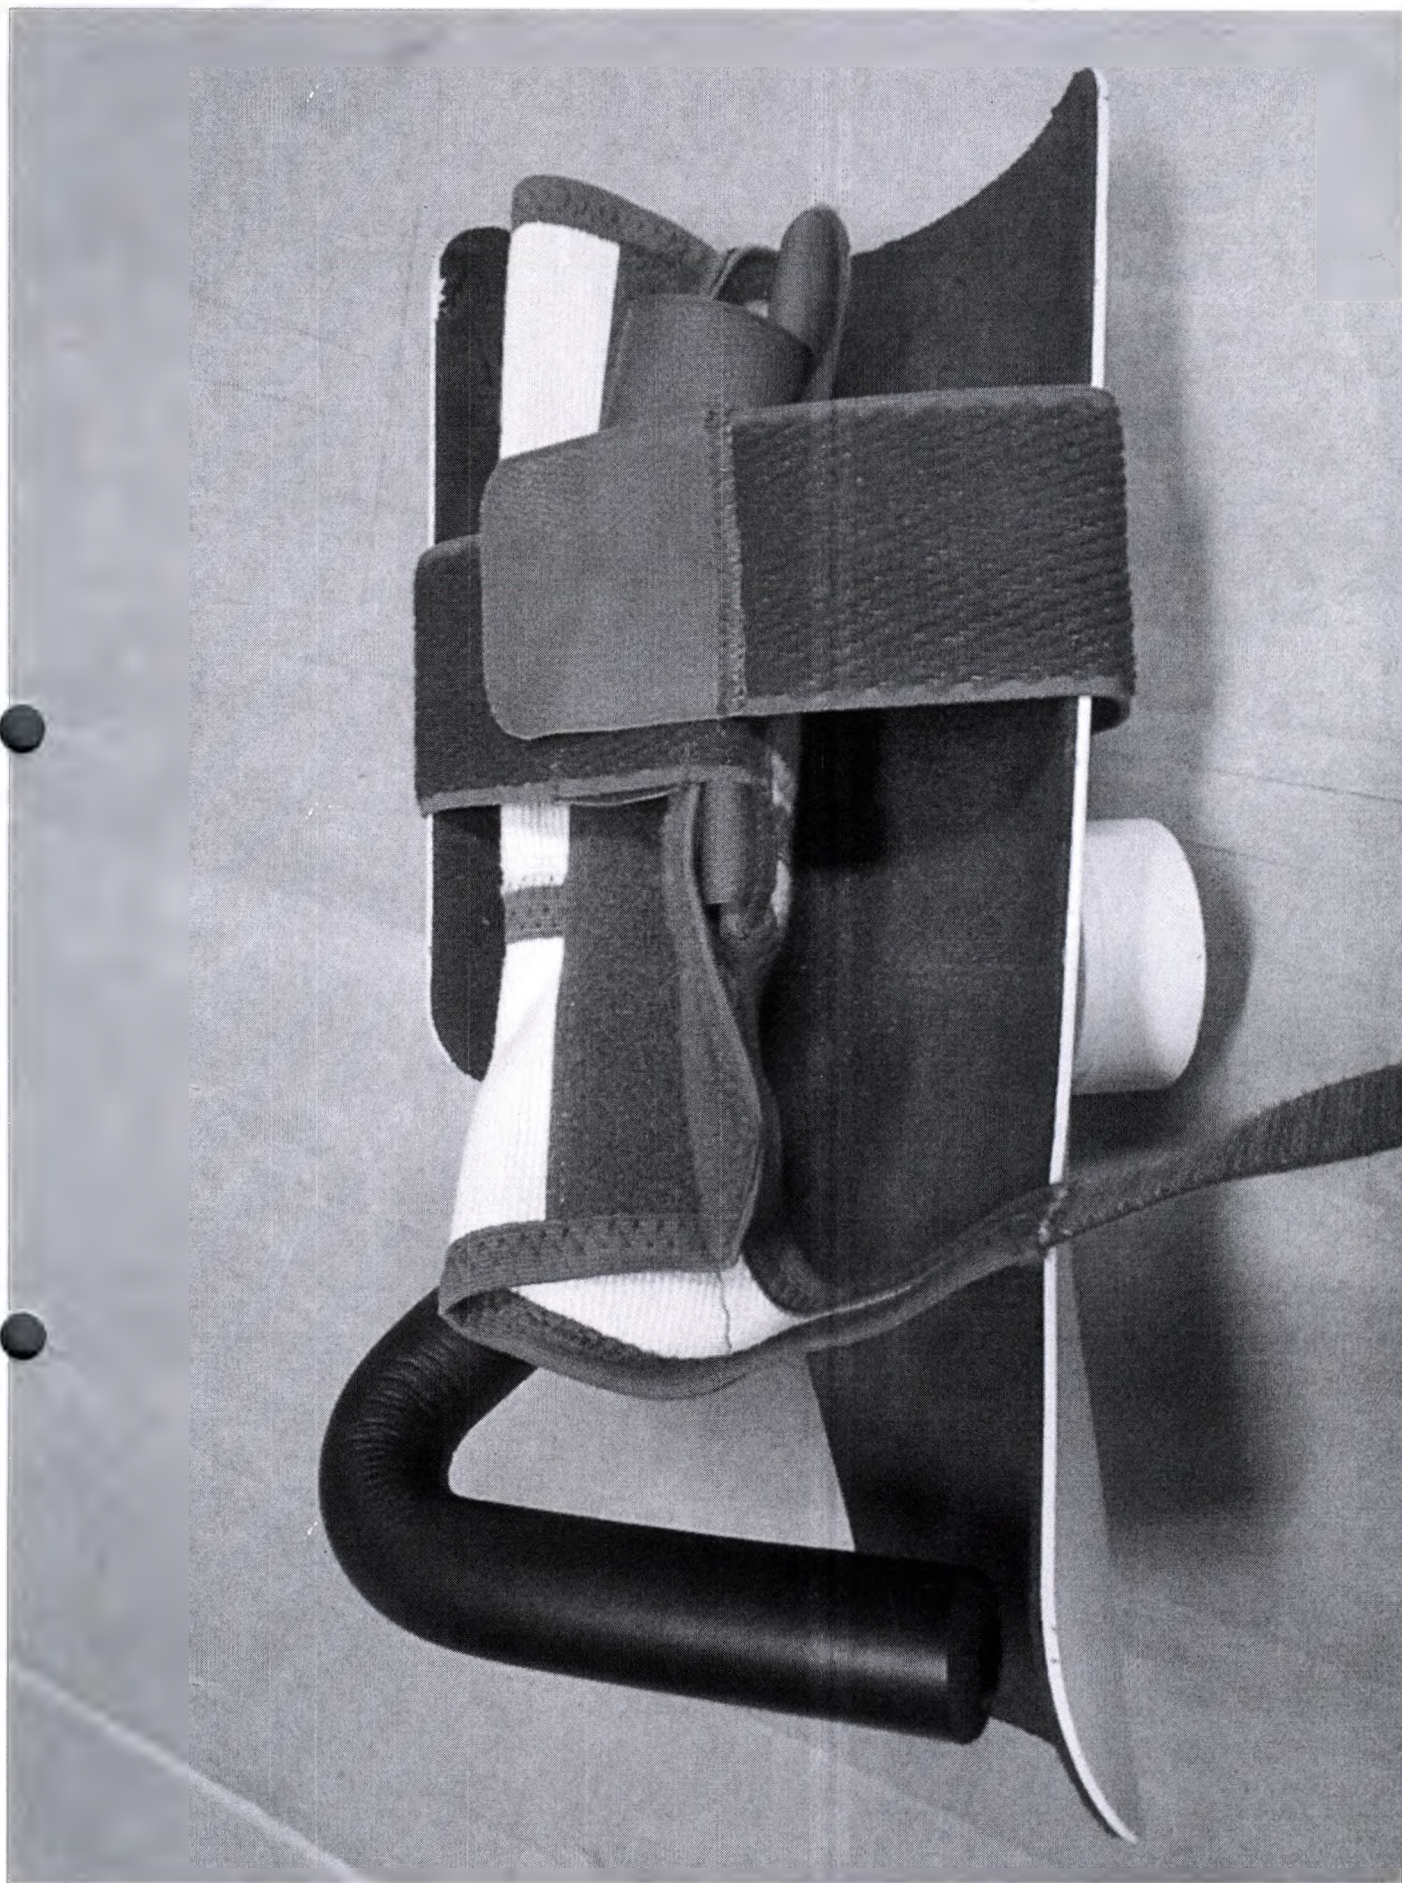

9. Ложа для рук с манжетами (взрослые, педиатрические)




10. Программно-аппаратный комплект для регистрации параметров SAM1




11. Стабилизатор положения инвалидной коляски, стула




12. Плоская регулируемая опора для стула

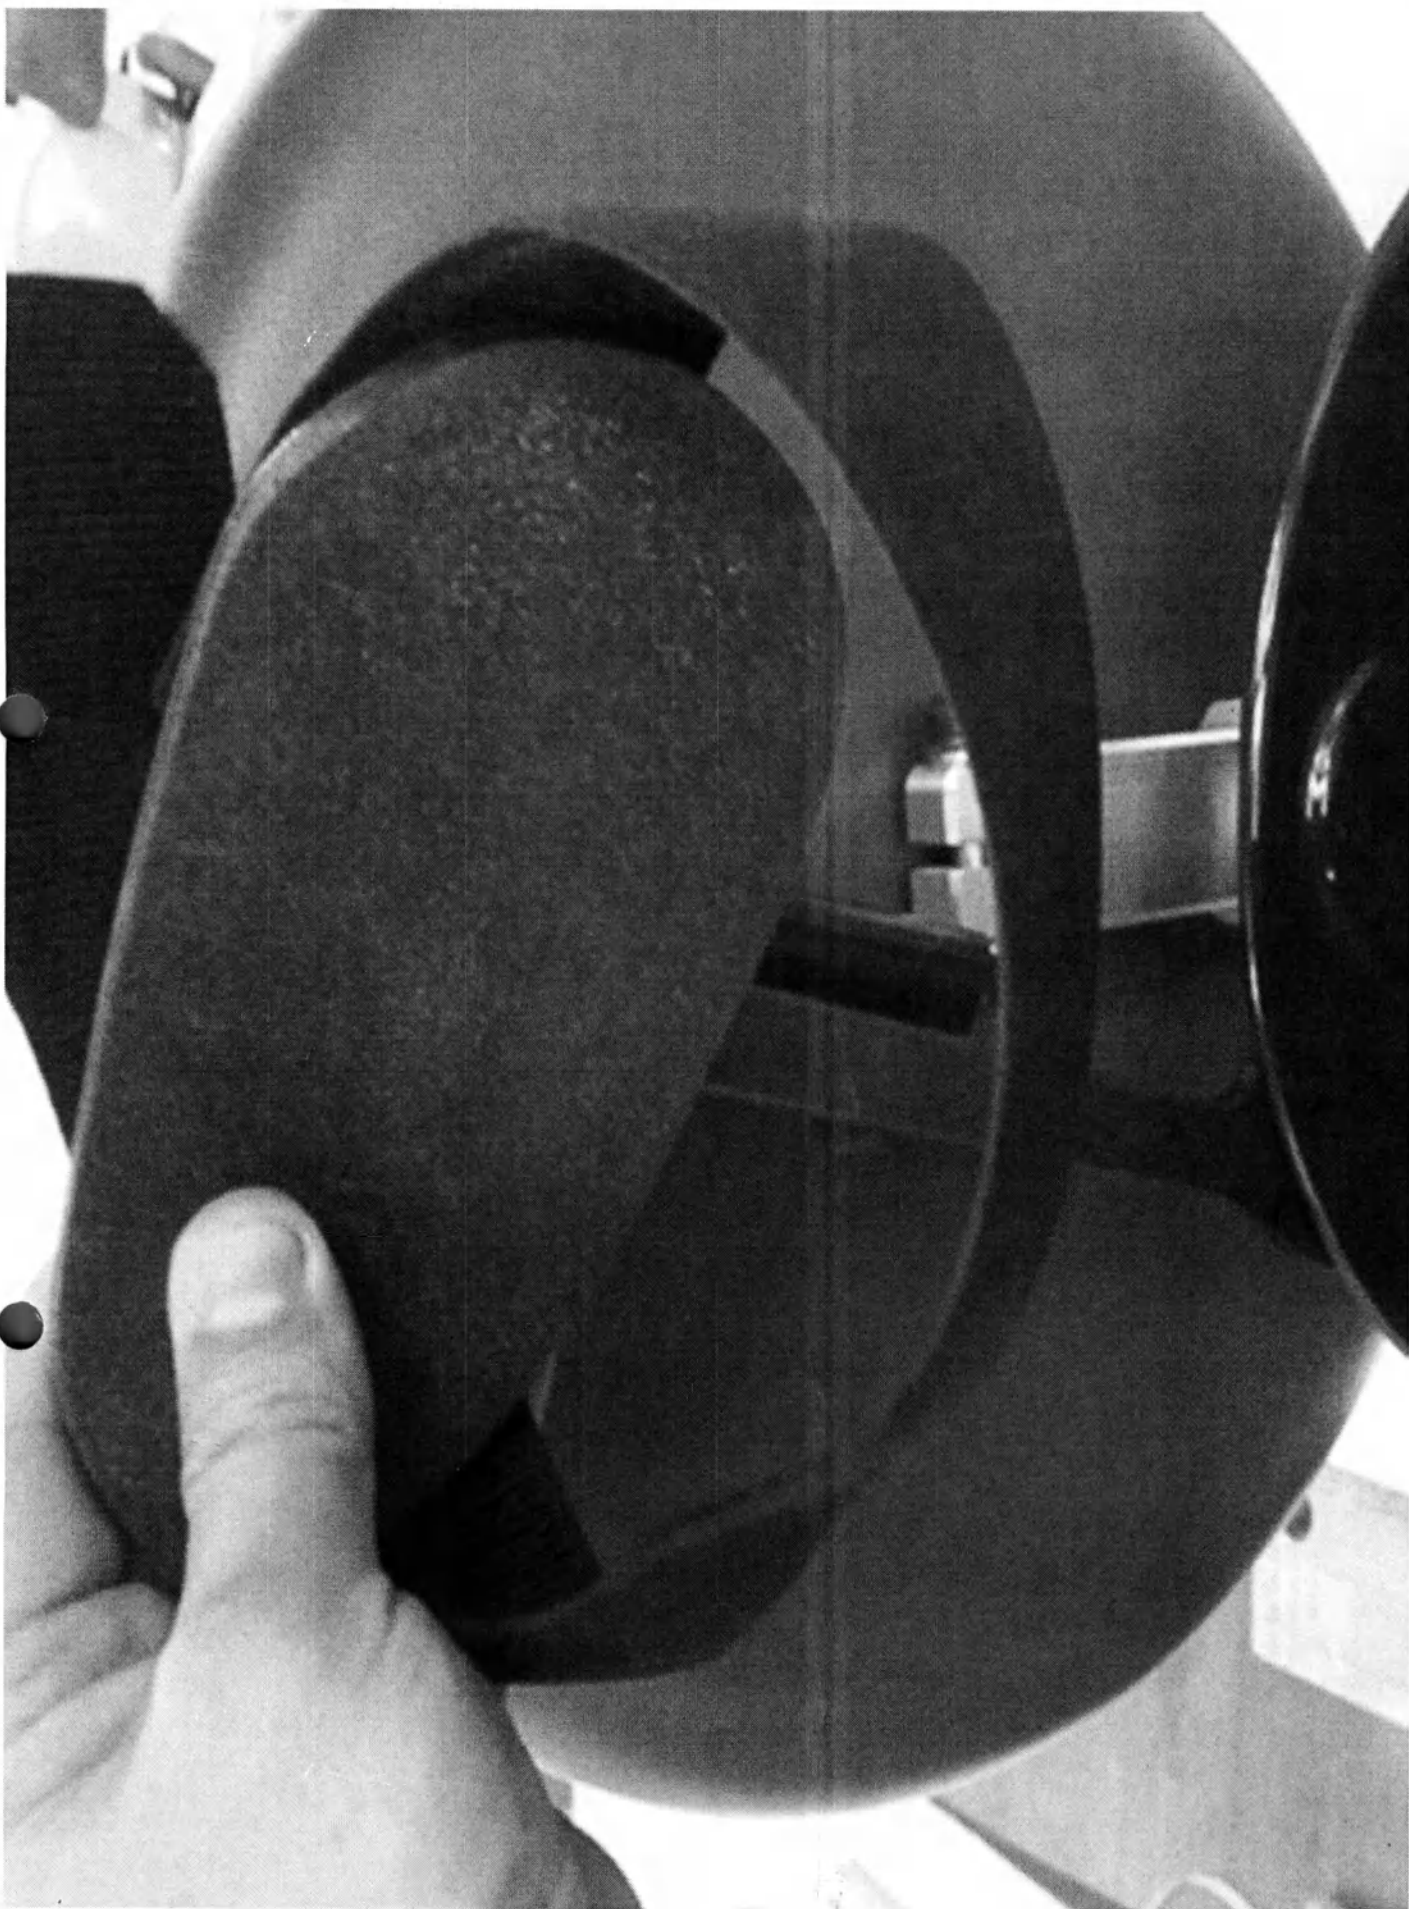


13. Регулируемый модуль поддержки голени

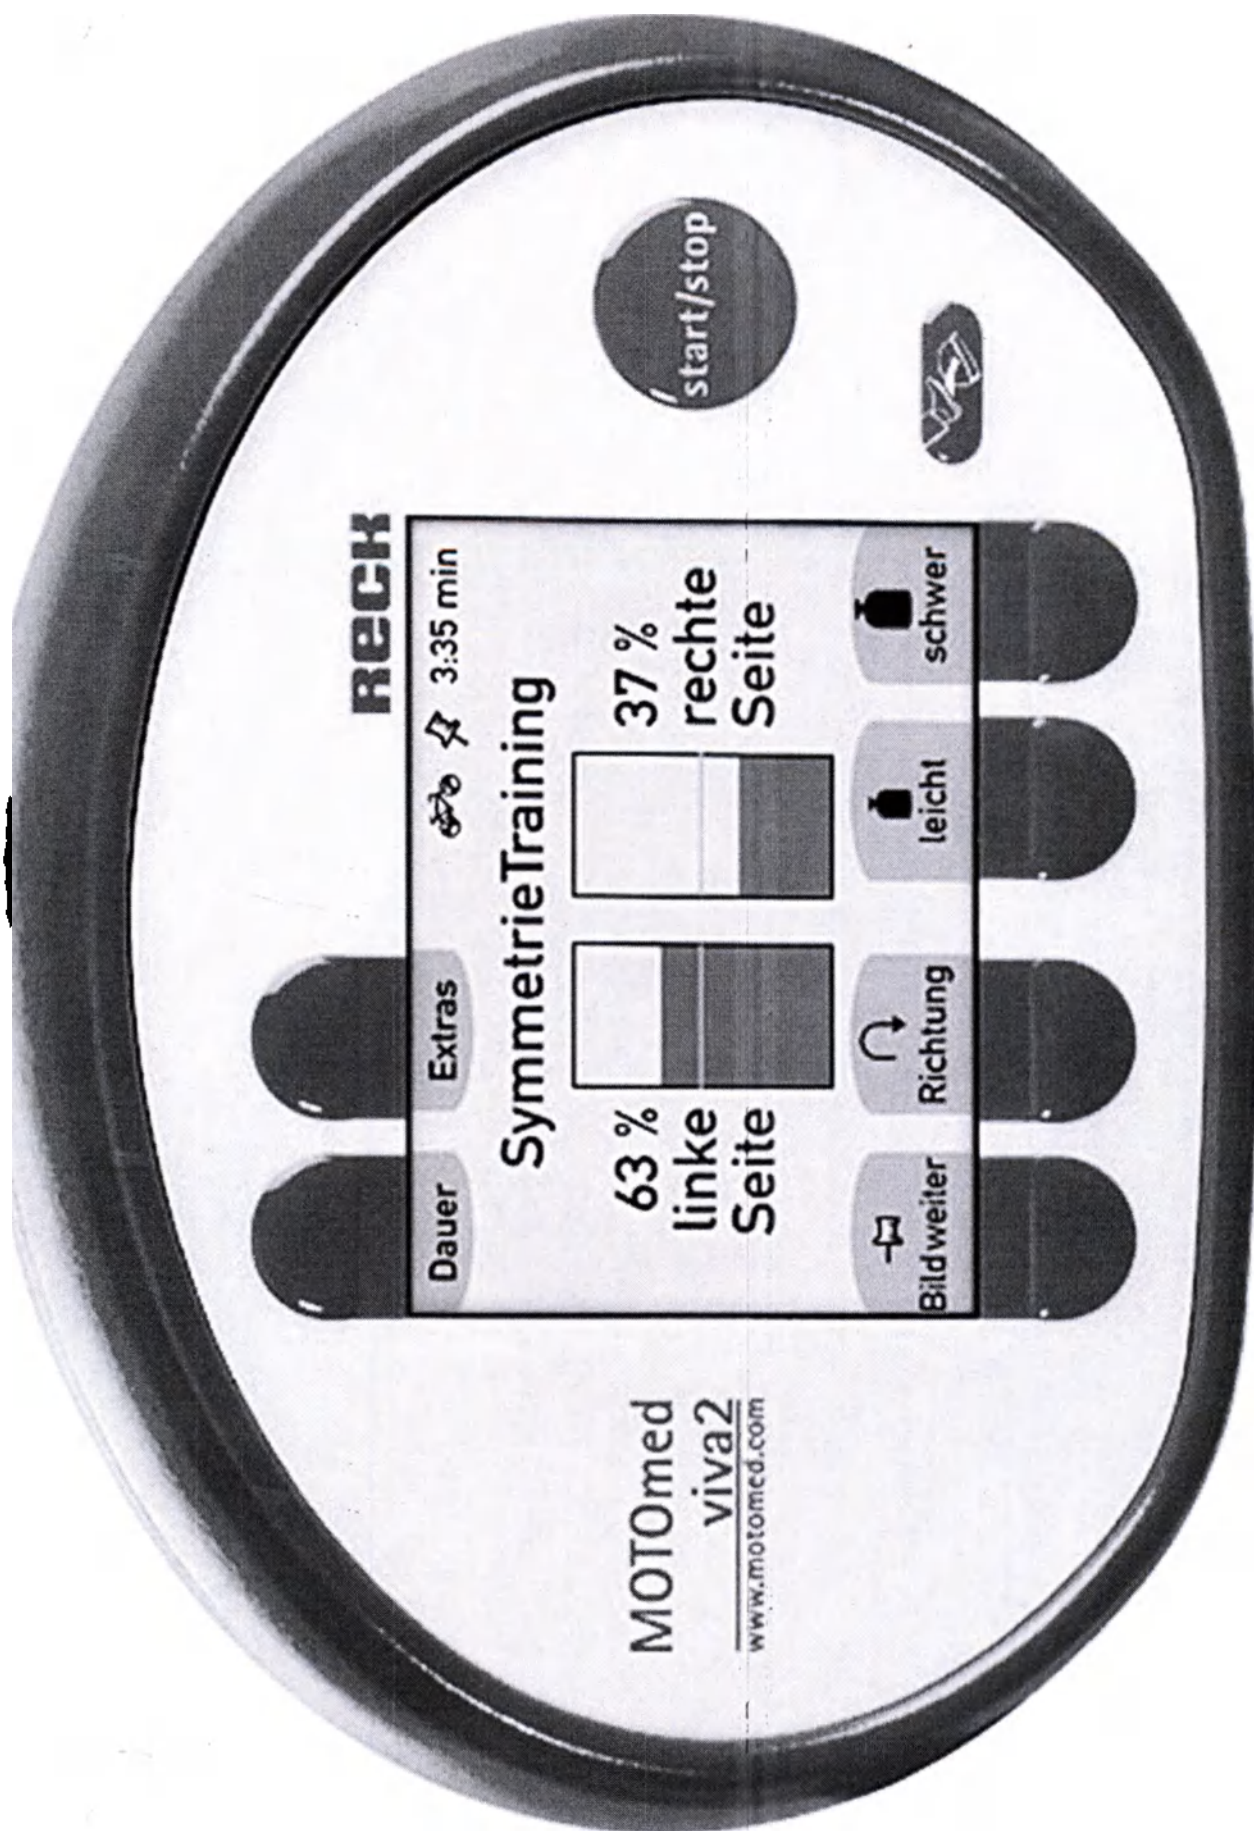


14. Программный комплект "Симметричная тренировка для рук/ног"

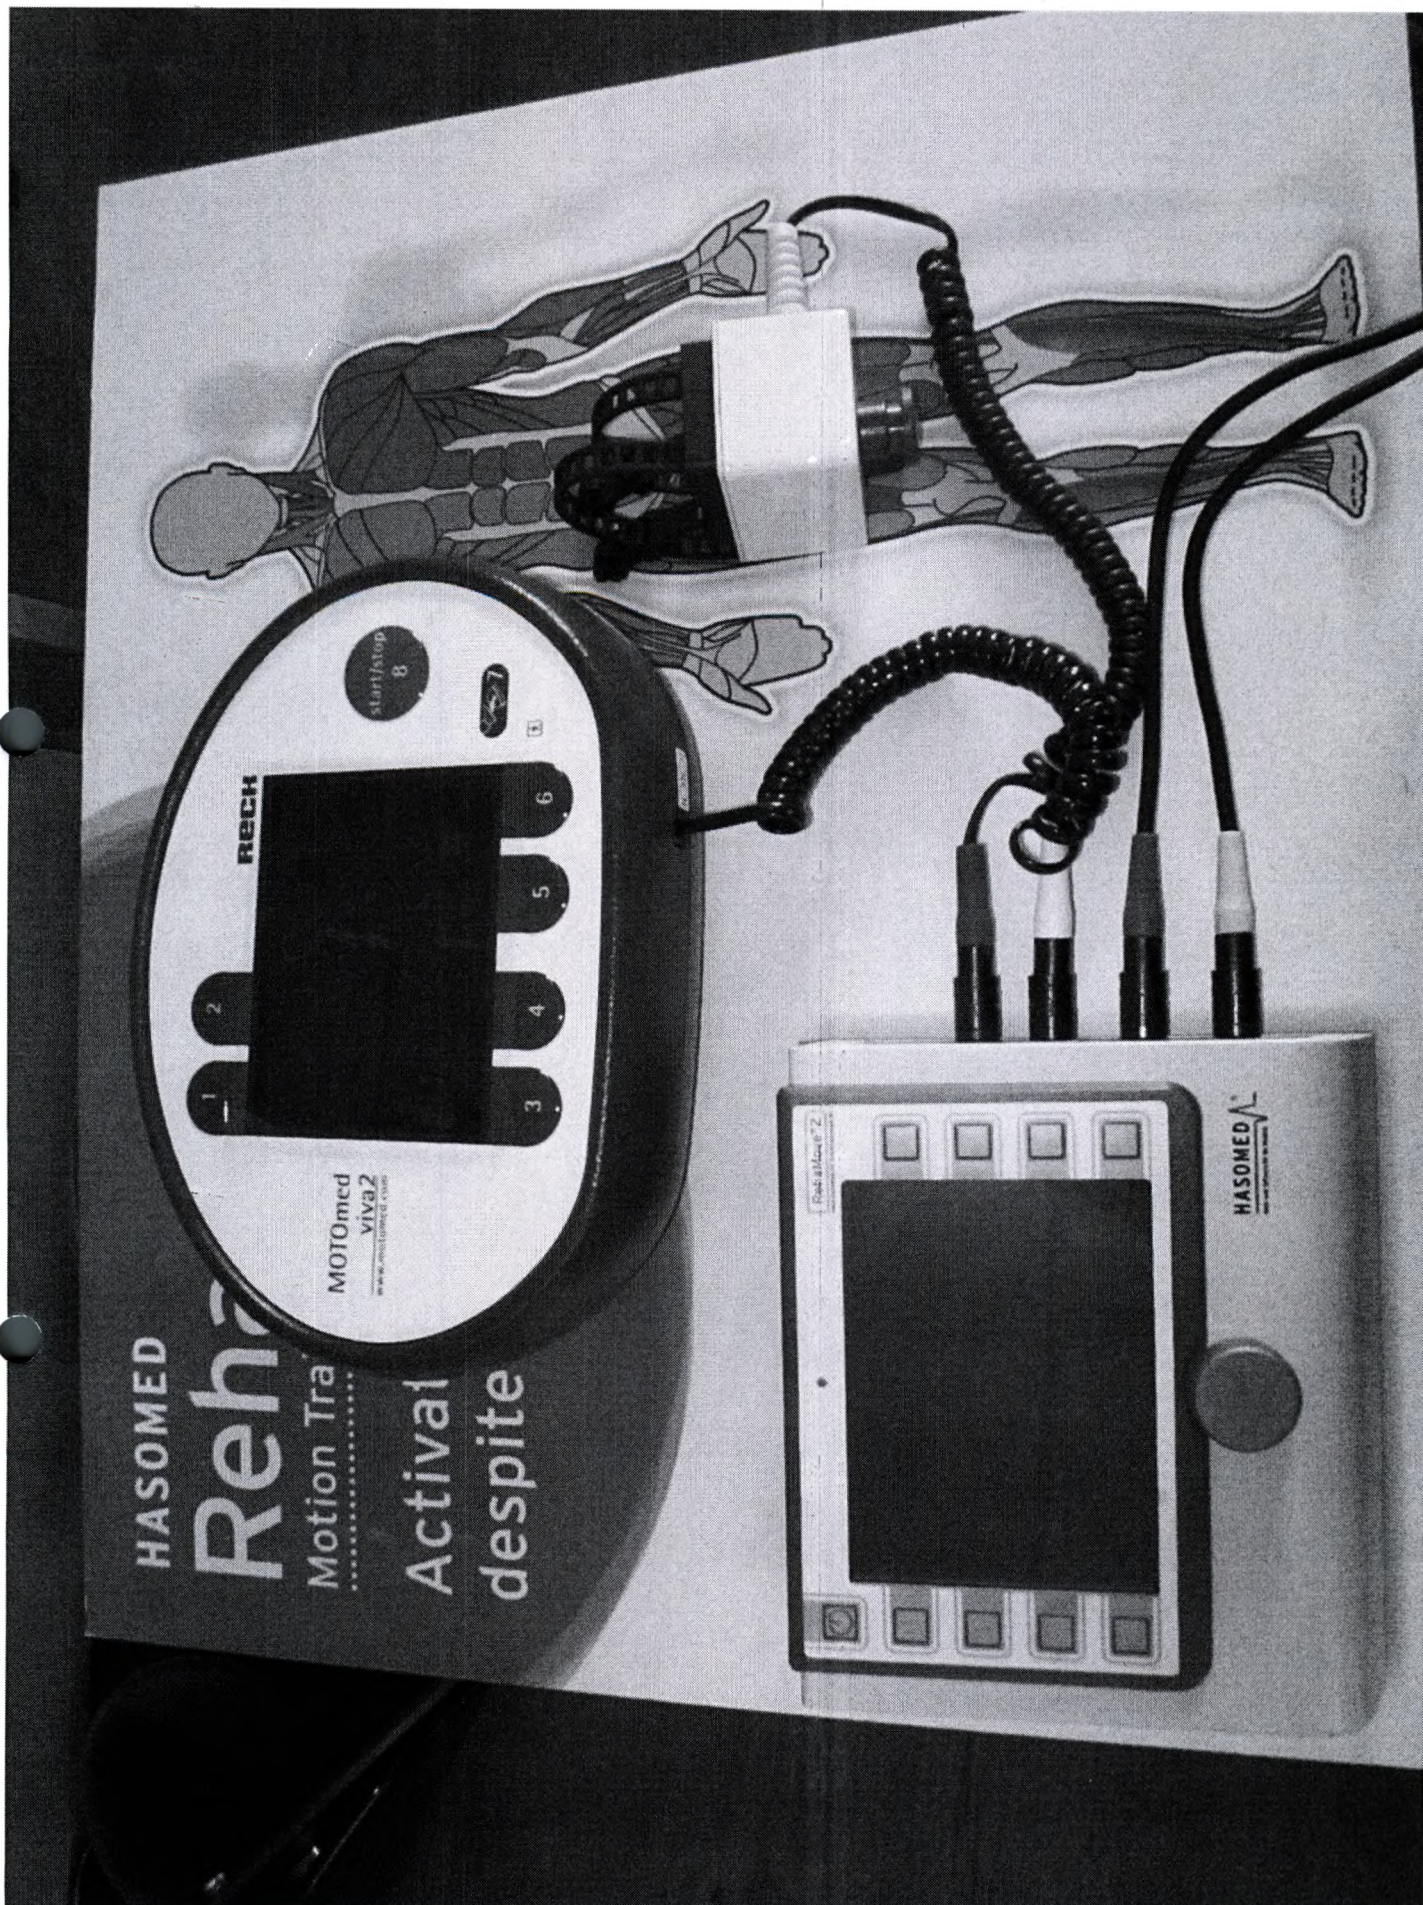

15. Программно-аппаратный комплект фэс "Hazomed"

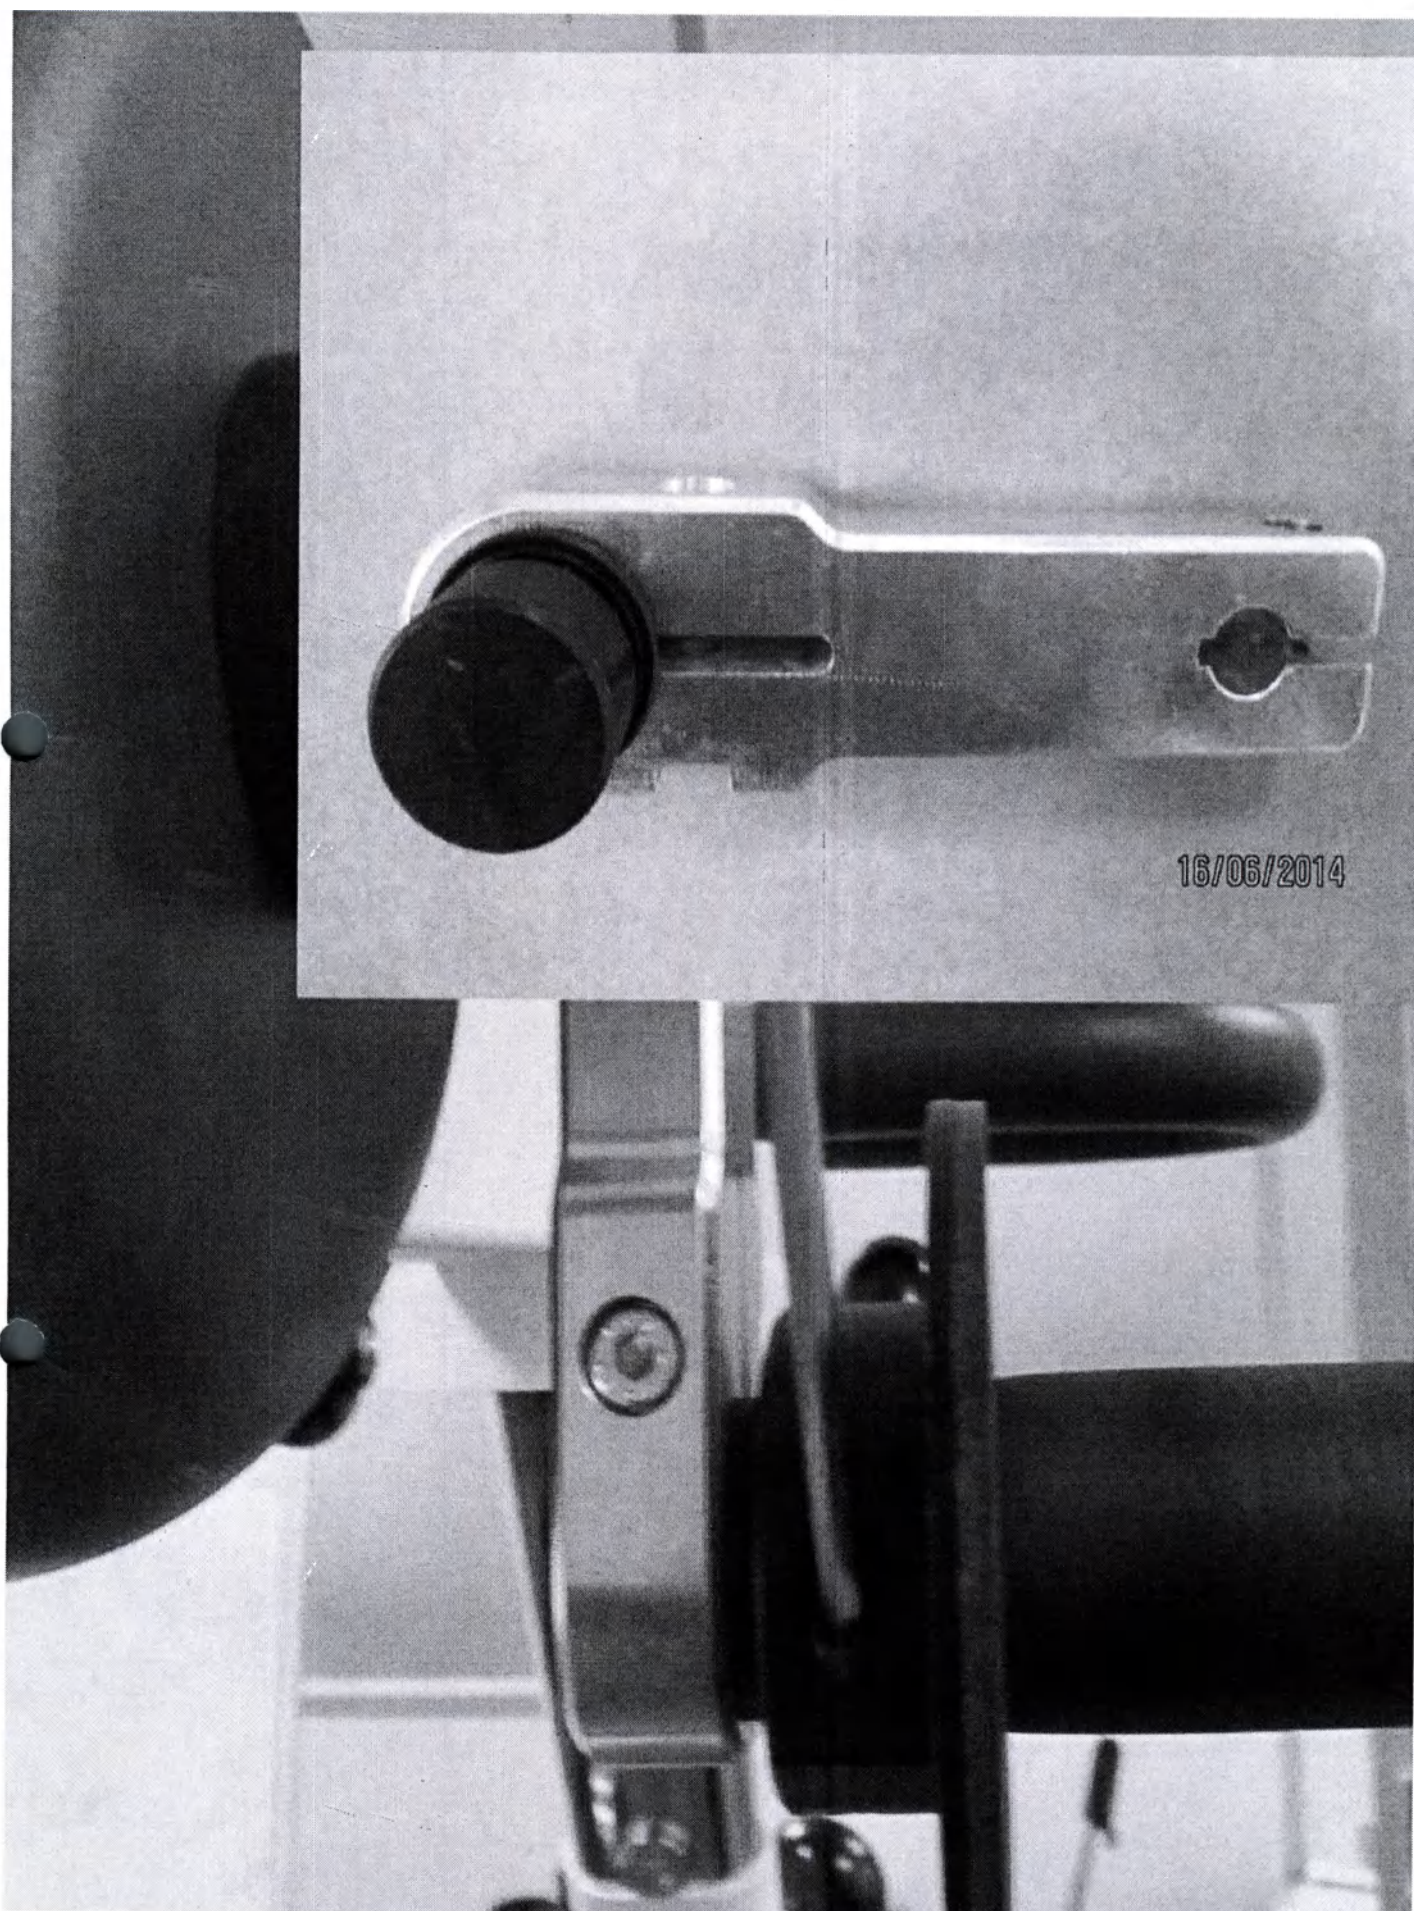

16. Устройство для симметричного вращения

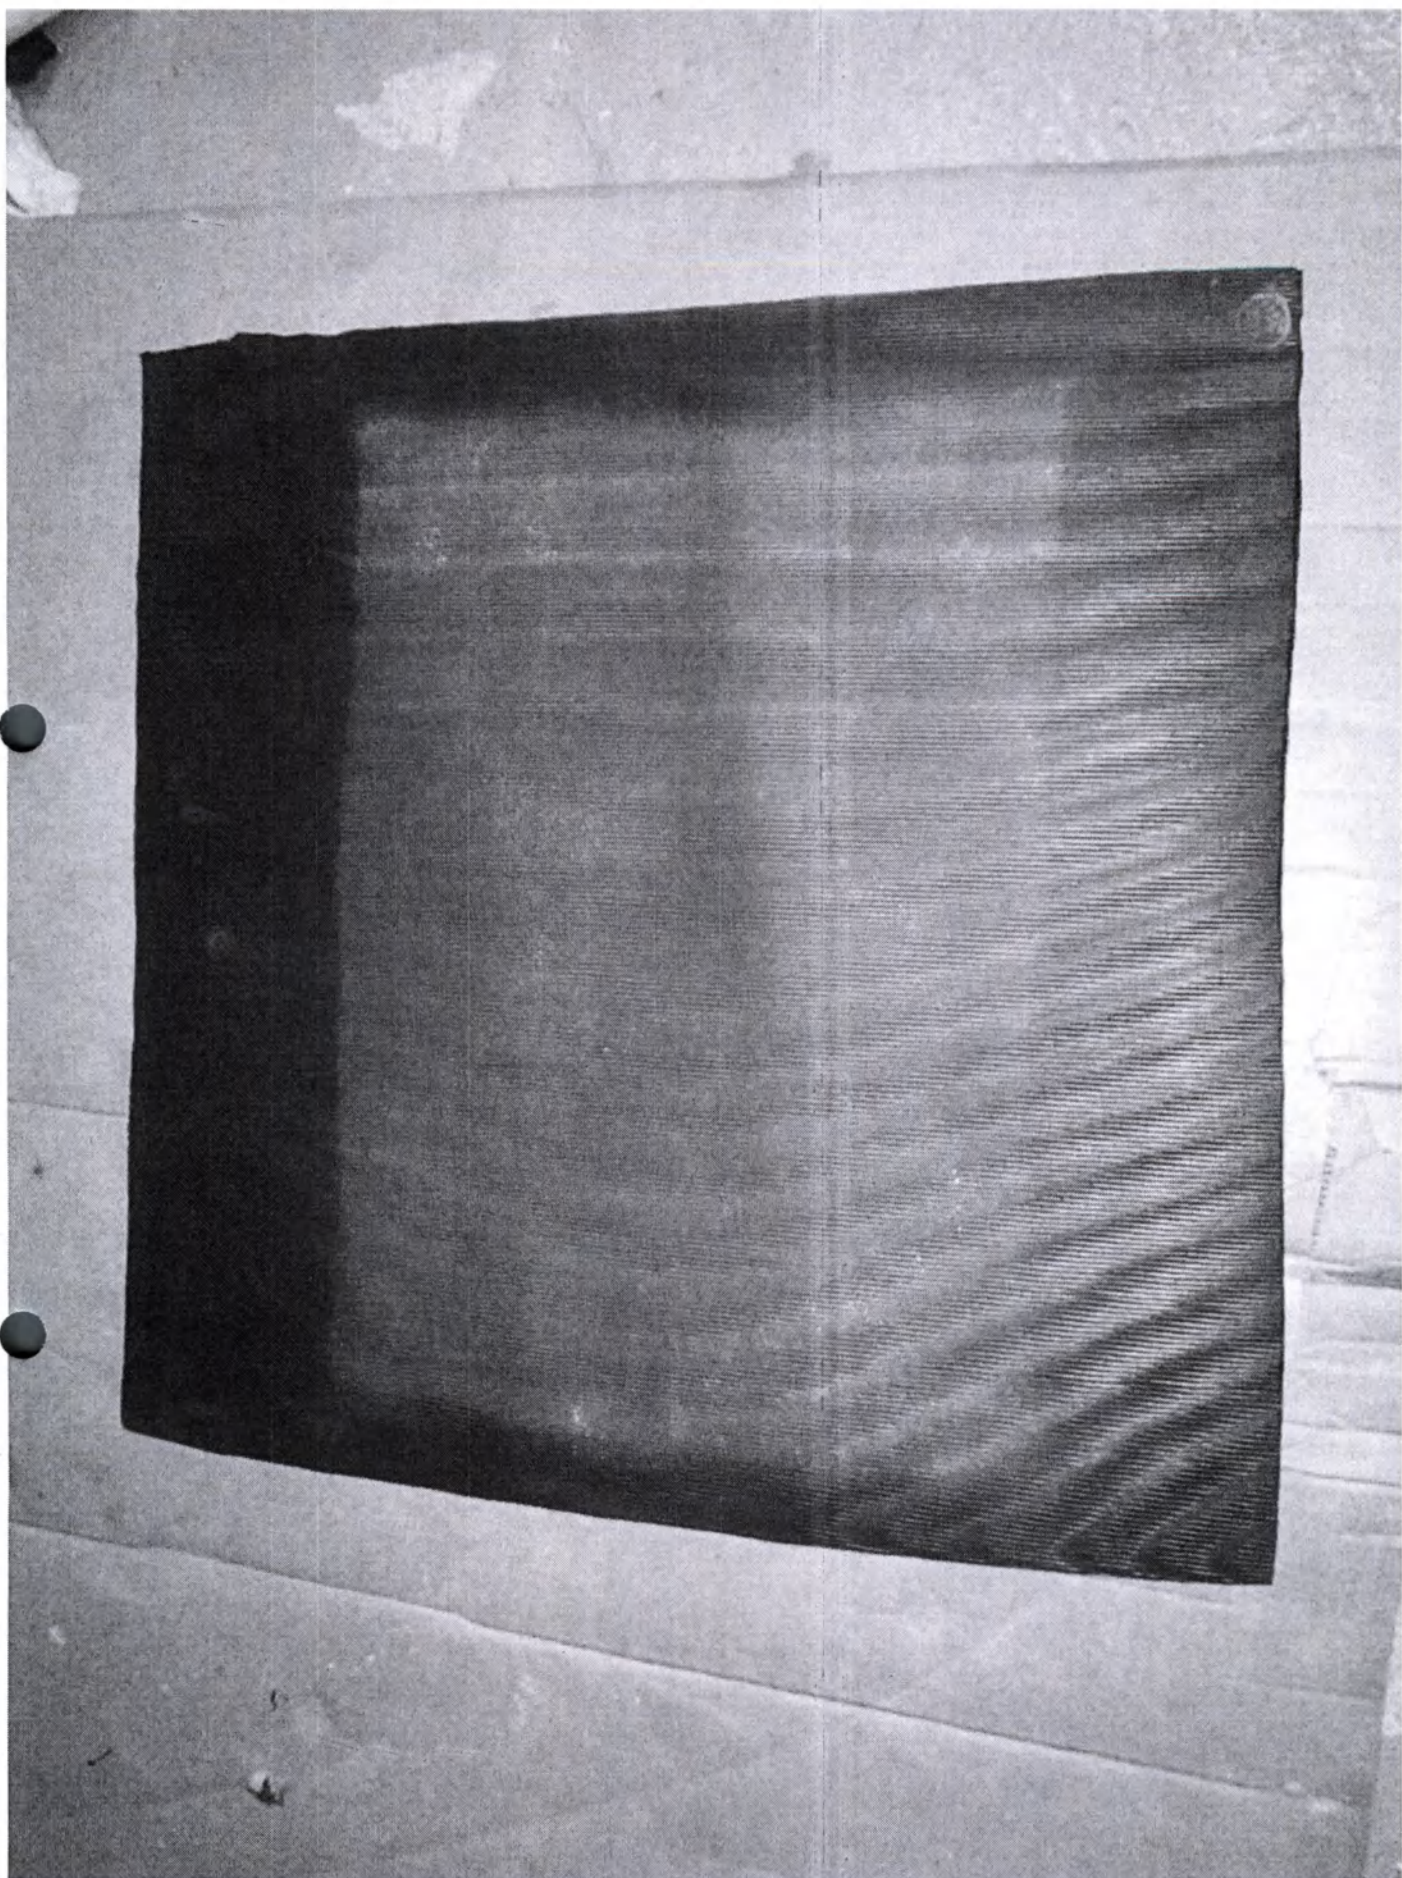

17. Противоскользящий коврик

1

2

Menü

Parkinson

Phase 1 / 12



2:29



2:29

A

0:39

P

1:50

Puls: 90 - 110



Erfolg
86%




1. hin ~22 W

2. ab

~34 W

~20 W

4. auf ~14 W 3. her

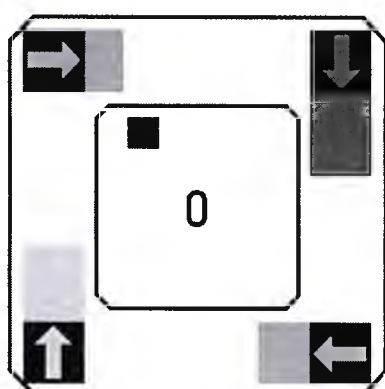

57

[U/min]
Drehzahl



0

10


20

6



—

+



0

30

60

35
10



—

+


3

4


5

6


18. Программный комплект для 4-х сегментной симметричной тренировки

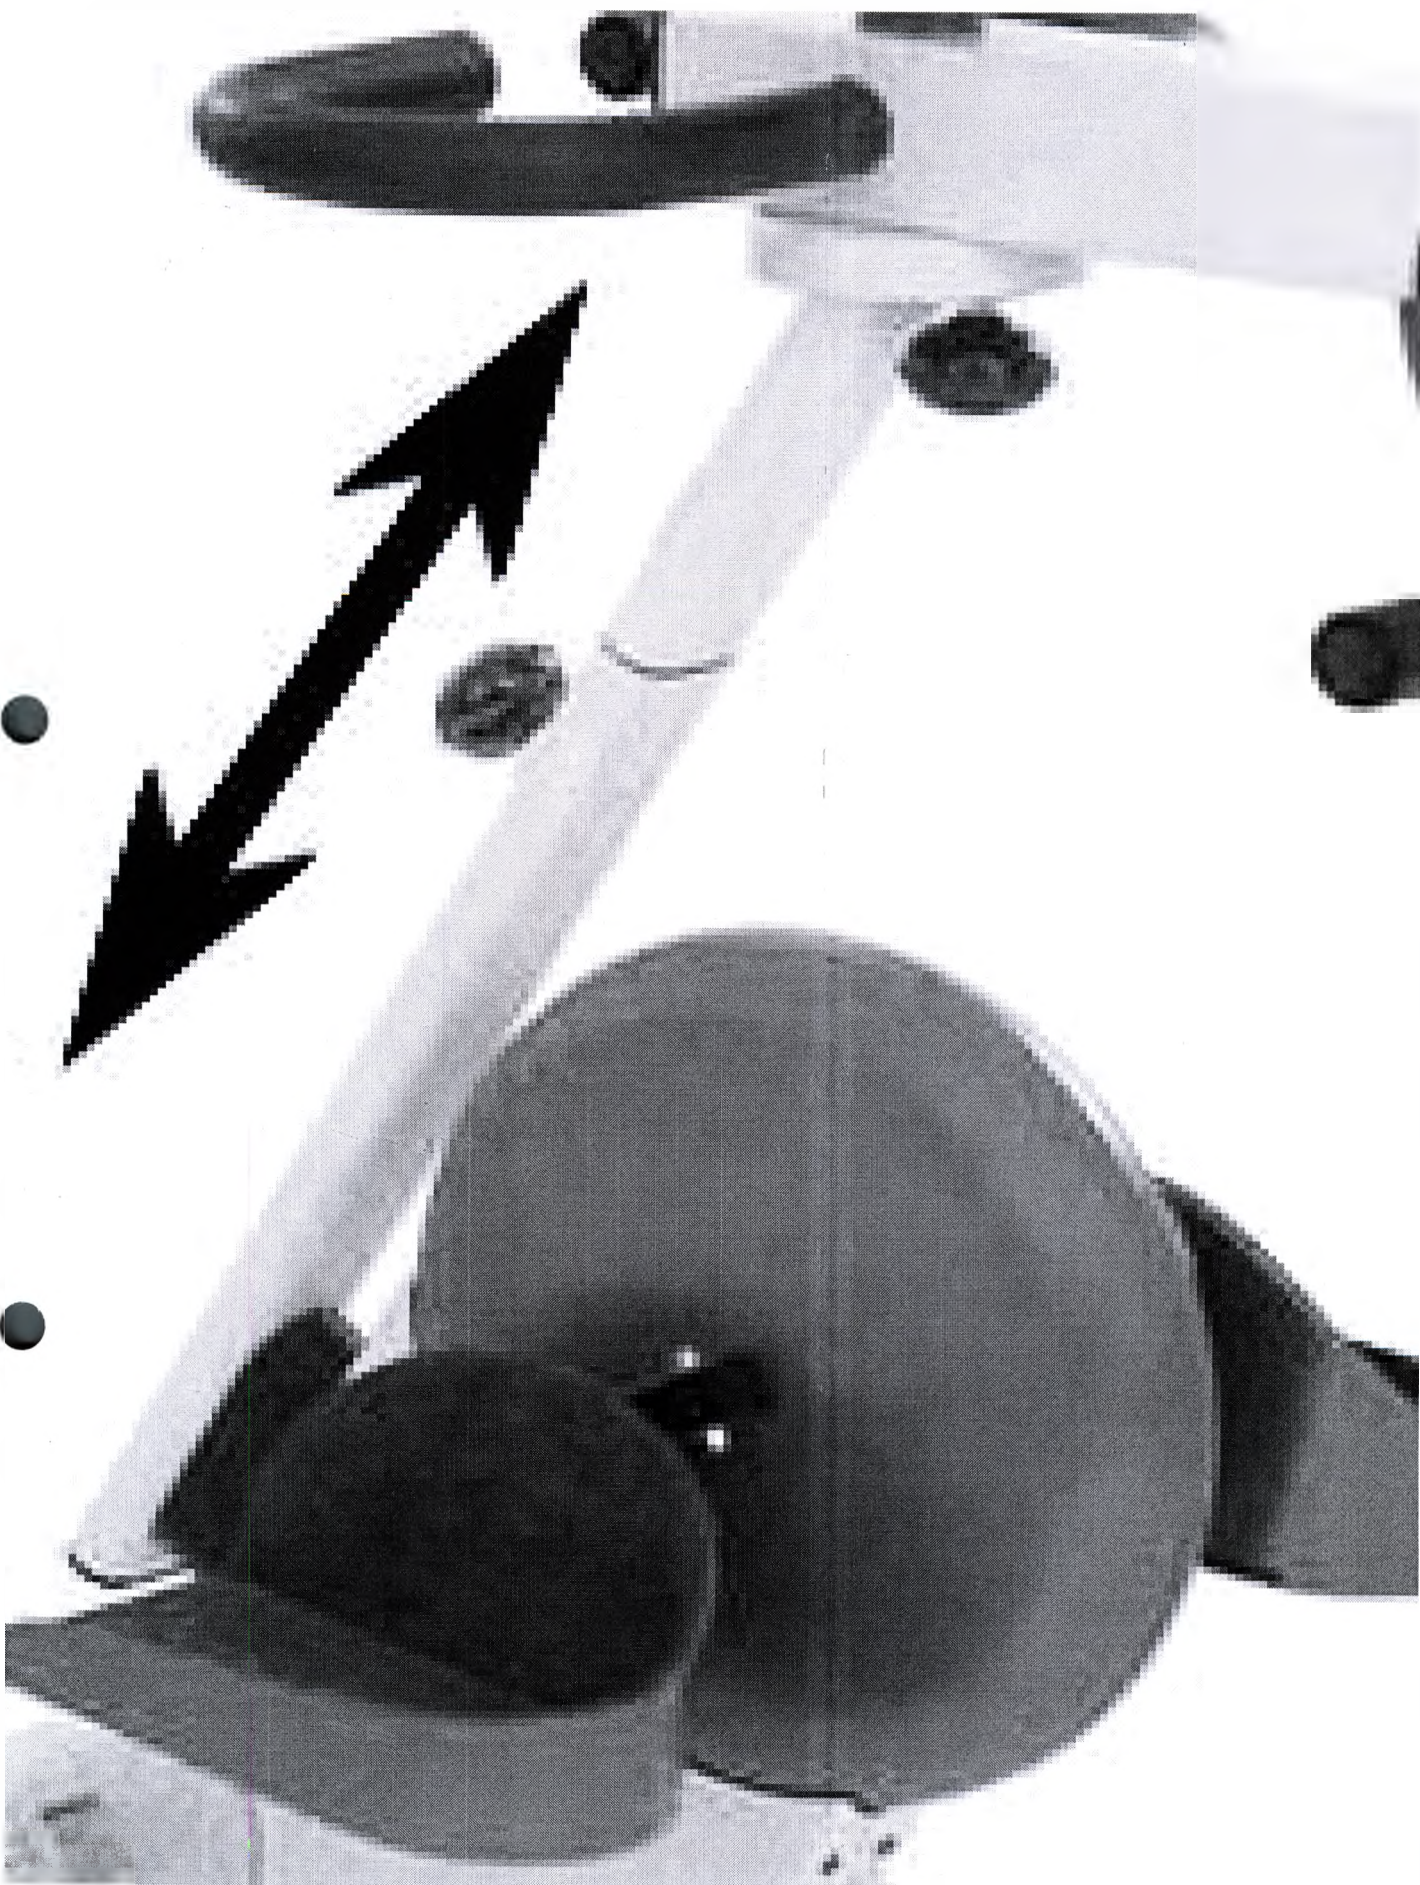


19. Удлинитель штатива тренажера рук

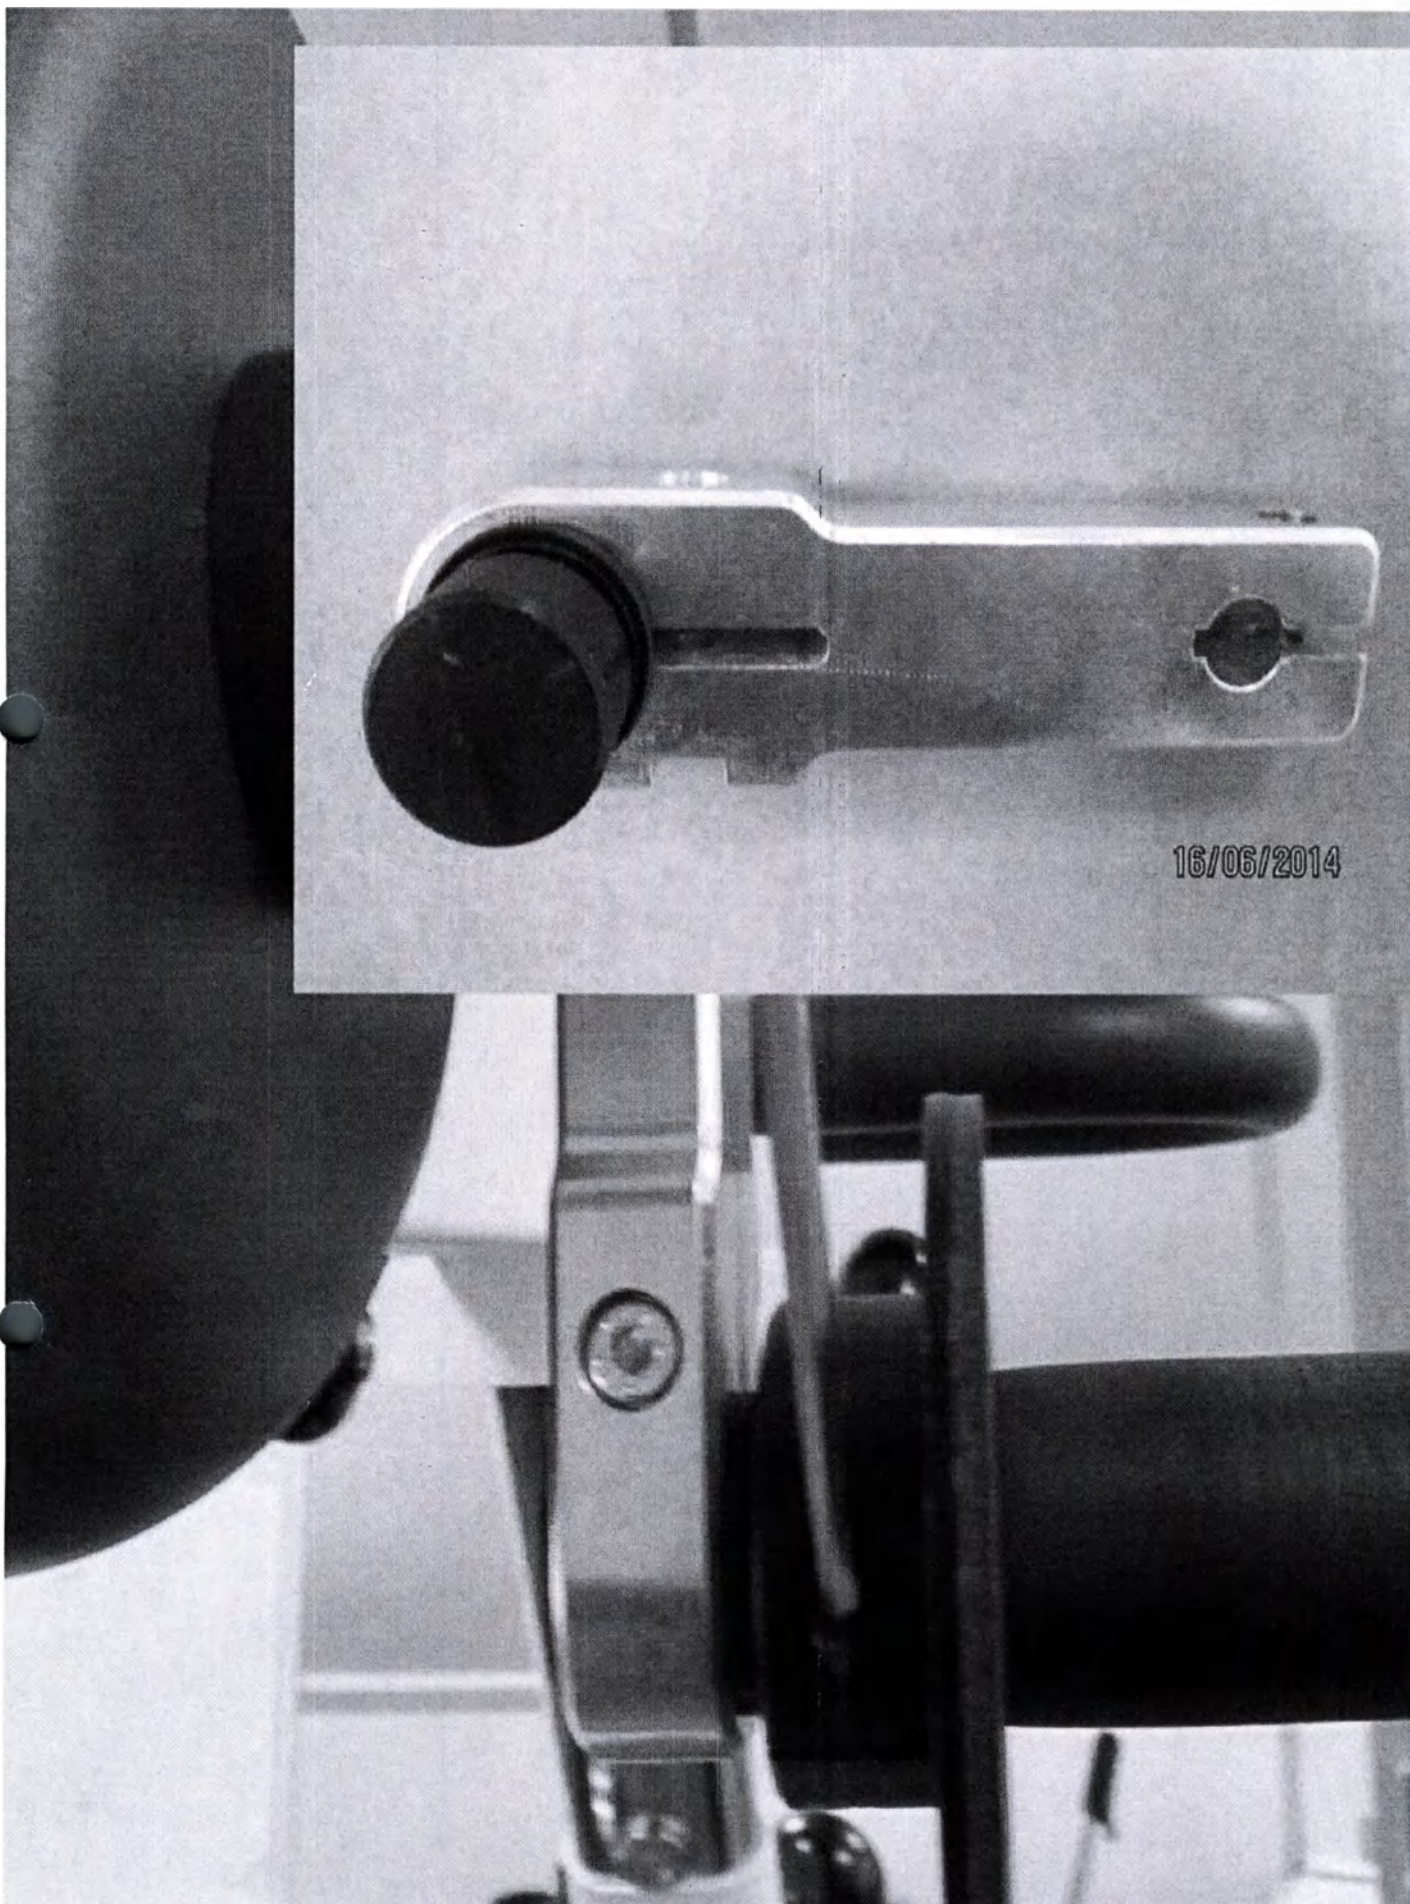


20. Устройство для изменения высоты штатива

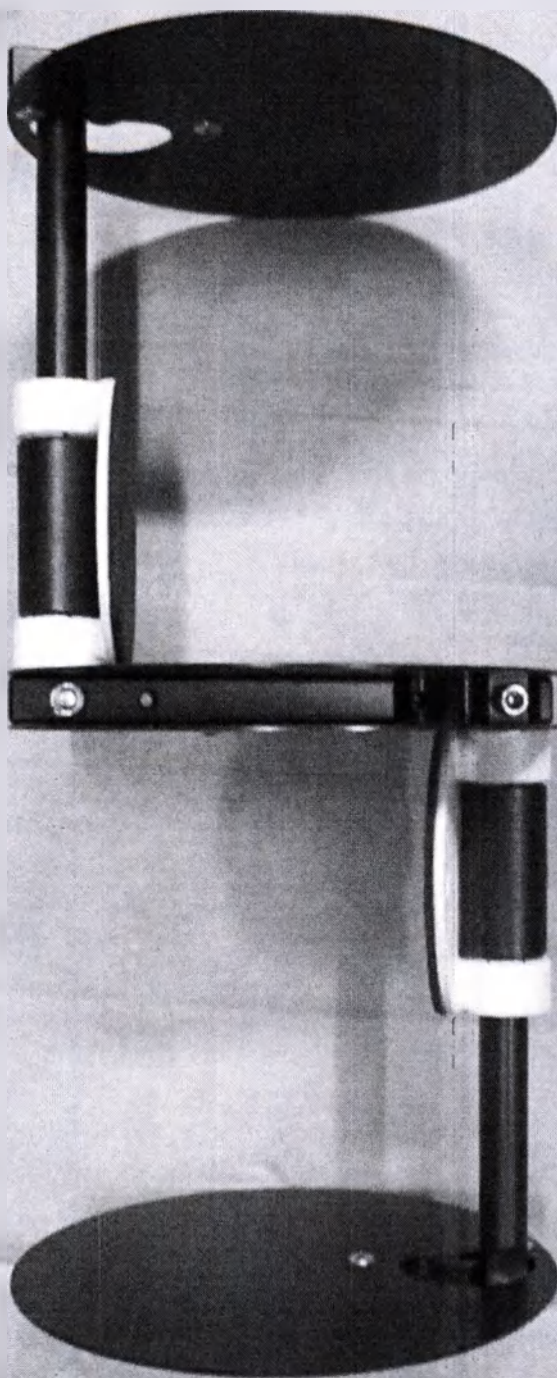

21. Устройство для изменения межпедального расстояния тренажера для ног

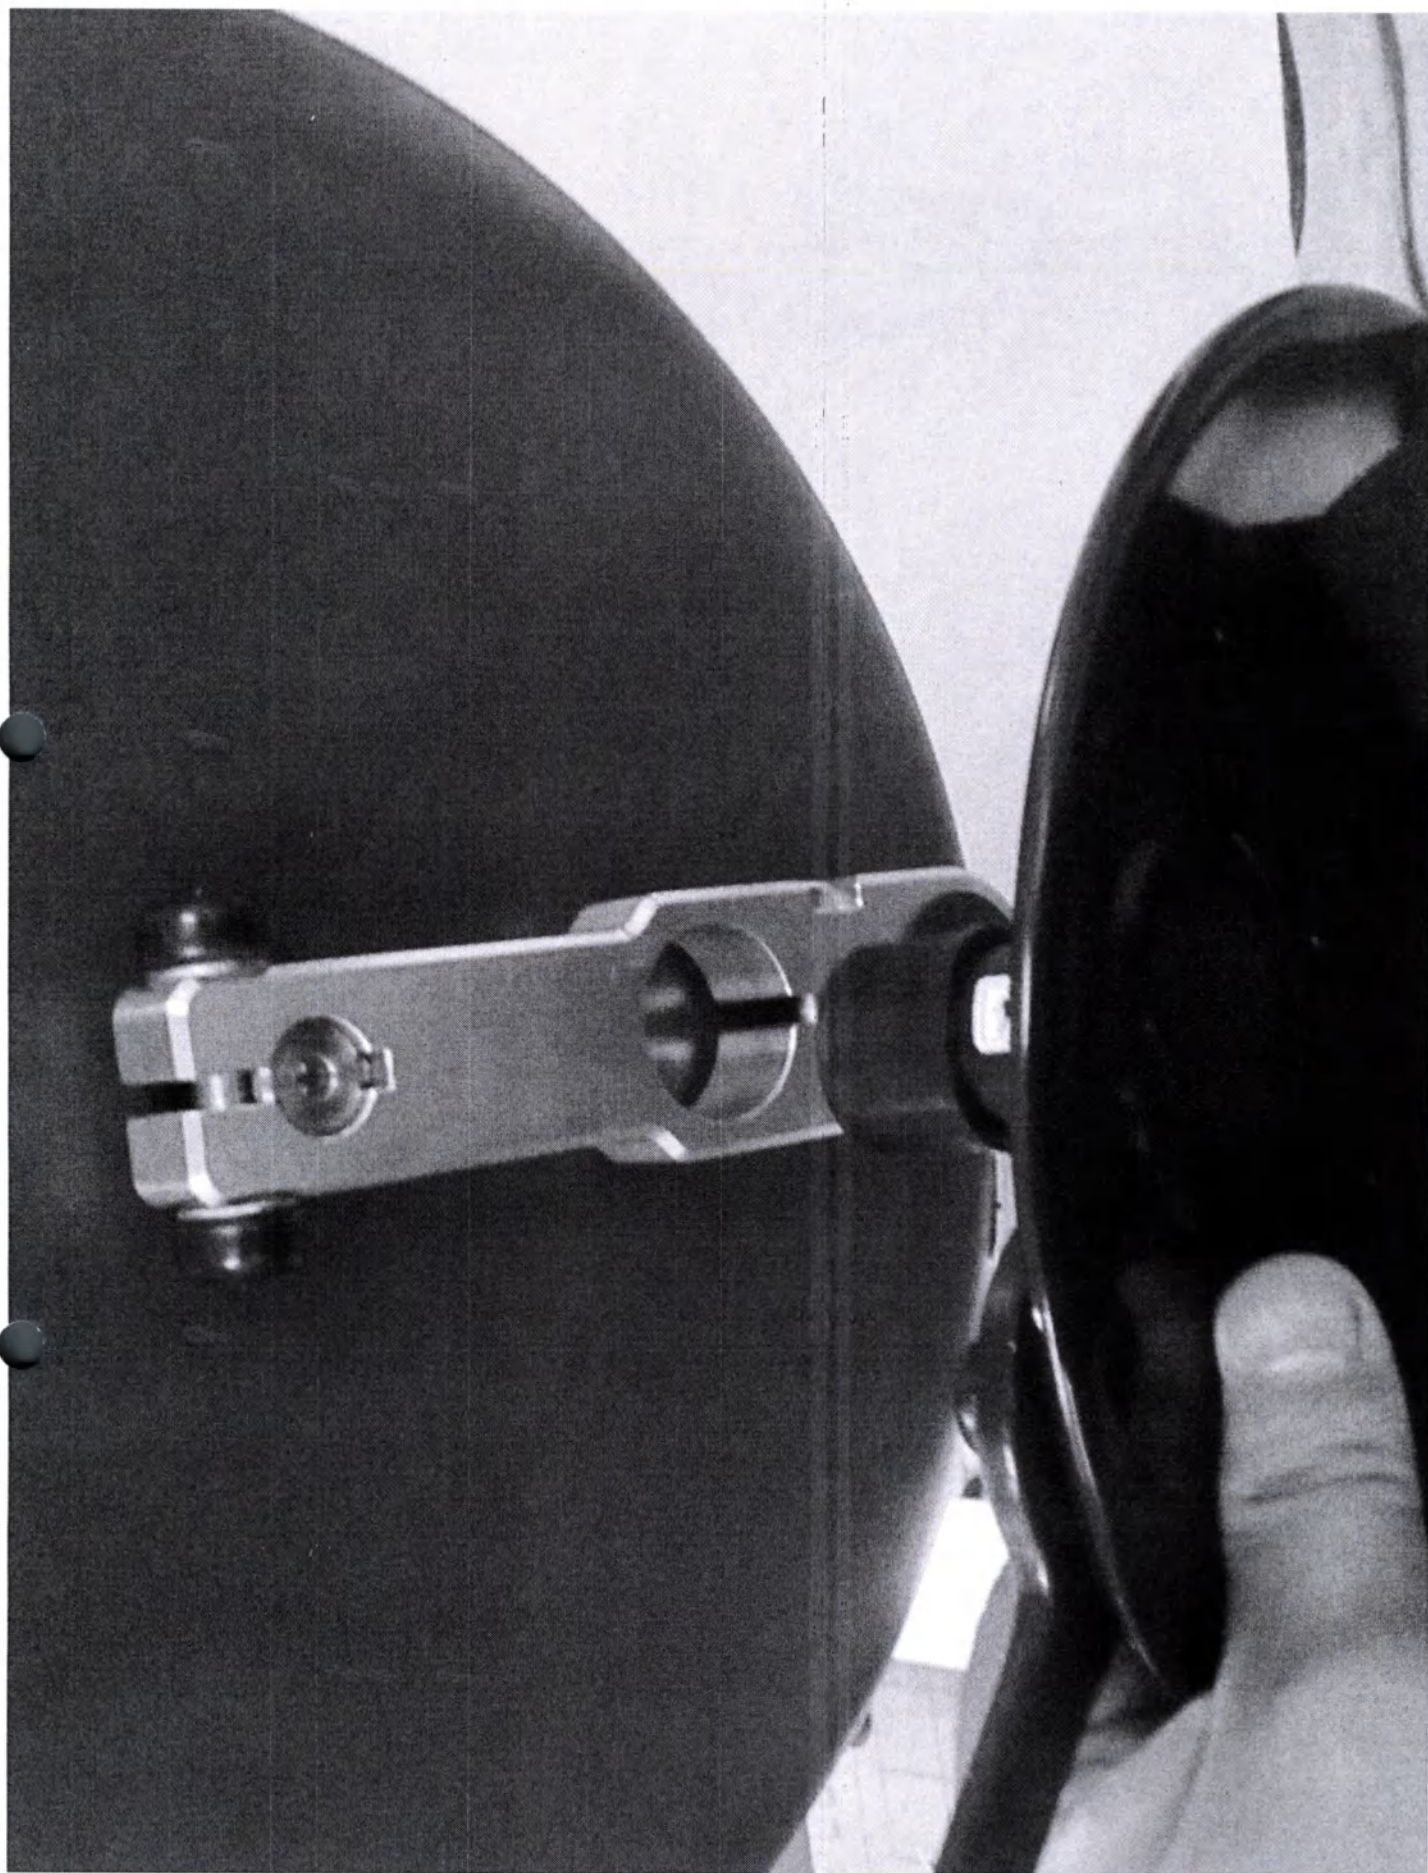


22. Устройство для быстрого монтажа безопасных педалей

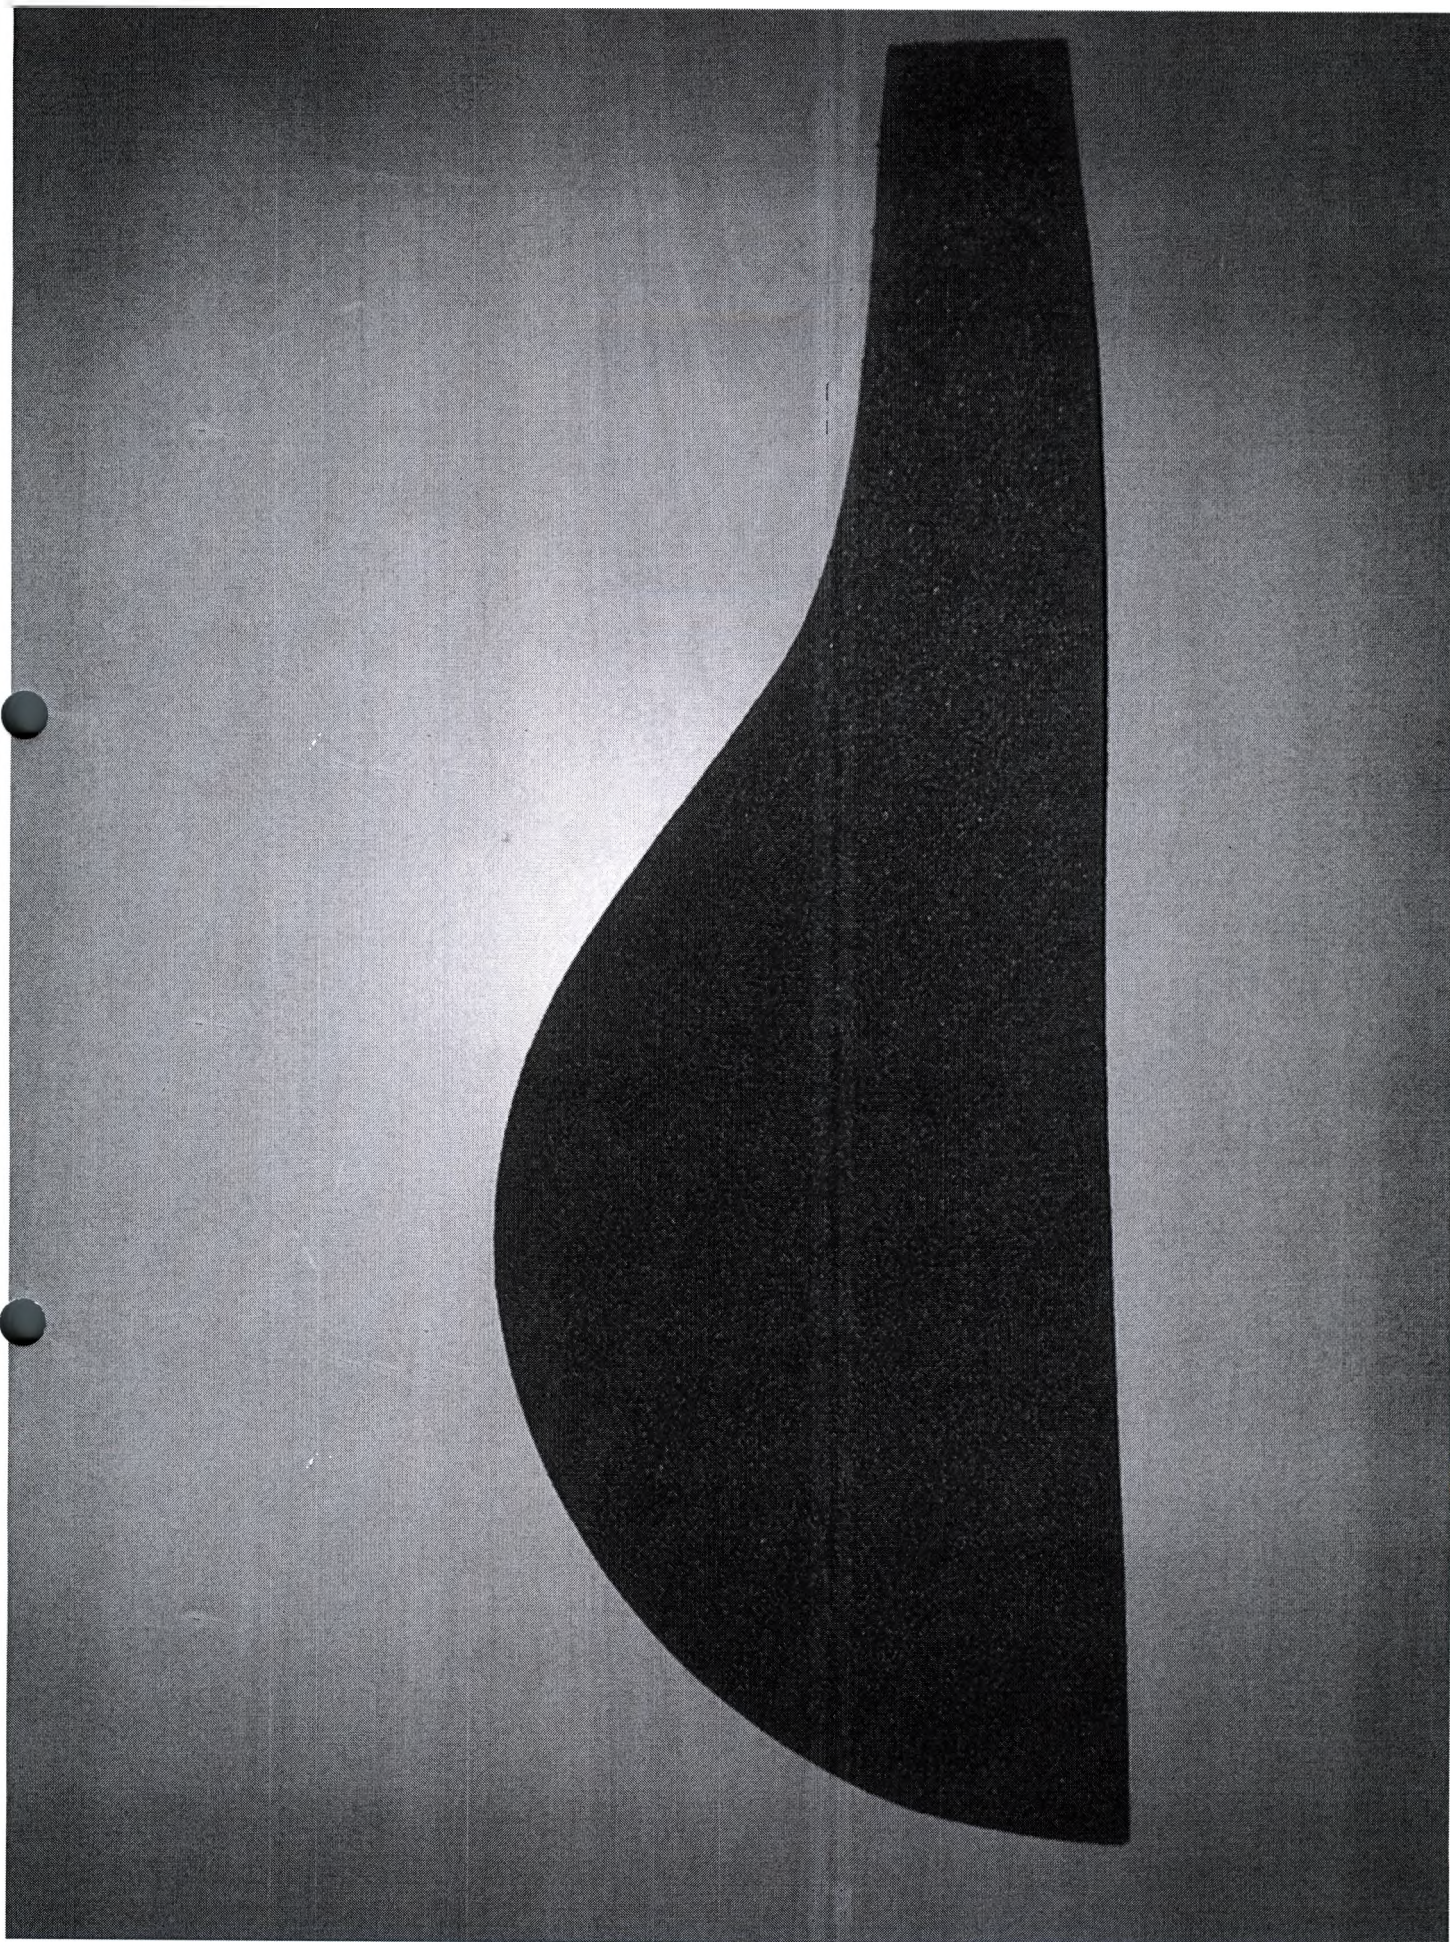


23. Вставки в педали



24. Штатив пассивного/активного тренажера

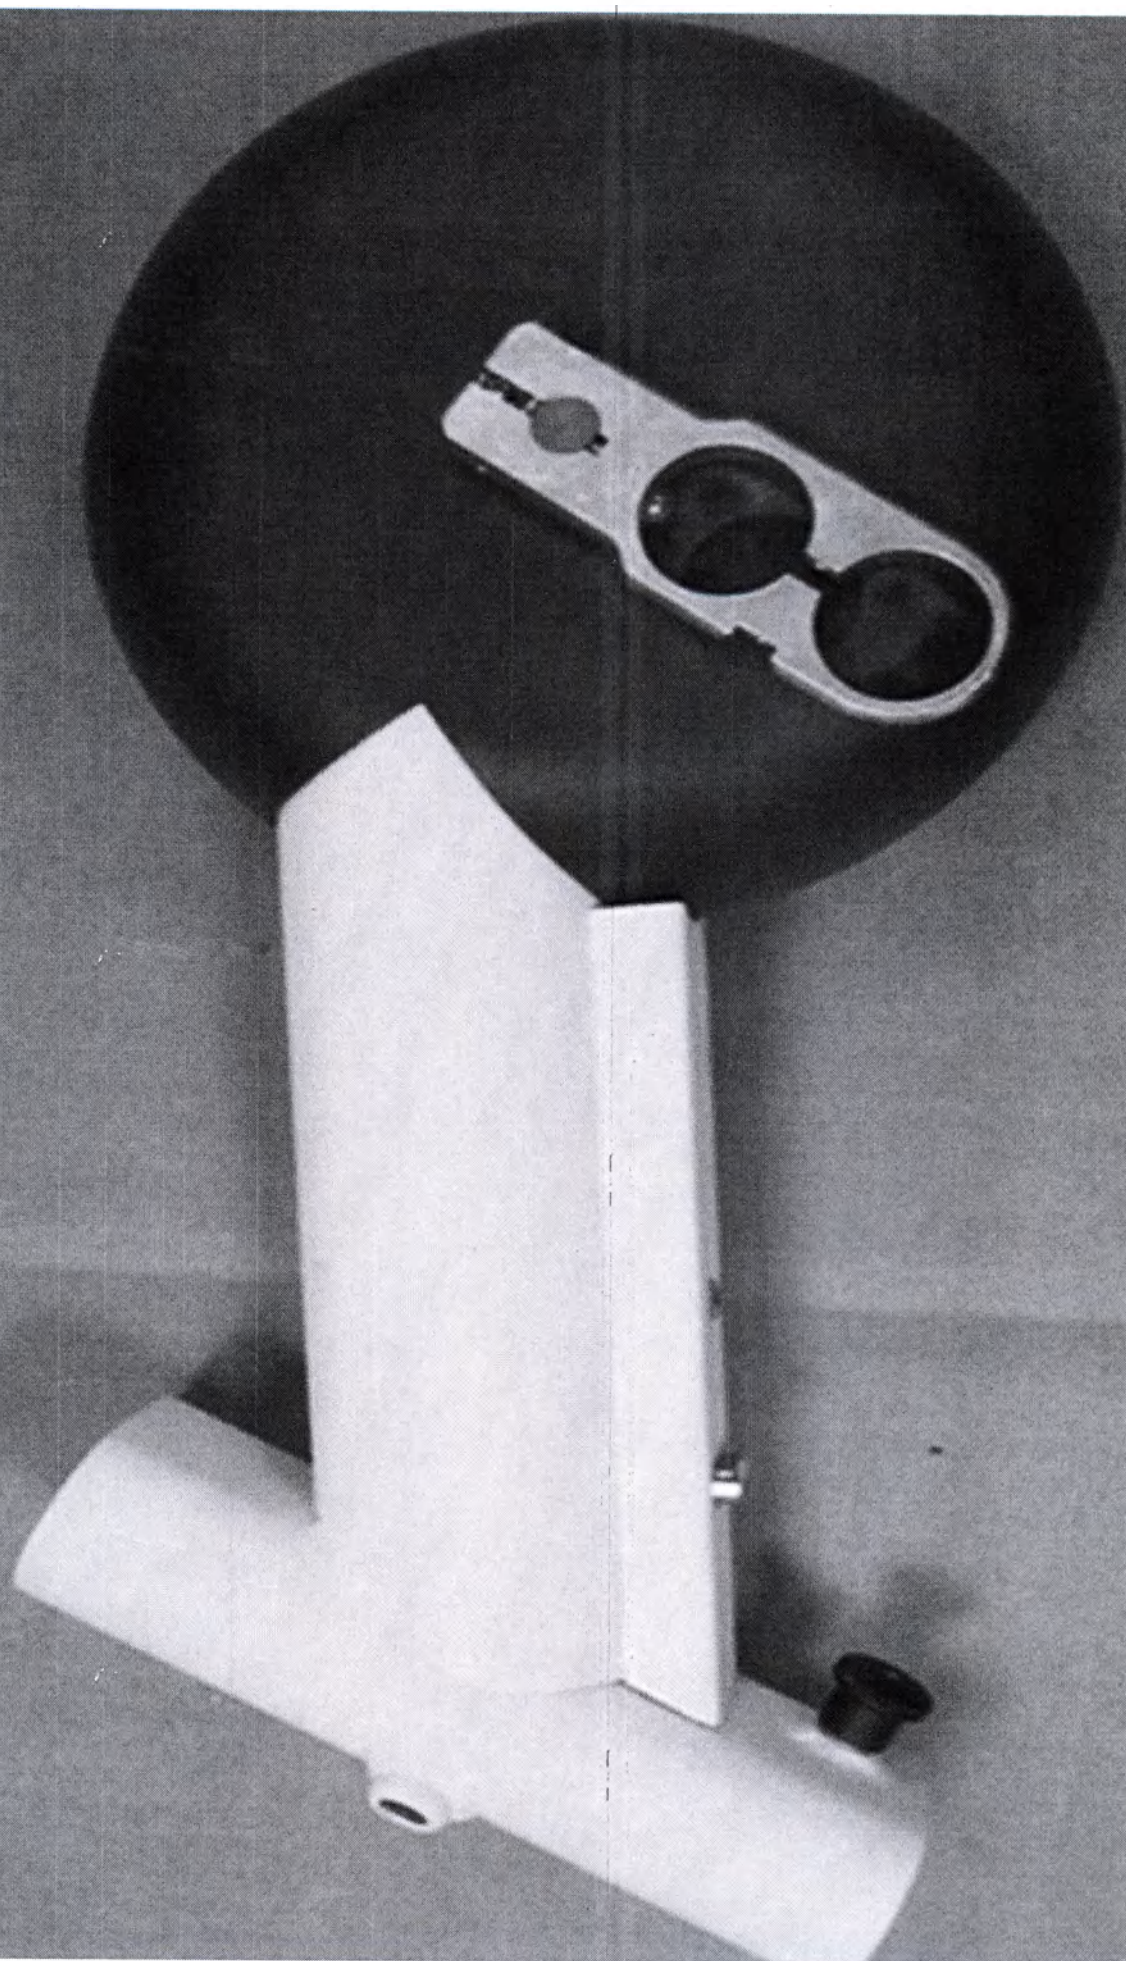

25. Блок для изменения положения педалей по высоте

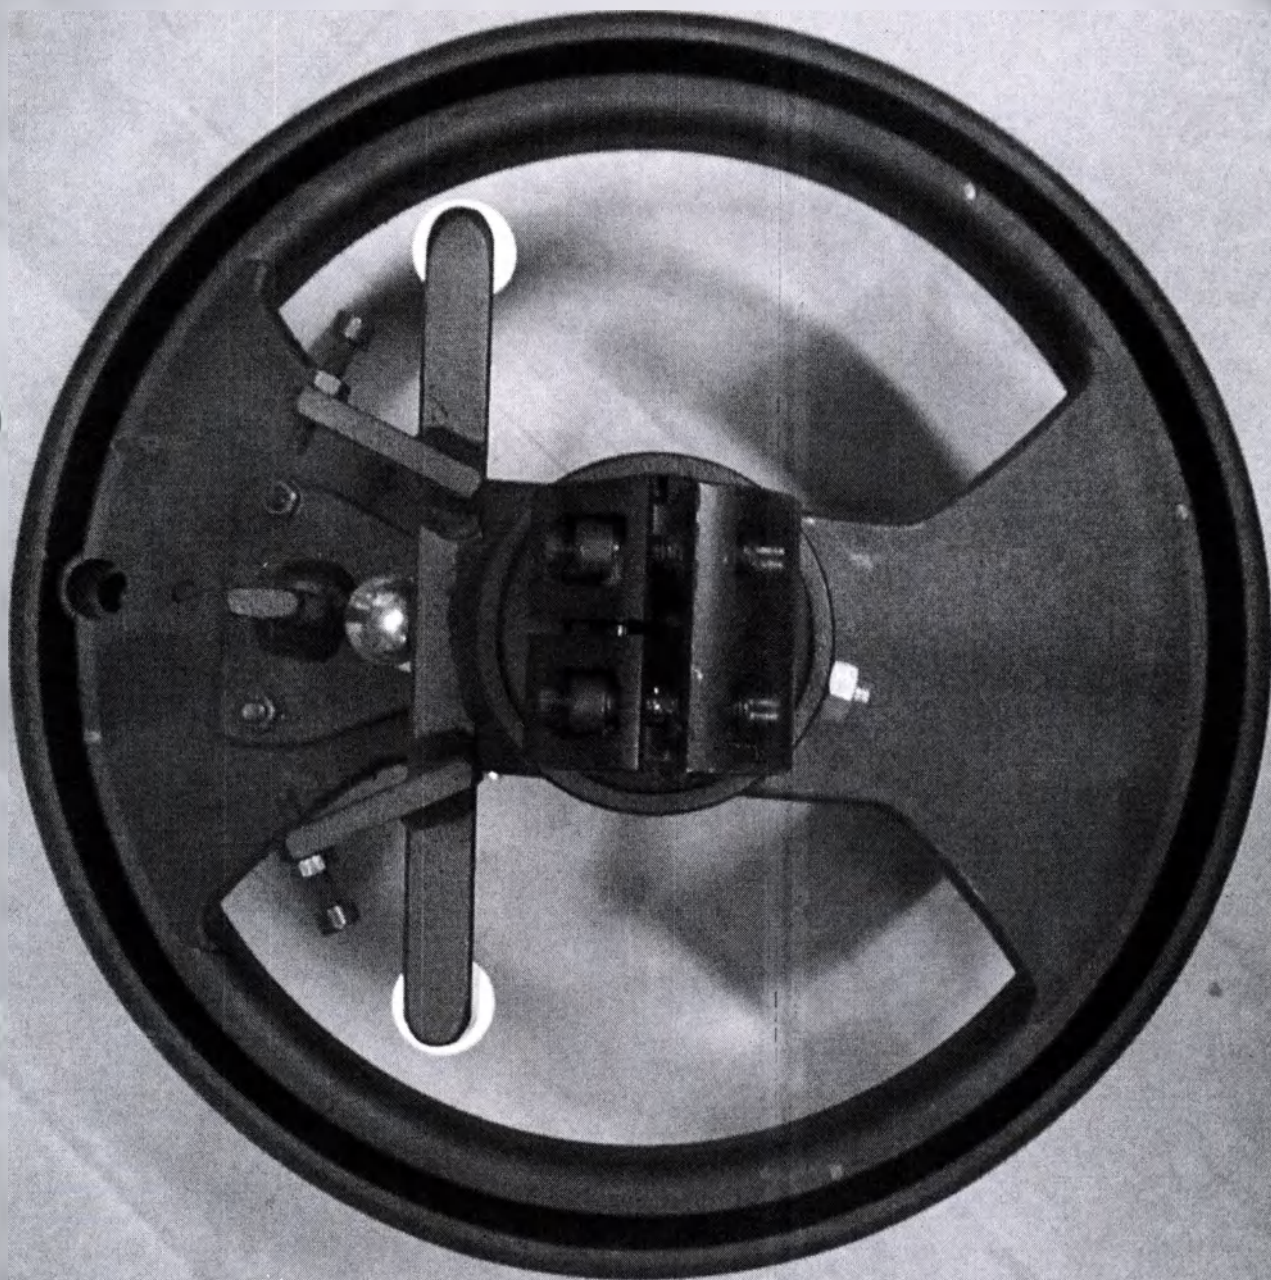



26. Руль (сегментарный, с круговым вращением, с секторным вращением)



27. Регулируемые эллипсные держатели рук




28. Защитный чехол операционной панели

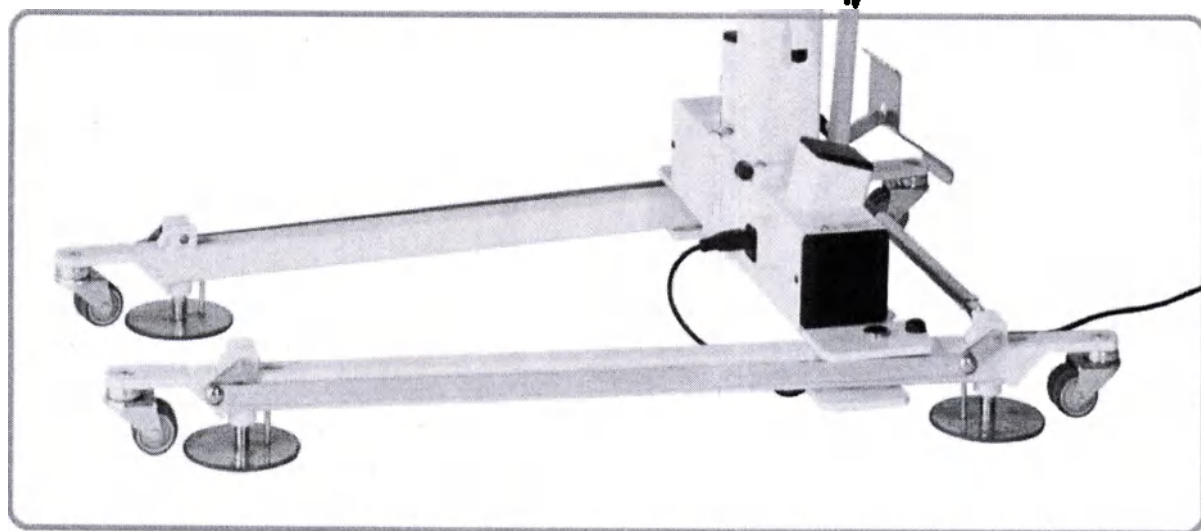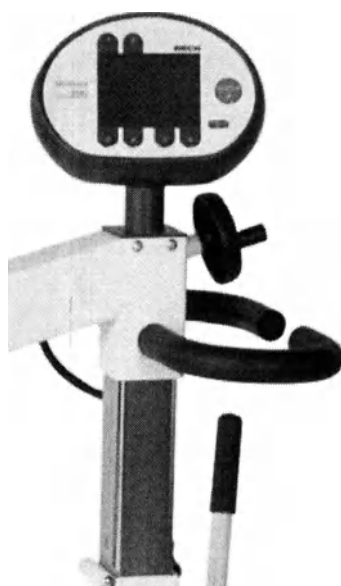

29. Регулируемый расширитель шасси

RECK MOTOMed® viva1



СТАРТ-СТОП
НОГИ



ПОМОЩЬ
НАЧАЛО-КОНЕЦ



ВПЕРЕД-НАЗАД



СТАРТ-СТОП
РУКИ



СУДОРОГИ
ДА-НЕТ



ОЦЕНКА



АКТИВНО
ДЕРЖИТЬ



-

+



СИЛА МОТОРА
ВЕРХНЯЯ
ГРАНИЦА



-

+




ПРОГРАММА




ВЫБОР

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

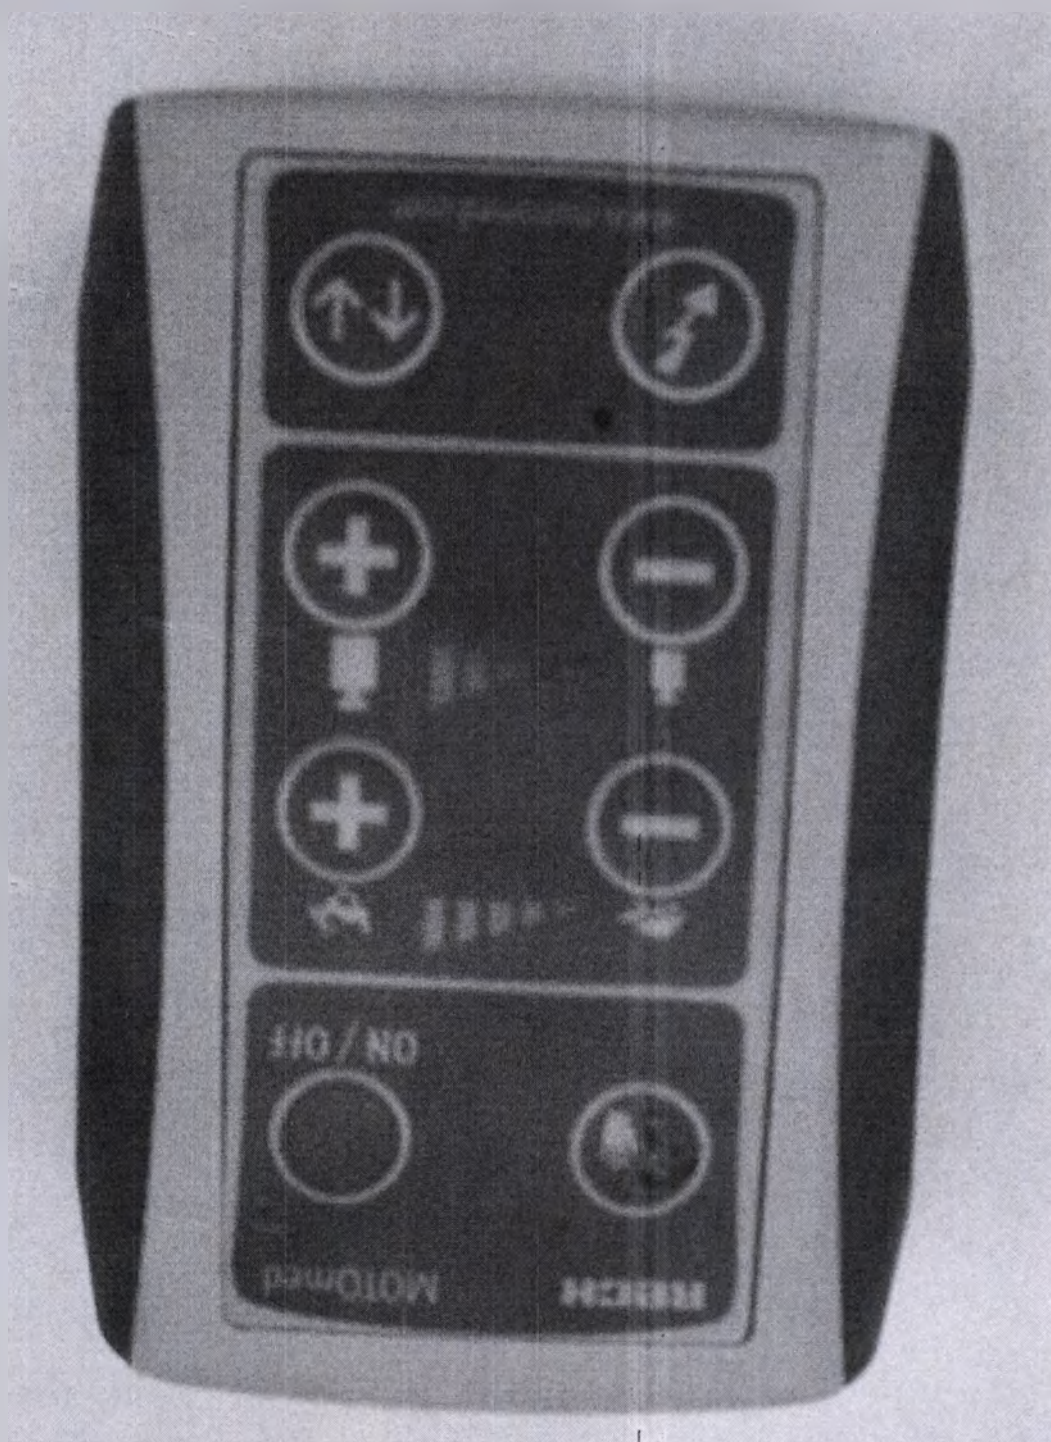

30. Операционная панель ессо

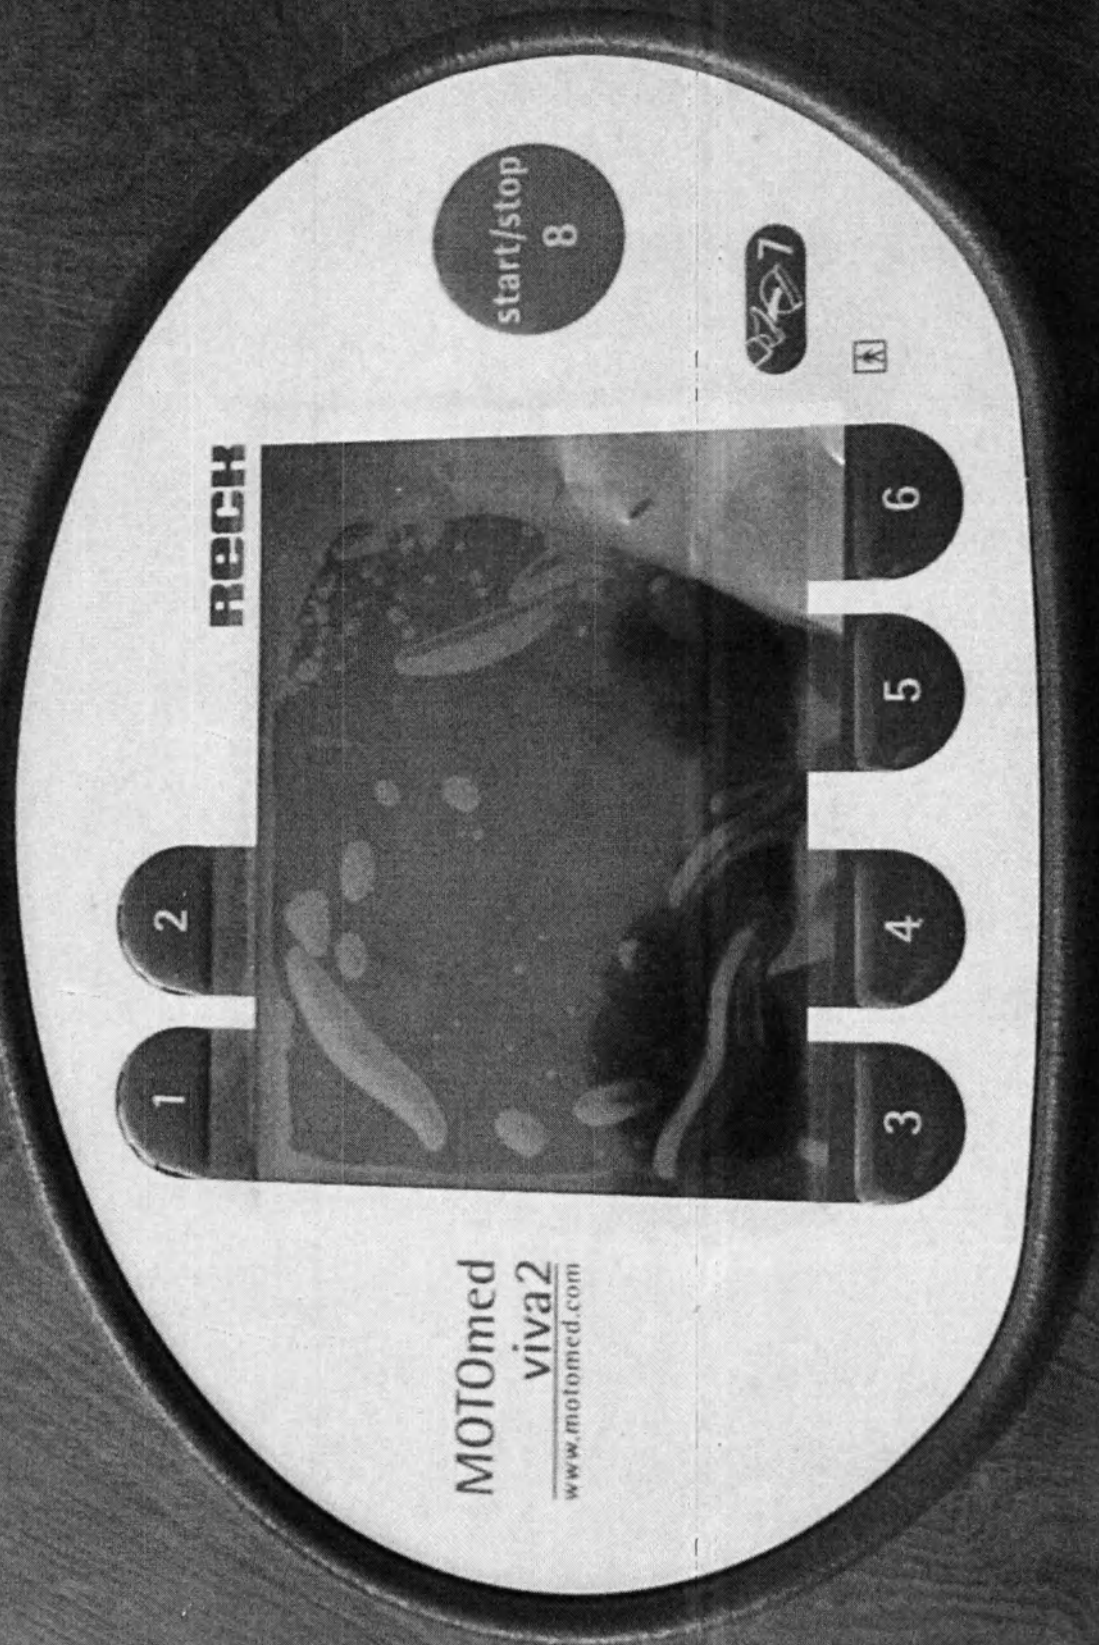


30. Операционная панель viva2




30. Операционная панель letto, duplex



30. Операционная панель muvi

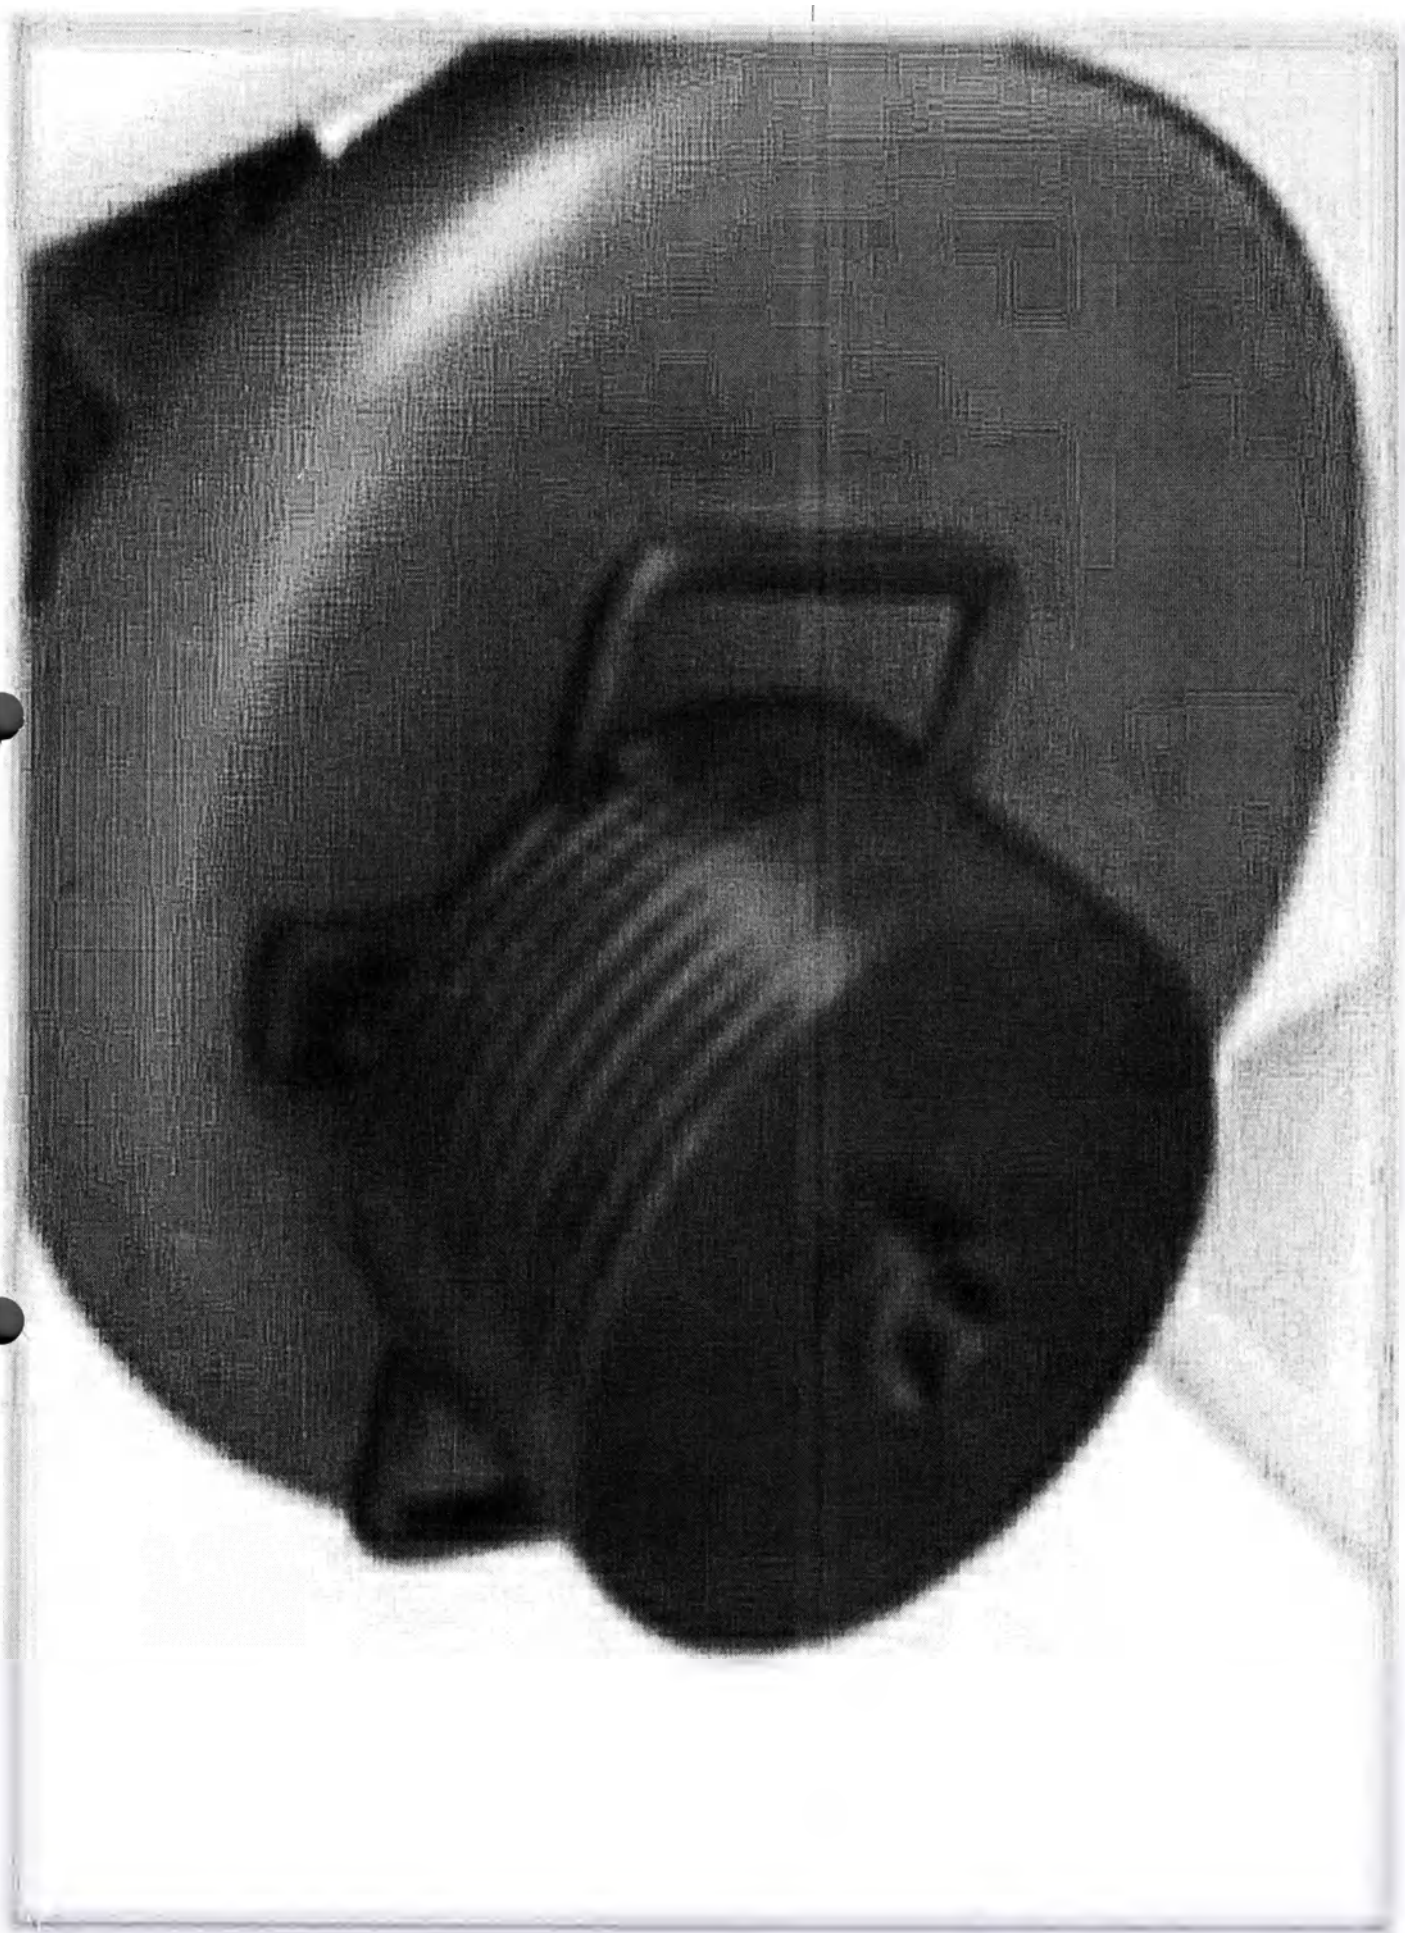

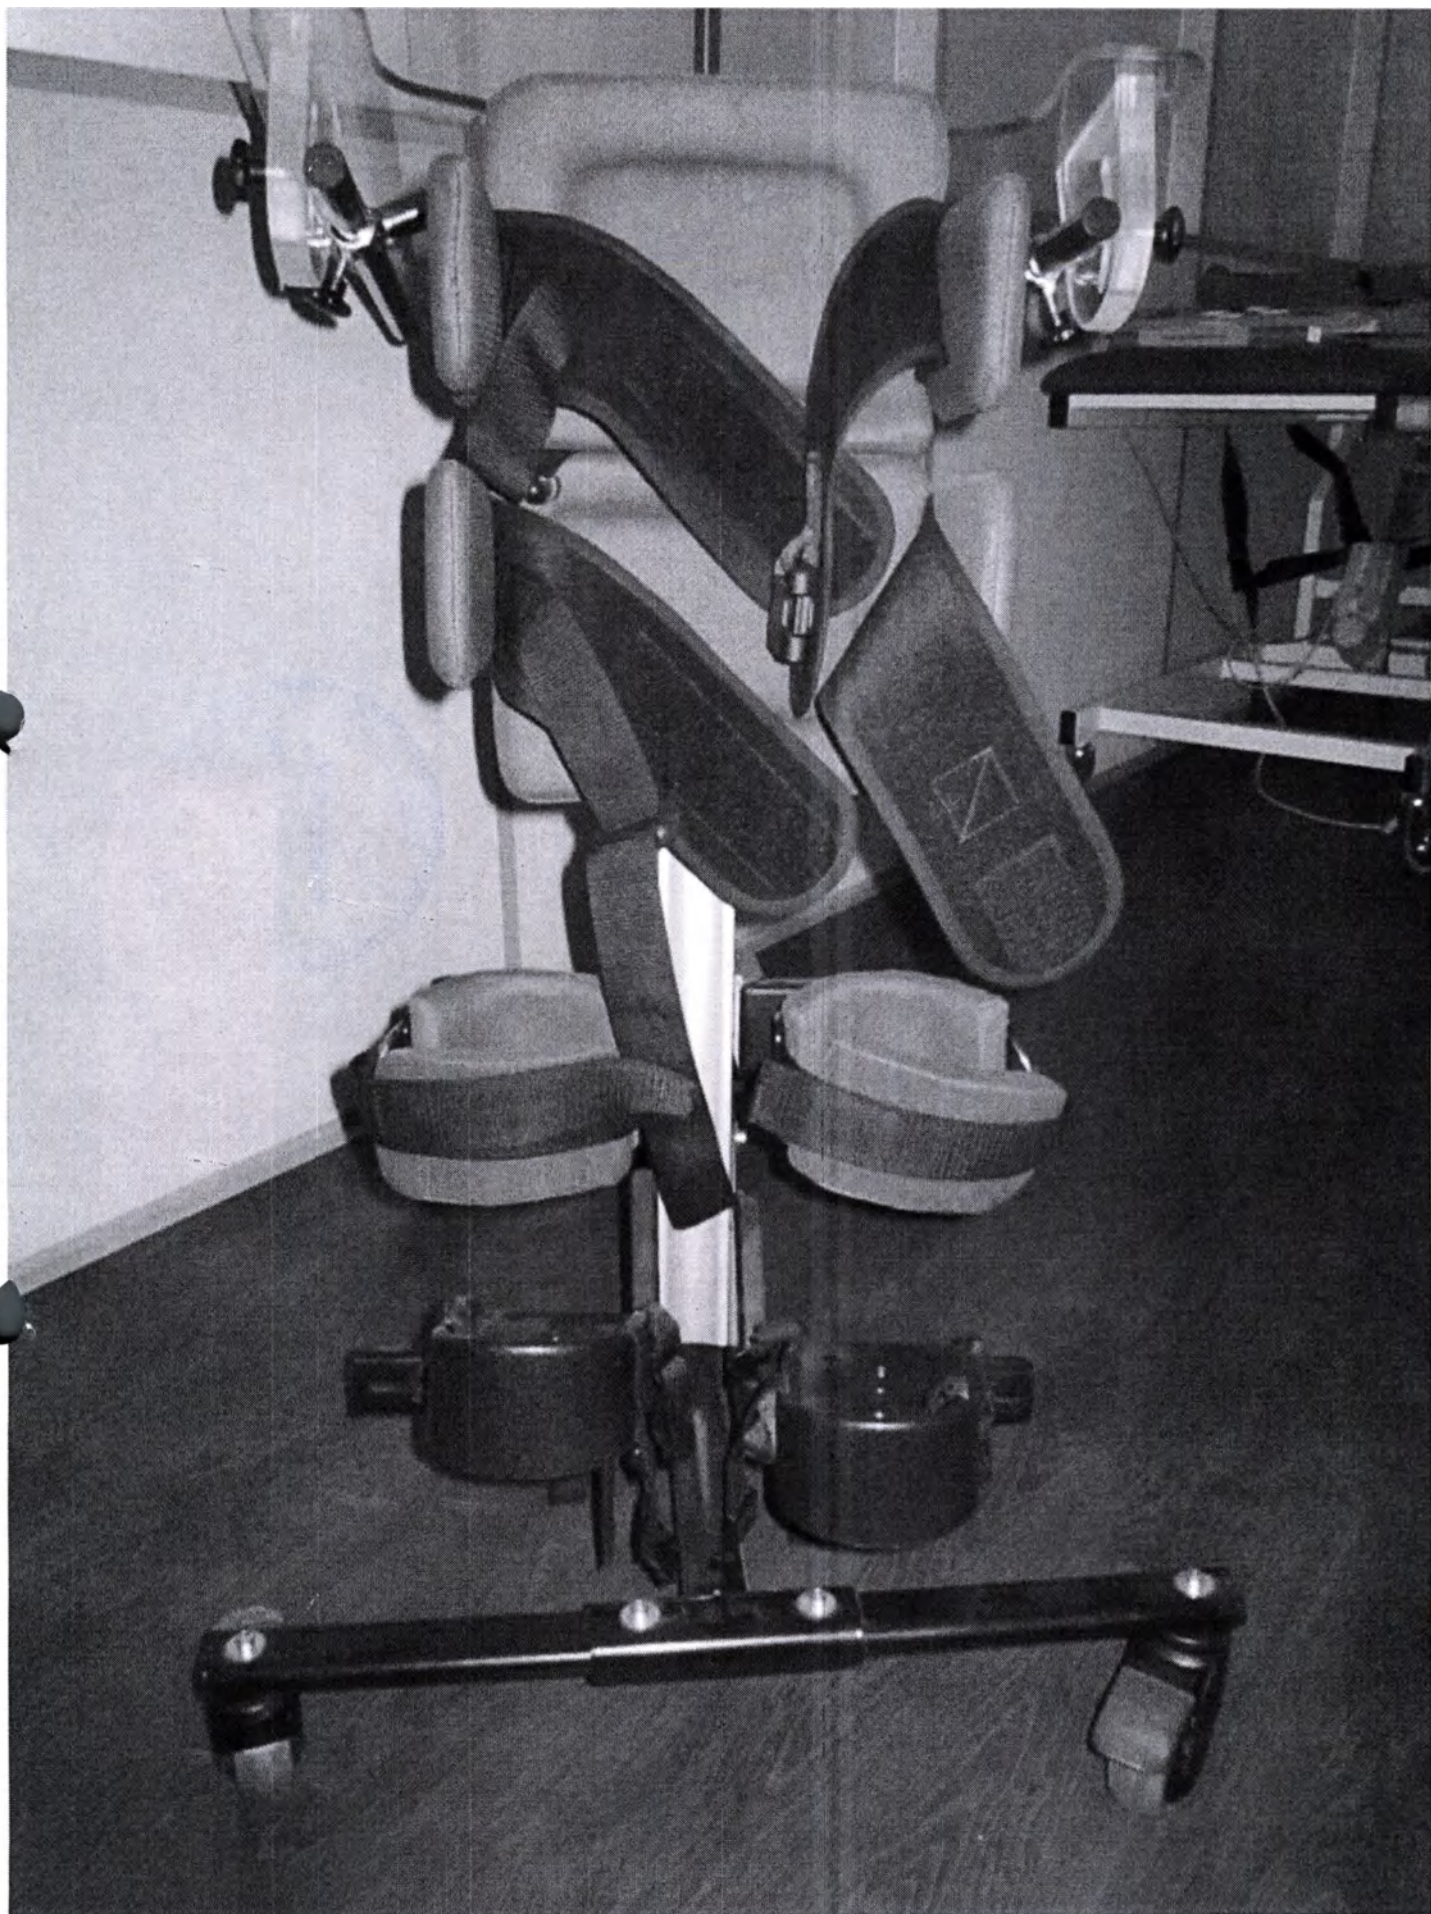

32. Терапевтический стул

Прошито, пронумеровано, скреплено

печатью (44) листов.

Генеральный директор ООО «СТД Медикал»

/ Н.В.Володина

