


Иллюстративный материал


Комплект оборудования системы диагностической careHPV для выявления ДНК вируса папилломы человека, в составе:

1. Блок управления системы диагностической careHPV
2. Люминометр системы диагностической careHPV
3. Шейкер системы диагностической careHPV
4. Держатель магнитной пластины системы диагностической careHPV
5. Кабель соединительный RS-232
6. Кабель электропитания с адаптером электропитания для блока управления системы диагностической careHPV
7. Кабель электропитания с адаптером электропитания для люминометра системы диагностической careHPV
8. Кабель электропитания с адаптером электропитания для шейкера системы диагностической careHPV
9. Руководство по использованию комплекта оборудования системы диагностической careHPV на бумажном носителе
10. Руководство по использованию люминометра и блока управления системы диагностической careHPV на бумажном носителе

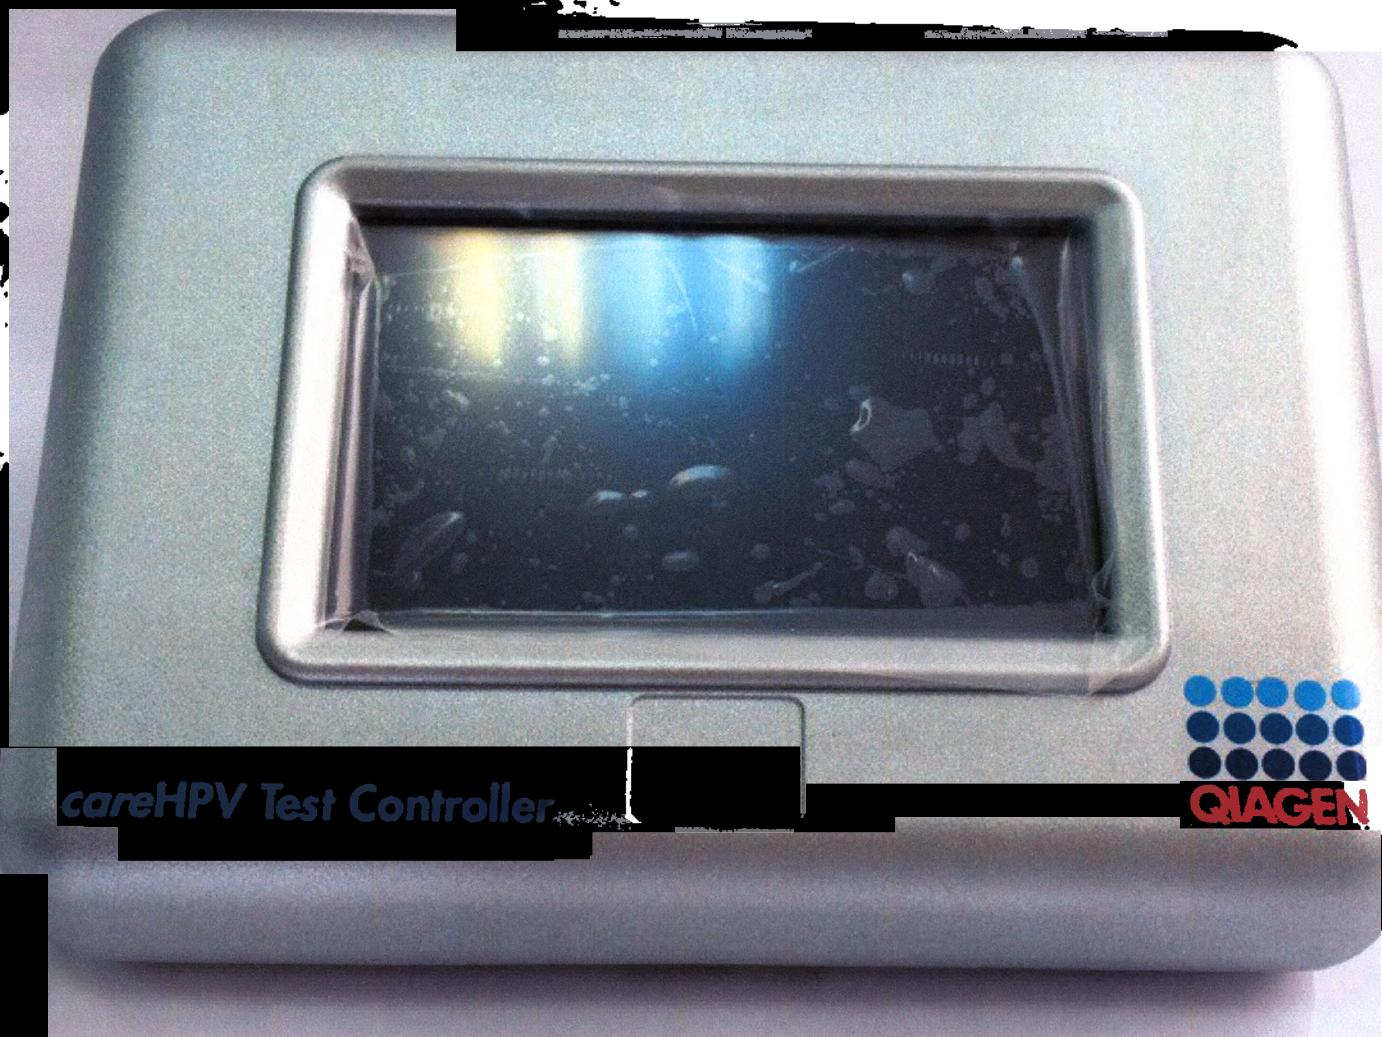



careHPV Test Controller



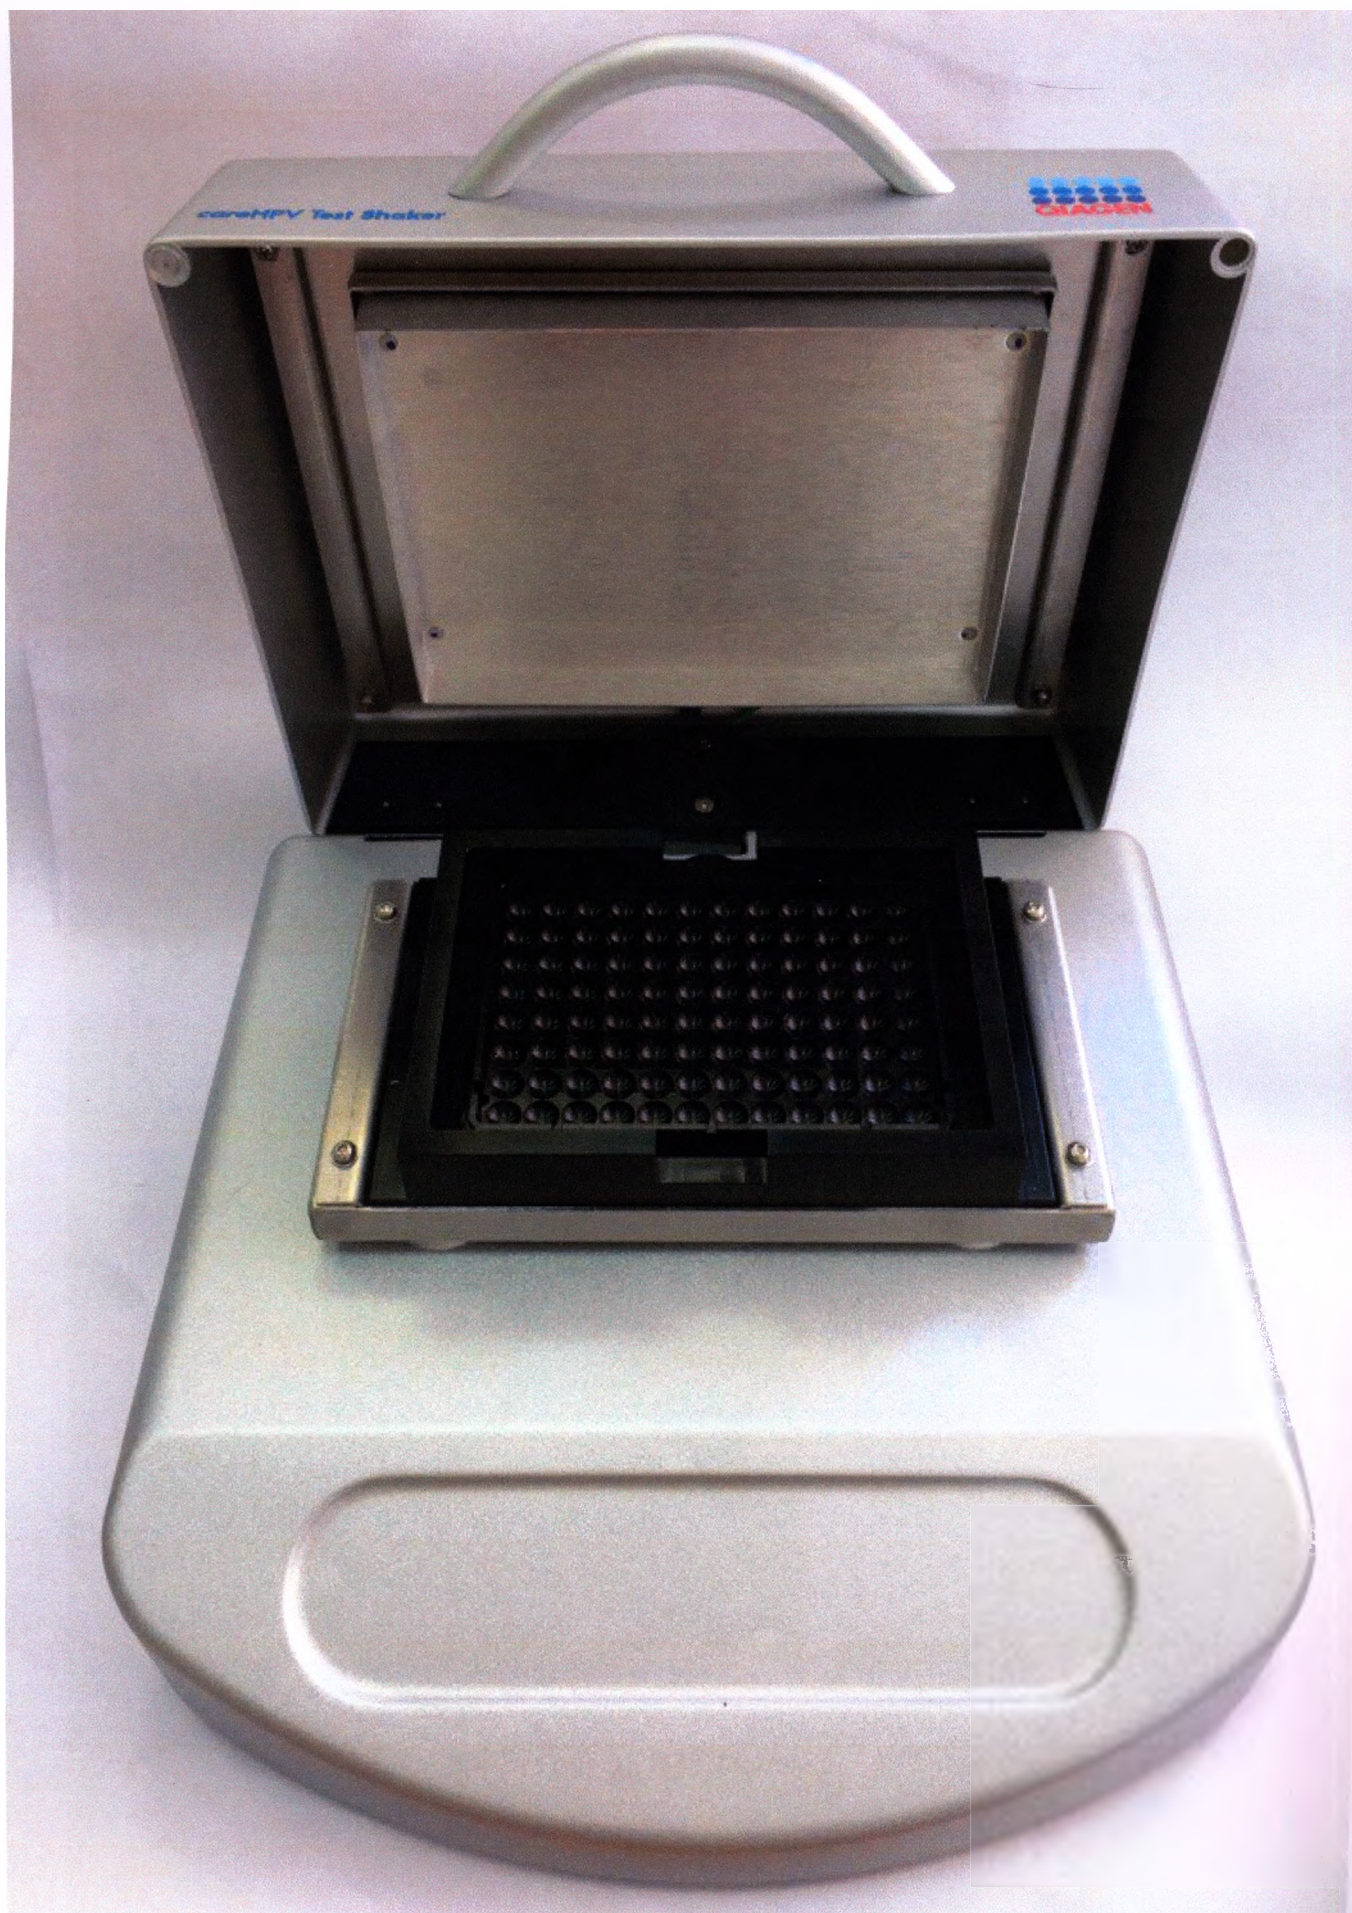



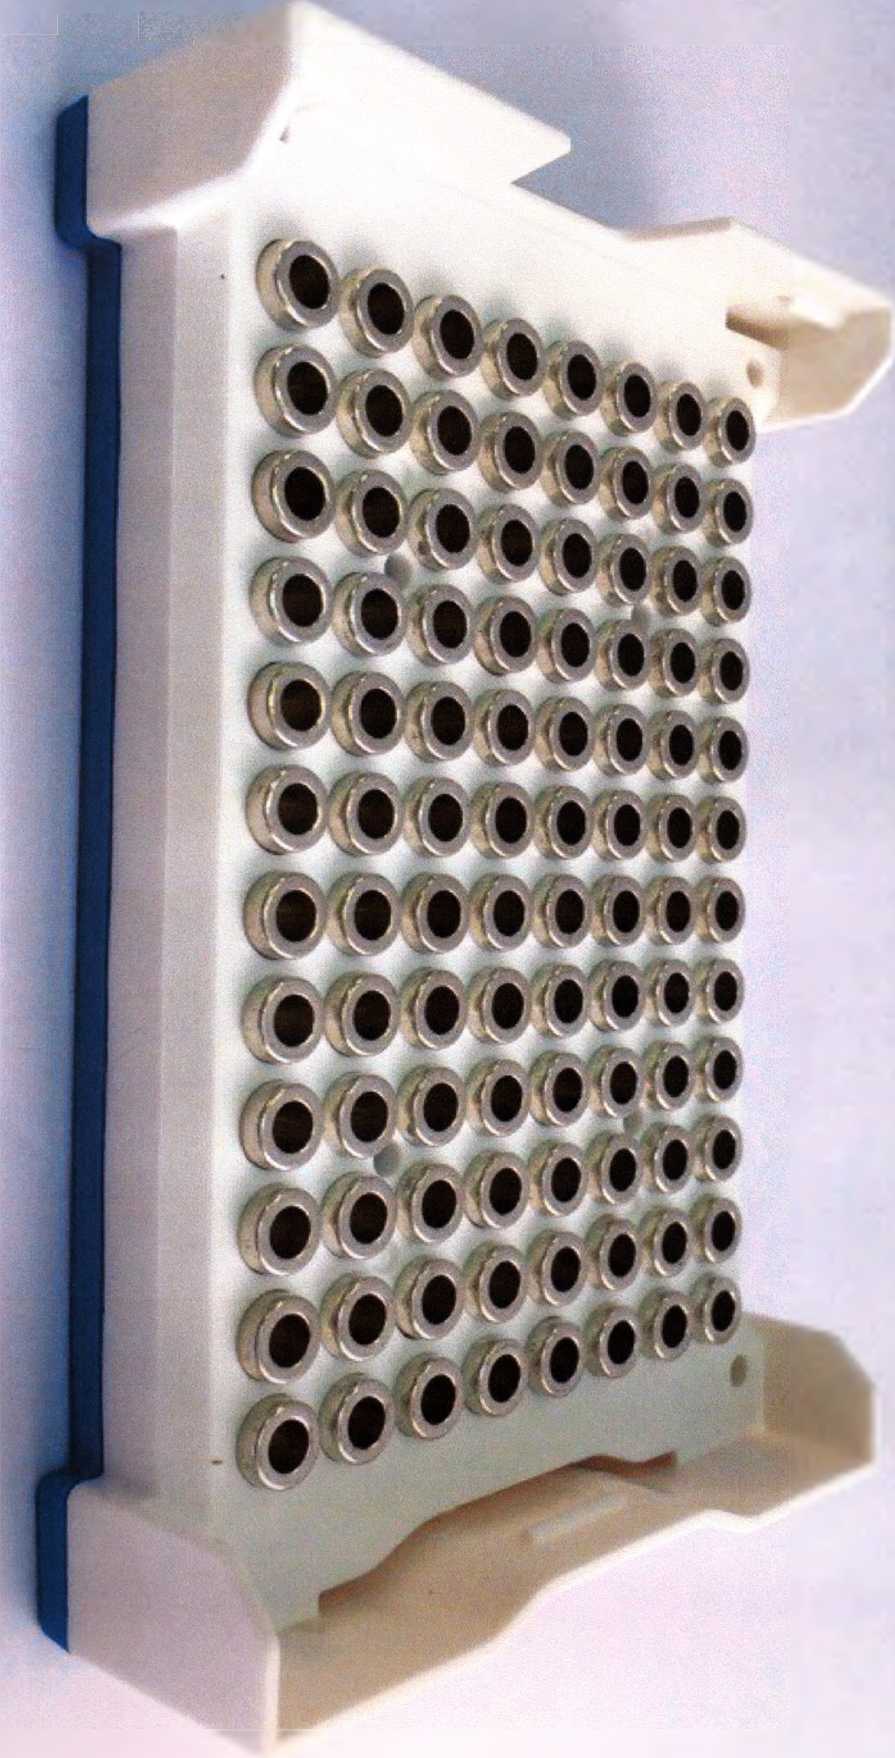

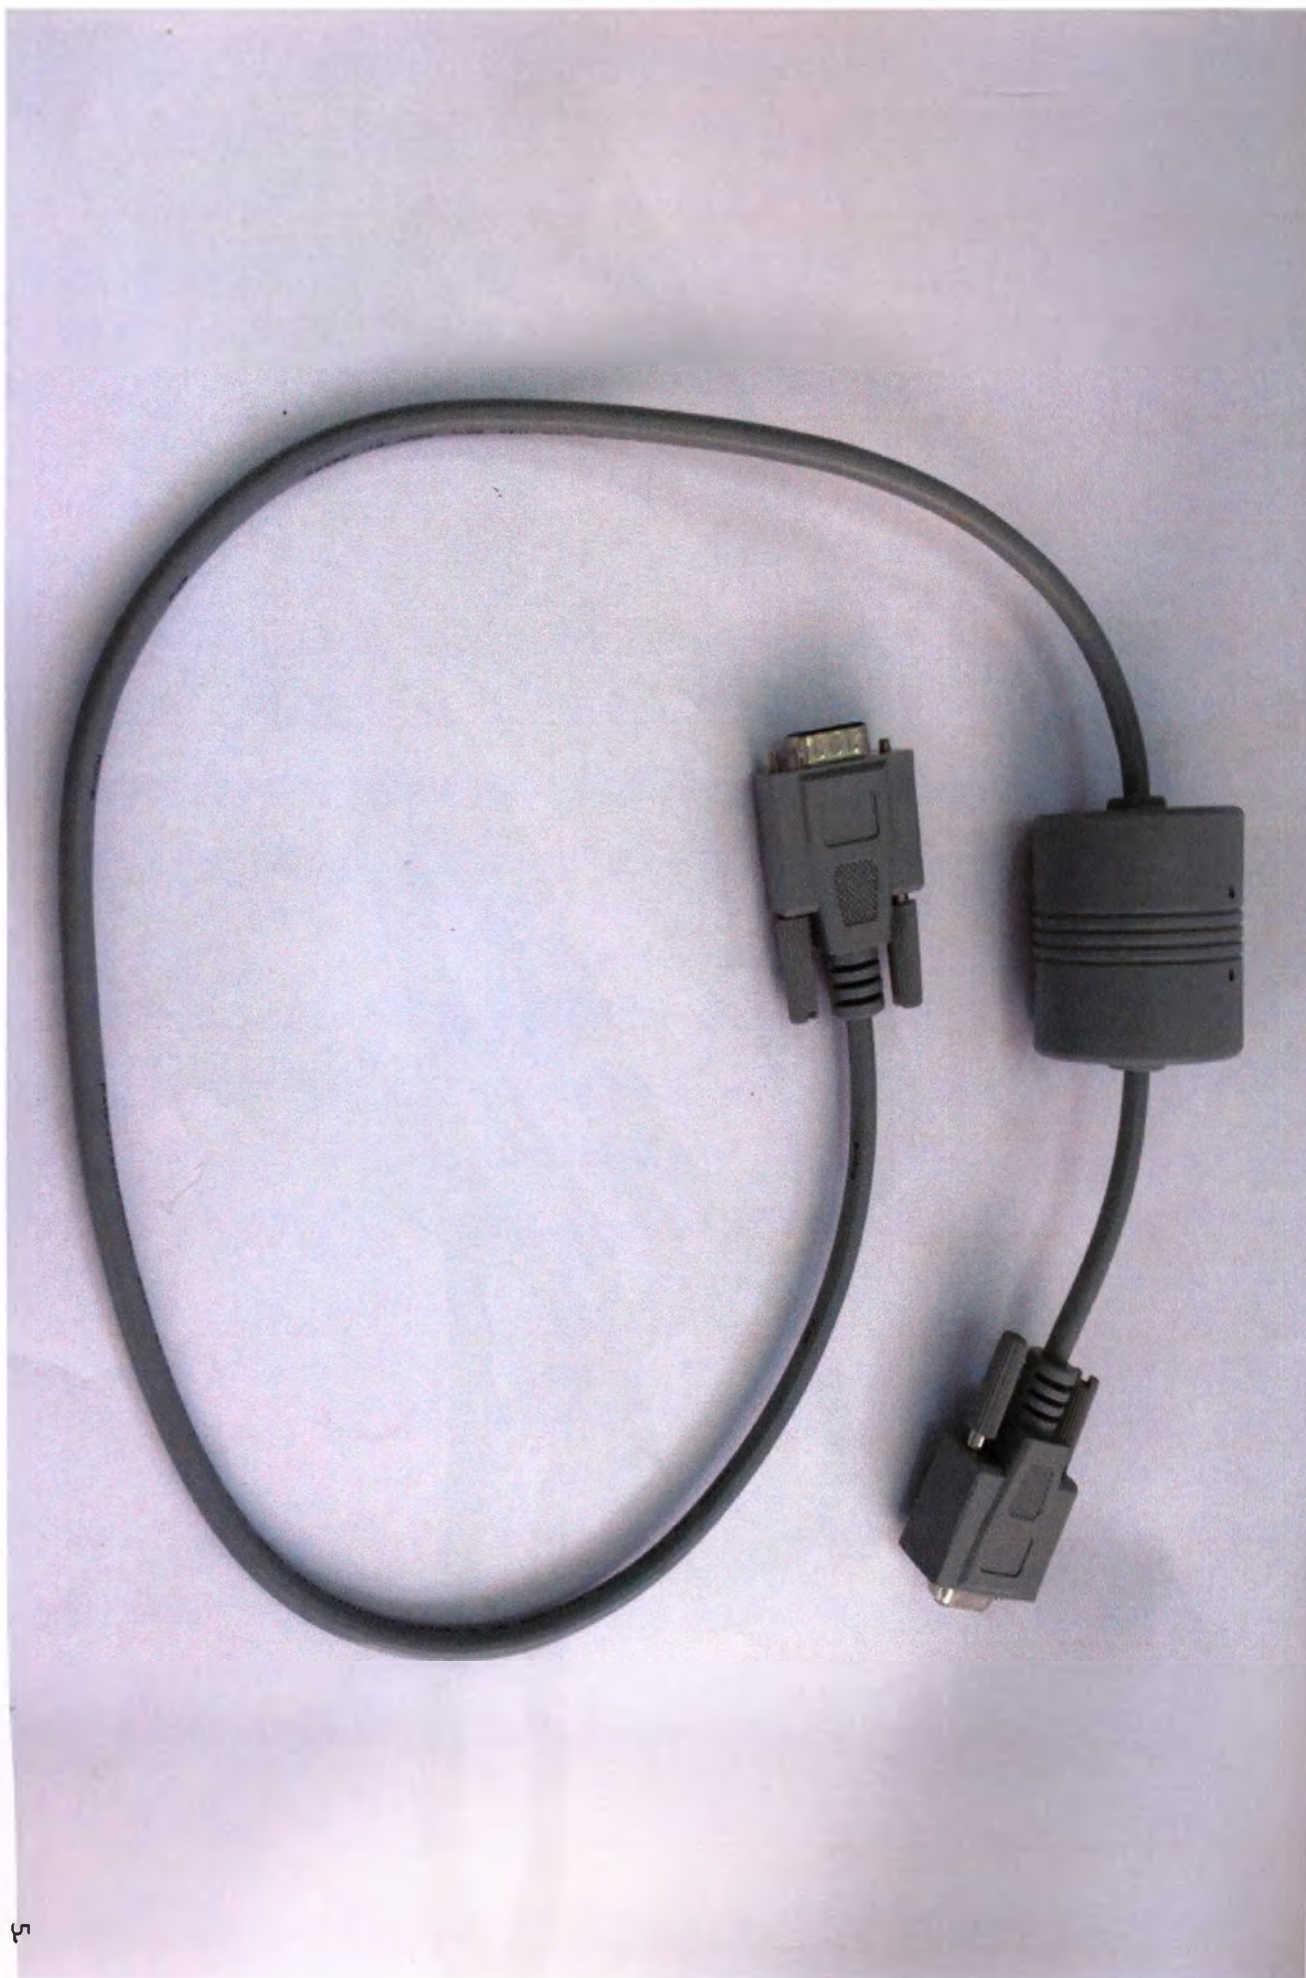

5









Руководство по использованию комплекта оборудования системы диагностической sageHPV

**Руководство по использованию
комплекта оборудования системы диагностической sageHPV
для выявления ДНК вируса папилломы человека**



IVD

REF.

9001773



QIAGEN GmbH, QIAGEN Straße 1, 40724 Hilden, Germany



Руководство по использованию люминометра и блока управления системы диагностической сагеHPV

**Руководство по использованию
люминометра и блока управления системы диагностической сагеHPV
для выявления ДНК вируса папилломы человека**



IVD

REF

9001773



QIAGEN GmbH, QIAGEN Street 1, 40724 Hilden, Germany

Прошнуровано и пронумеровано 11 листа(ов)

Директор ООО «Кайджен РУС»

Габуня А.Р.

Габуня

