



ВИНАР®

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА

Индикаторы

химические одноразовые

ООО «НПФ «ВИНАР»
РОССИЯ, 105094 г. Москва, а/я 26
Тел.: +7(495)988-7667
www.vinar.ru vinar@vinar.ru

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от +5°C до +40°C
и относительной влажности не выше 85%,
в защищенном от солнечного света месте. Беречь от влаги.

Гарантийный срок годности 36 месяцев

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
001	03	4.06.2015

Индикатор паровоздушной дезинфекции
химический одноразовый класса 4

ДезИД-1

ТУ 9398-176-11764404-2015

Количество: 500 шт.

Внешний вид индикаторов паровоздушной дезинфекции химических одноразовых класса 4 ДезИД-1



Индикаторы

химические одноразовые

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
001	03	ДЕК. 2015

ООО «НПФ «ВИНАР»
РОССИЯ, 105094 г. Москва, а/я 26
Тел.: +7(495)988-7667
www.vinar.ru vinar@vinar.ru

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от +5°C до +40°C
и относительной влажности не выше 85%,
в защищенном от солнечного света месте. Беречь от влаги.

Гарантийный срок годности 36 месяцев

Индикатор паровоздушной дезинфекции
химический одноразовый класса 4

ДезИД-2

ТУ 9398-176-11764404-2015

Количество: 500 шт.

Внешний вид индикаторов паровоздушной дезинфекции химических одноразовых класса 4 ДезИД-2



ВИНАР®

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА

Индикаторы

химические одноразовые



ООО «НПФ «ВИНАР»
РОССИЯ, 105094 г. Москва, а/я 26
Тел.: +7(495)988-7667
www.vinar.ru vlnar@vinar.ru

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от +5°C до +40°C
и относительной влажности не выше 85%,
в защищенном от солнечного света месте. Беречь от влаги.

Гарантийный срок годности 36 месяцев

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
001	03	4ЕК 2015

Индикатор паровоздушной дезинфекции
химический одноразовый класса 4

ДезИД-3

ТУ 9398-176-11764404-2015

Количество: 500 шт.

Внешний вид индикаторов паровоздушной дезинфекции химических одноразовых класса 4 ДезИД-3



ВИНАР[®]

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА

Индикаторы

химические одноразовые

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
001	03	14.08.2015

Индикатор паровоздушной дезинфекции
химический одноразовый класса 4

ДезИД-4

ТУ 9398-176-11764404-2015

Количество: 500 шт.

г. Москва, а/я 26
+7 (495) 988-7667
vinar@vinar.ru

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от +5°C до +40°C
и относительной влажности не выше 85%,
в защищенном от солнечного света месте. Беречь от влаги.

Гарантийный срок годности 36 месяцев

Внешний вид индикаторов паровоздушной дезинфекции химических одноразовых класса 4 ДезИД-4




ВИНАР®
 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
 ФИРМА

Индикаторы

химические одноразовые



ООО «НПФ «ВИНАР»
 РОССИЯ, 105094 г. Москва, а/я 26
 Тел.: +7(495)988-7667
www.vinar.ru vinar@vinar.ru

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
001	03	ДЕК 2015

Индикатор паровоздушной дезинфекции
 химический одноразовый класса 4
ДеЗИД-5
 ТУ 9398-176-11764404-2015
 Количество: 500 шт.

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от +5°C до +40°C
 и относительной влажности не выше 85%,
 в защищенном от солнечного света месте. Беречь от влаги.

Гарантийный срок годности 36 месяцев

Внешний вид индикаторов паровоздушной дезинфекции химических одноразовых класса 4 ДеЗИД-5



Индикаторы

химические одноразовые



ООО «НПФ «ВИНАР»
РОССИЯ, 105094 г. Москва, а/я 26
Тел.: +7(495)988-7667
www.vinar.ru vinar@vinar.ru

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от +5°C до +40°C
и относительной влажности не выше 85%,
в защищенном от солнечного света месте. Беречь от влаги.

Гарантийный срок годности 36 месяцев

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
001	03	Д.ЕК. 2015

Индикатор паровоздушной дезинфекции
химический одноразовый класса 4

ДеизД-6

ТУ 9398-176-11764404-2015

Количество: 500 шт.

Внешний вид индикаторов паровоздушной дезинфекции химических одноразовых класса 4 ДеизД-6


ВИНАР®
 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
 ФИРМА

Индикаторы

химические одноразовые

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
001	03	4 ФЕВ. 2015

Индикатор паровоздушной дезинфекции
химический одноразовый класса 4

ДезИД-7

ТУ 9398-176-11764404-2015
Количество: 500 шт.



ООО «НПФ «ВИНАР»
РОССИЯ, 105094 г. Москва, а/я 26
Тел.: +7(495)988-7667
www.vinar.ru vinar@vinar.ru

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от +5°C до +40°C
и относительной влажности не выше 85%,
в защищенном от солнечного света месте. Беречь от влаги.

Гарантийный срок годности 36 месяцев

Внешний вид индикаторов паровоздушной дезинфекции химических одноразовых класса 4 ДезИД-7



Индикаторы

химические одноразовые



ООО «НПФ «ВИАР»
РОССИЯ, 105094 г. Москва, а/я 26
Тел.: +7(495)988-7667
www.vinar.ru vinar@vinar.ru

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от +5°C до +40°C
и относительной влажности не выше 85%,
в защищенном от солнечного света месте. Беречь от влаги.

Гарантийный срок годности 36 месяцев

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
DD1	03	4ЕК. 2015

Индикатор паровоздушной дезинфекции
химический одноразовый класса 4

ДезИД-8

ТУ 9398-176-11764404-2015

Количество: 500 шт.

Внешний вид индикаторов паровоздушной дезинфекции химических одноразовых класса 4 ДезИД-8



ВИНАР®

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА

Индикаторы

химические одноразовые

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
001	03	Дек 2015

ООО «НПФ «ВИНАР»
РОССИЯ, 105094 г. Москва, а/я 26
Тел.: +7(495)988-7667
www.vinar.ru vinar@vinar.ru

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от +5°C до +40°C
и относительной влажности не выше 85%,
в защищенном от солнечного света месте. Беречь от влаги.

Гарантийный срок годности 36 месяцев

Индикатор паровоздушной дезинфекции
химический одноразовый класса 4

ДезИД-9

ТУ 9398-176-11764404-2015

Количество: 500 шт.

Внешний вид индикаторов паровоздушной дезинфекции химических одноразовых класса 4 ДезИД-9



ВИНАР®

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА

Индикаторы

химические одноразовые

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
001	03	Д.ЕК. 2015

Индикатор паровоздушной дезинфекции
химический одноразовый класса 4

ДезИД-10

ТУ 9398-176-11764404-2015

Количество: 500 шт.

ООО «НПФ «ВИНАР»
РОССИЯ, 105094 г. Москва, а/я 26
Тел.: +7(495)988-7667
www.vinar.ru vinar@vinar.ru

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от +5°C до +40°C
и относительной влажности не выше 85%,
в защищенном от солнечного света месте. Беречь от влаги.

Гарантийный срок годности 36 месяцев

Внешний вид индикаторов паровоздушной дезинфекции химических одноразовых класса 4 ДезИД-10



ВИНАР®

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА

Индикаторы

химические одноразовые



ООО «НПФ «ВИНАР»
РОССИЯ, 105094 г. Москва, а/я 26
Тел.: +7(495)988-7667
www.vinar.ru vinar@vinar.ru

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от +5°C до +40°C
и относительной влажности не выше 85%,
в защищенном от солнечного света месте. Беречь от влаги.

Гарантийный срок годности 36 месяцев

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
001	03	Дек. 2015


Индикатор паровоздушной дезинфекции
химический одноразовый класса 4

ДезИД-11

ТУ 9398-176-11764404-2015

Количество: 500 шт.

Внешний вид индикаторов паровоздушной дезинфекции химических одноразовых класса 4 ДезИД-11

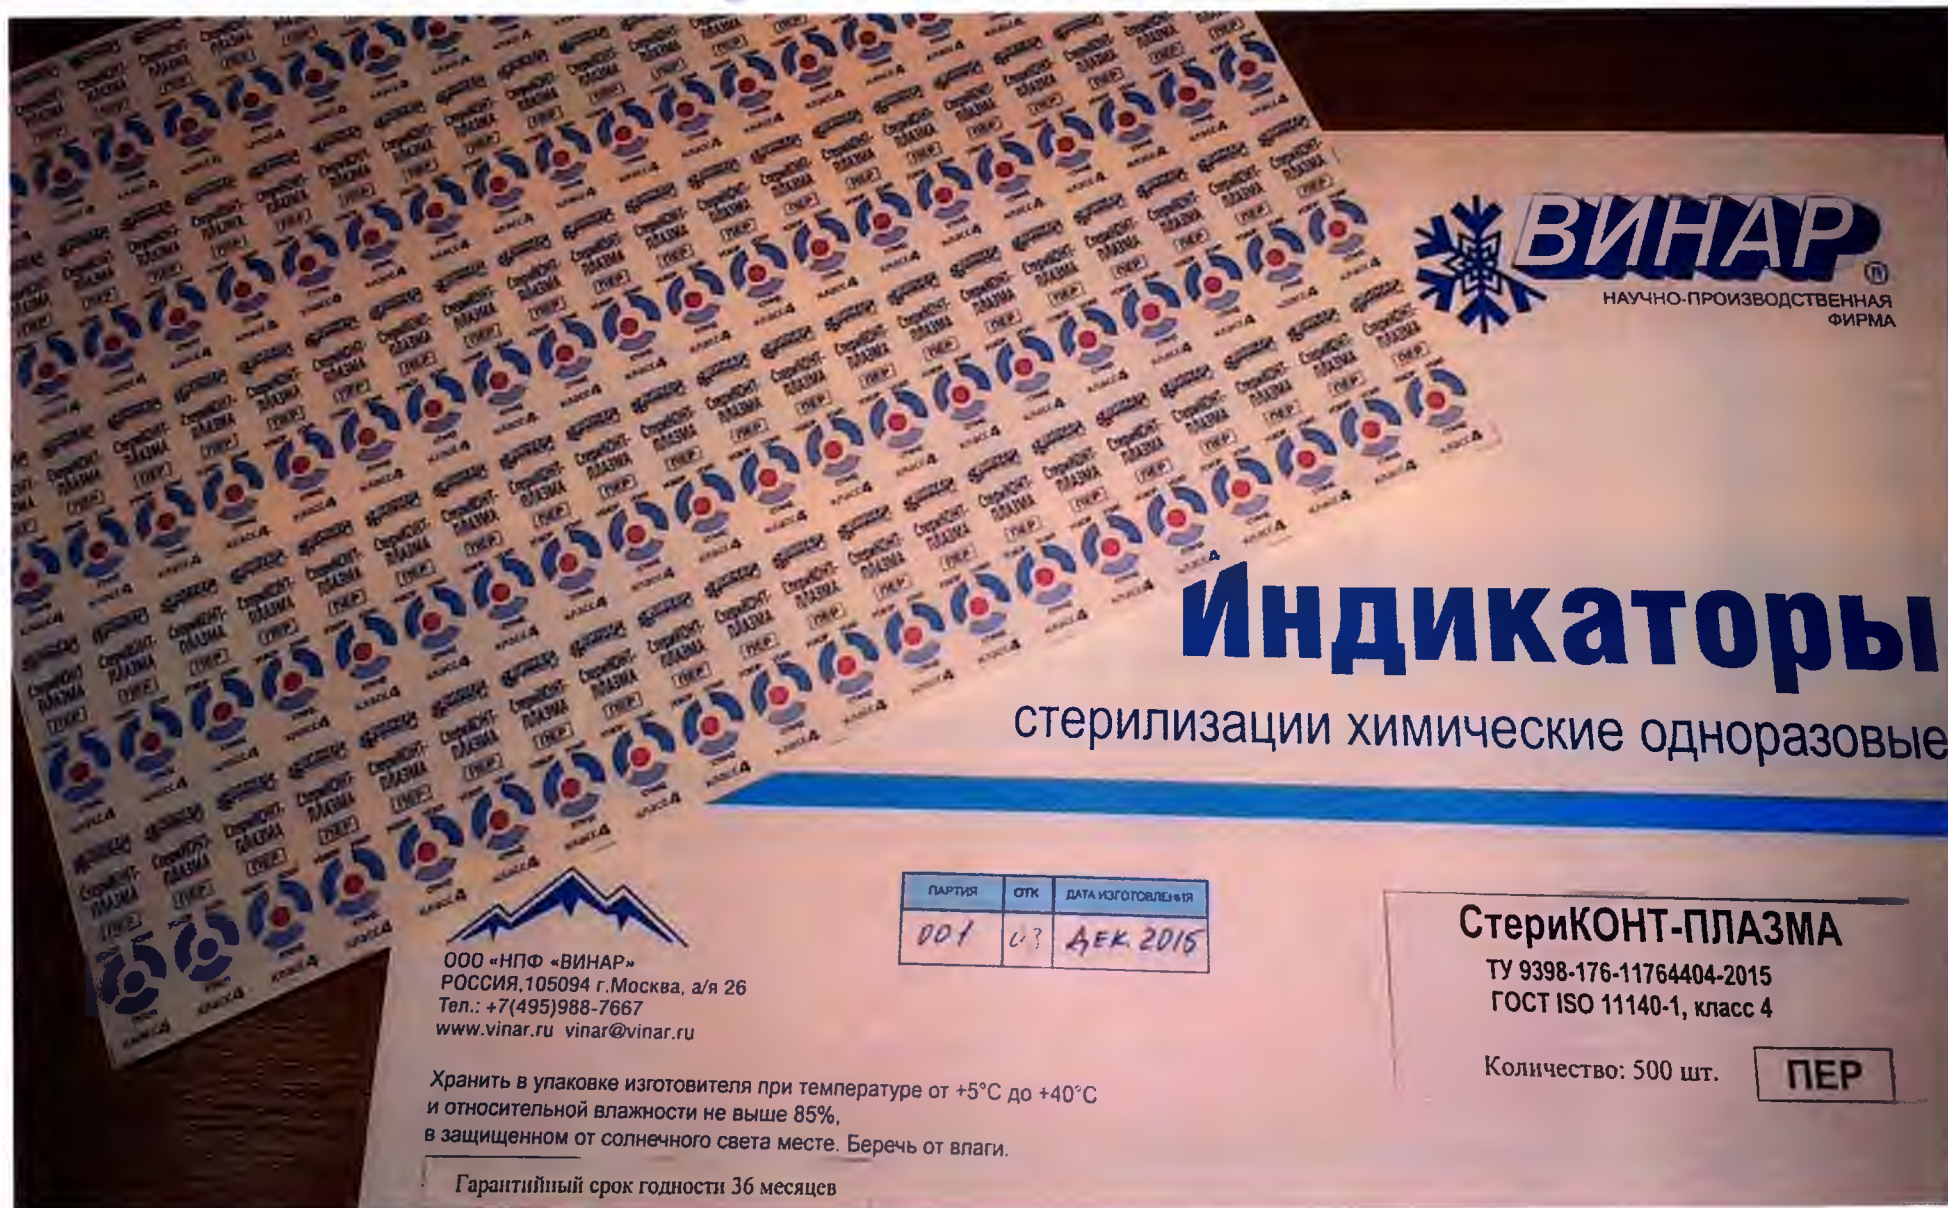

ВИНАР

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА

Индикаторы

стерилизации химические одноразовые

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
001	03	ДЕК 2015

ООО «НПФ «ВИНАР»
РОССИЯ, 105094 г. Москва, а/я 26
Тел.: +7(495)988-7667
www.vinar.ru vinar@vinar.ru

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от +5°C до +40°C
и относительной влажности не выше 85%,
в защищенном от солнечного света месте. Беречь от влаги.

Гарантийный срок годности 36 месяцев

СтериКОНТ-ПЛАЗМА

ТУ 9398-176-11764404-2015
ГОСТ ISO 11140-1, класс 4

Количество: 500 шт.

ПЕР

Внешний вид индикаторов стерилизации парами перекиси водорода химических одноразовых

СтериКОНТ-ПЛАЗМА



Внешний вид индикаторов стерилизации парами перекиси водорода химических одноразовых

ИНТЕСТ-ПЛАЗМА



Индикаторы

стерилизации химические одноразовые

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИСХОДОВАНИЯ
001	03	ДЕК 2015

ИНТЕСТ-ПЛАЗМА-1
ТУ 9398-176-11764404-2015
ГОСТ ISO 11140-1, класс 4, класс 5

Количество: 500 шт. **ПЕР**


ООО «НПФ «ВИНАР»
РОССИЯ, 105094 г. Москва, а/я 26
Тел.: +7(495)988-7667
www.vinar.ru vinar@vinar.ru

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от +5°C до +40°C
и относительной влажности не выше 85%,
в защищенном от солнечного света месте. Беречь от влаги.

Гарантийный срок годности 36 месяцев

Внешний вид индикаторов стерилизации парами перекиси водорода химических одноразовых

ИНТЕСТ-ПЛАЗМА-1

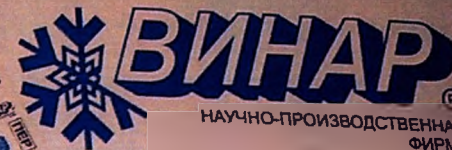

Индикаторы

стерилизации химические одноразовые

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
001	03	ДЕК 2015

ИНТЕСТ-ПЛАЗМА-2

ТУ 9398-176-11764404-2015
ГОСТ ISO 11140-1, класс 4, класс 5

Количество: 500 шт.

ПЕР

ООО «НПФ «ВИНАР»
РОССИЯ, 105094 г. Москва, а/я 26
Тел.: +7(495)988-7667
www.vinar.ru vinar@vinar.ru

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от +5°C до +40°C
и относительной влажности не выше 85%,
в защищенном от солнечного света месте. Беречь от влаги.

Гарантийный срок годности 36 месяцев

Внешний вид индикаторов стерилизации парами перекиси водорода химических одноразовых

ИНТЕСТ-ПЛАЗМА-2



ВИНАР

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

Индикаторы

стерилизации химические одноразовые

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
001	03	ДЕК 2015

ИНТЕСТ-ПЛАЗМА-3

ТУ 9398-176-11764404-2015
ГОСТ ISO 11140-1, класс 4, класс 5

Количество: 500 шт.

ПЕР

ООО «НПФ «ВИНАР»
РОССИЯ, 105094 г. Москва, а/я 26
Тел.: +7(495)988-7667
www.vinar.ru vinar@vinar.ru

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от +5°C до +40°C
и относительной влажности не выше 85%,
в защищенном от солнечного света месте. Беречь от влаги.

Гарантийный срок годности 36 месяцев

Внешний вид индикаторов стерилизации парами перекиси водорода химических одноразовых

ИНТЕСТ-ПЛАЗМА-3



ВИНАР®
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА

Индикаторы

химические одноразовые



ООО «НПФ «ВИНАР»
РОССИЯ, 105094 г. Москва, а/я 26
Тел.: +7(495)988-7667
www.vinar.ru vinar@vinar.ru

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от +5°C до +40°C
и относительной влажности не выше 85%,
в защищенном от солнечного света месте. Беречь от влаги.

Гарантийный срок годности 36 месяцев

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
5226	03	ИЮНЬ 2015

КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ ПАРОВОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

СанИС-3

(132 °C 90 мин, 134 °C 60 мин)

кол-во: **500 шт.**

ТУ 9398-176-11764404-2015

Внешний вид индикаторов химических для контроля процесса обеззараживания паровым методом одноразовых

СанИС-3

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 17 (семнадцать) листов

Генеральный директор
ООО «НПФ «ВИНАР» _____ Андреев В.С.

