

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Термо Фишер Сайентифик»



С.А.Лашков
«30» ноября 2018 г.

Фотографии медицинского изделия:

«Наконечники полимерные одноразовые к дозаторам пипеточным НП-«Термо Фишер Сайентифик» по ТУ 9398-004-33189998-2007»

производство: Акционерное общество «Термо Фишер Сайентифик», Россия, 196240, Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 73, корп. 1, литер А

Список фотографий медицинского изделия
«Наконечники полимерные одноразовые к дозаторам пипеточным НП-«Термо
Фишер Сайентифик» по ТУ 9398-004-33189998-2007»:

Рис 1. - Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП-«Термо Фишер Сайентифик» для одноканального дозатора на (0,2 – 10) мкл;

Рис 2. - Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП-«Термо Фишер Сайентифик» для одноканального дозатора на (5 – 200) мкл;

Рис 3. - Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП-«Термо Фишер Сайентифик» для одноканального дозатора на (5 – 300) мкл;

Рис 4. - Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП-«Термо Фишер Сайентифик» для одноканального дозатора на (0,5 – 250) мкл;

Рис 5. - Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП-«Термо Фишер Сайентифик» для одноканального дозатора на (100 – 1000) мкл;

Рис 6. - Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП-«Термо Фишер Сайентифик» для одноканального дозатора на (1–5) мл;

Рис 7. - Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП-«Термо Фишер Сайентифик» для одноканального дозатора на (0.5 – 5) мл;

Рис 8. - Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП-«Термо Фишер Сайентифик» для одноканального дозатора на (2 – 10) мл;

Рис 9. - Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП-«Термо Фишер Сайентифик» для одноканального дозатора на (1 – 10) мл;

Рис 10. - Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП-«Термо Фишер Сайентифик» для четырехканального дозатора на (0,5 – 300) мкл;

Рис 11. - Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП-«Термо Фишер Сайентифик» для девятиканального дозатора на (5 – 200) мкл;

Рис 12. - Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП-«Термо Фишер Сайентифик» для девятиканального дозатора на (200 – 1000) мкл.

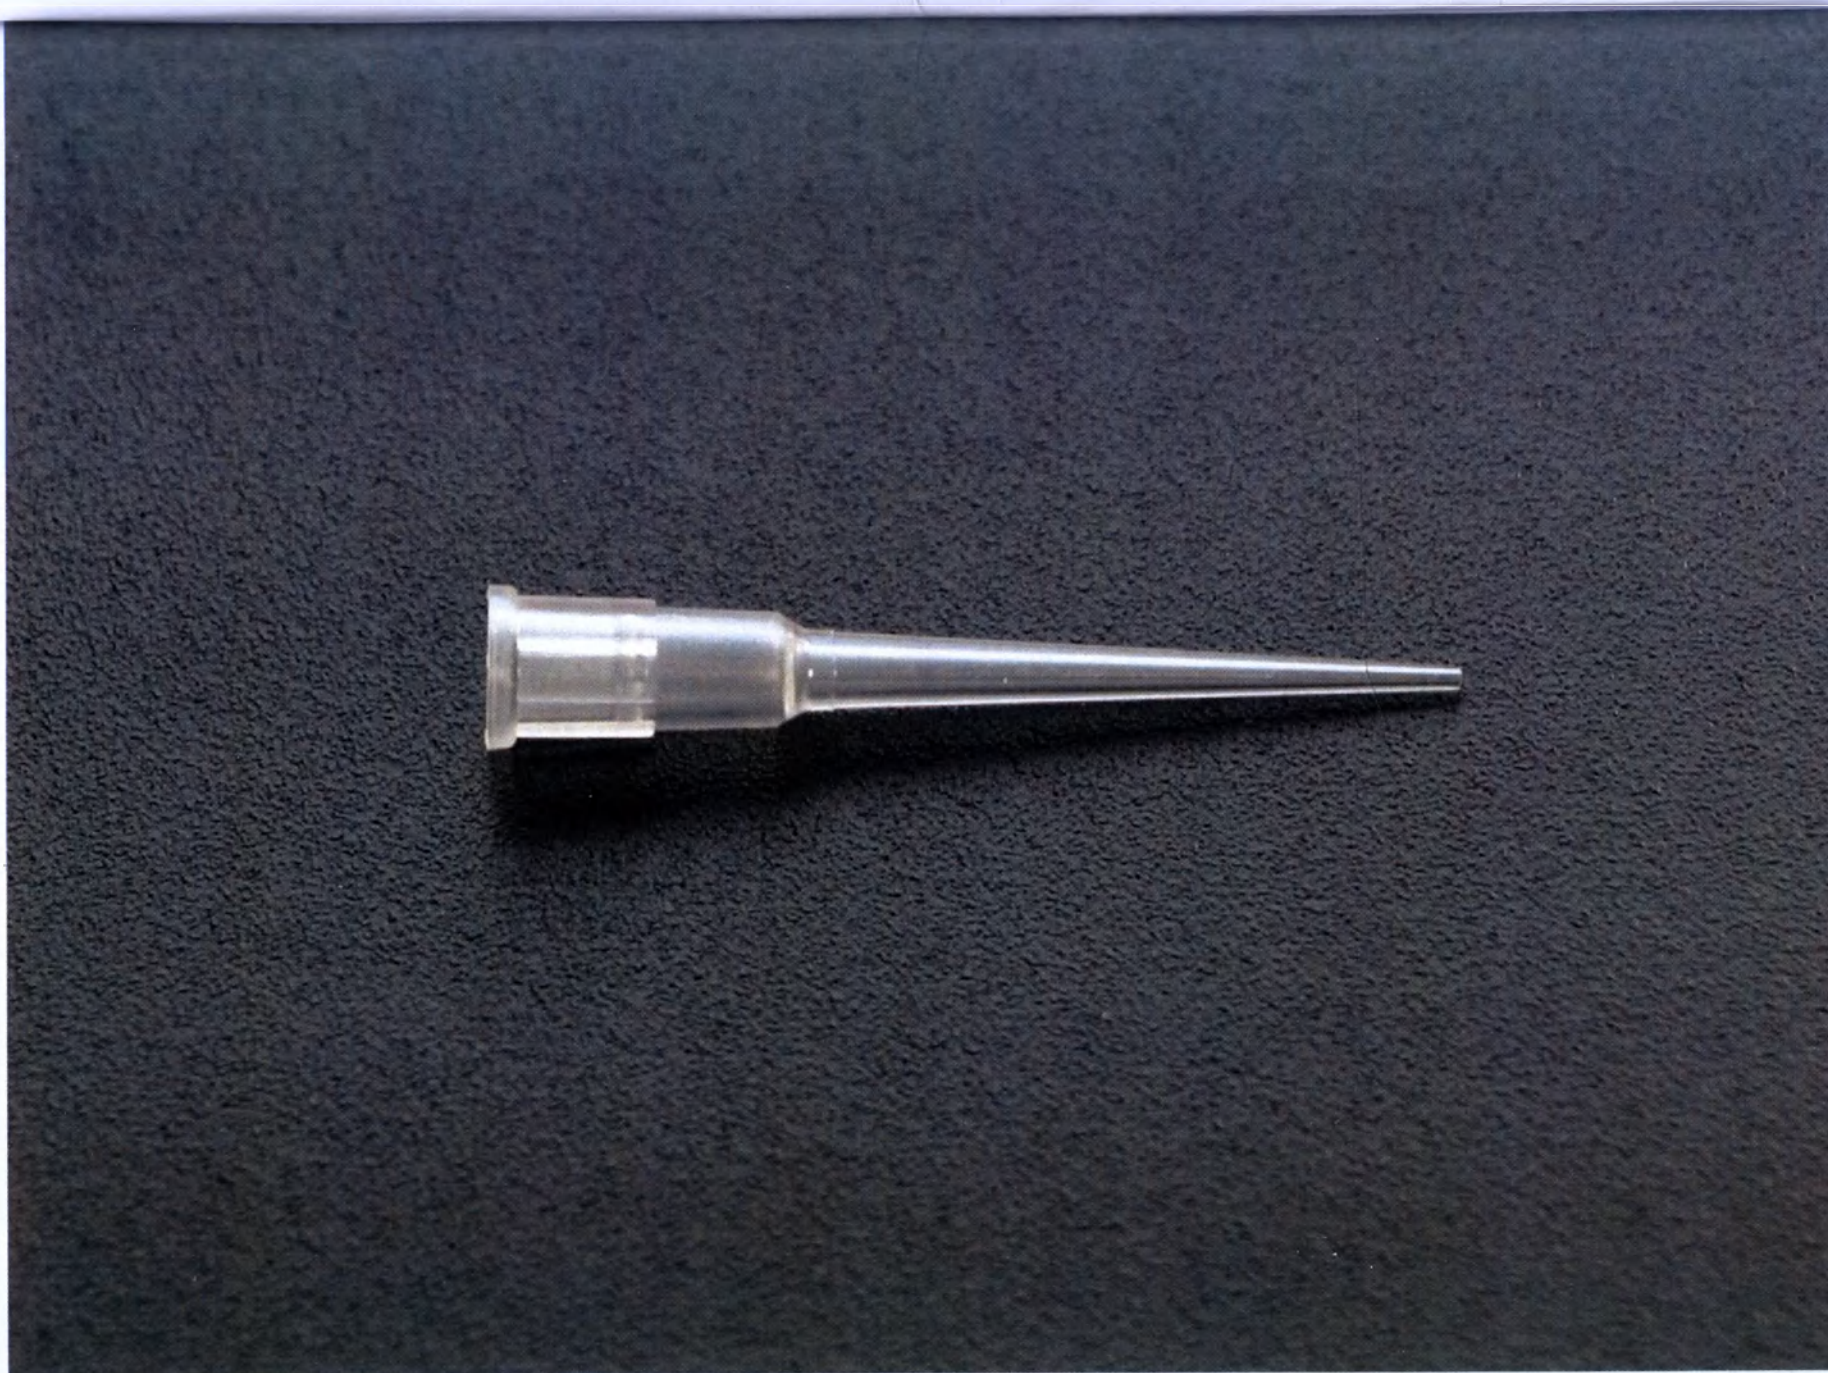


Рис 1. - Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП-«Термо Фишер Сайентифик» для одноканального дозатора на (0,2–10) мкл

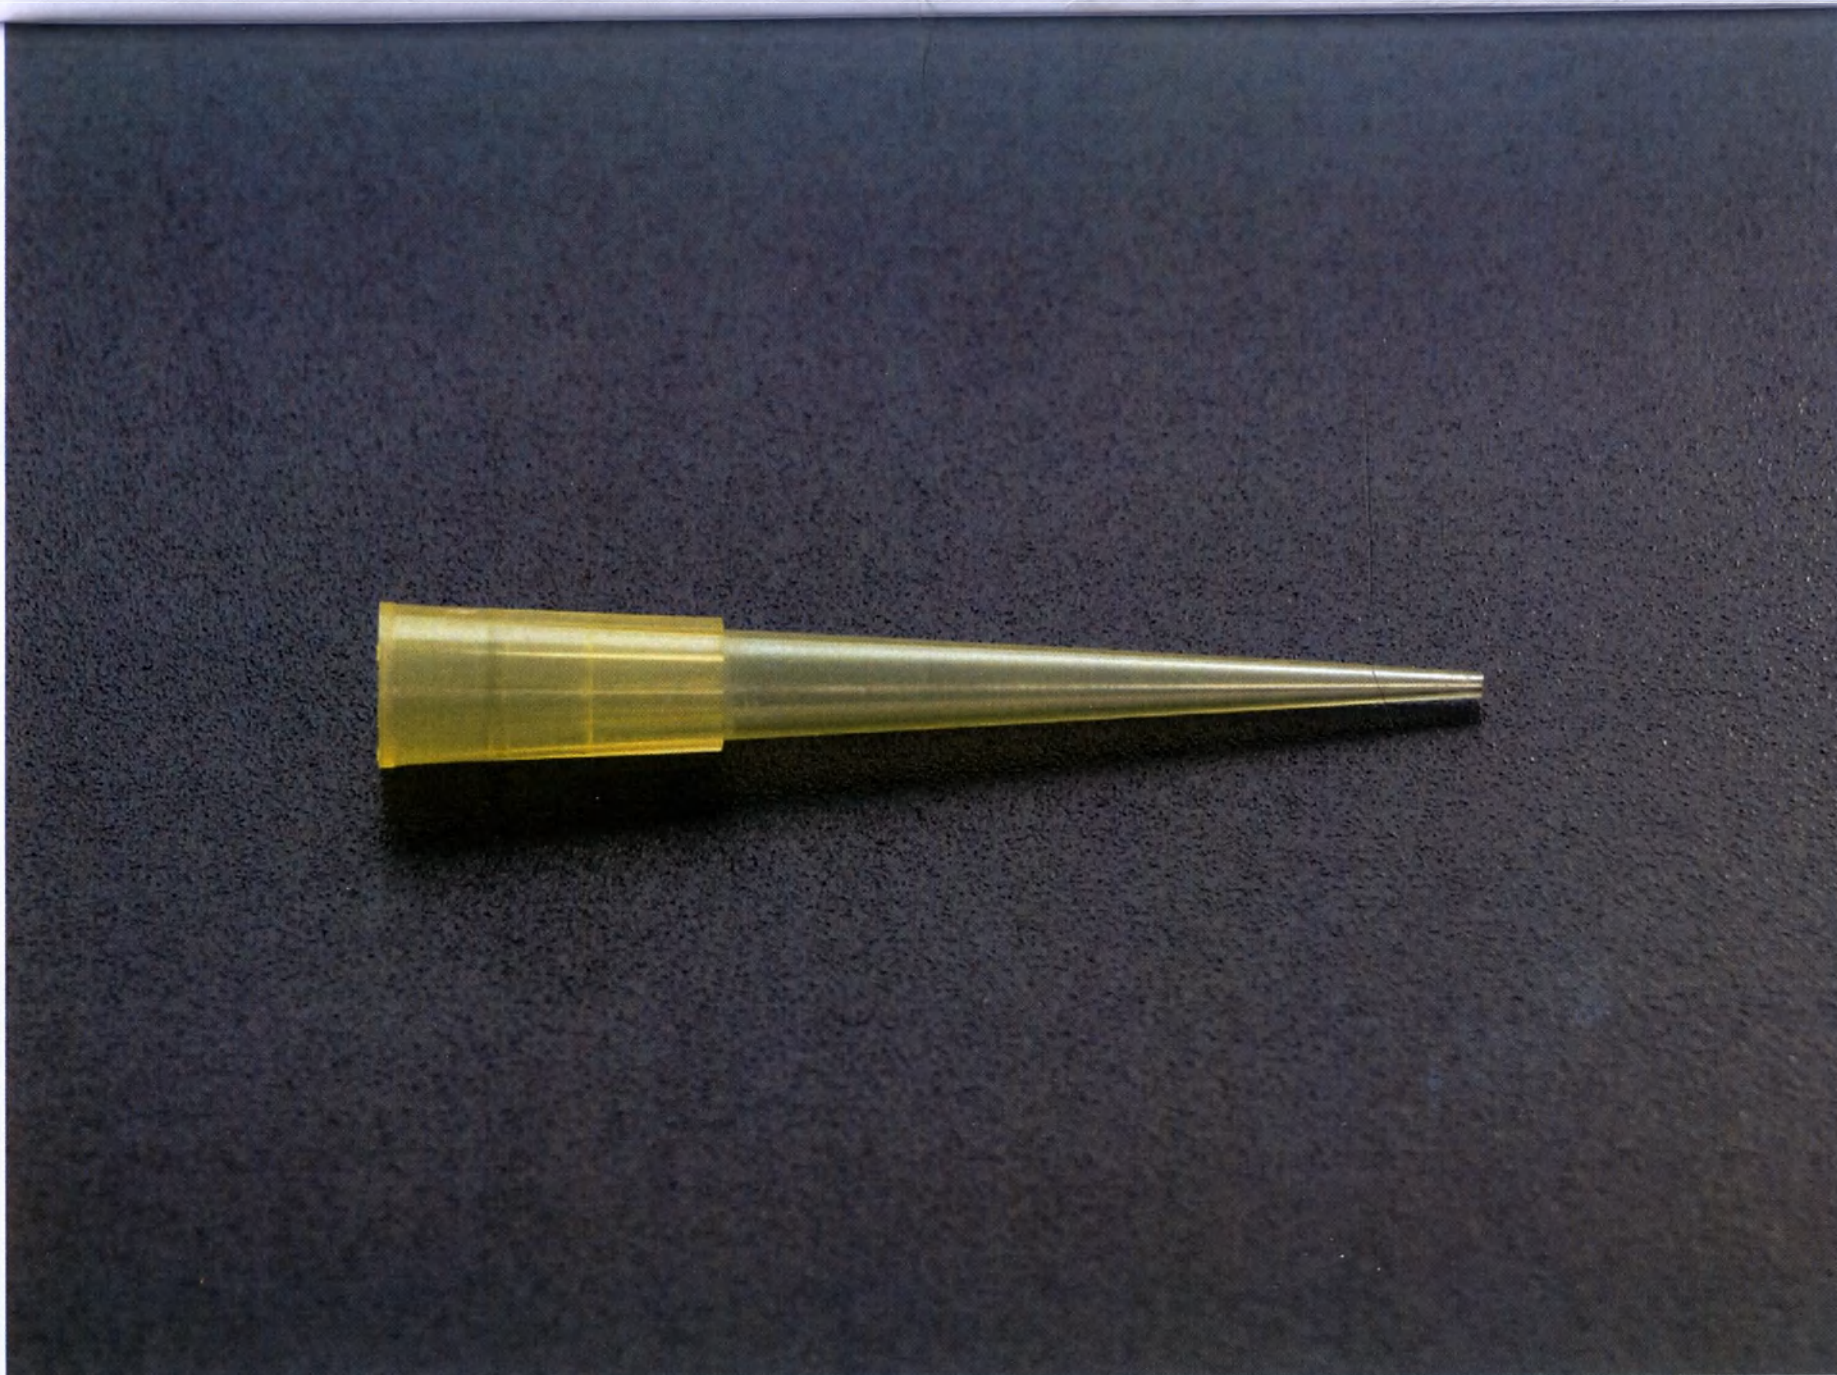


Рис 2. - Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП-«Термо Фишер Сайентифик» для одноканального дозатора на (5–200) мкл



Рис 3. - Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП-«Термо Фишер Сайентифик» для одноканального дозатора на (5–300) мкл



Рис 4. - Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП-«Термо Фишер Сайентифик» для одноканального дозатора на (0,5–250) мкл



Рис 5. - Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП-«Термо Фишер Сайентифик» для одноканального дозатора на (100–1000) мкл



Рис 6. - Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП- «Термо Фишер Сайентифик» для одноканального дозатора на (1–5) мл

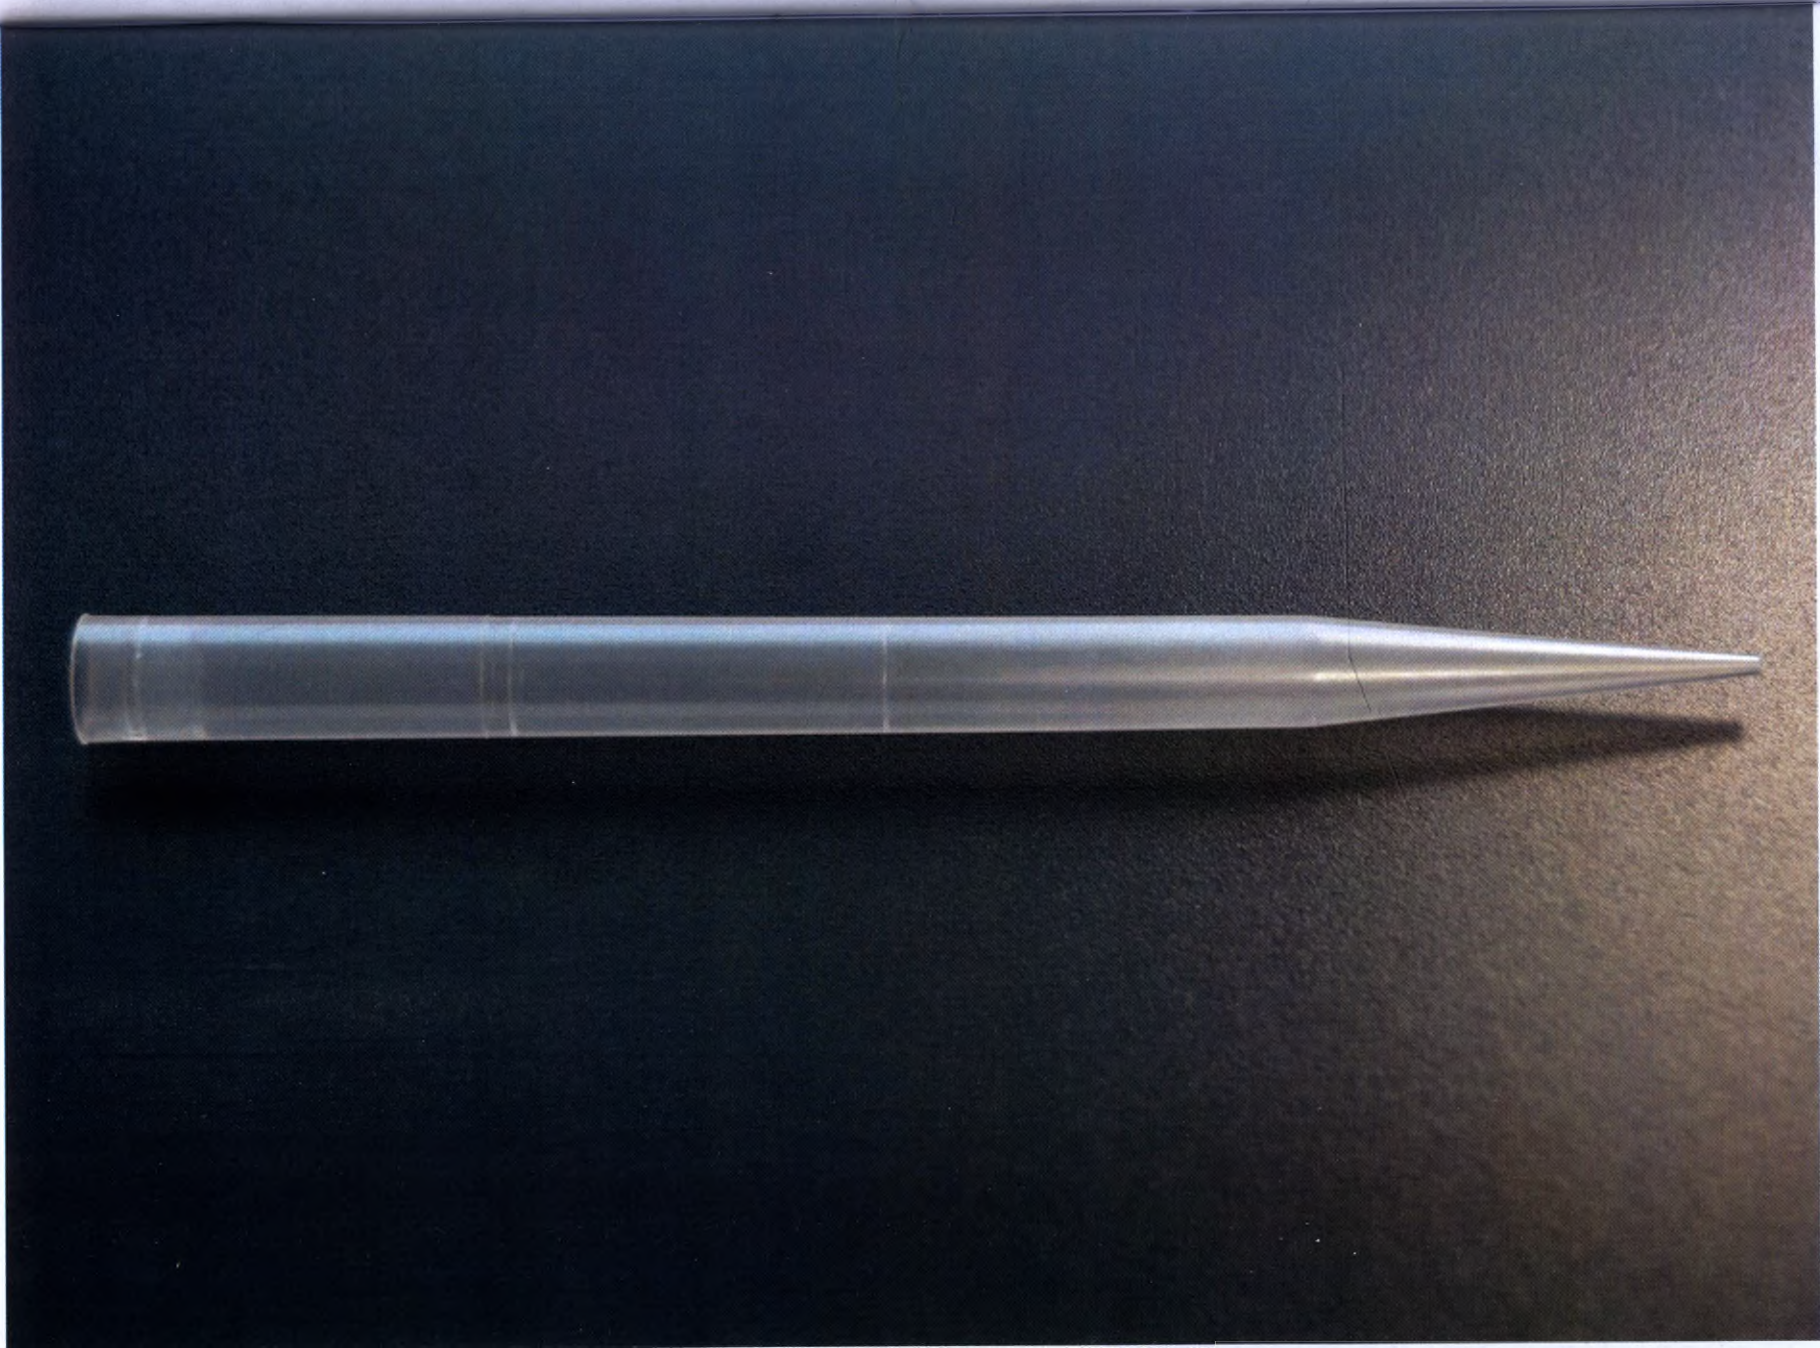


Рис 7. - Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП- «Термо Фишер Сайентифик» для одноканального дозатора на (0.5–5) мл

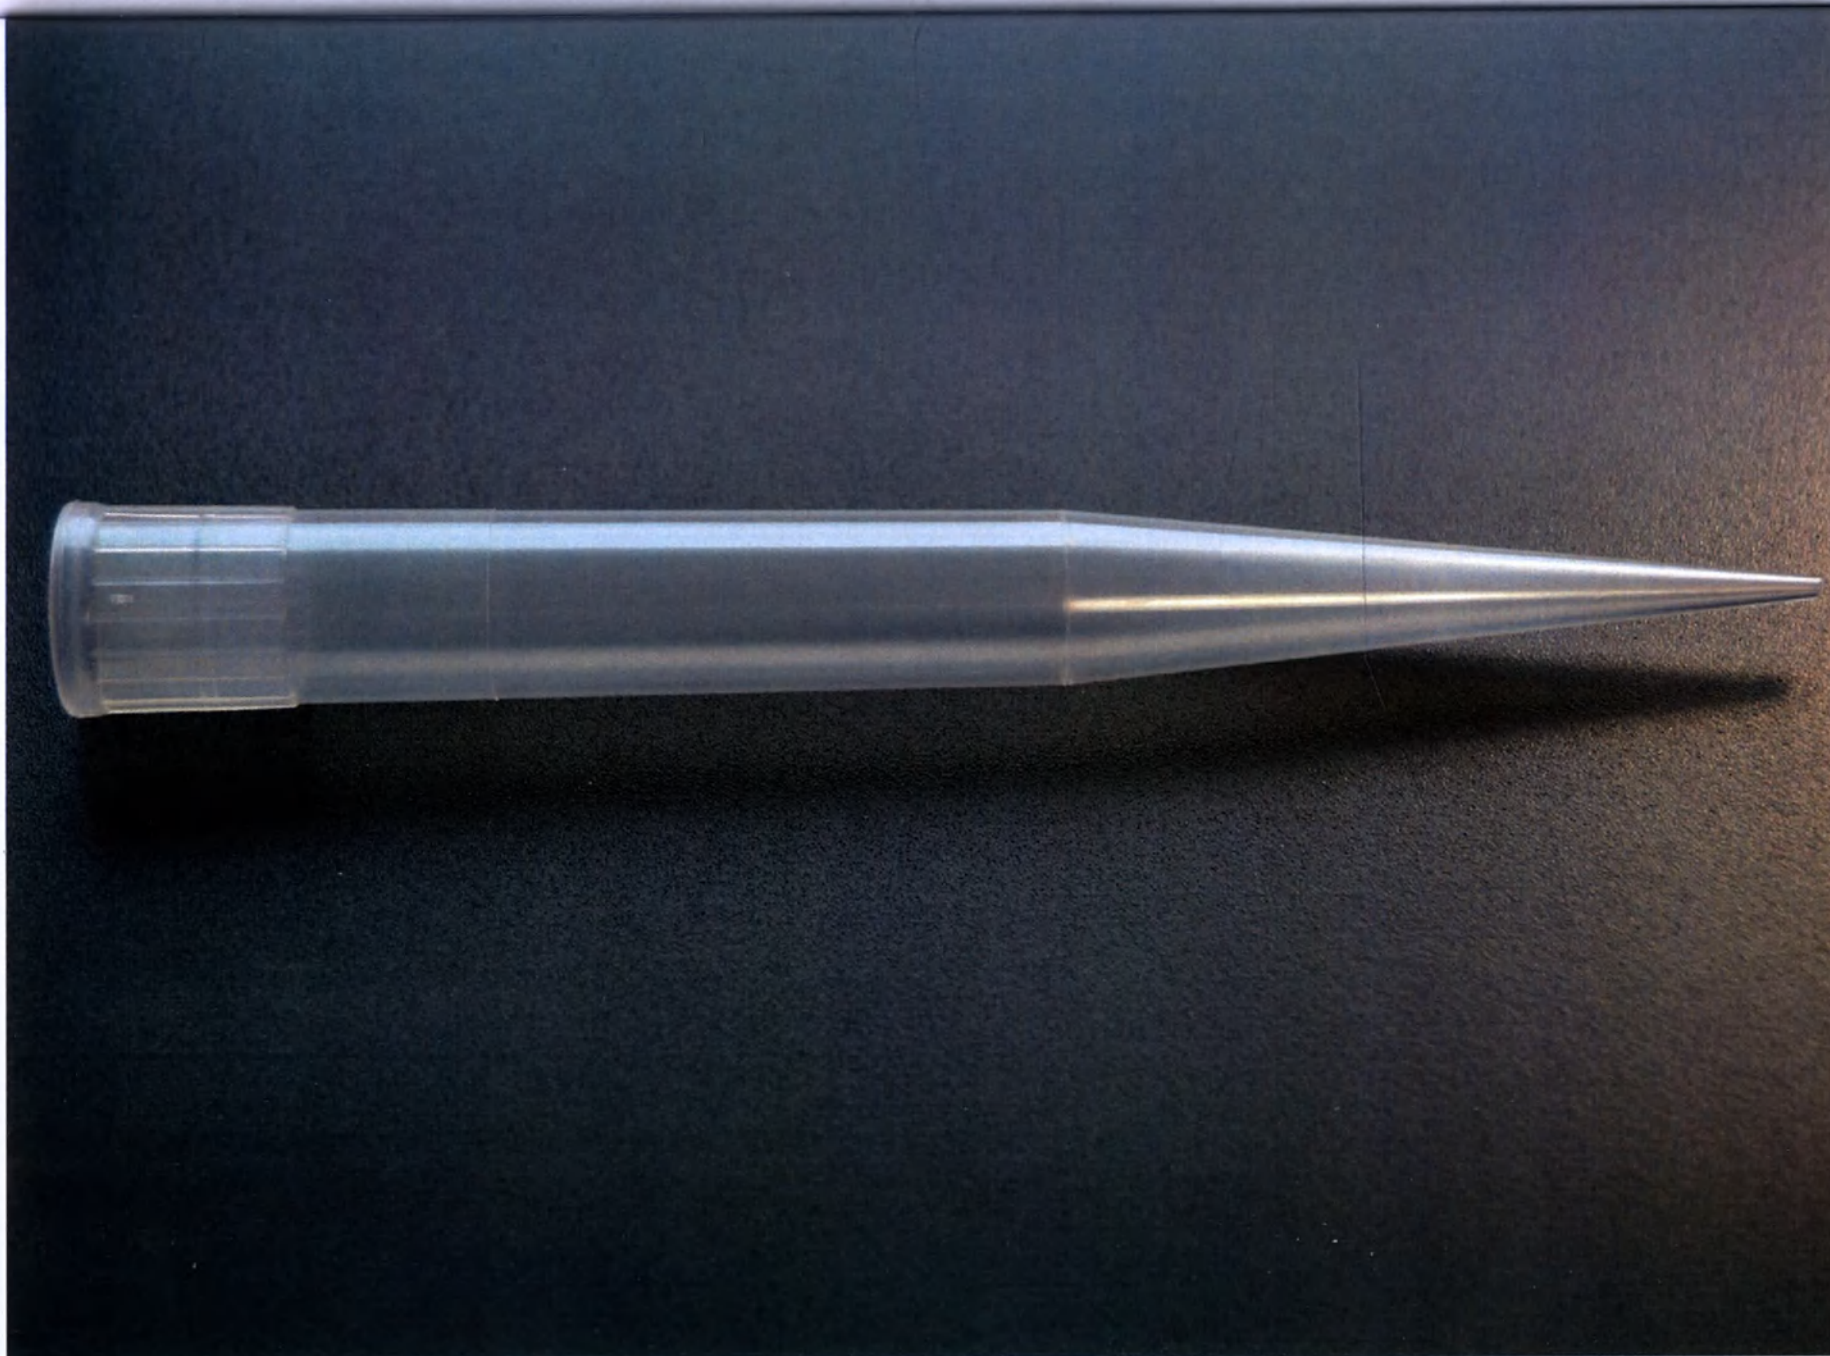


Рис 8. - Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП- «Термо Фишер Сайентифик» для одноканального дозатора на (2–10) мл

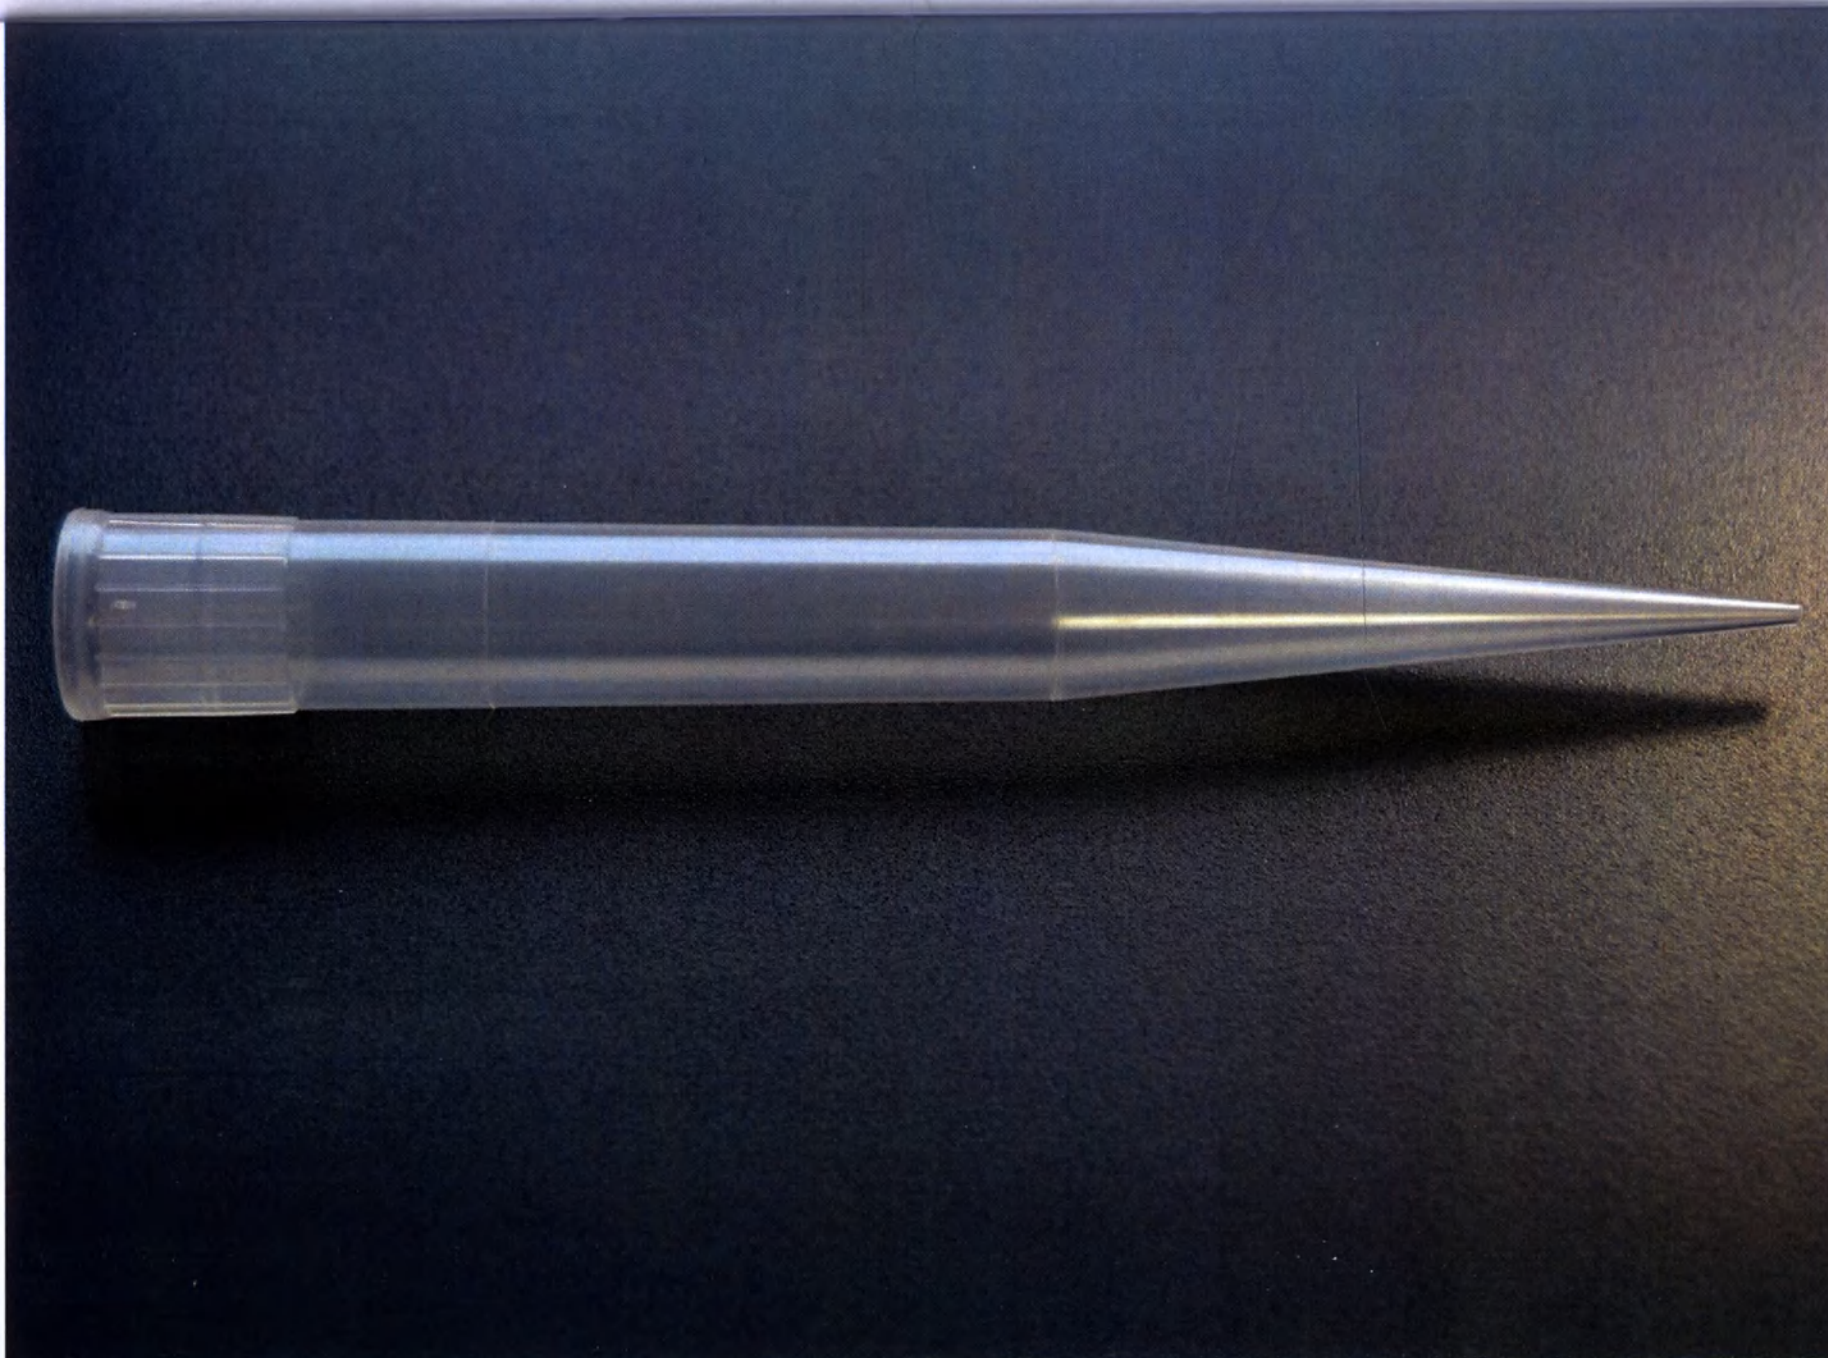


Рис 9. - Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП- «Термо Фишер Сайентифик» для одноканального дозатора на (1–10) мл



Рис 10. - Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП- «Термо Фишер Сайентифик» для четырехканального дозатора на (0,5–300) мкл

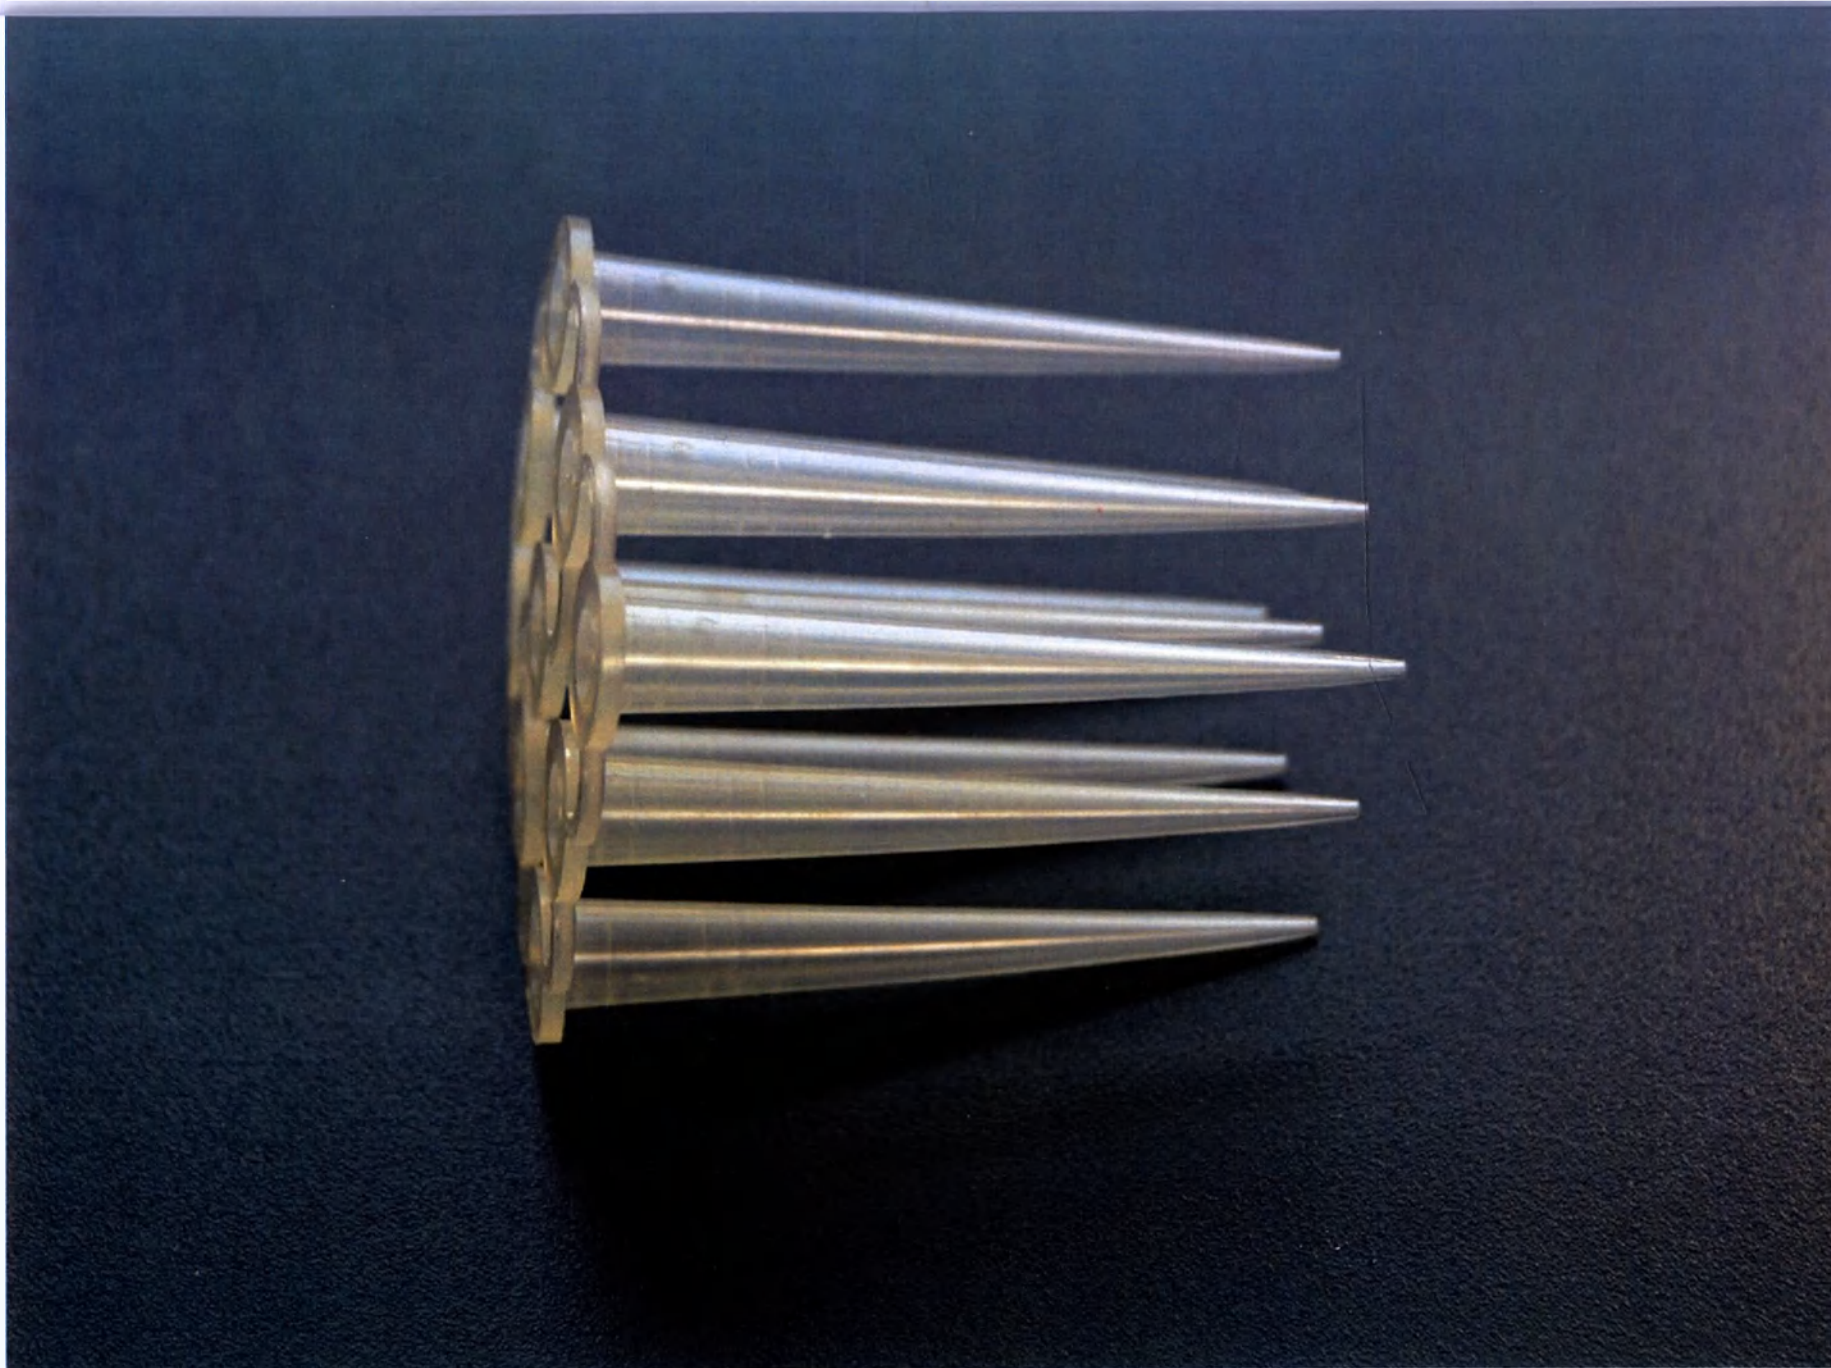


Рис 11. - Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП-«Термо Фишер Сайентифик» для девятиканального дозатора на (5–200) мкл

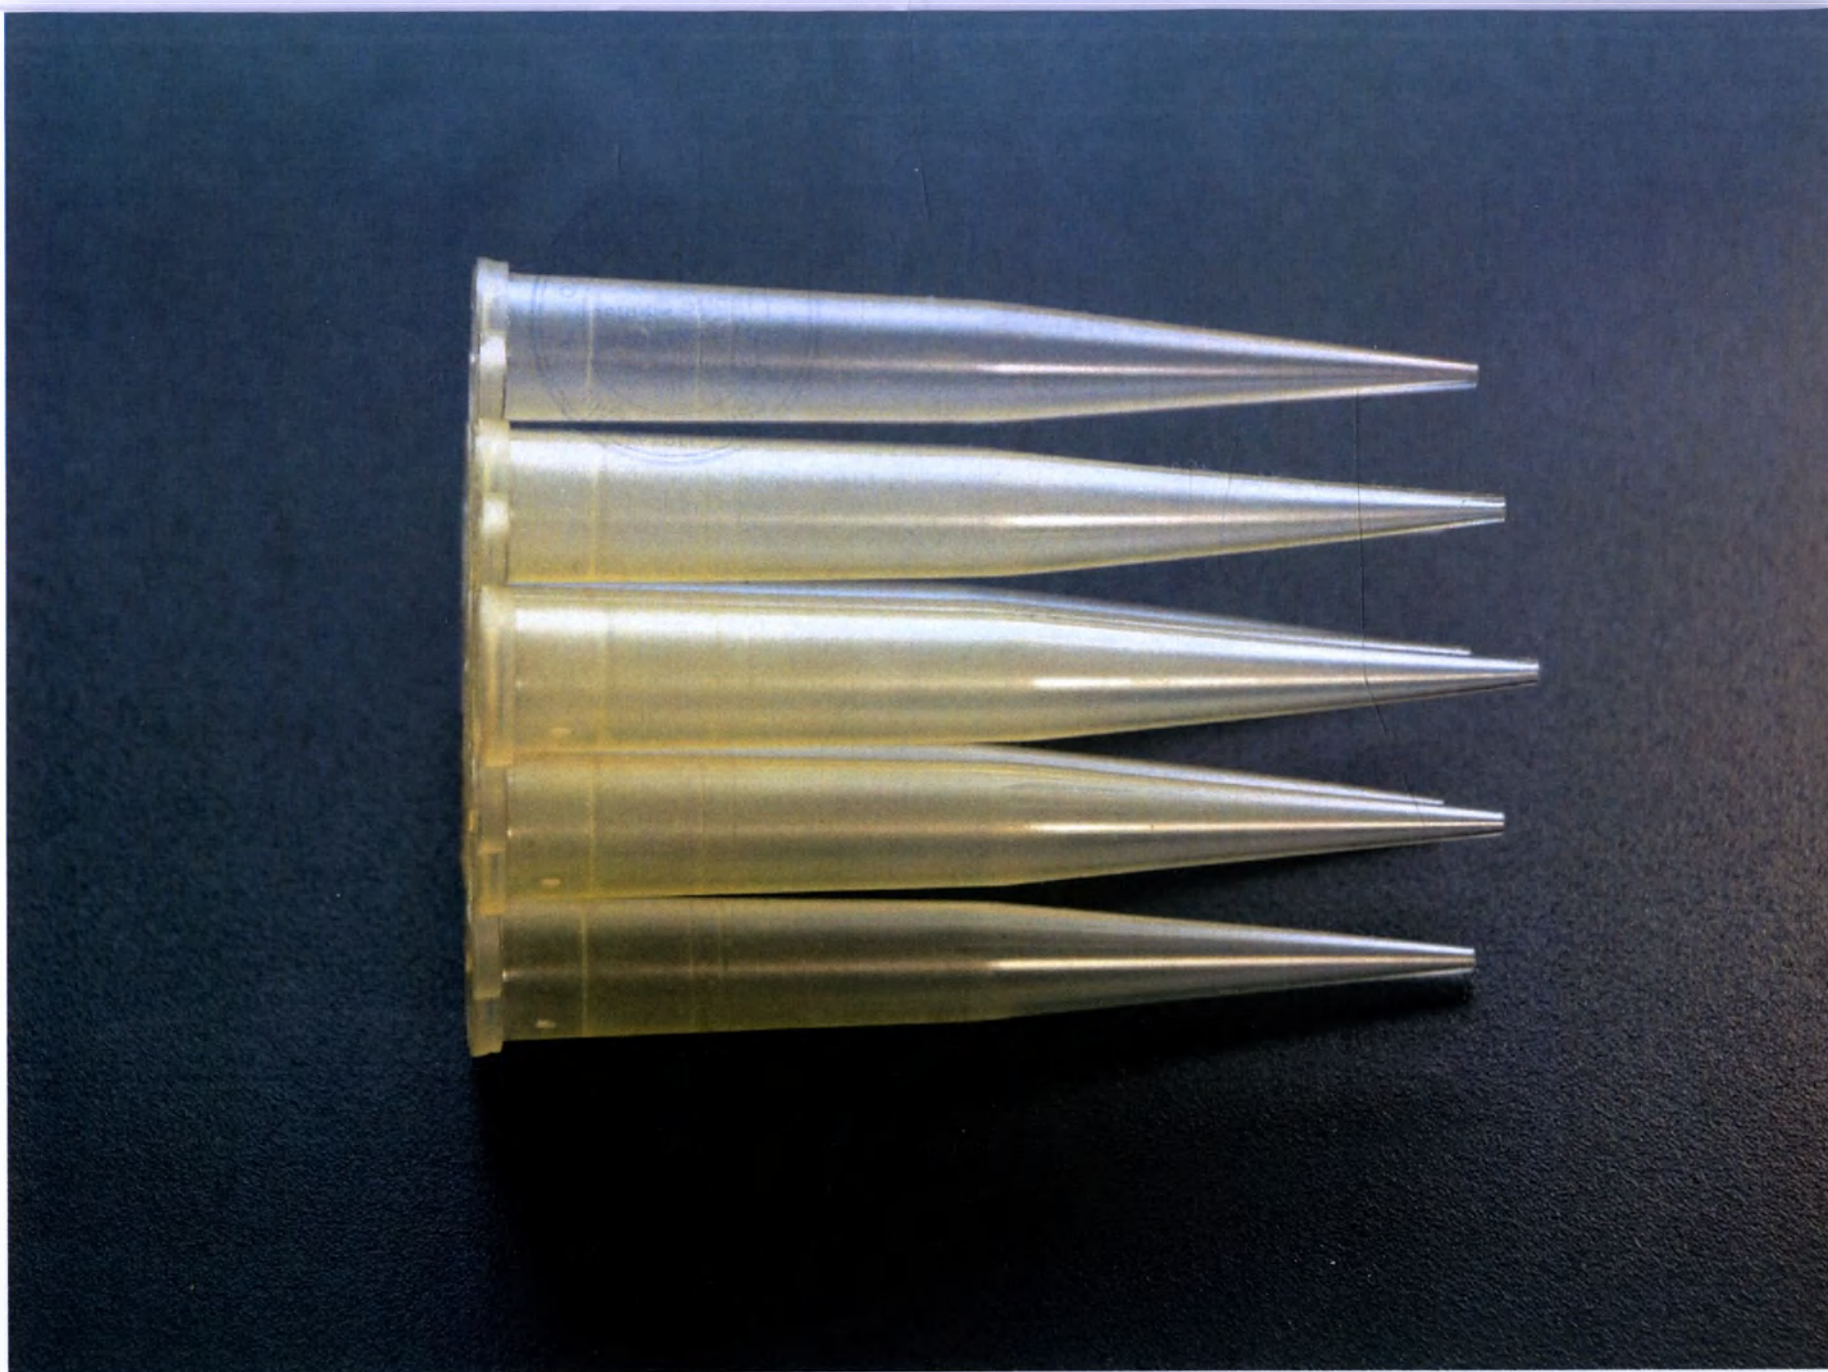


Рис 12. - Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП- «Термо Фишер Сайентифик» для девятиканального дозатора на (200–1000) мкл

Всего сброшюровано,
пронумеровано,
скреплено печатью

14/четырнадцать "Термо Фишер Сайентифик"

листов



Подпись