


Изгиб дистального конца	вверх	180°	180°
	вниз	180°	180°
	вправо	160°	160°
	влево	160°	160°
Диаметр дистального конца		11,5 мм	11,5 мм
Диаметр вводимой трубки		11,5 мм	11,5 мм
Диаметр инструментального канала		3,5 мм	3,5 мм
Рабочая Длина		700 мм	700 мм
Общая длина		1045 мм	1045 мм

II-2-5.

Общий вид фиброскопа для исследования желудочно-кишечного тракта:

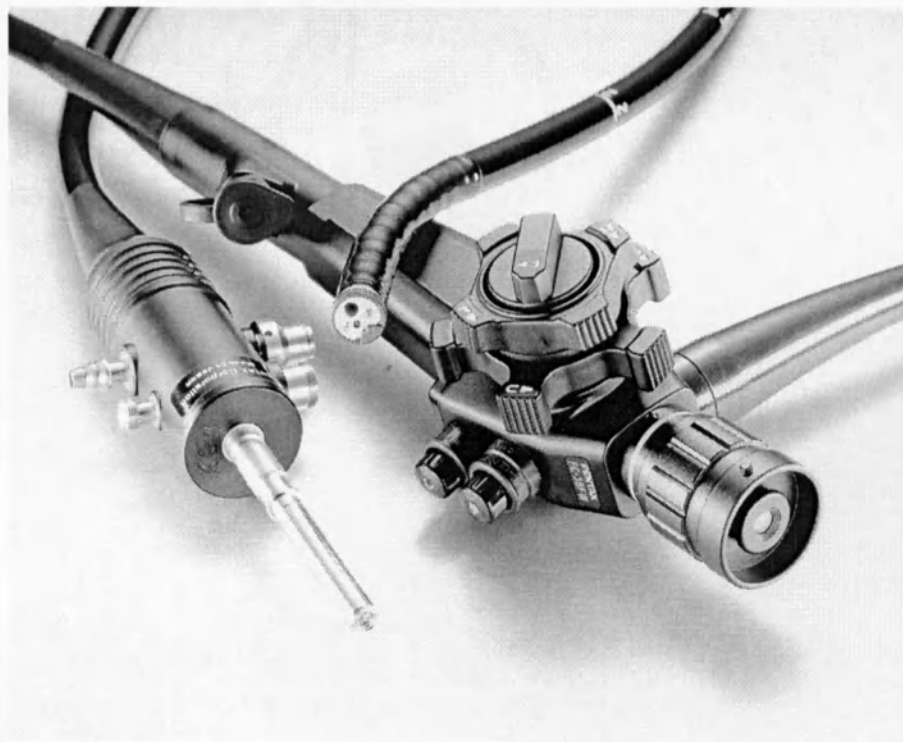

III. Принцип действия изделия:

Обеспечение визуализации осматриваемой поверхности внутренних органов, относящихся к желудочно-кишечному тракту, за счет фокусировки света в объективе на дистальном конце с одной стороны пучка фиброволокна и передачи изображения по пучку фиброволокна на другую сторону - к окуляру.