

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ХЕЛСИ ВОРЛД»


Р.И. Махмудов

2016 г.



Фотографии изделия медицинского назначения


Аппарат нейромышечной реабилитации и диагностики HUBER 360 MD

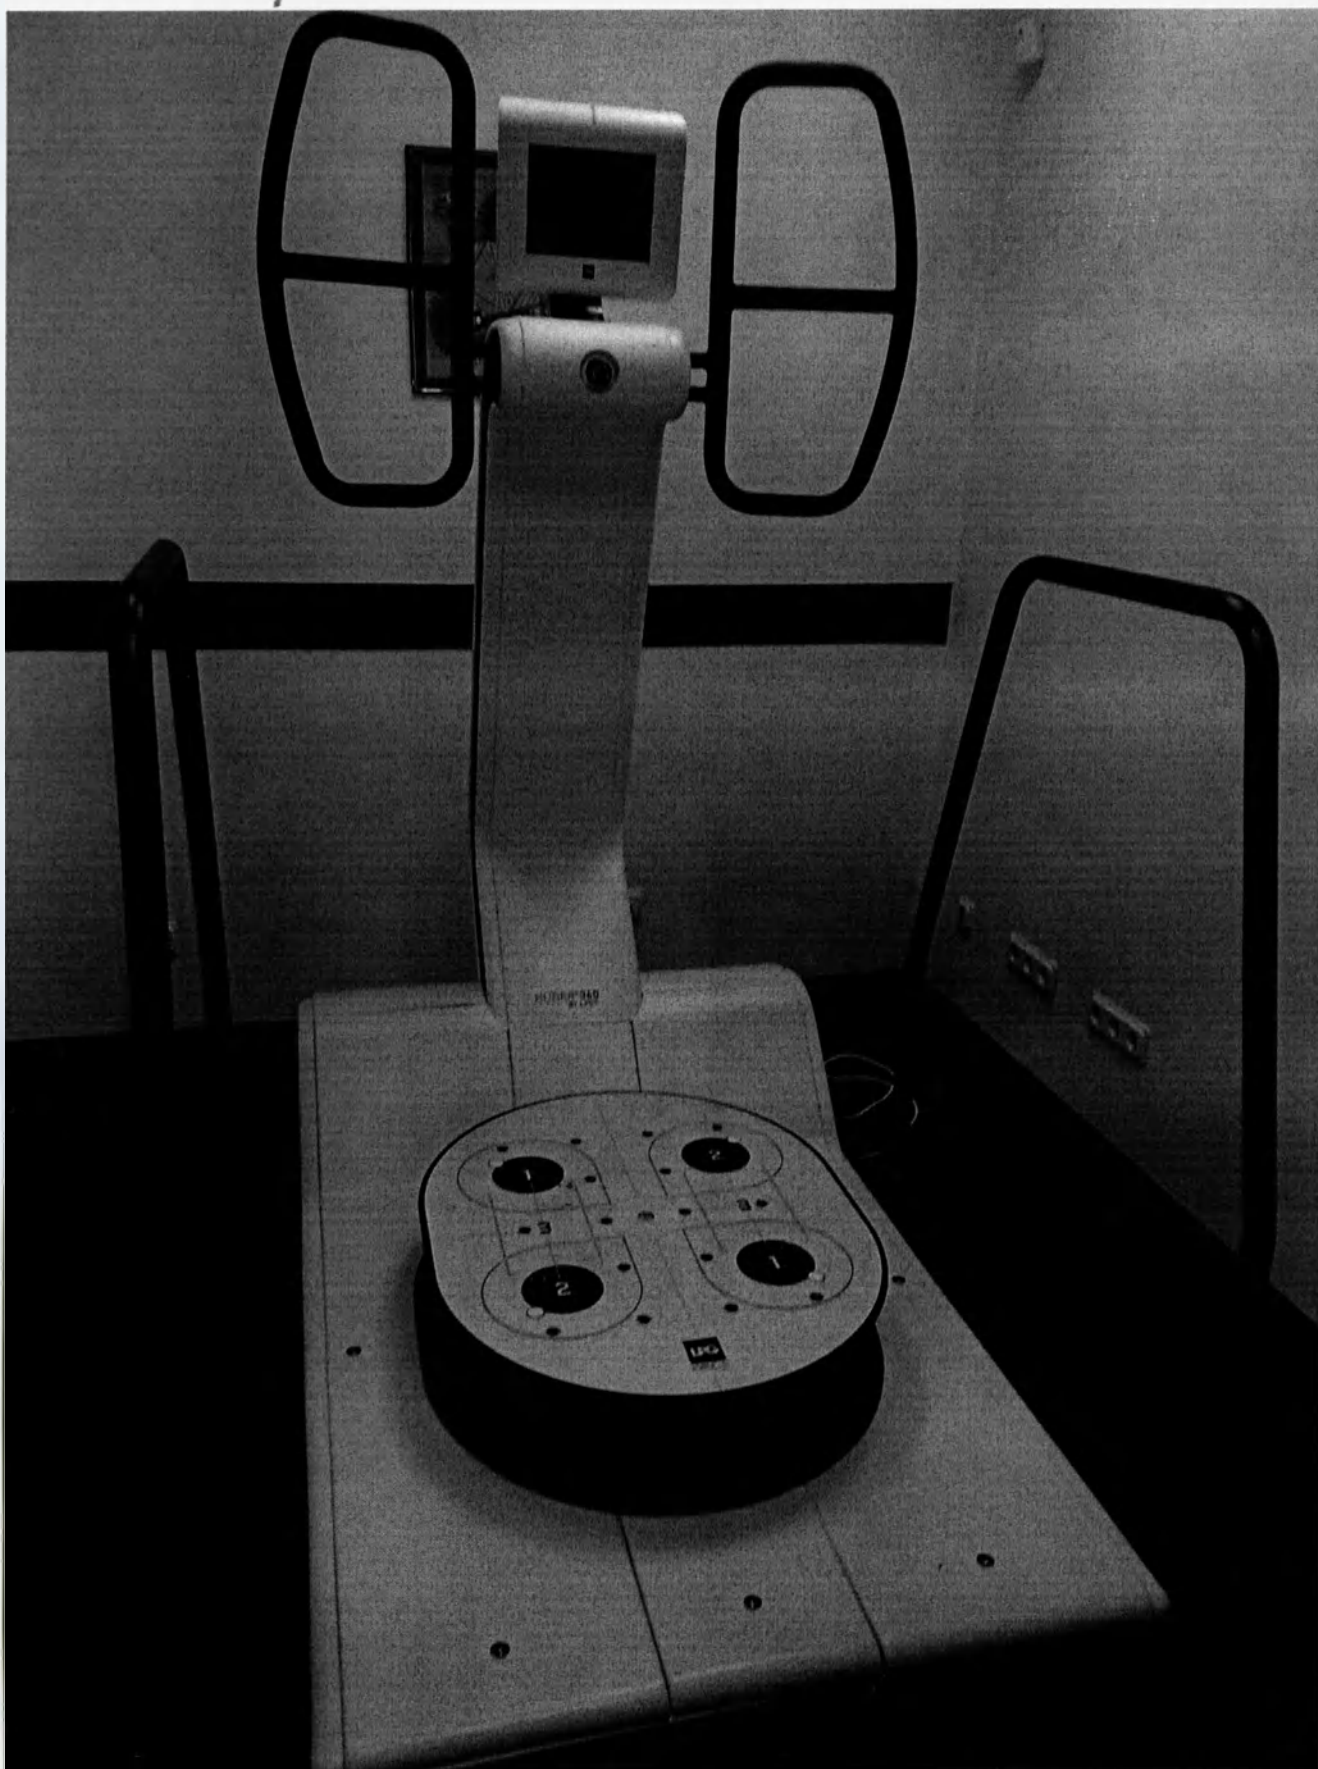


Аппарат нейромышечной реабилитации и диагностики HUBER 360 MD с защитными перилами

	Технопарк де ла Плэн, 30, улица Доктор Абель, СС 90035, 26902 Валанс, Седекс 09 Франция	
Аппарат нейромышечной реабилитации и диагностики HUBER 360 MD		
	09.2015 S/N: 45176	IP20
~ 220 В 50 Гц	Потребляемая мощность ВА: 1800	


Маркировка аппарата нейромышечной реабилитации и диагностики HUBER 360 MD

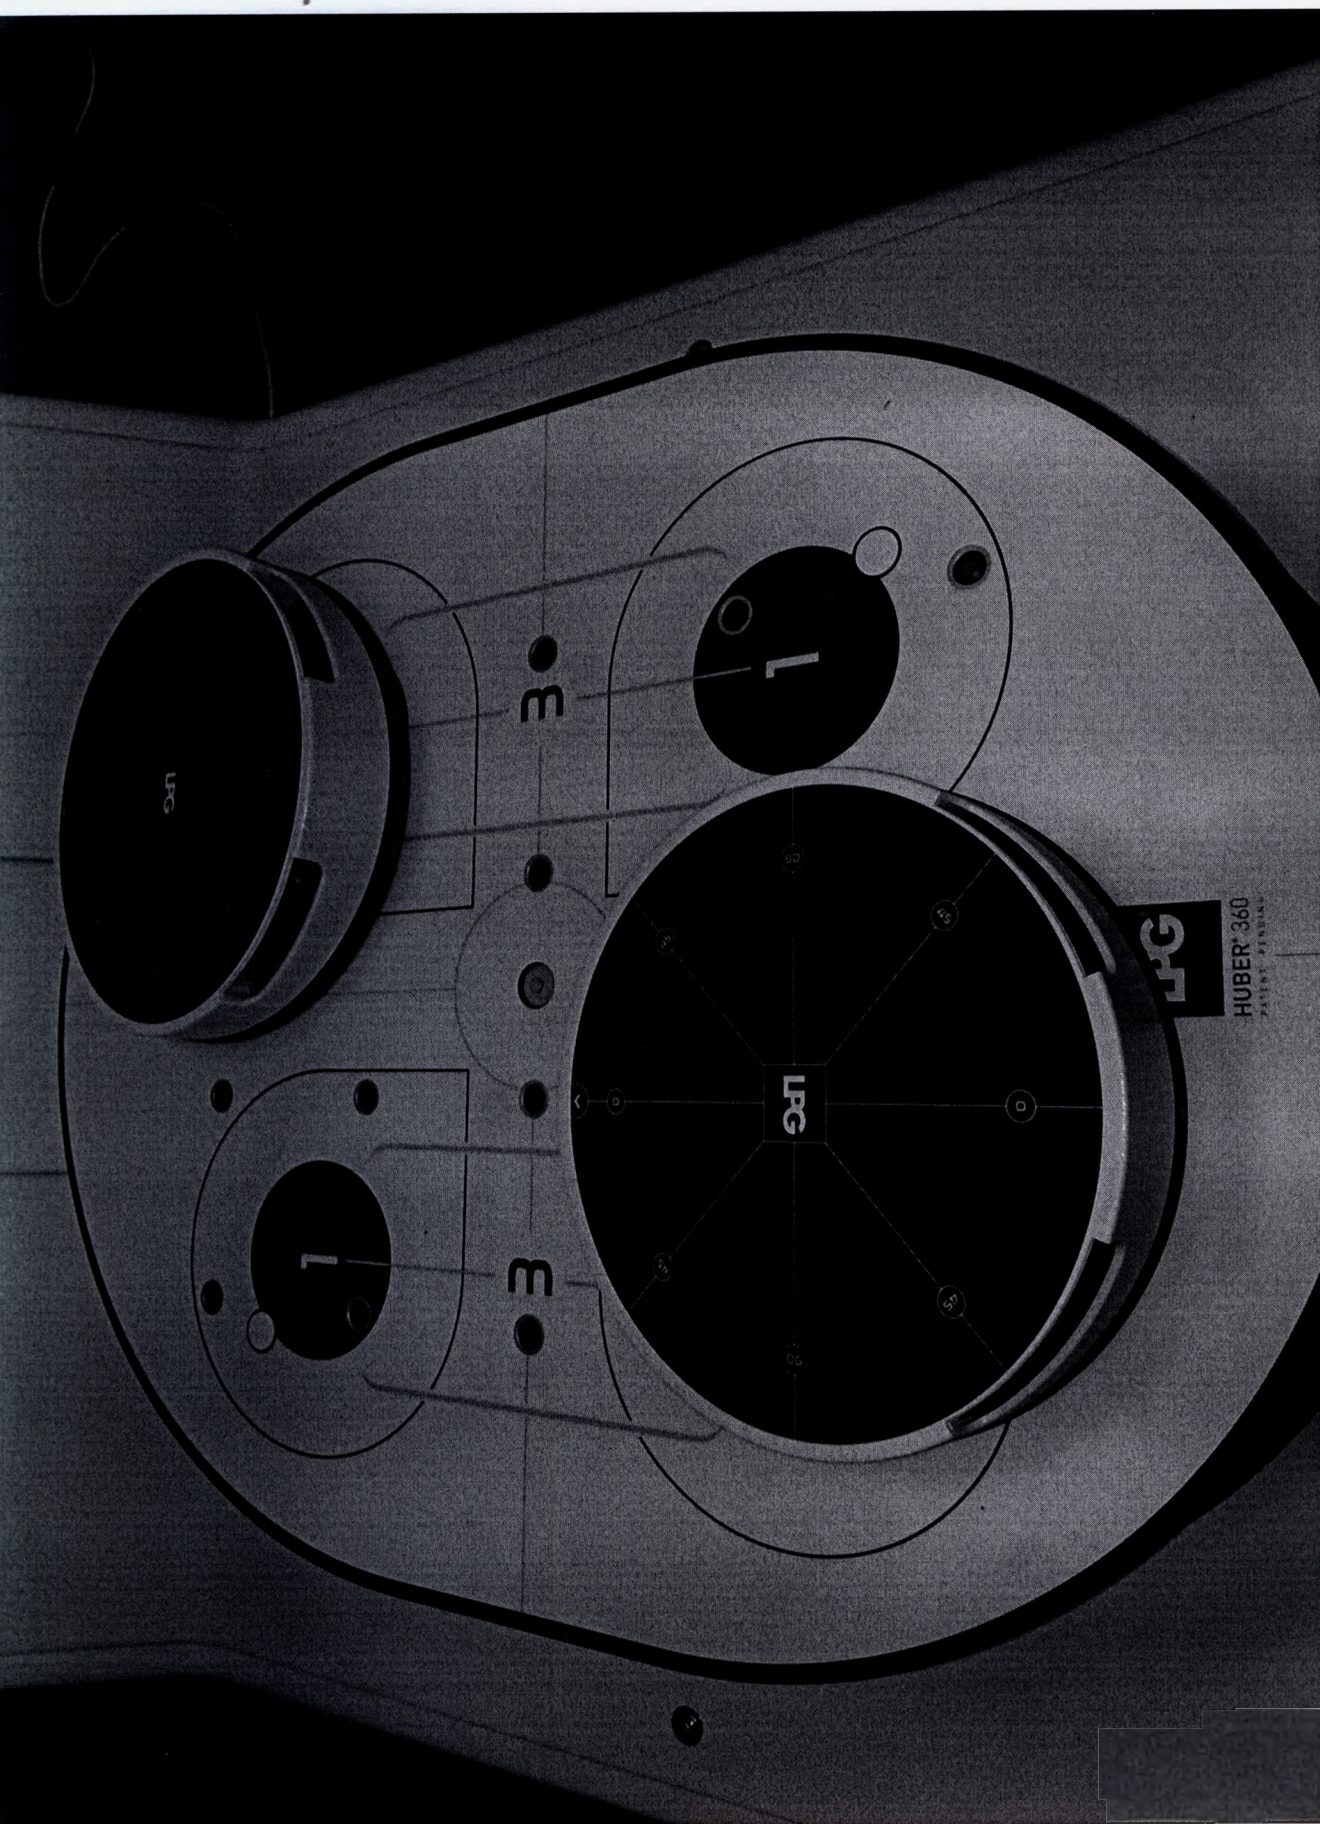

Подкладки для ног

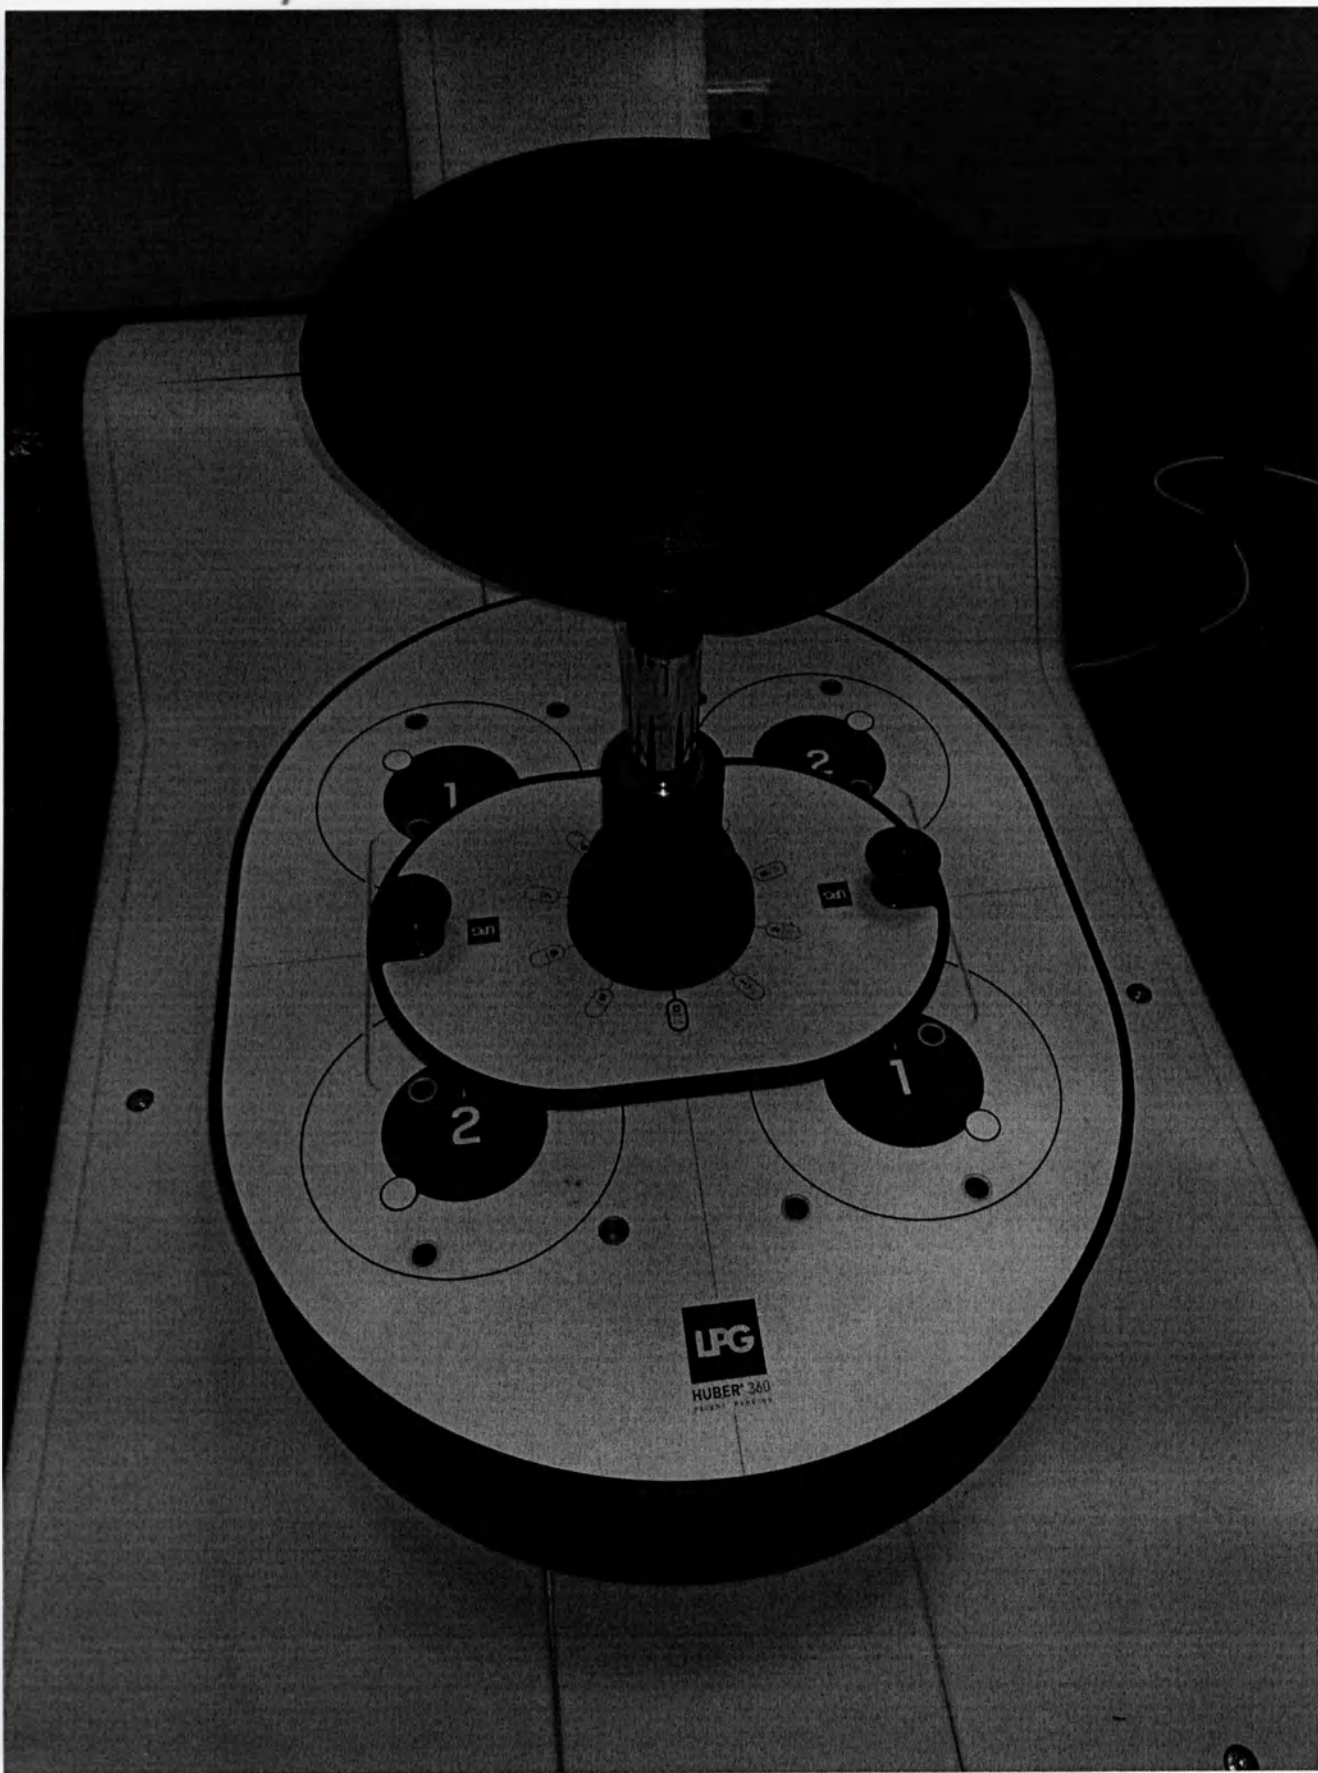


Шарнирный стул

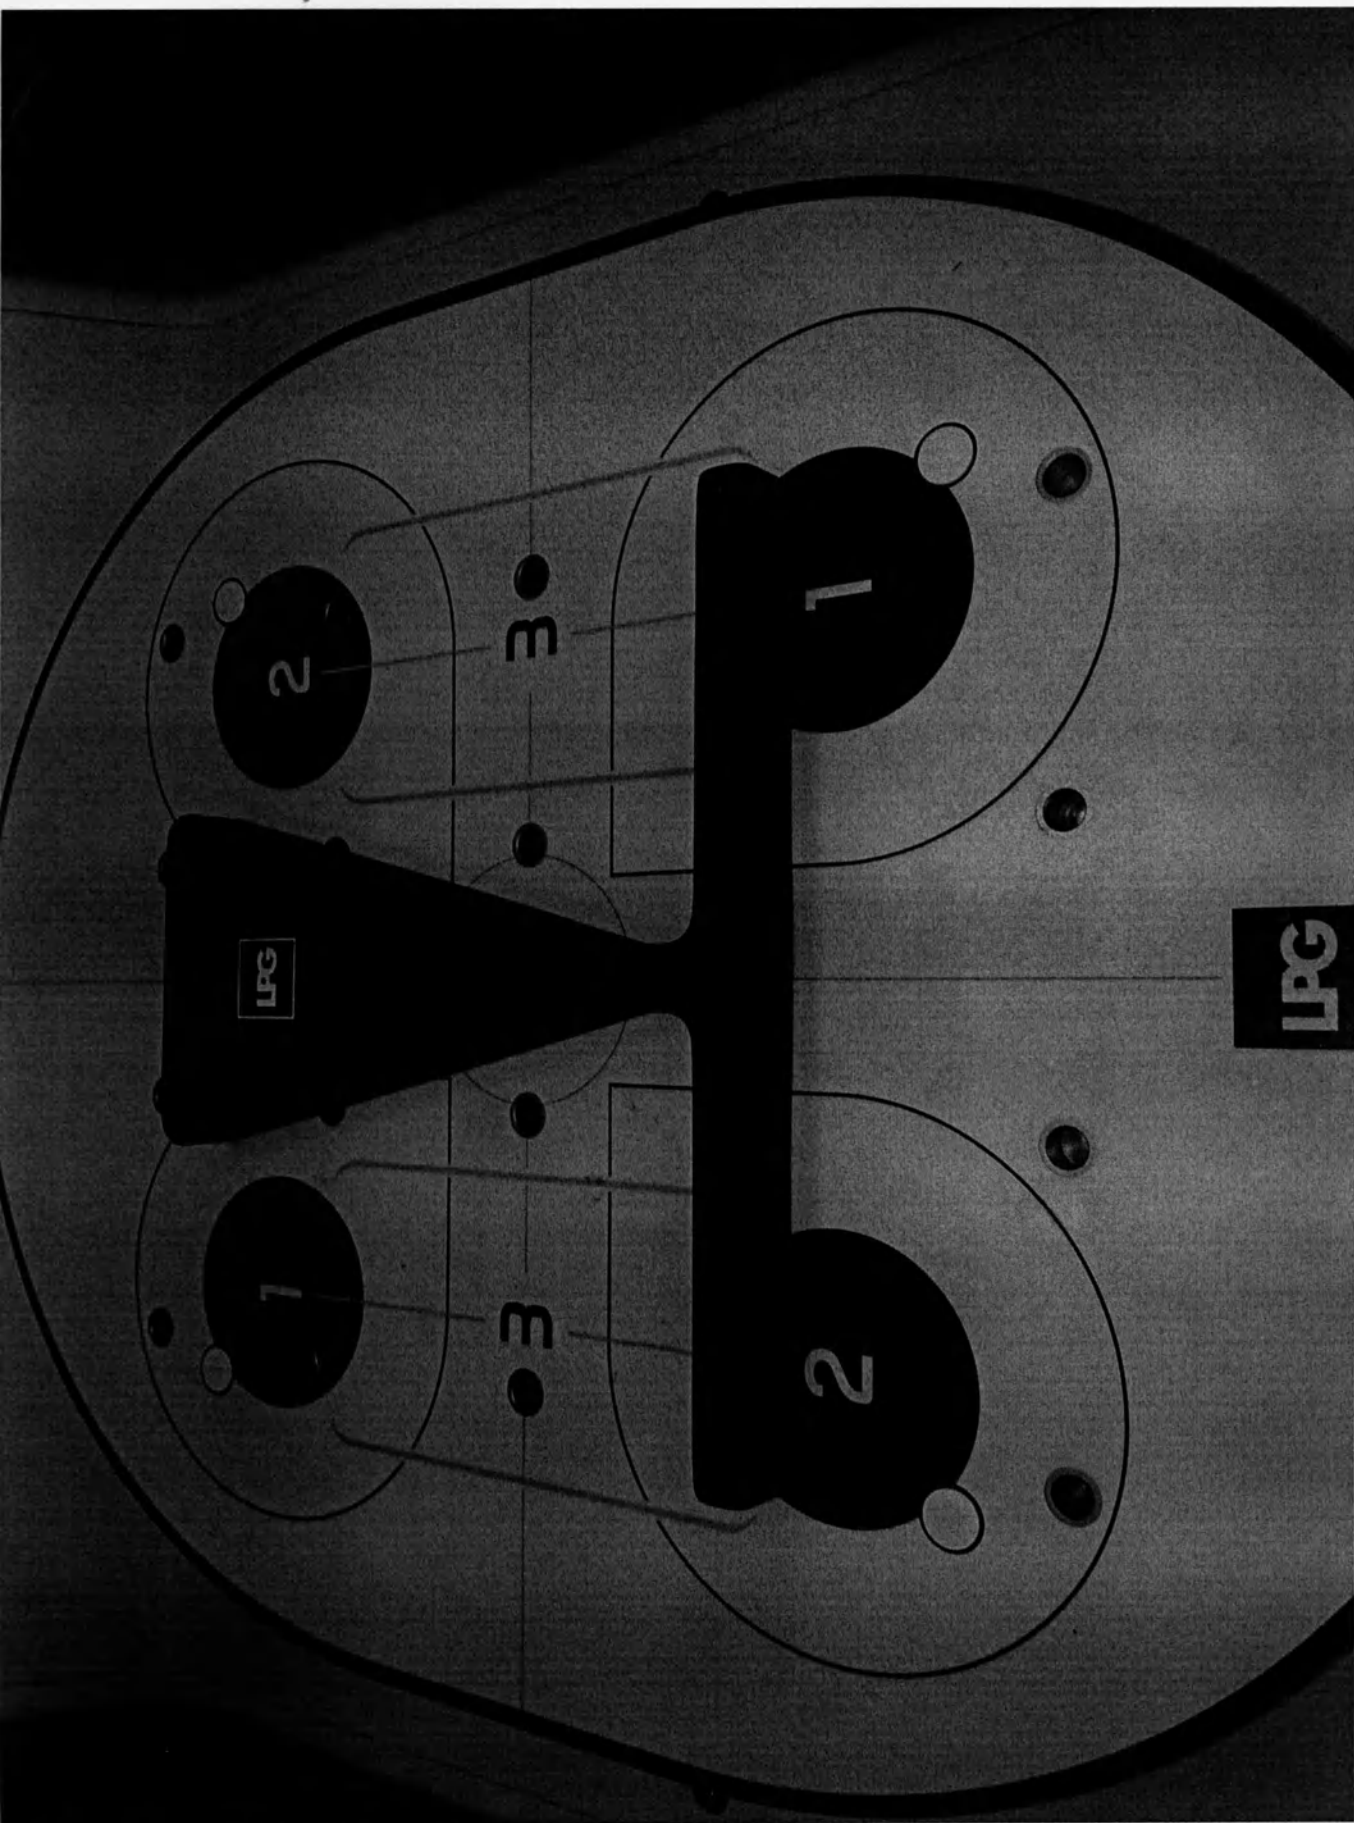

Тестер устойчивости




Стопорные втулки

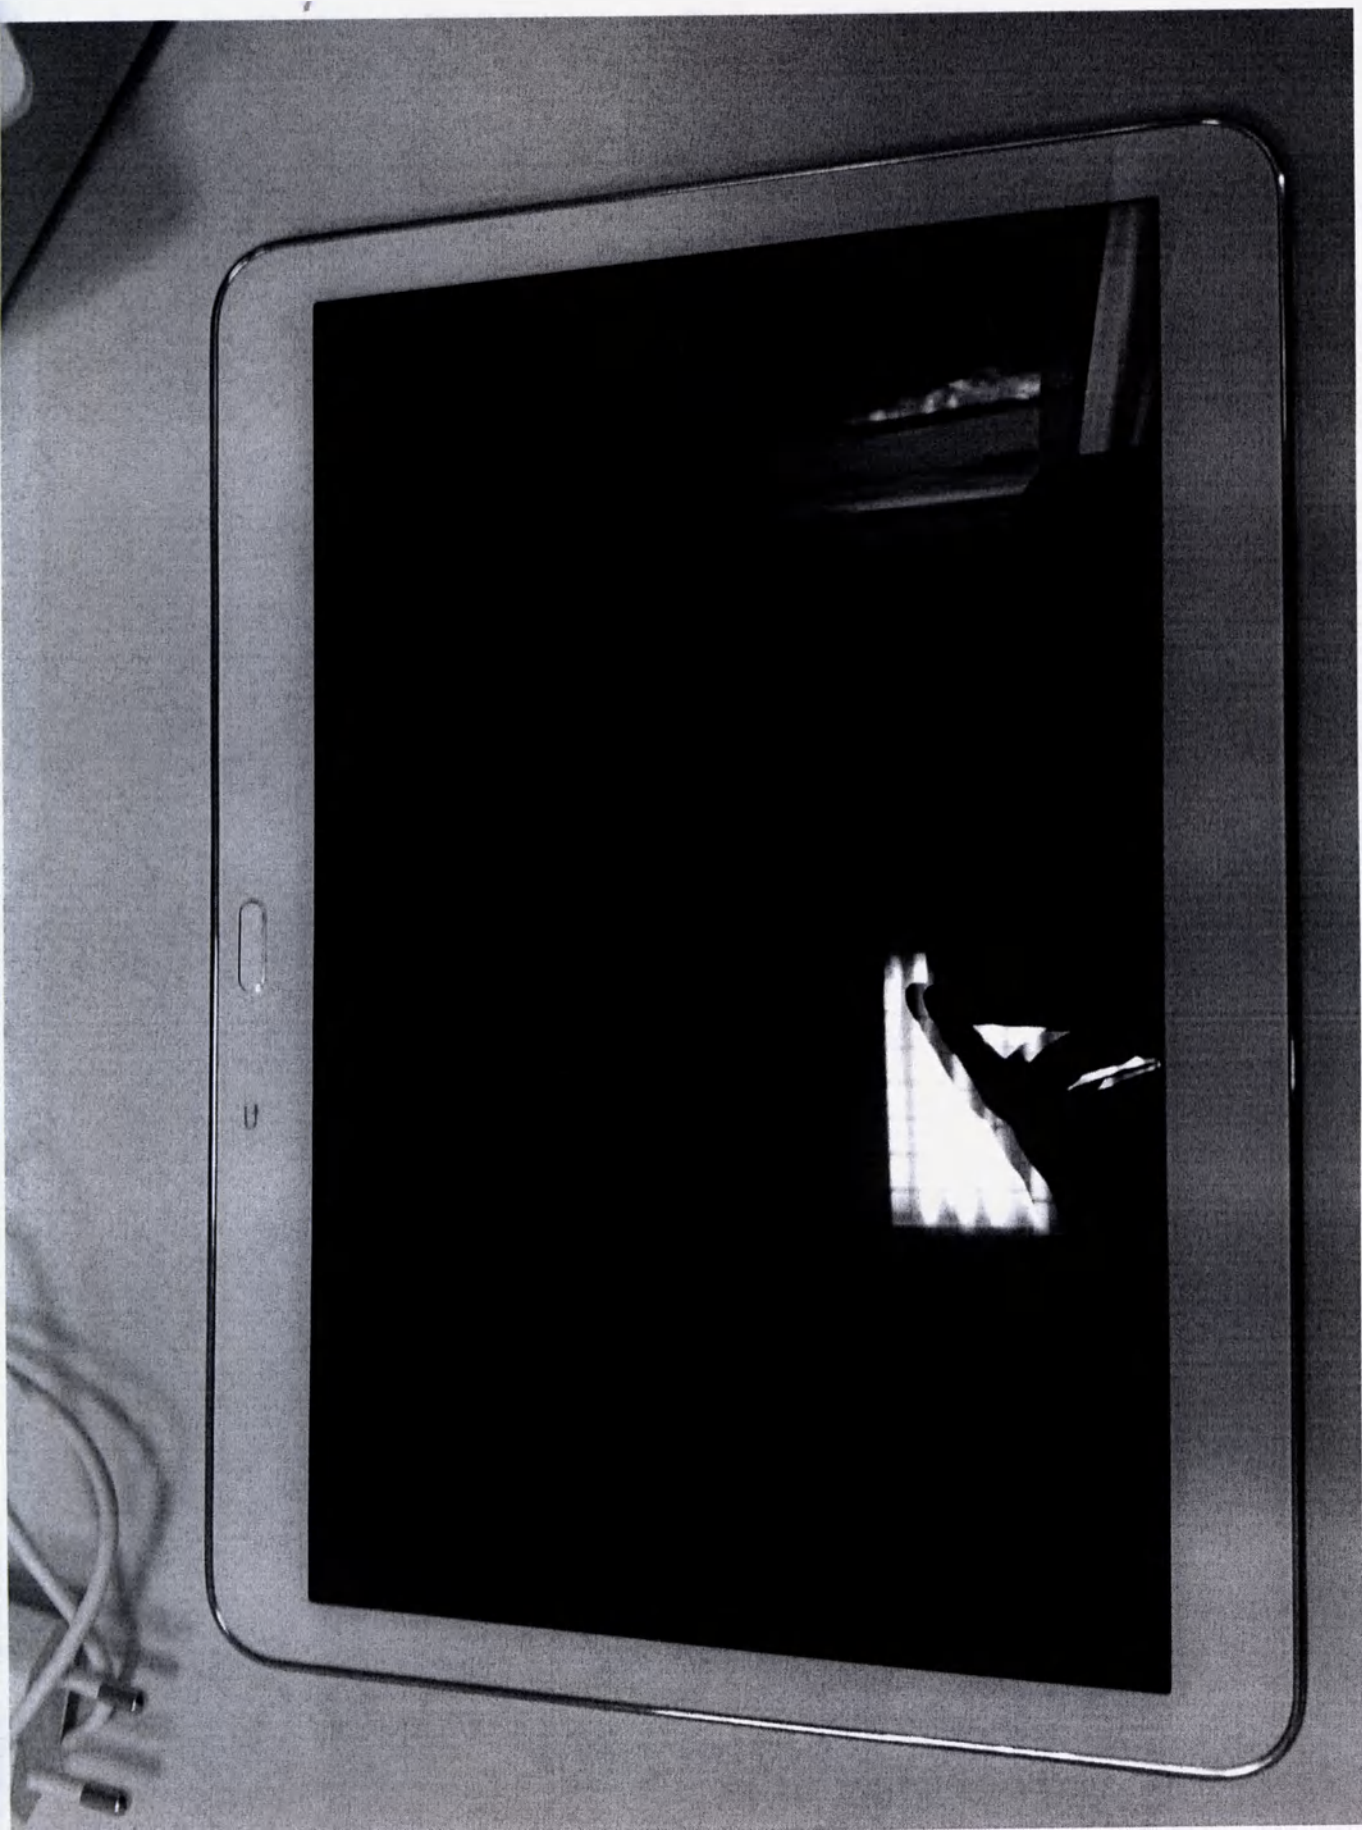

Планшет для удаленного управления




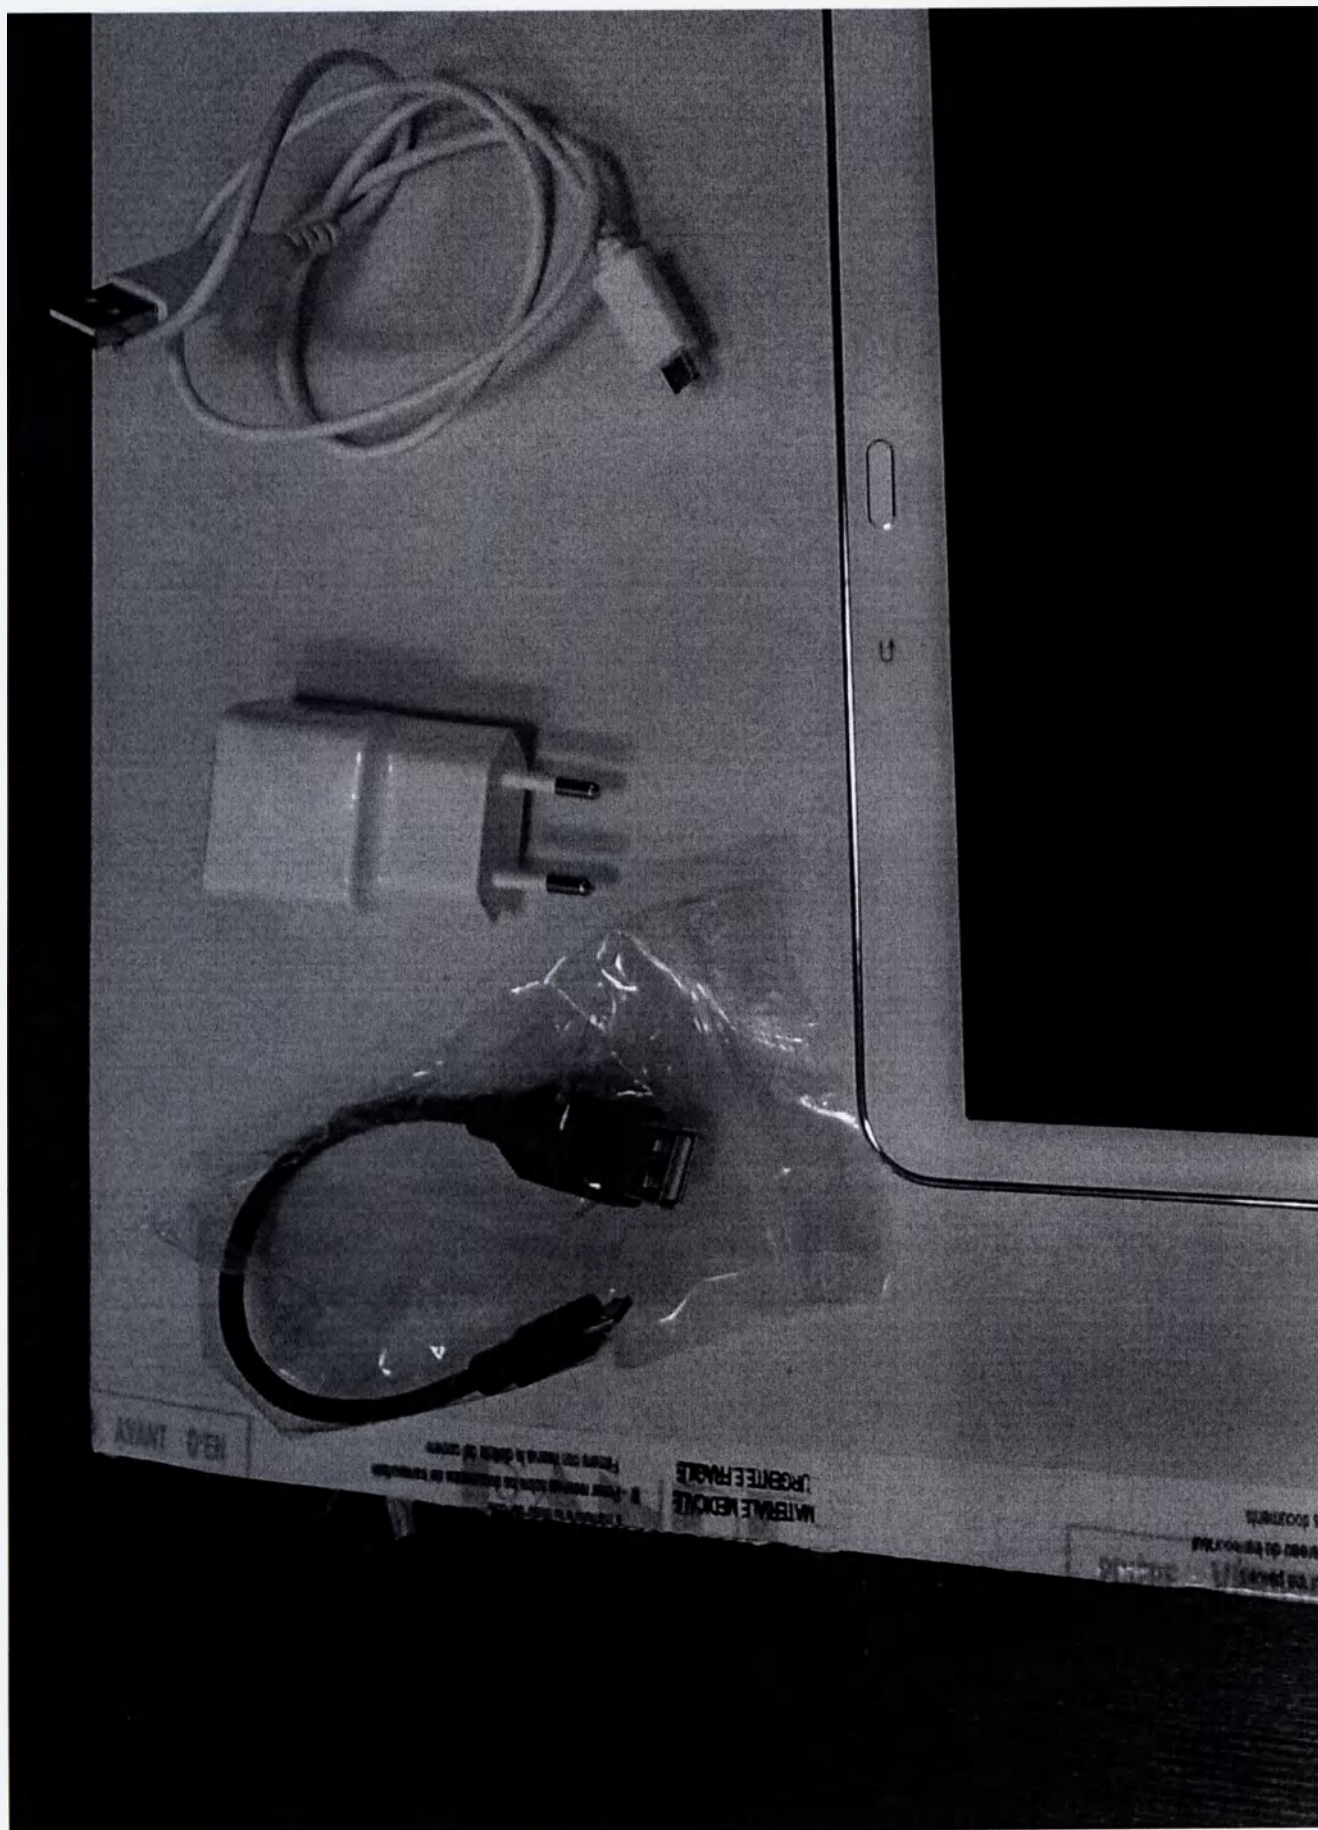

Зарядное устройство, USB/microUSB кабель, OTG USB/microUSB кабель



microSDHC™ Card




32 GB

up to 24MB/s
Transfer Speed

CLASS 6

Карта памяти

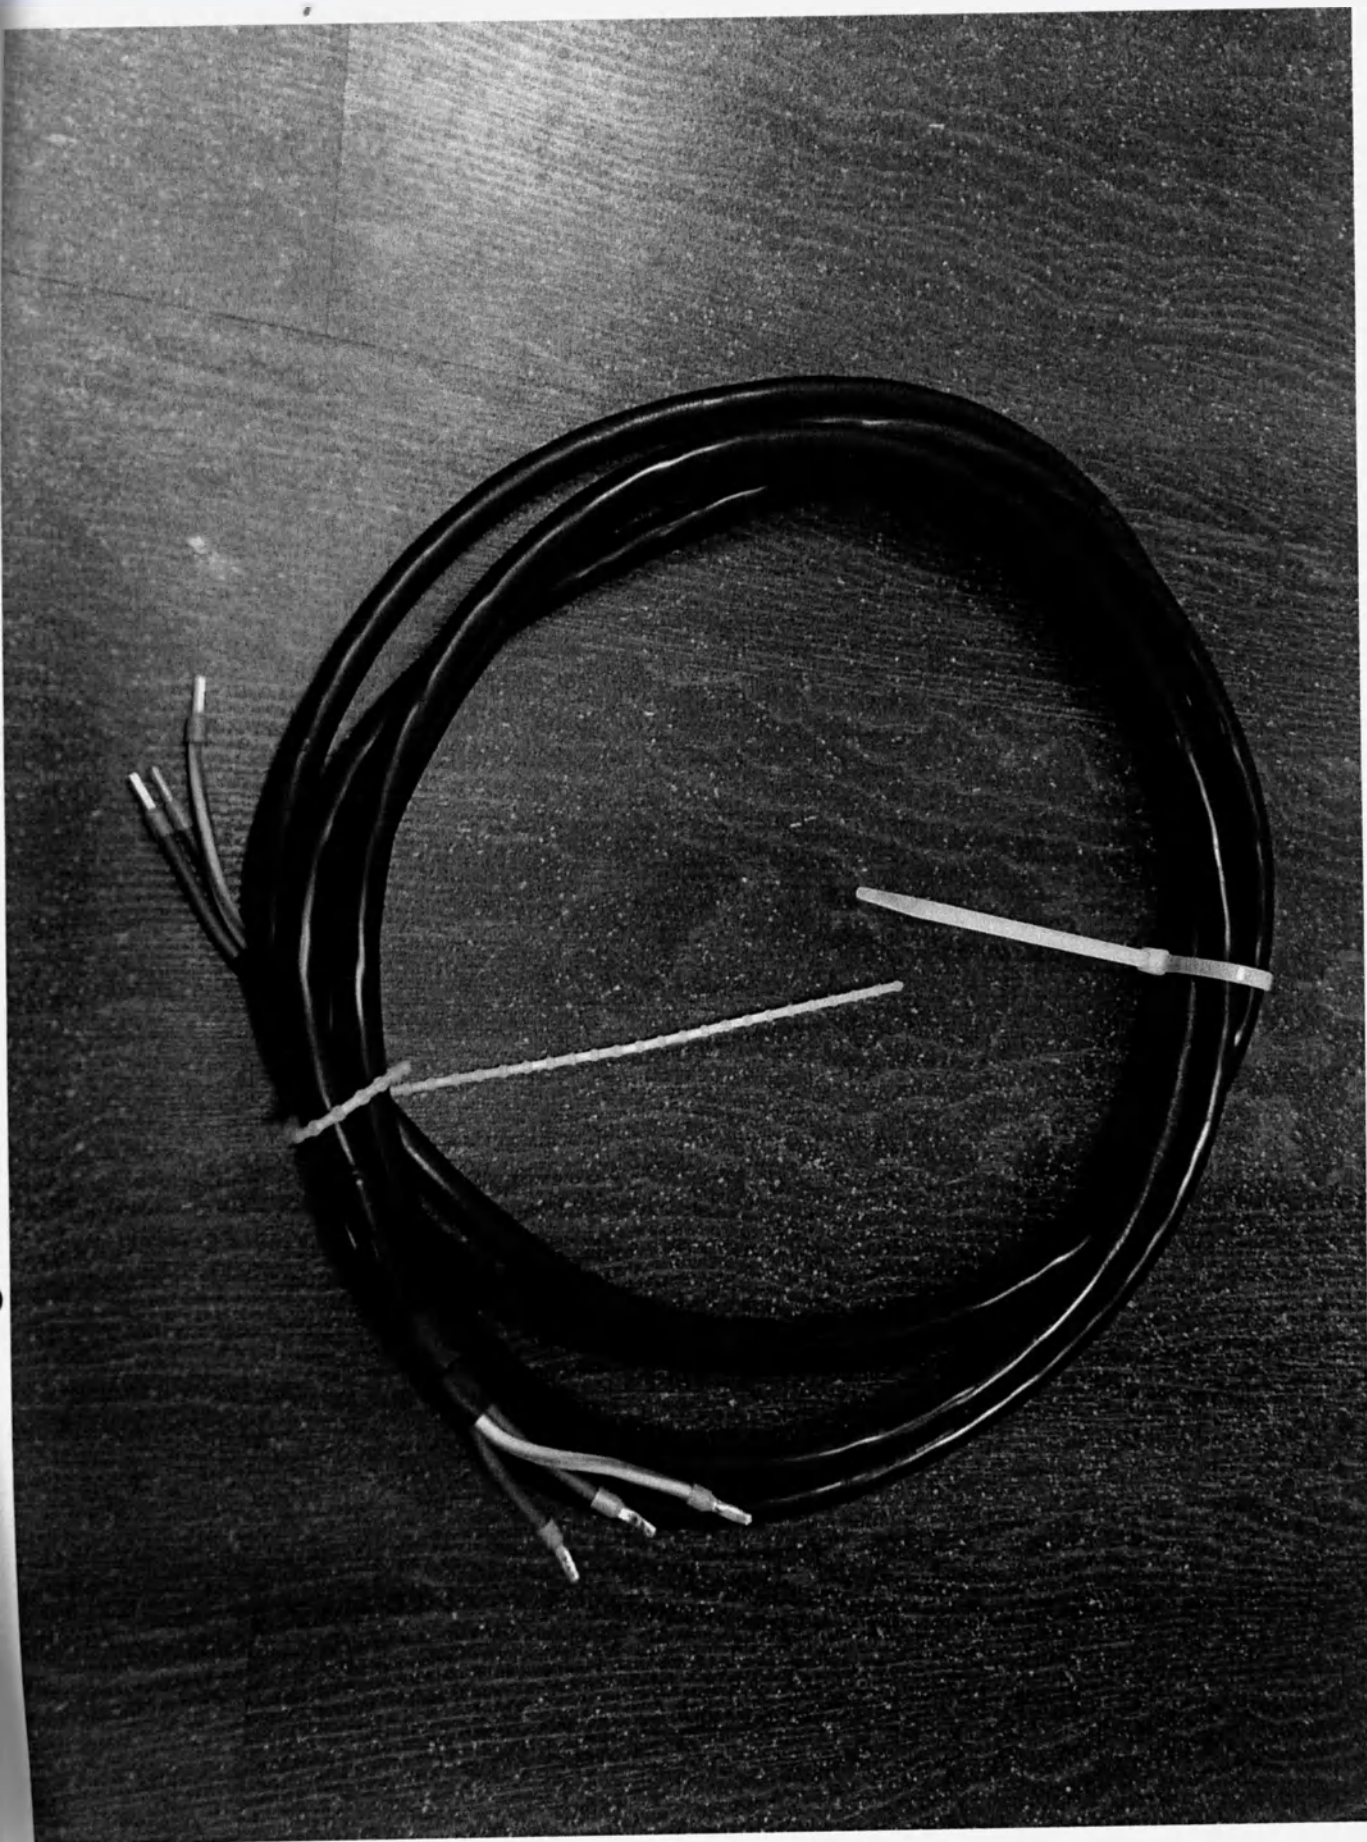

Сетевой кабель



Наушники

ООО «ХЕЛСИ ВОРЛД»

Итого в настояще документе

13

листа (ов)

Генеральный директор
Махмудов Ровшан Ибрагим оглы

