

**«Видеодерматоскоп "Фотофайндер бодистудио Эй-Ти-Би-Эм" (Videodermatoscope "FotoFinder bodystudio ATBM") с принадлежностями»,
производства "Фотофайндер Системс ГмбХ", Германия / FotoFinder Systems GmbH, Germany**


б/н - Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

1. Сервер бесшумный медицинский "Фотофайндер" (FotoFinder Silent Medical Server).
2. Видеокамера "Медикэм 800 Эйч-Ди" (Medicam 800HD).
3. LCD-монитор (LCD Monitor).
4. Трансформатор разделительный (Isolating Transformer).
5. Стенд монтажный Эй-Ти-Би-Эм (ATBM Tower Station).
6. Привод линейный "драйлин" (Linear Drive "dryLin").
7. Фотокамера Canon EOS без объектива, варианты исполнения EOS 700D, EOS 750D (Photo camera Canon EOS without lens, manufacturing modifications EOS 700D, EOS 750D).
8. Объектив SIGMA 30 мм F1.4 DC HSM (SIGMA 30 mm F1.4 DC HSM Lens).
9. Указатель лазерный USB (Laser Liner USB).
10. Устройство осветительное "Полфлэш фейс" (PolFlash face).
11. Адаптер сетевой AC/DC с сетевым кабелем (AC/DC Power Adapter with power cable).
12. Синхронизатор вспышки (Flash-Coupler).
13. Электродвигатель шаговый (Stepper motor).
14. Блок управления шаговым электродвигателем TSA (Control Unit TSA).
15. Разветвитель многорозеточный (Power Distribution Unit).
16. Устройство защитное для медицинских сетей (Medical Network-Isolation).
17. Кабель сетевой, длина 150 см (Power cable 150 cm long).

18. Клавиатура для персонального компьютера.
19. Манипулятор типа "мышь".
20. Руководство пользователя.

Принадлежности:

1. Объектив Canon EF-S 18-55 мм (Canon EF-S 18-55 mm Lens).
2. Объектив для дерматоскопии "Ди-Скоуп 2 Плюс Ленс" (D-Scope II Plus Lens).
3. Фильтр поляризующий для объектива "Ди-Скоуп 2 Плюс Ленс" (Polarizing Filter for D-Scope II Plus Lens).
4. Наконечник открытый для объектива "Ди-Скоуп 2 Плюс Ленс" (Open top piece for D-Scope II Plus Lens).
5. Наконечник закрытый для объектива "Ди-Скоуп 2 Плюс Ленс" (Closed top piece for D-Scope II Plus Lens).
6. Трубка открытая стеклянная для объектива "Ди-Скоуп 2 Плюс Ленс" (Open glass tube for D-Scope II Plus Lens).
7. Трубка закрытая стеклянная для объектива "Ди-Скоуп 2 Плюс Ленс" (Closed glass tube for D-Scope II Plus Lens).
8. Трубка коническая стеклянная для объектива "Ди-Скоуп 2 Плюс Ленс" (Conical glass tube for D-Scope II Plus Lens).
9. Объектив "Ди-Скоуп 3 Ленс" (D-Scope III Lens).
10. ФД-объектив (FD-Lens).
11. Накидка из чёрной ткани для ФД-объектива (Black cloth for FD-Lens).
12. Фильтр поляризующий для фотокамеры (FotoFinder Pol Body).
13. Коврик для фотосъёмки пациента (Positioning mat).
14. Полотно фоновое синее для фотосъёмки (ATBM Photo Background (blue)).

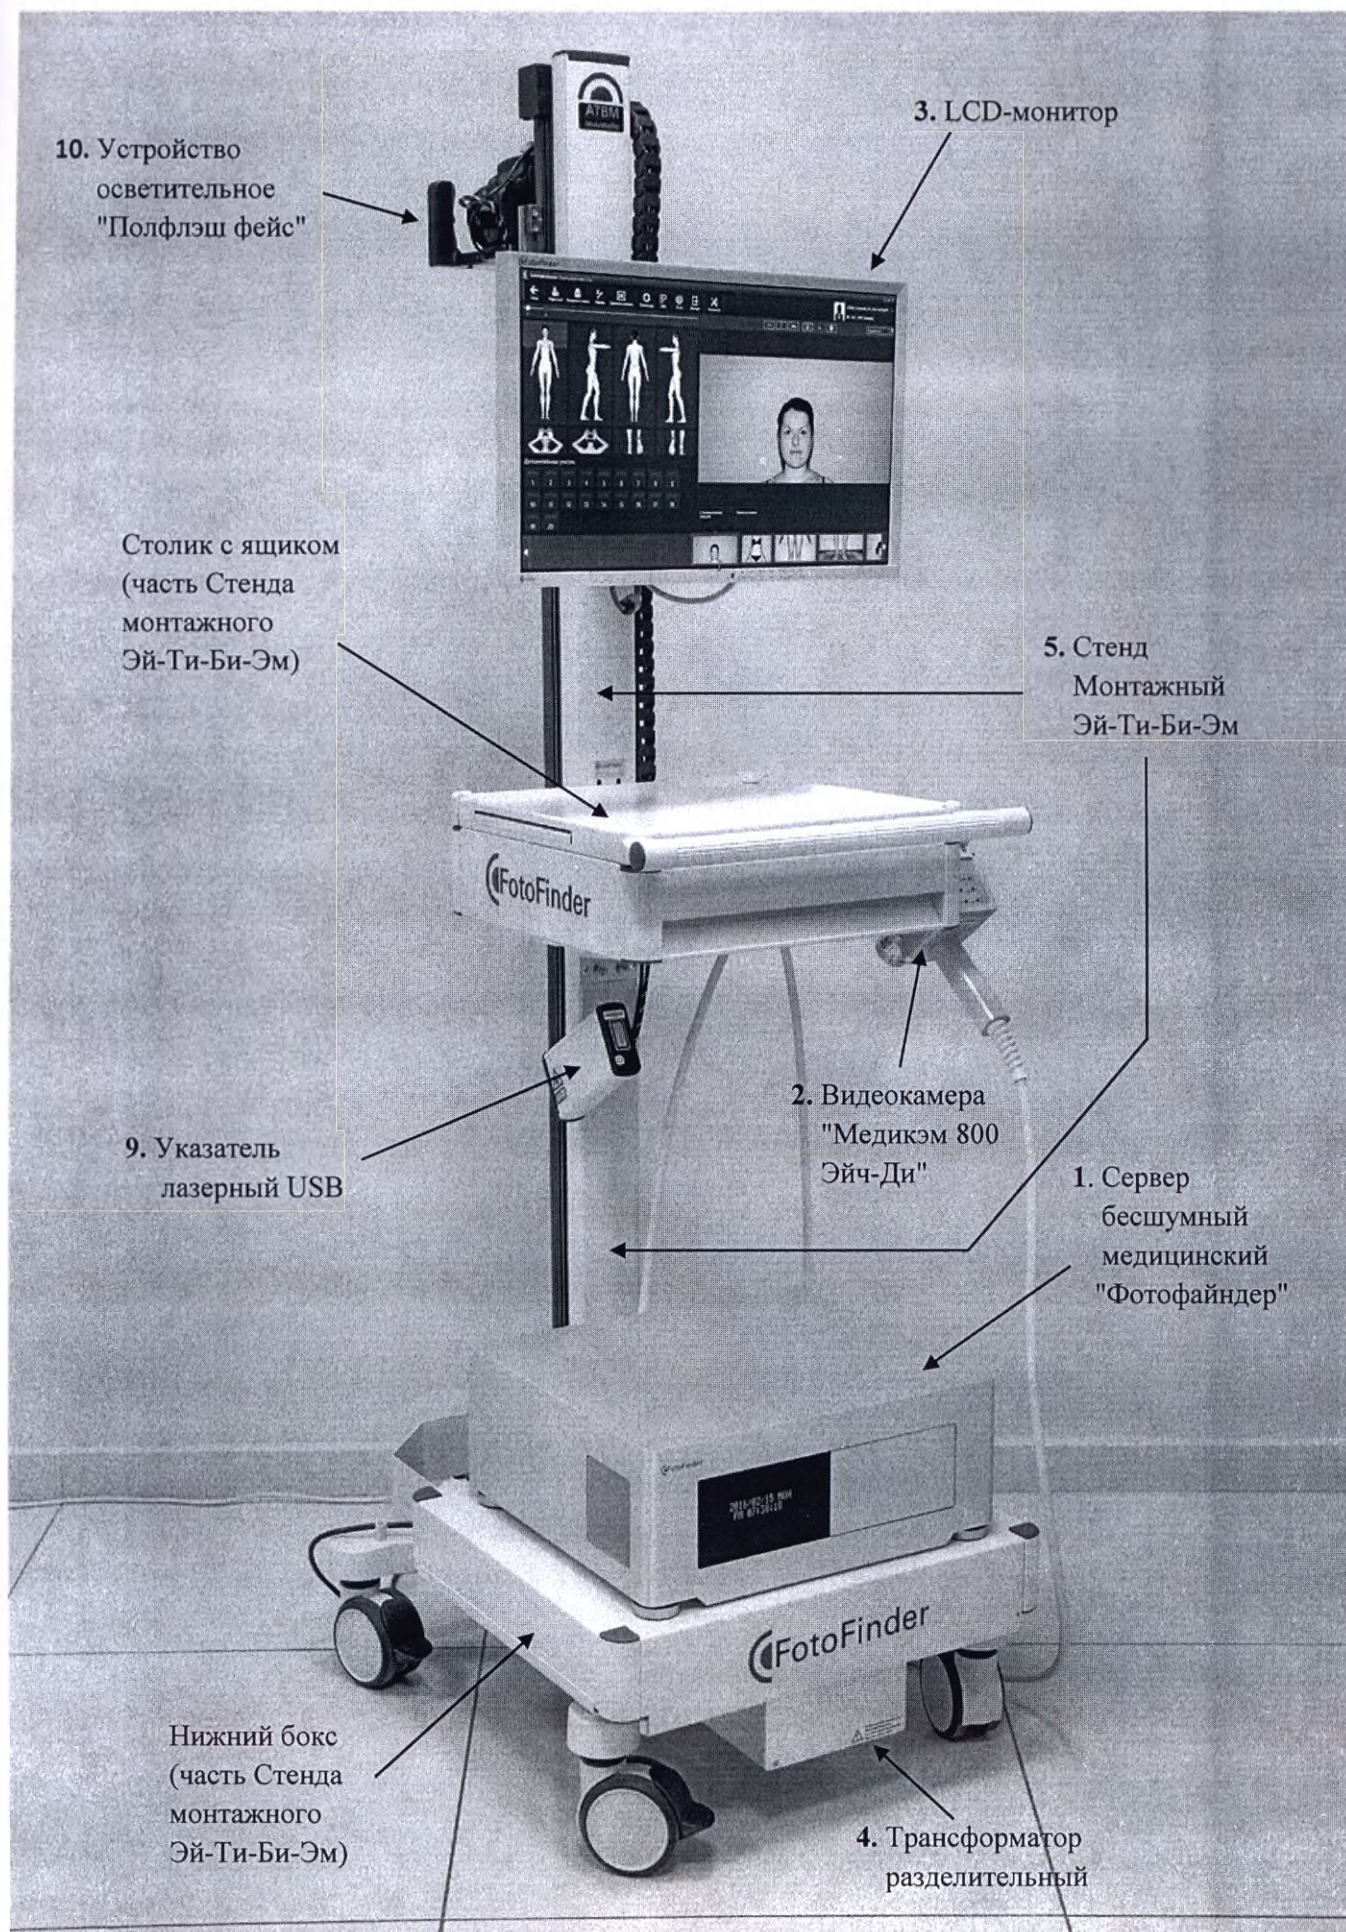

10. Устройство осветительное "Полфлэш фейс"

3. LCD-монитор

Столик с ящиком (часть Стенда монтажного Эй-Ти-Би-Эм)

5. Стенд Монтажный Эй-Ти-Би-Эм

9. Указатель лазерный USB

2. Видеокамера "Медикэм 800 Эйч-Ди"

1. Сервер бесшумный медицинский "Фотофайндер"

Нижний бокс (часть Стенда монтажного Эй-Ти-Би-Эм)

4. Трансформатор разделительный

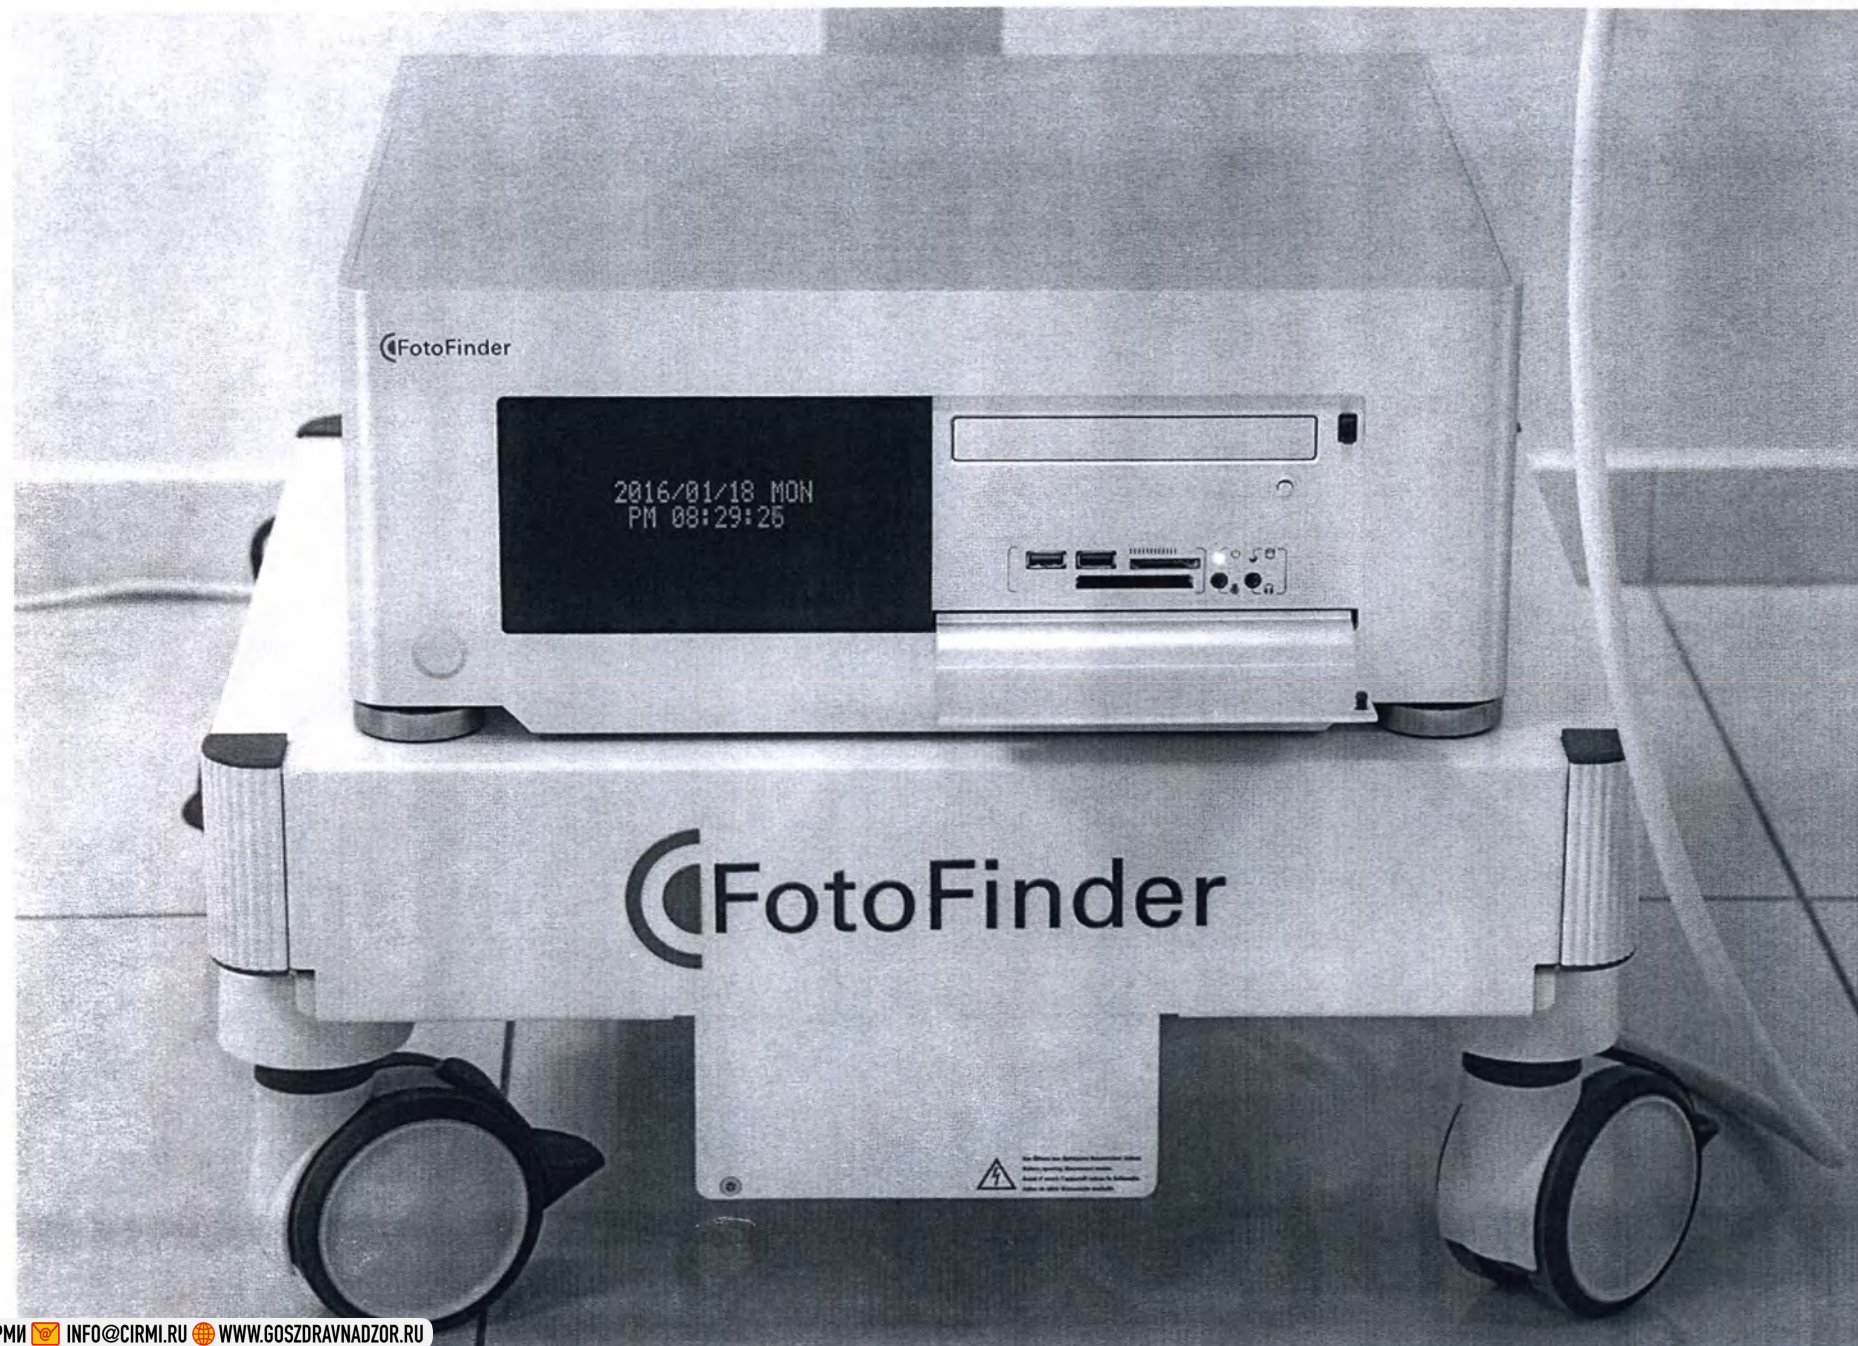
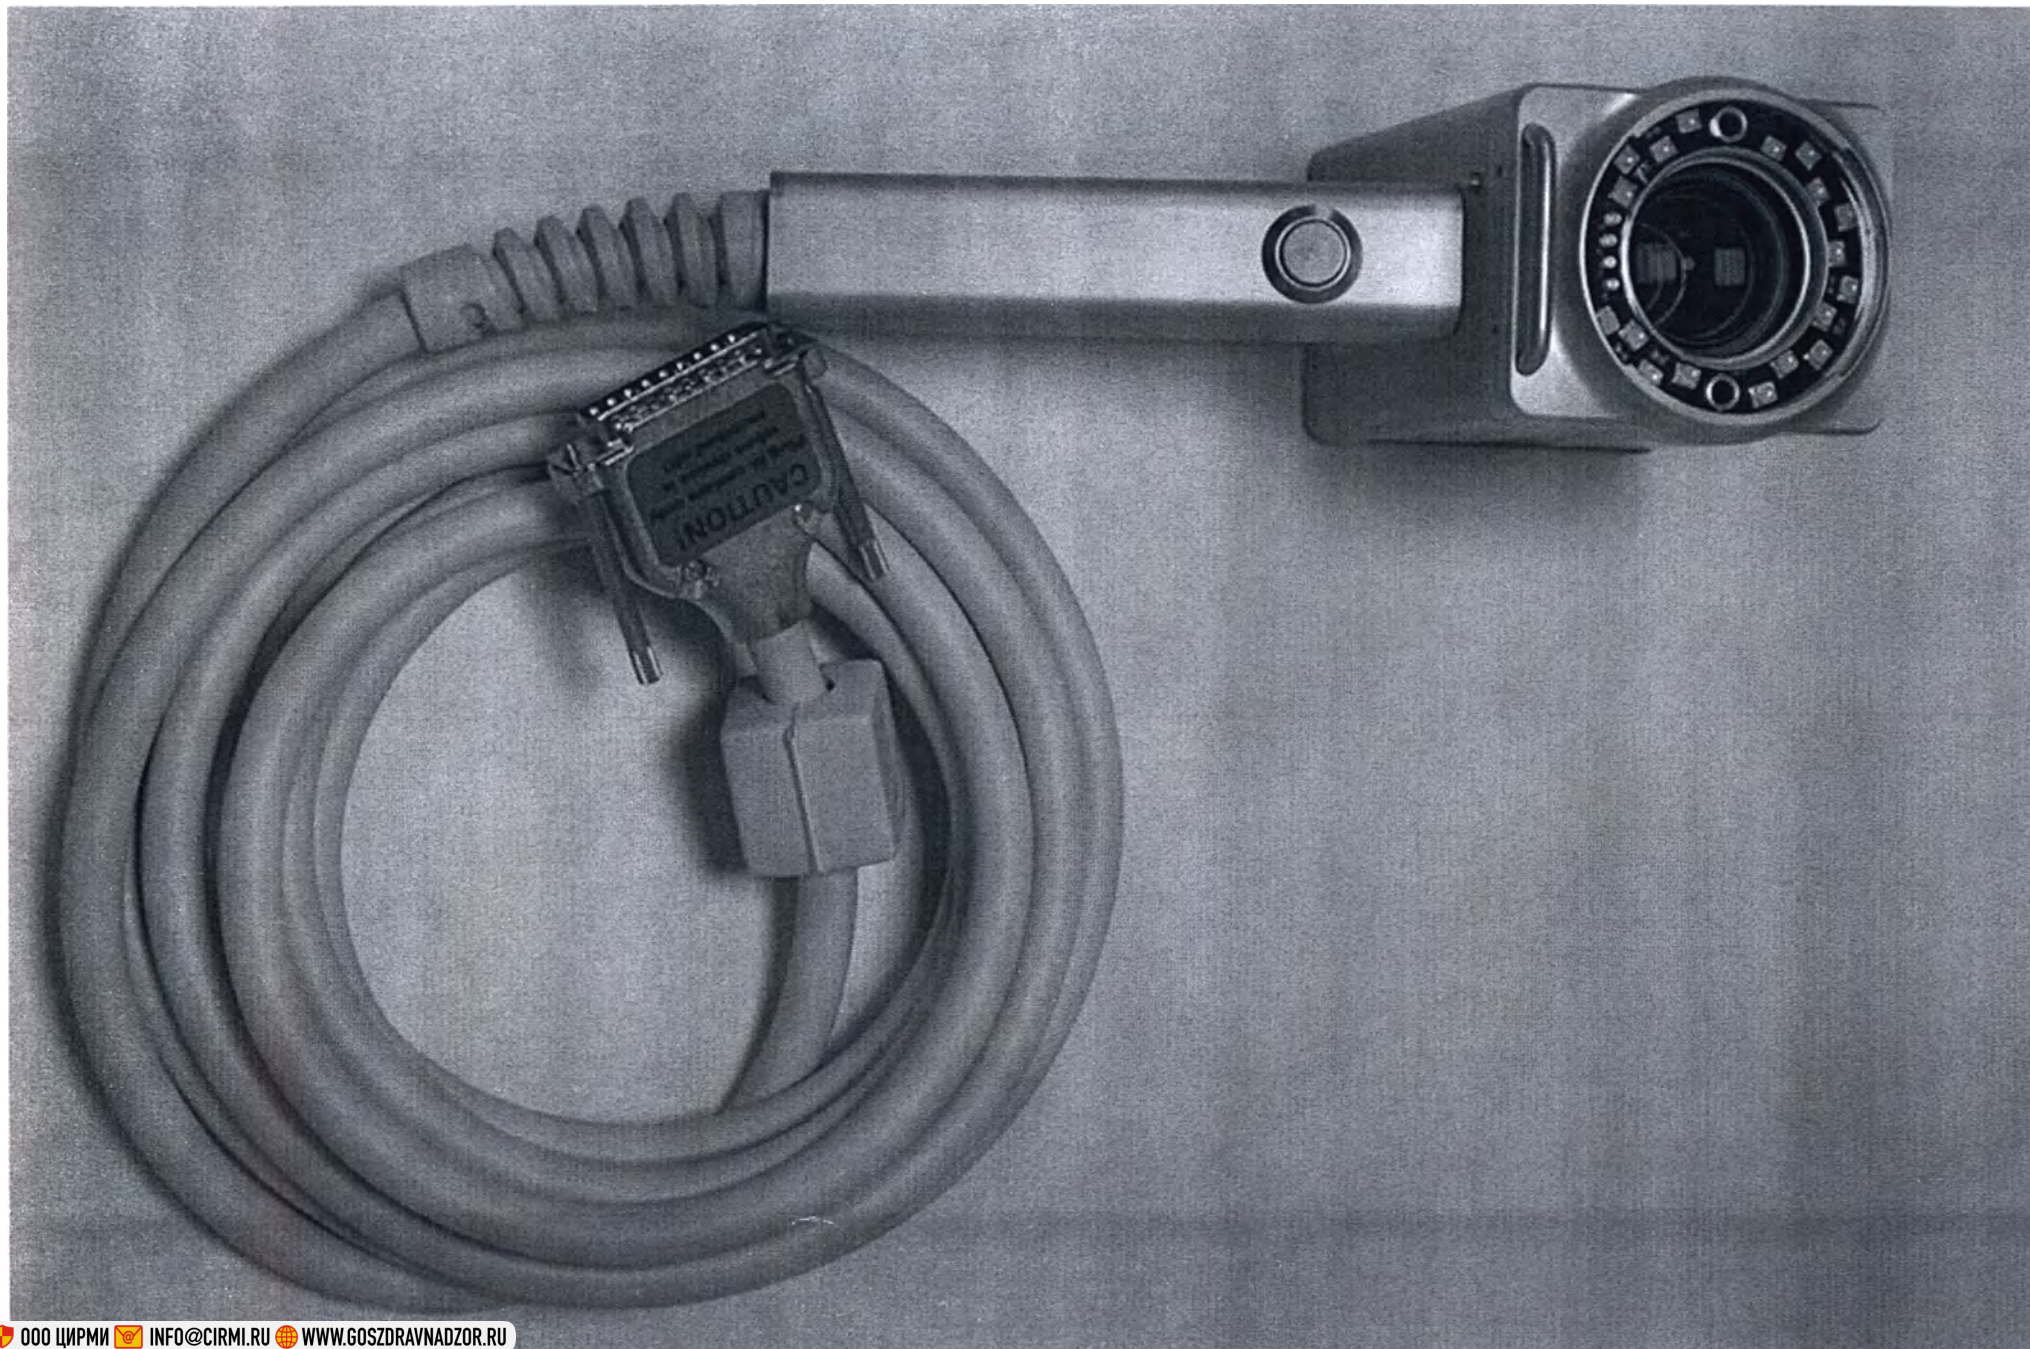
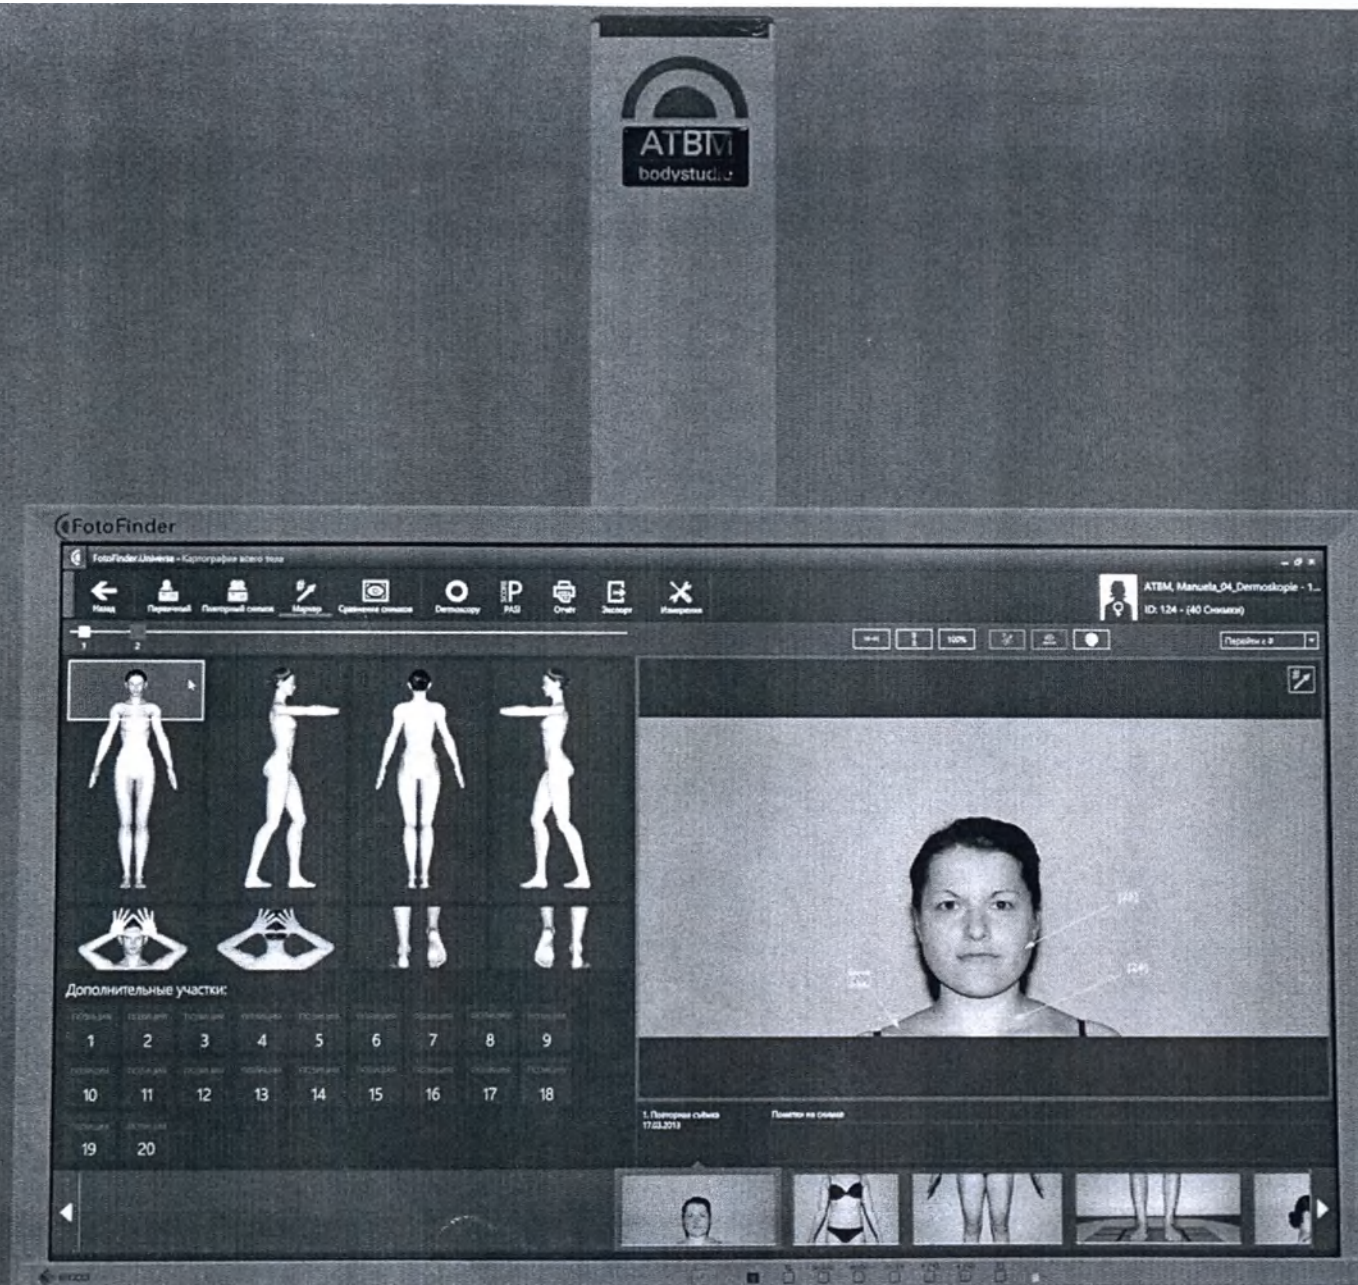


Фото 2. Видеокамера "Медикэм 800 Эйч-Ди" (Medicam 800HD)





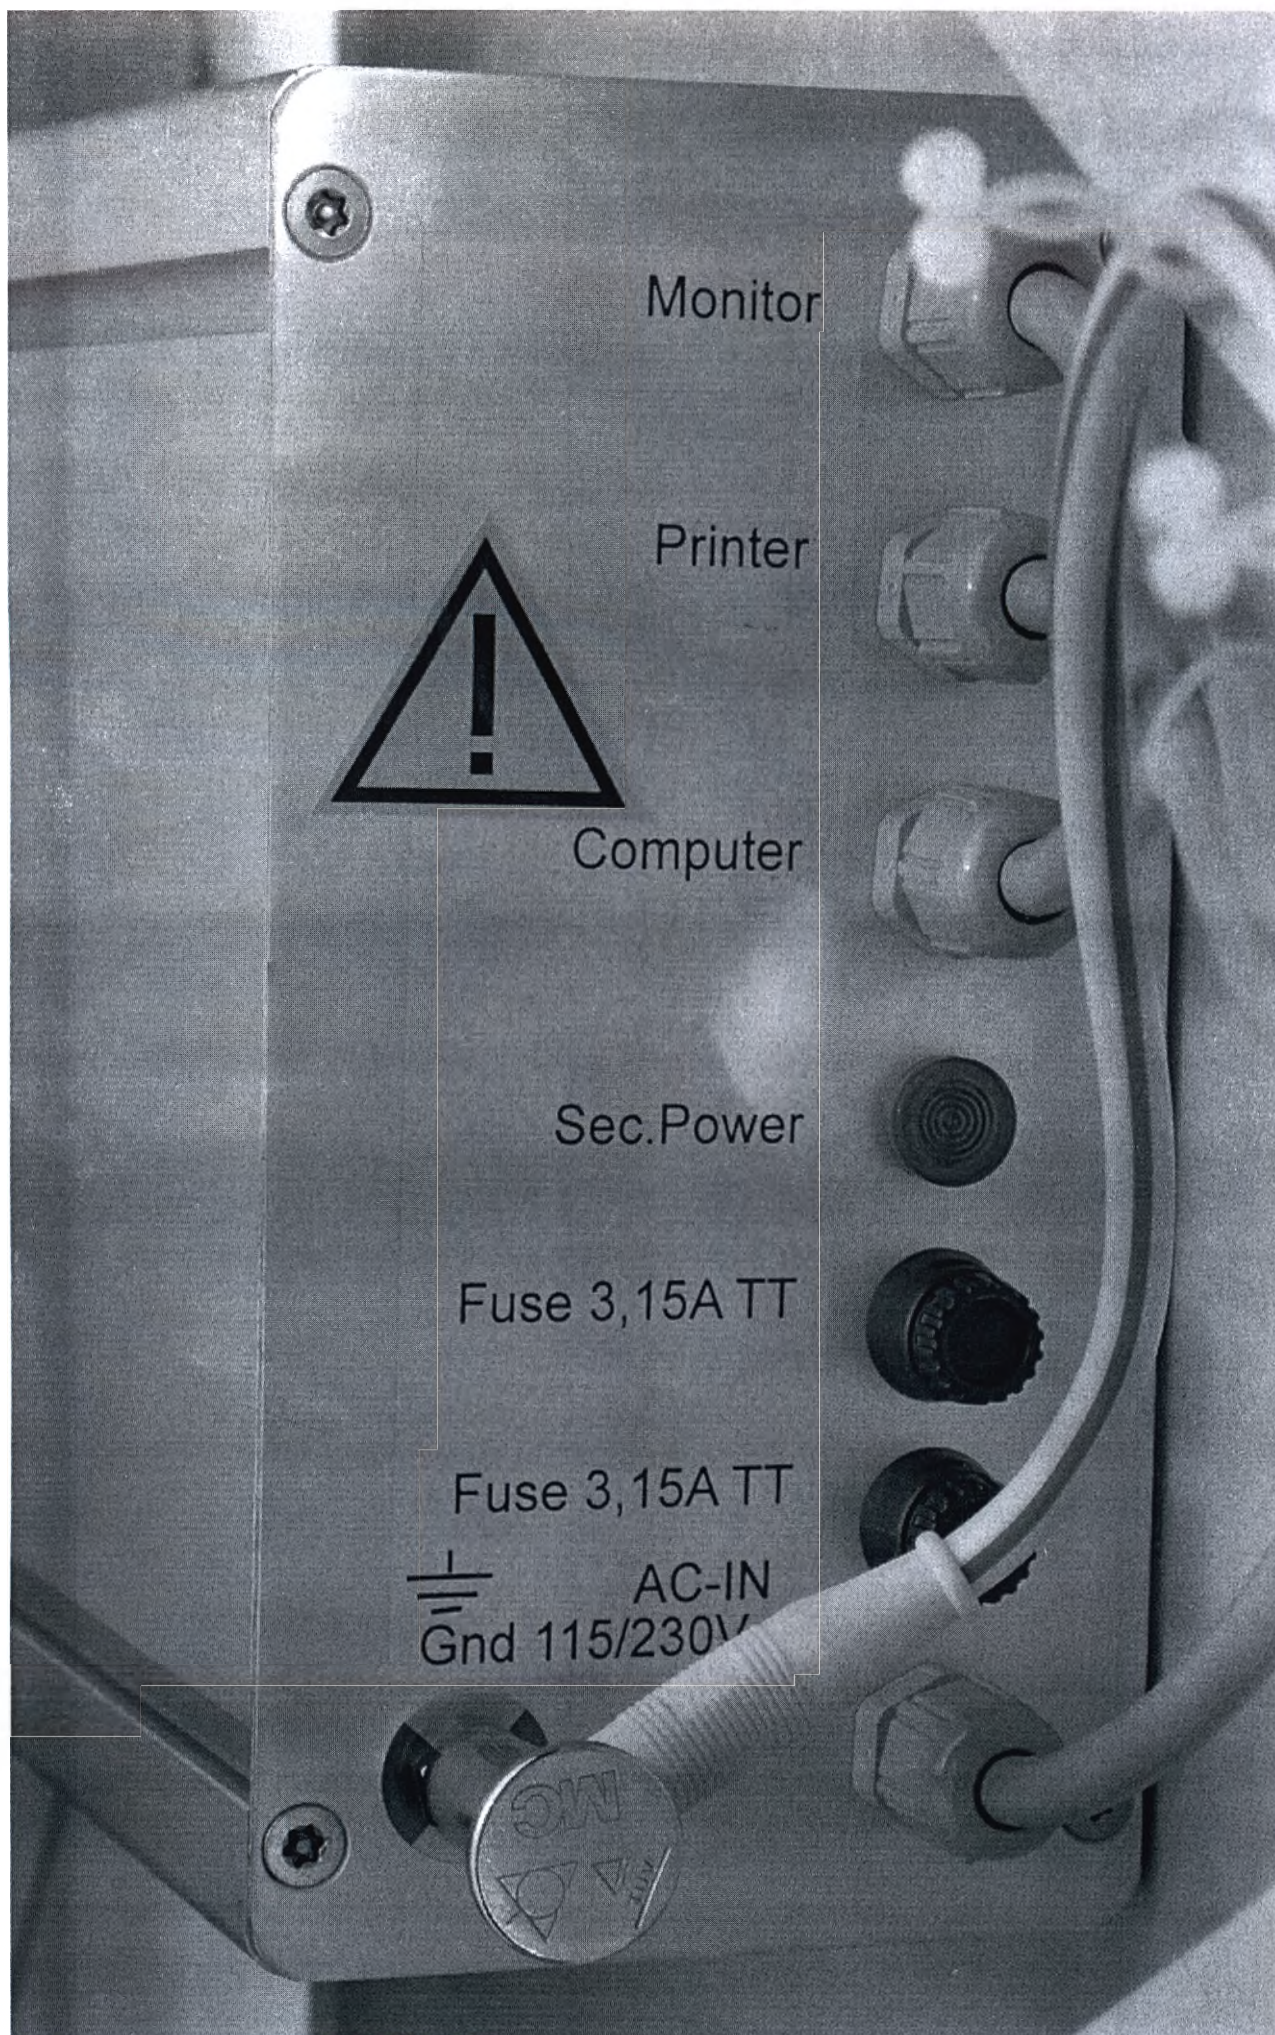


Фото 4. Трансформатор раздельный (Isolating Transformer)

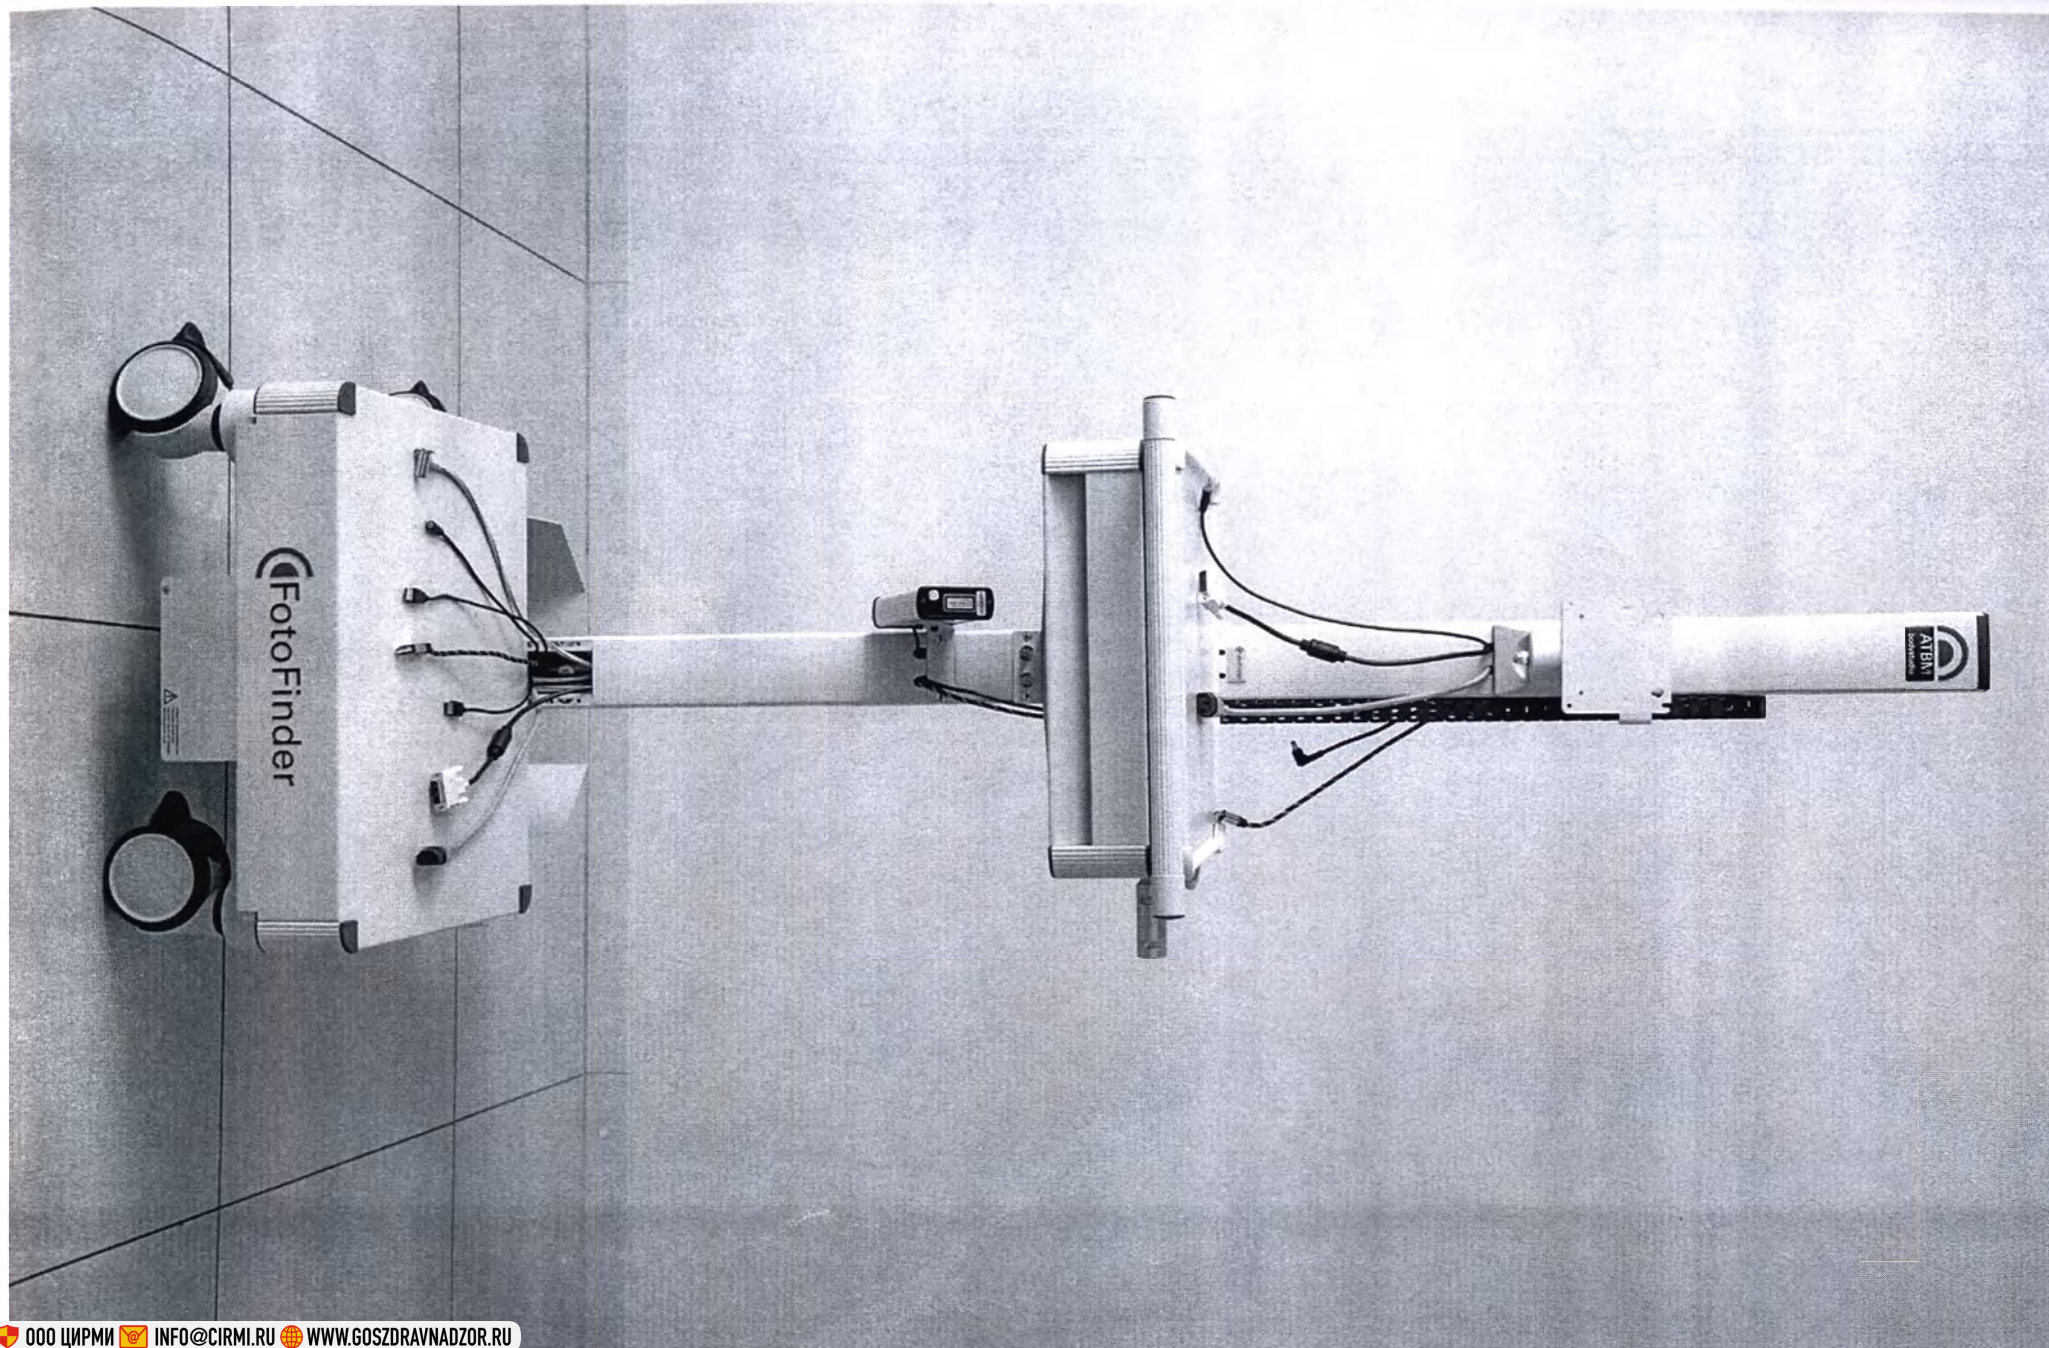


Фото 6. Привод линейный "Лайнлин" (Linear Drive "dryLin")

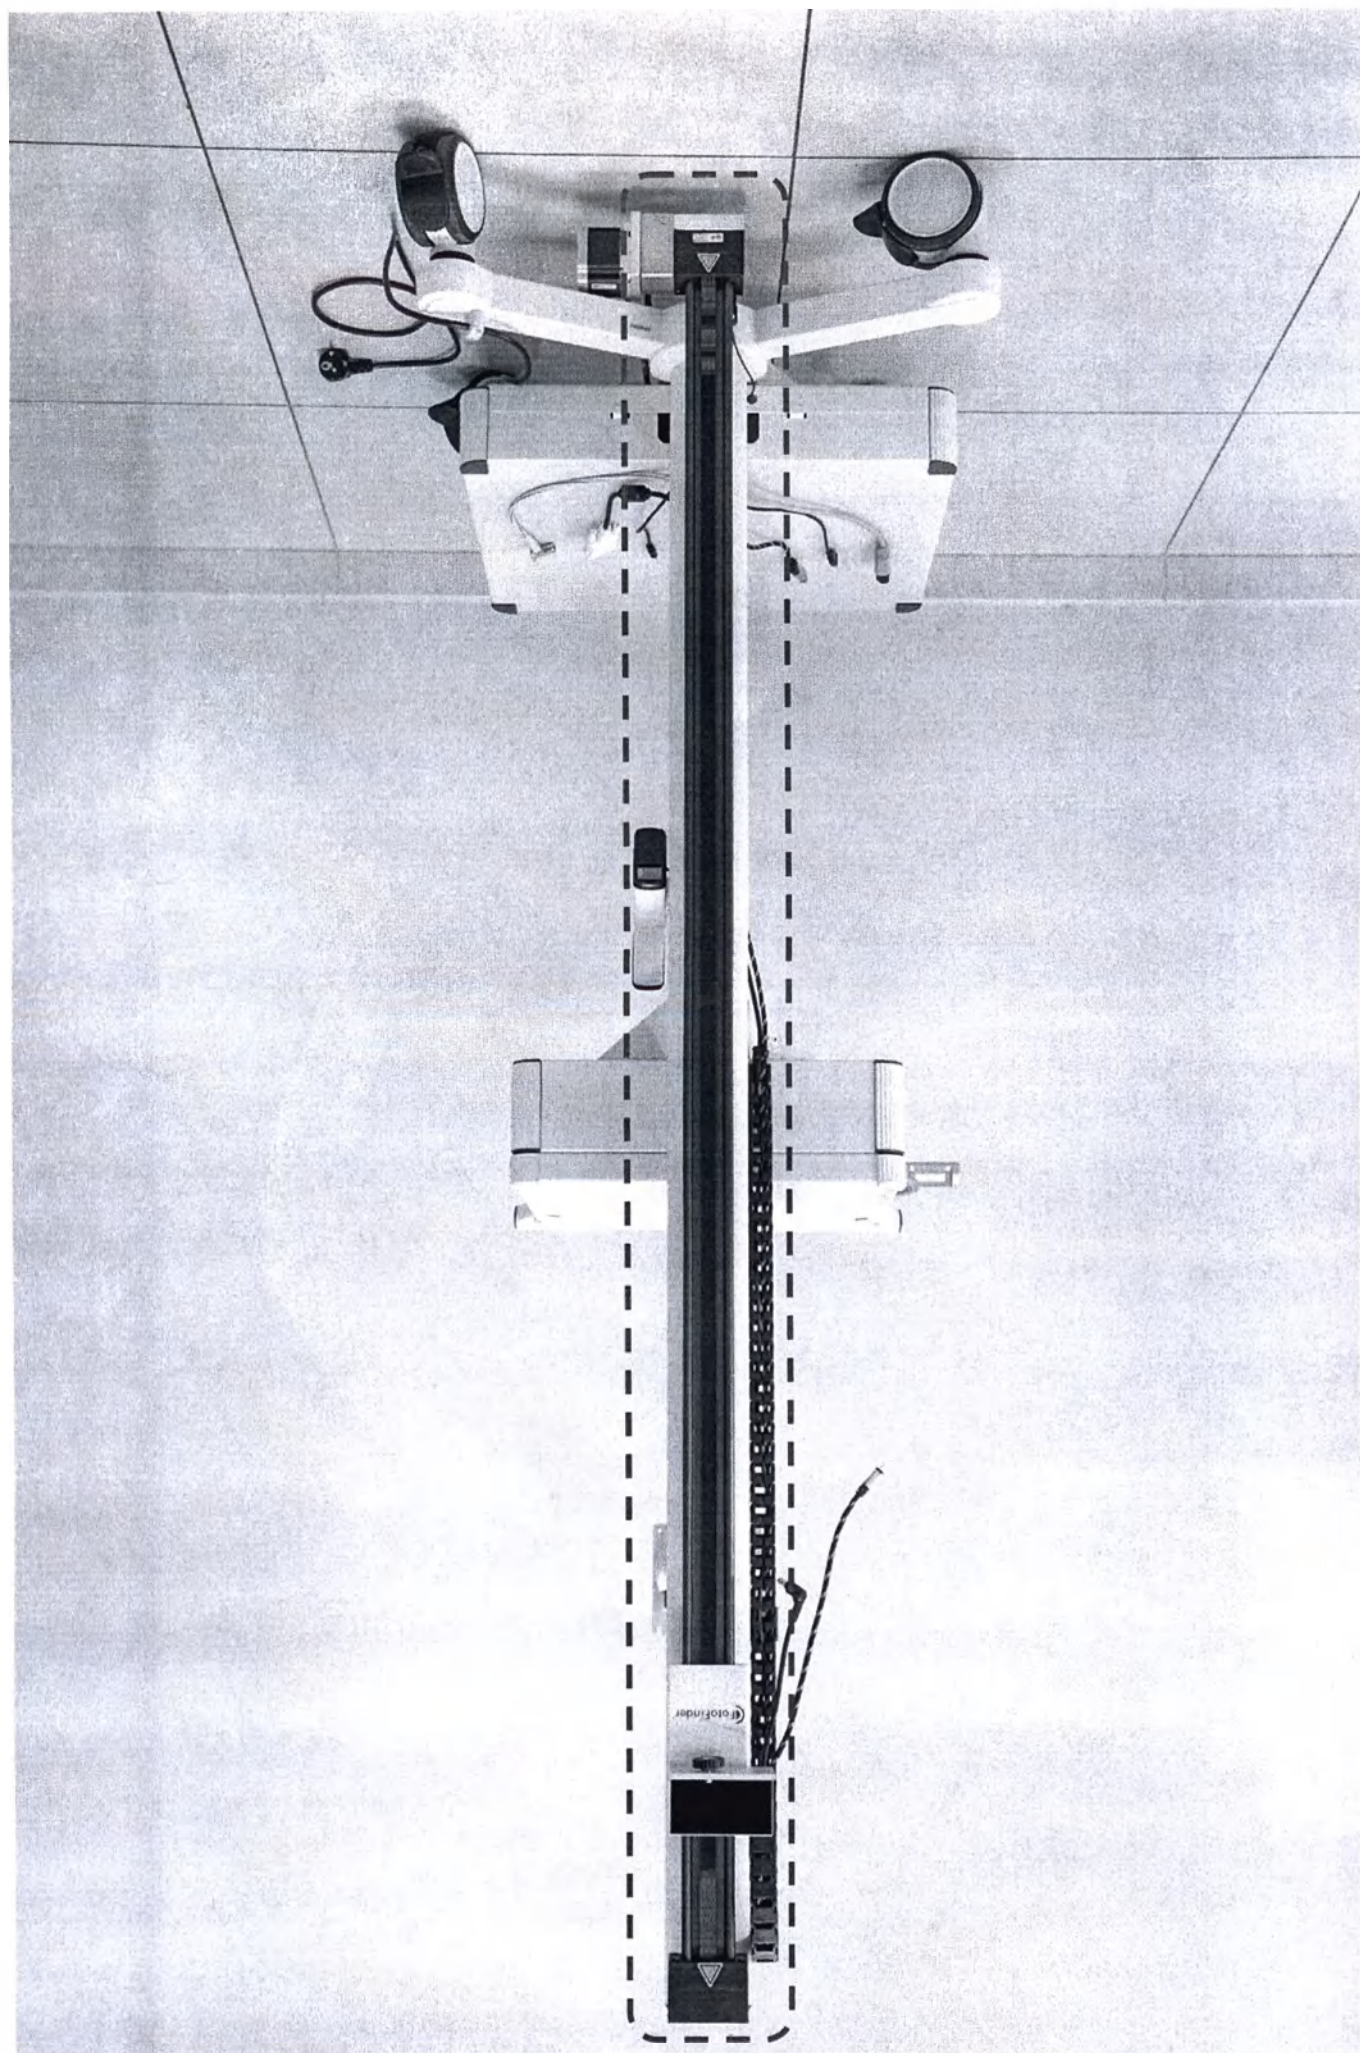




Фото 8. Фотокамера Canon EOS без объектива, вариант исполнения EOS 750D (Photo camera Canon EOS without lens, manufacturing modification EOS 750D)







Фото 11. Устройство осветительное "Полифлэш фэс" (Poliflash face).



Фото 12. Адаптер сетевой AC/DC с сетевым кабелем (AC/DC Power Adapter with power cable)

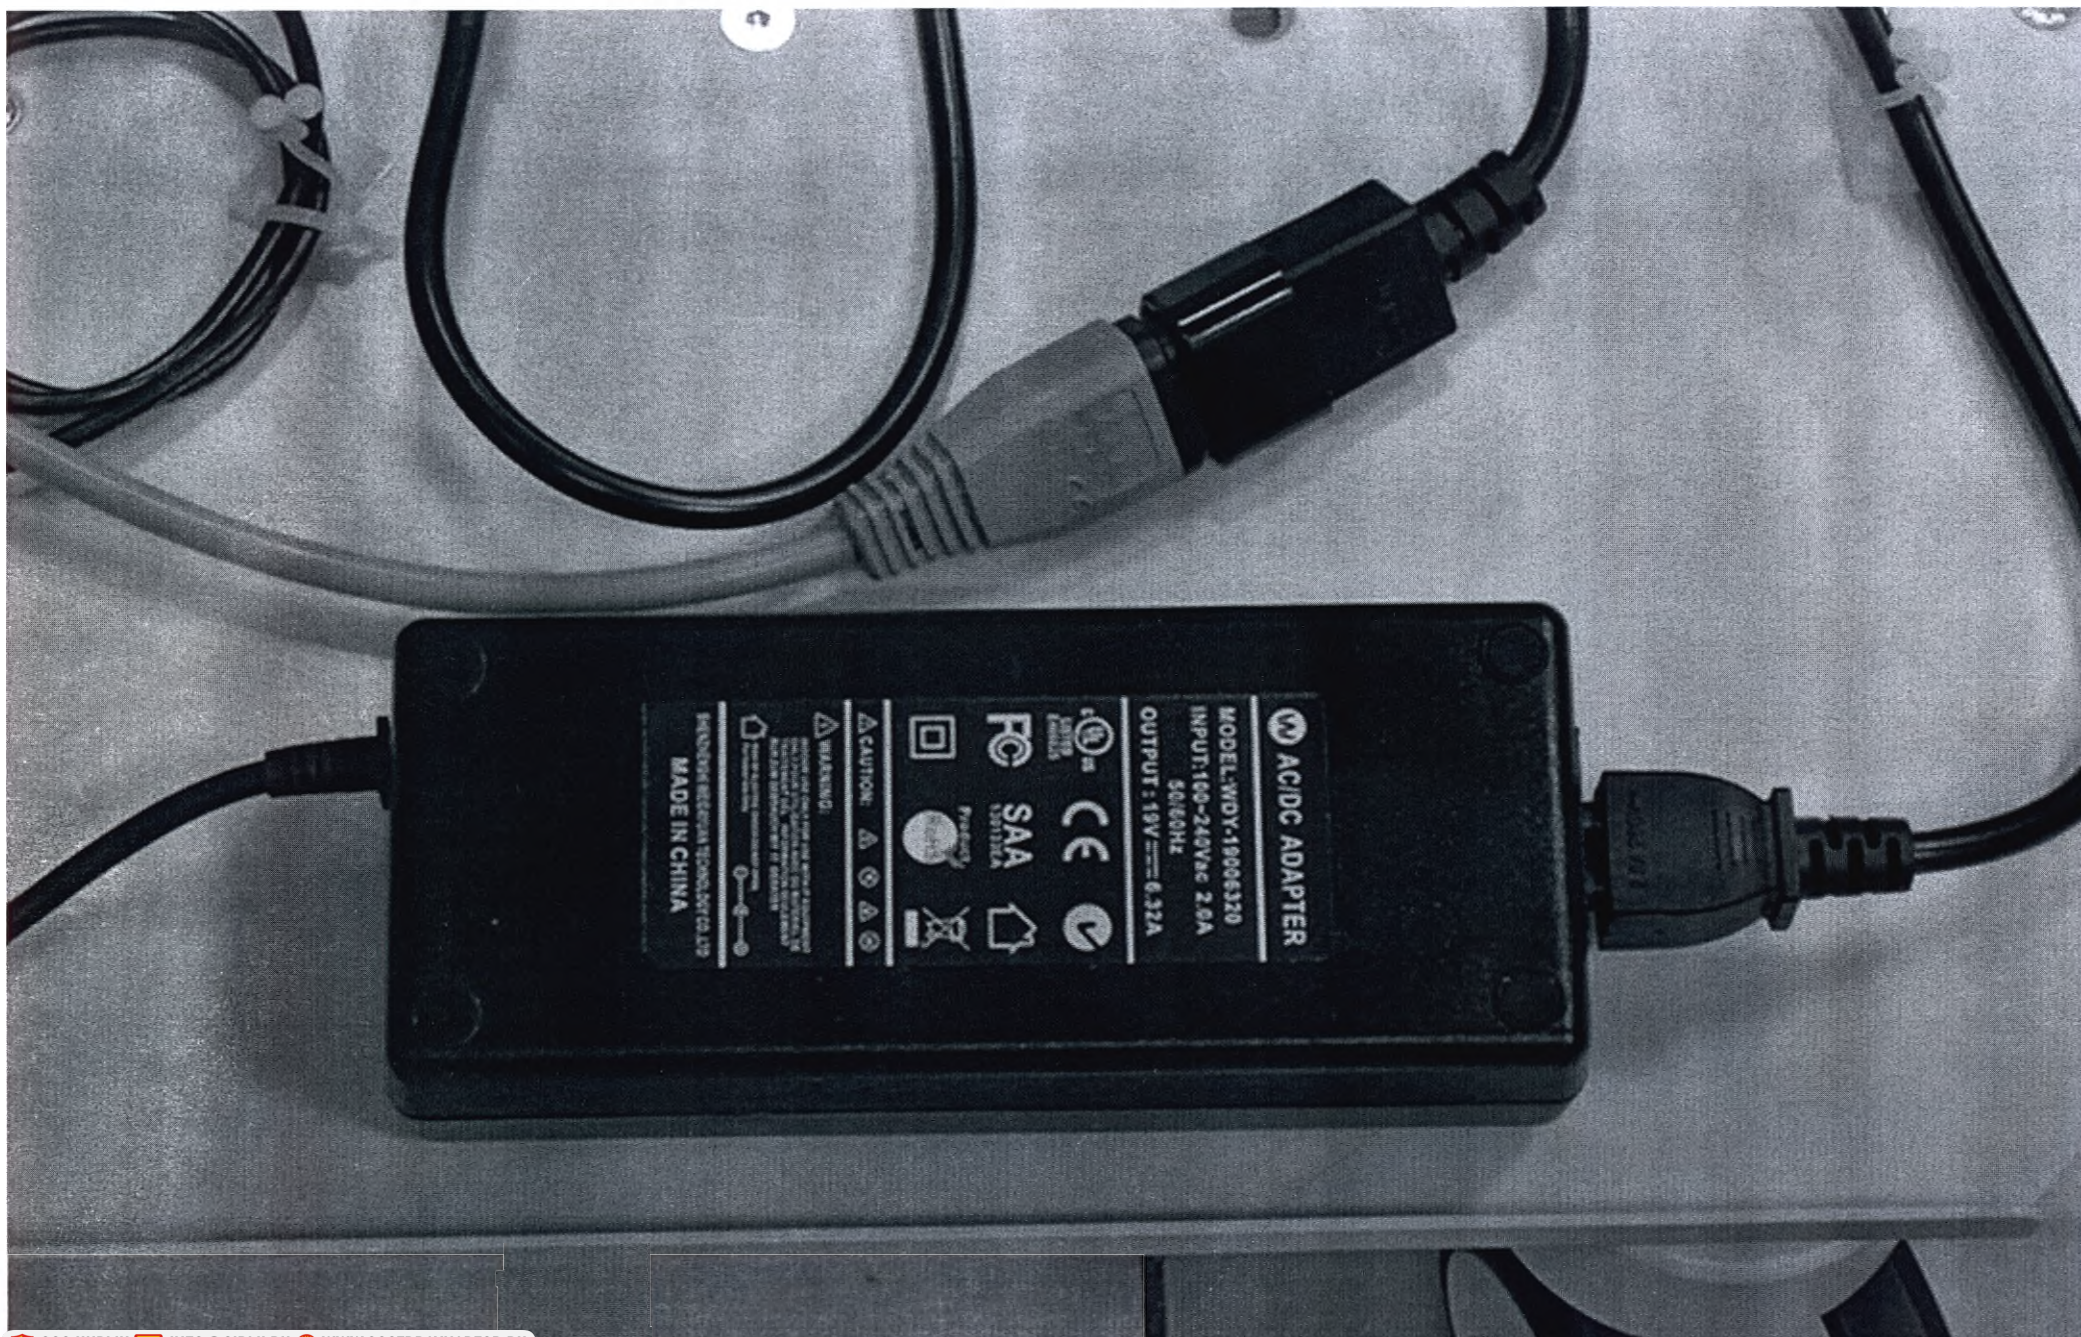


ФОТО 13. Синхронизатор вспышки (Flash-Coupler)

Flash-Coupler
SN: FC - 231
FotoFinder

Фото 14. Электродвигатель шаговый (Stepper motor)

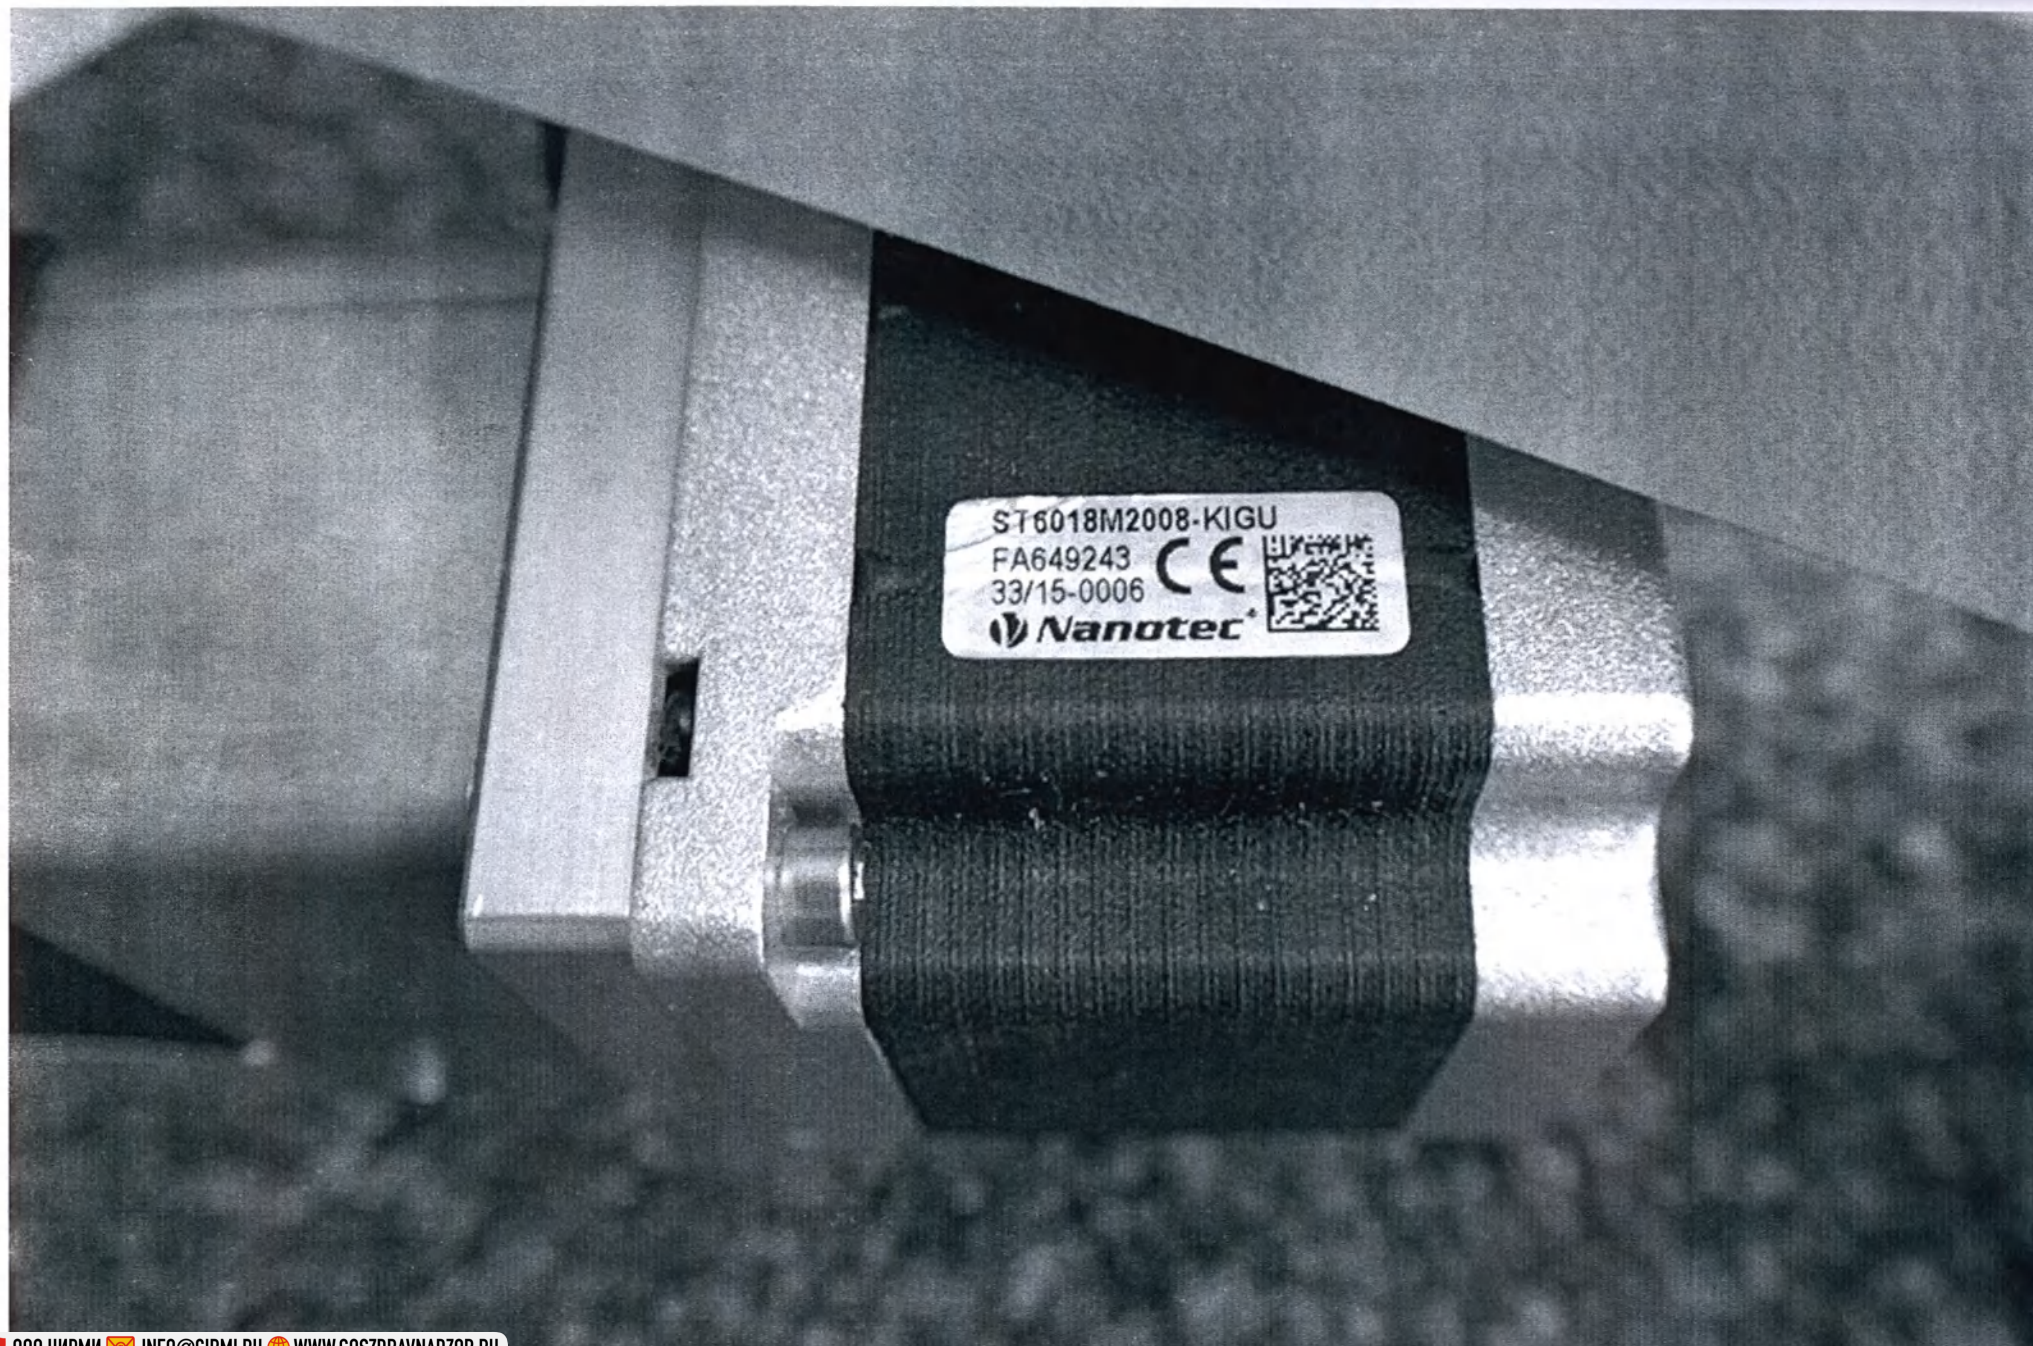


Фото 15. Блок управления шаговым электродвигателем TSA (Control Unit TSA)

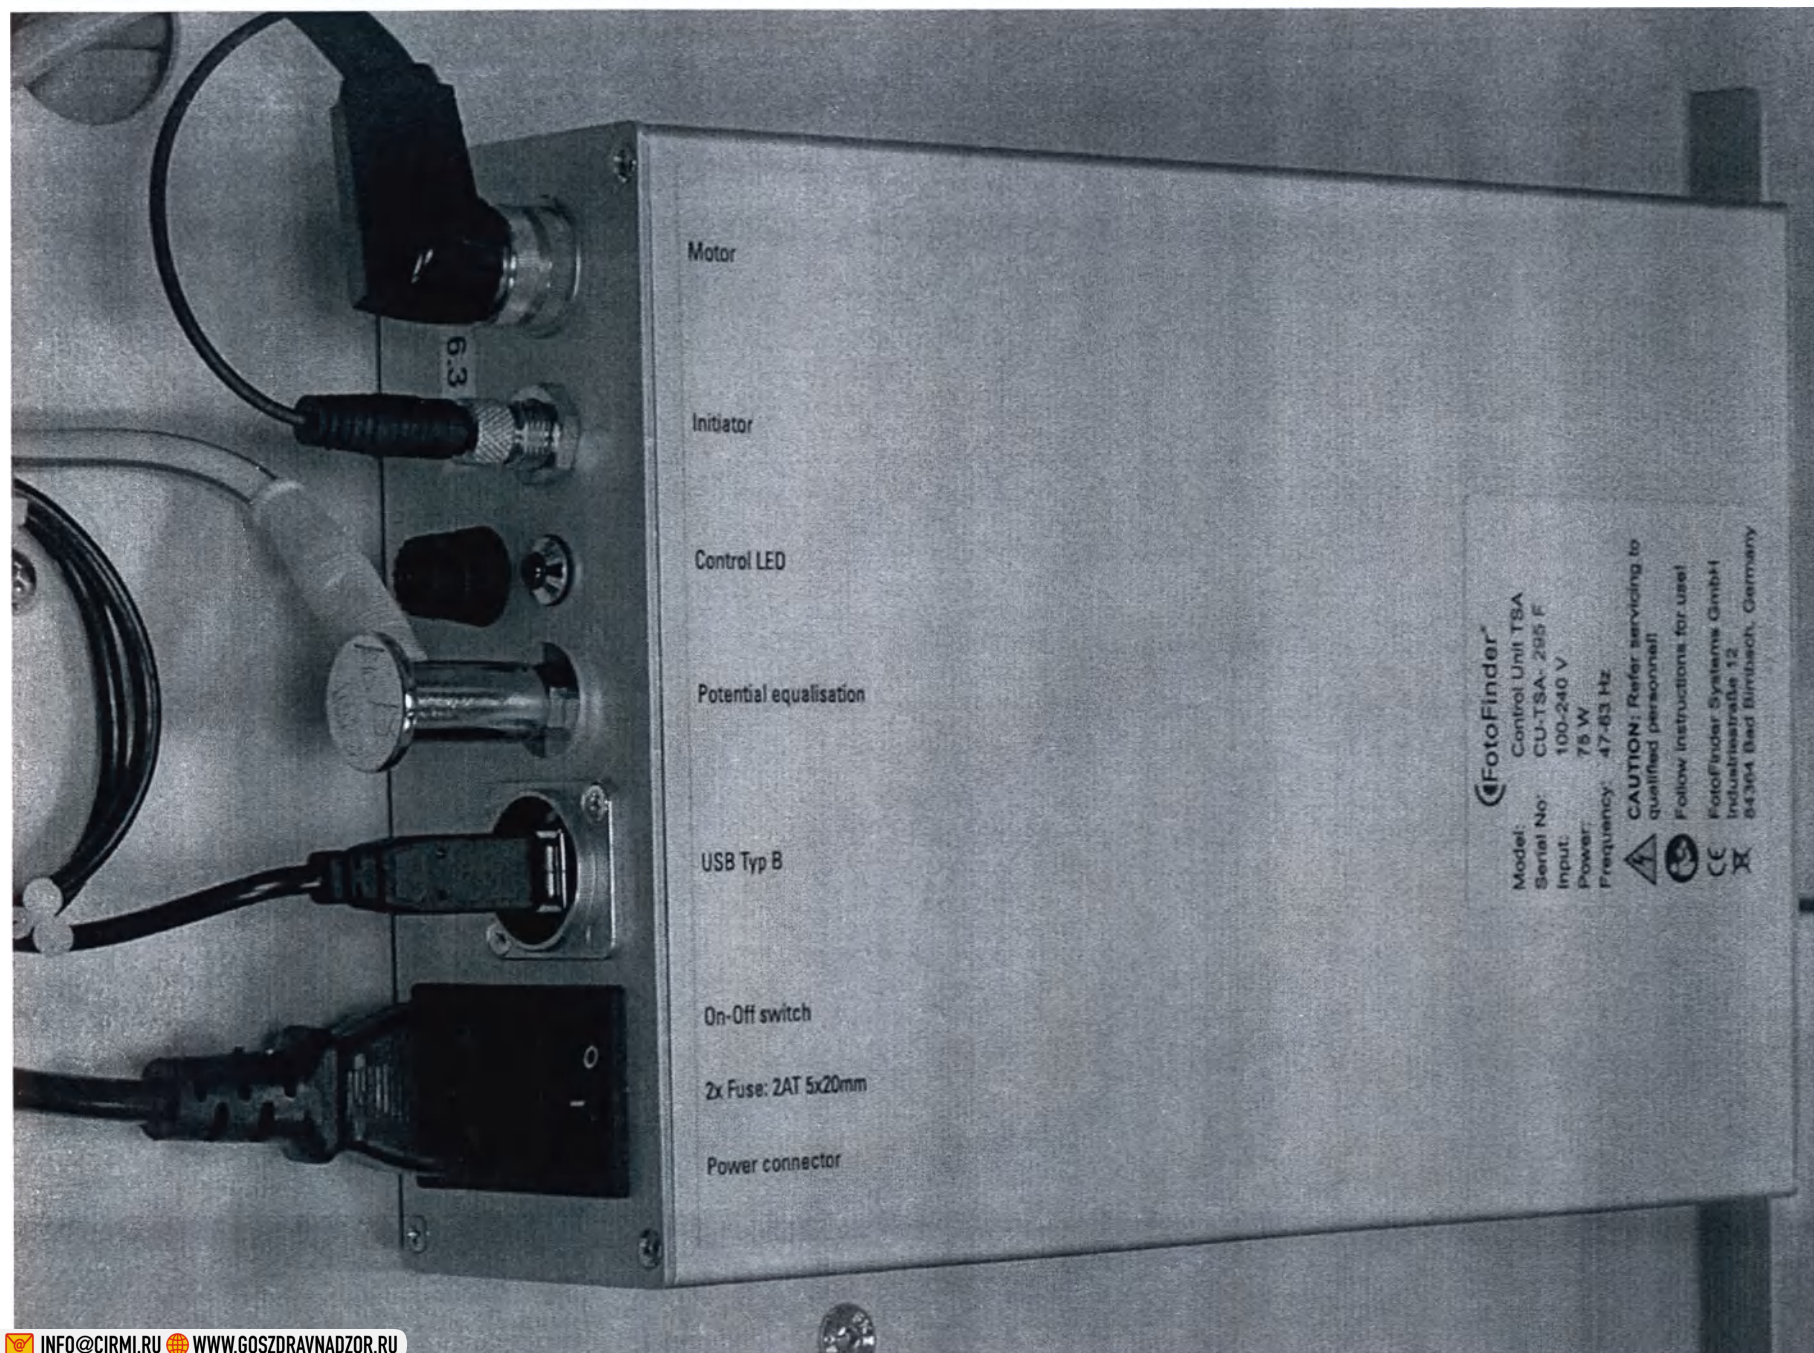
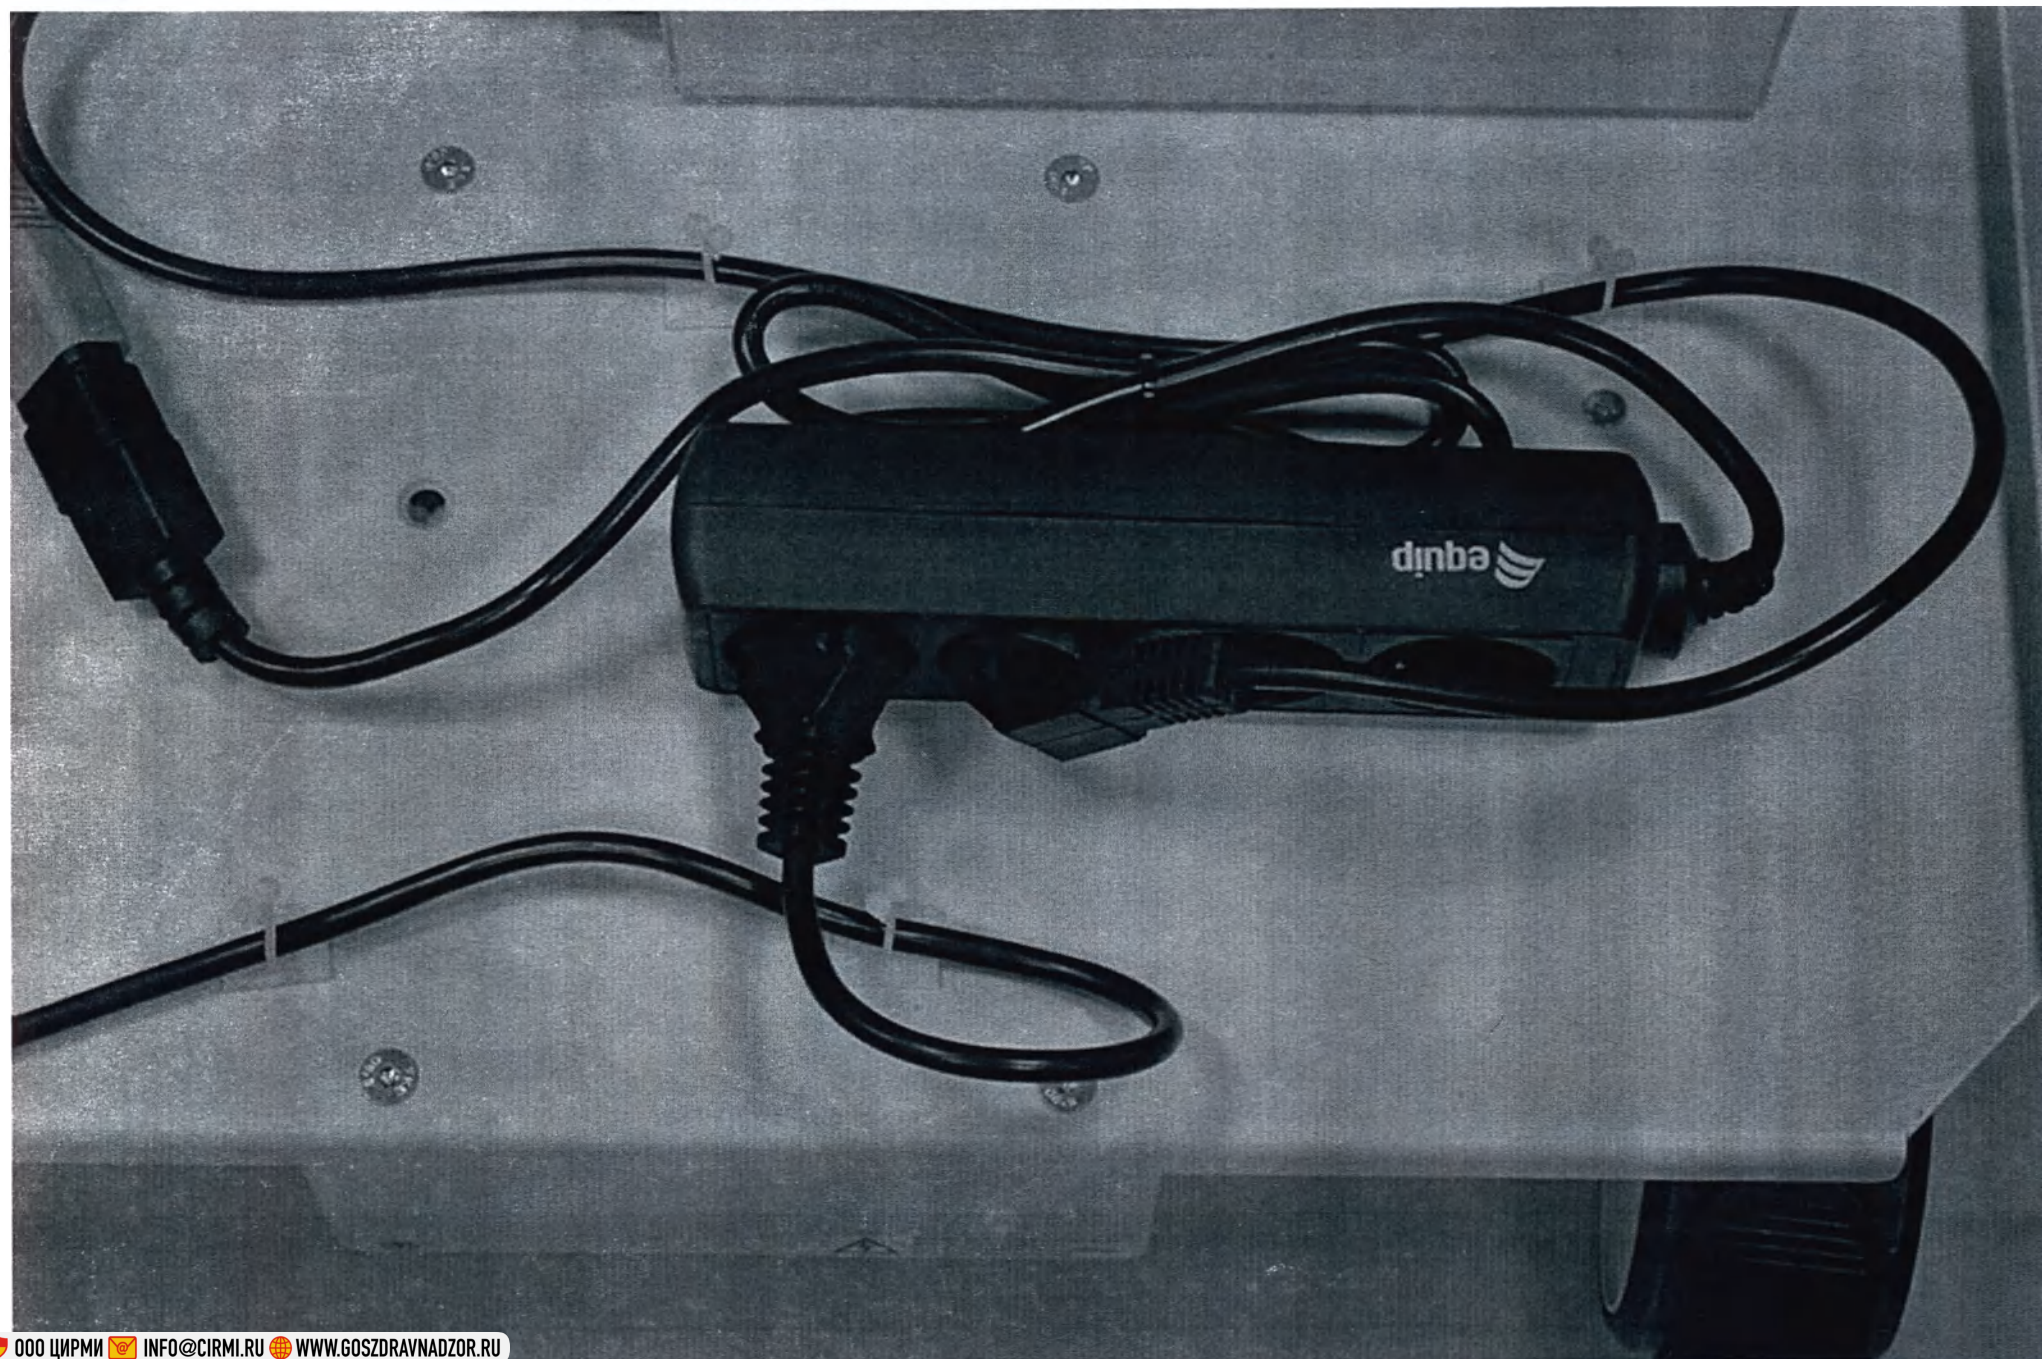


Фото 16. Разветвитель многорозеточный (Power Distribution Unit)



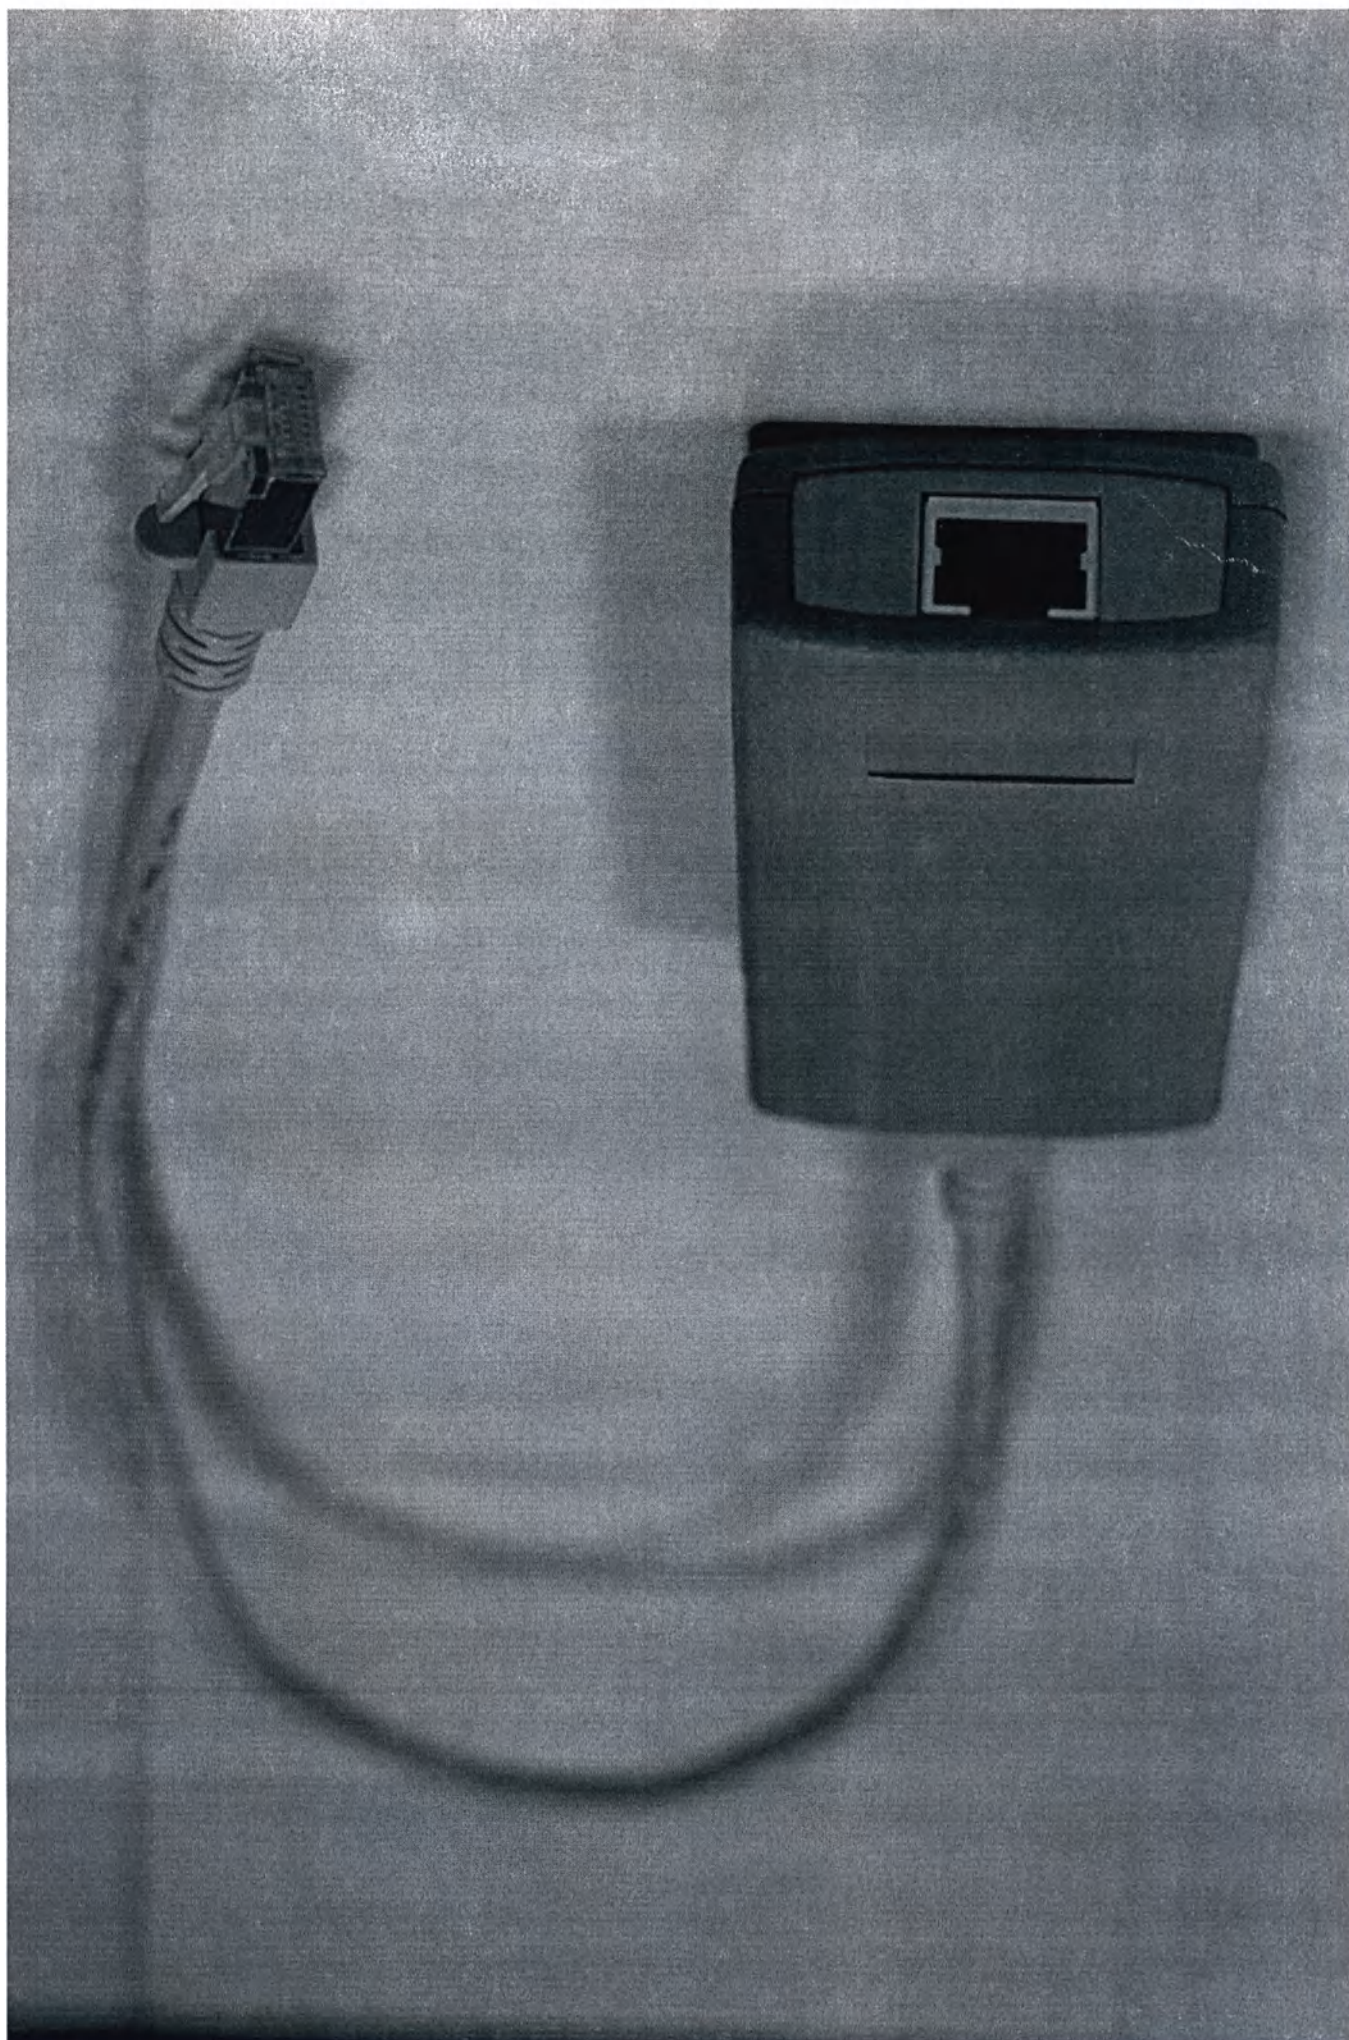
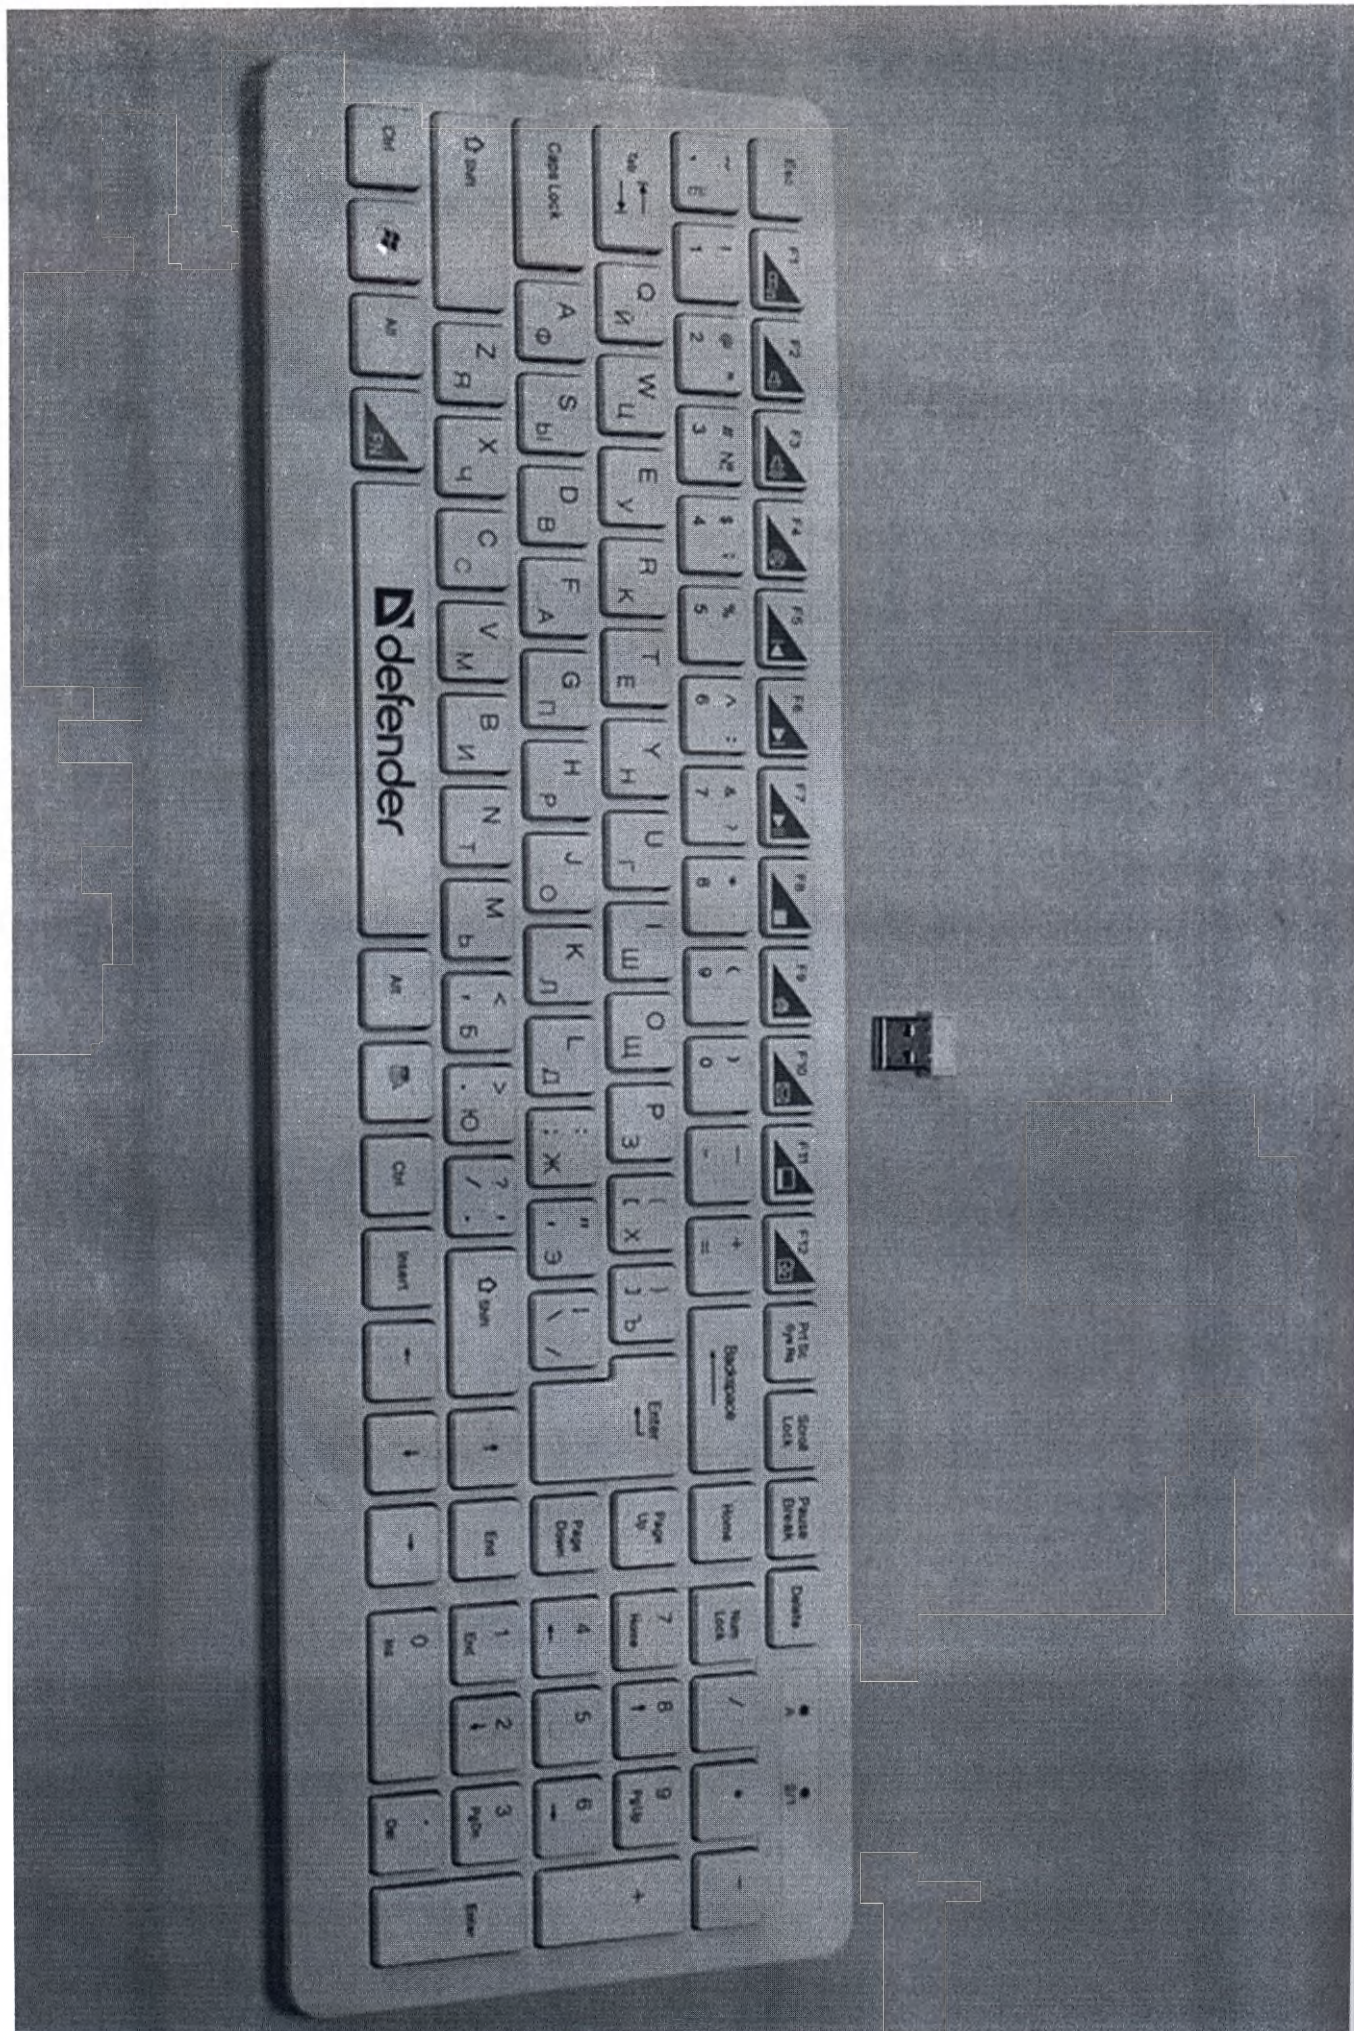


Фото 18. Кабель сетевой, длина 150 см (Power cable 150 cm long)





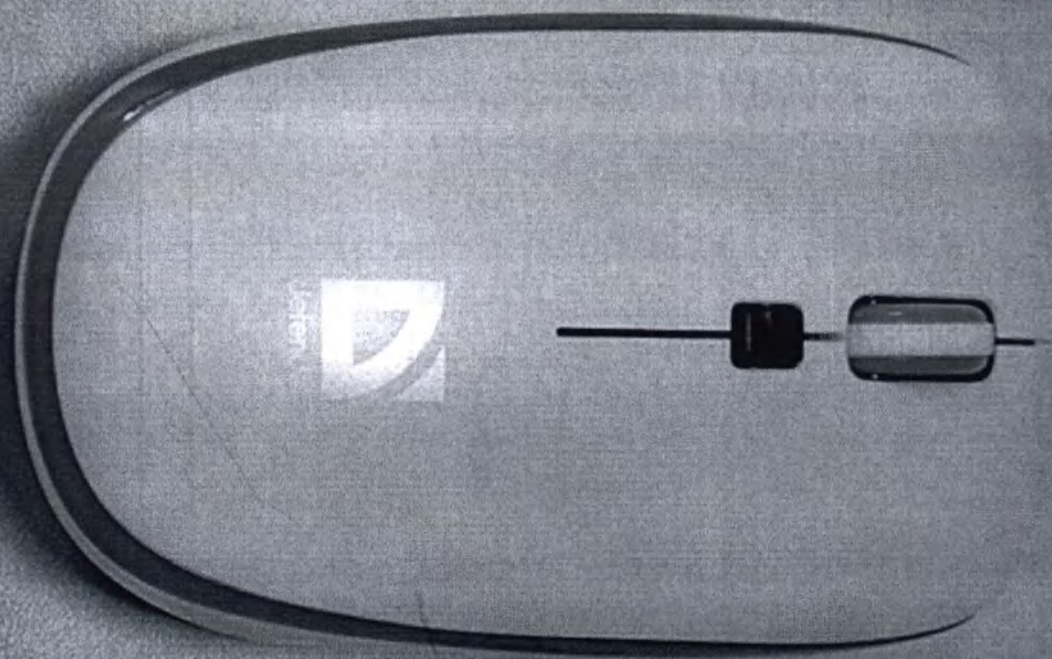


Фото 20. Манипулятор типа "мышь"



Перевод с английского языка на русский язык

Фотофайндер

Видеодерматоскоп

"Фотофайндер бодистудิโอ Эй-Ти-Би-Эм"
(Videodermatoscope "FotoFinder bodystudio ATBM")

Руководство пользователя

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство
перед началом работы с видеодерматоскопом
и держите его на своём рабочем месте!

2016

Страница 1 из 122

Фото 22. Объектив Canon EF-S 18-55 мм (Canon EF-S 18-55 mm Lens)



Фото 23. Объектив для дерматоскопии "Ди-Скоуп 2 Плюс Лене" (D-Scope II Plus Lens)



Фото 24. Фильтр поляризующий для объектива "Ди-Скоуп 2 Плюс Лене" (Polarizing Filter for D-Scope II Plus Lens)



Фото 25. Наконечник открыты для объектива "Дж-Скоуп 2 Плюс Джент" (Open top piece for D-SCOPE II Plus Gent)

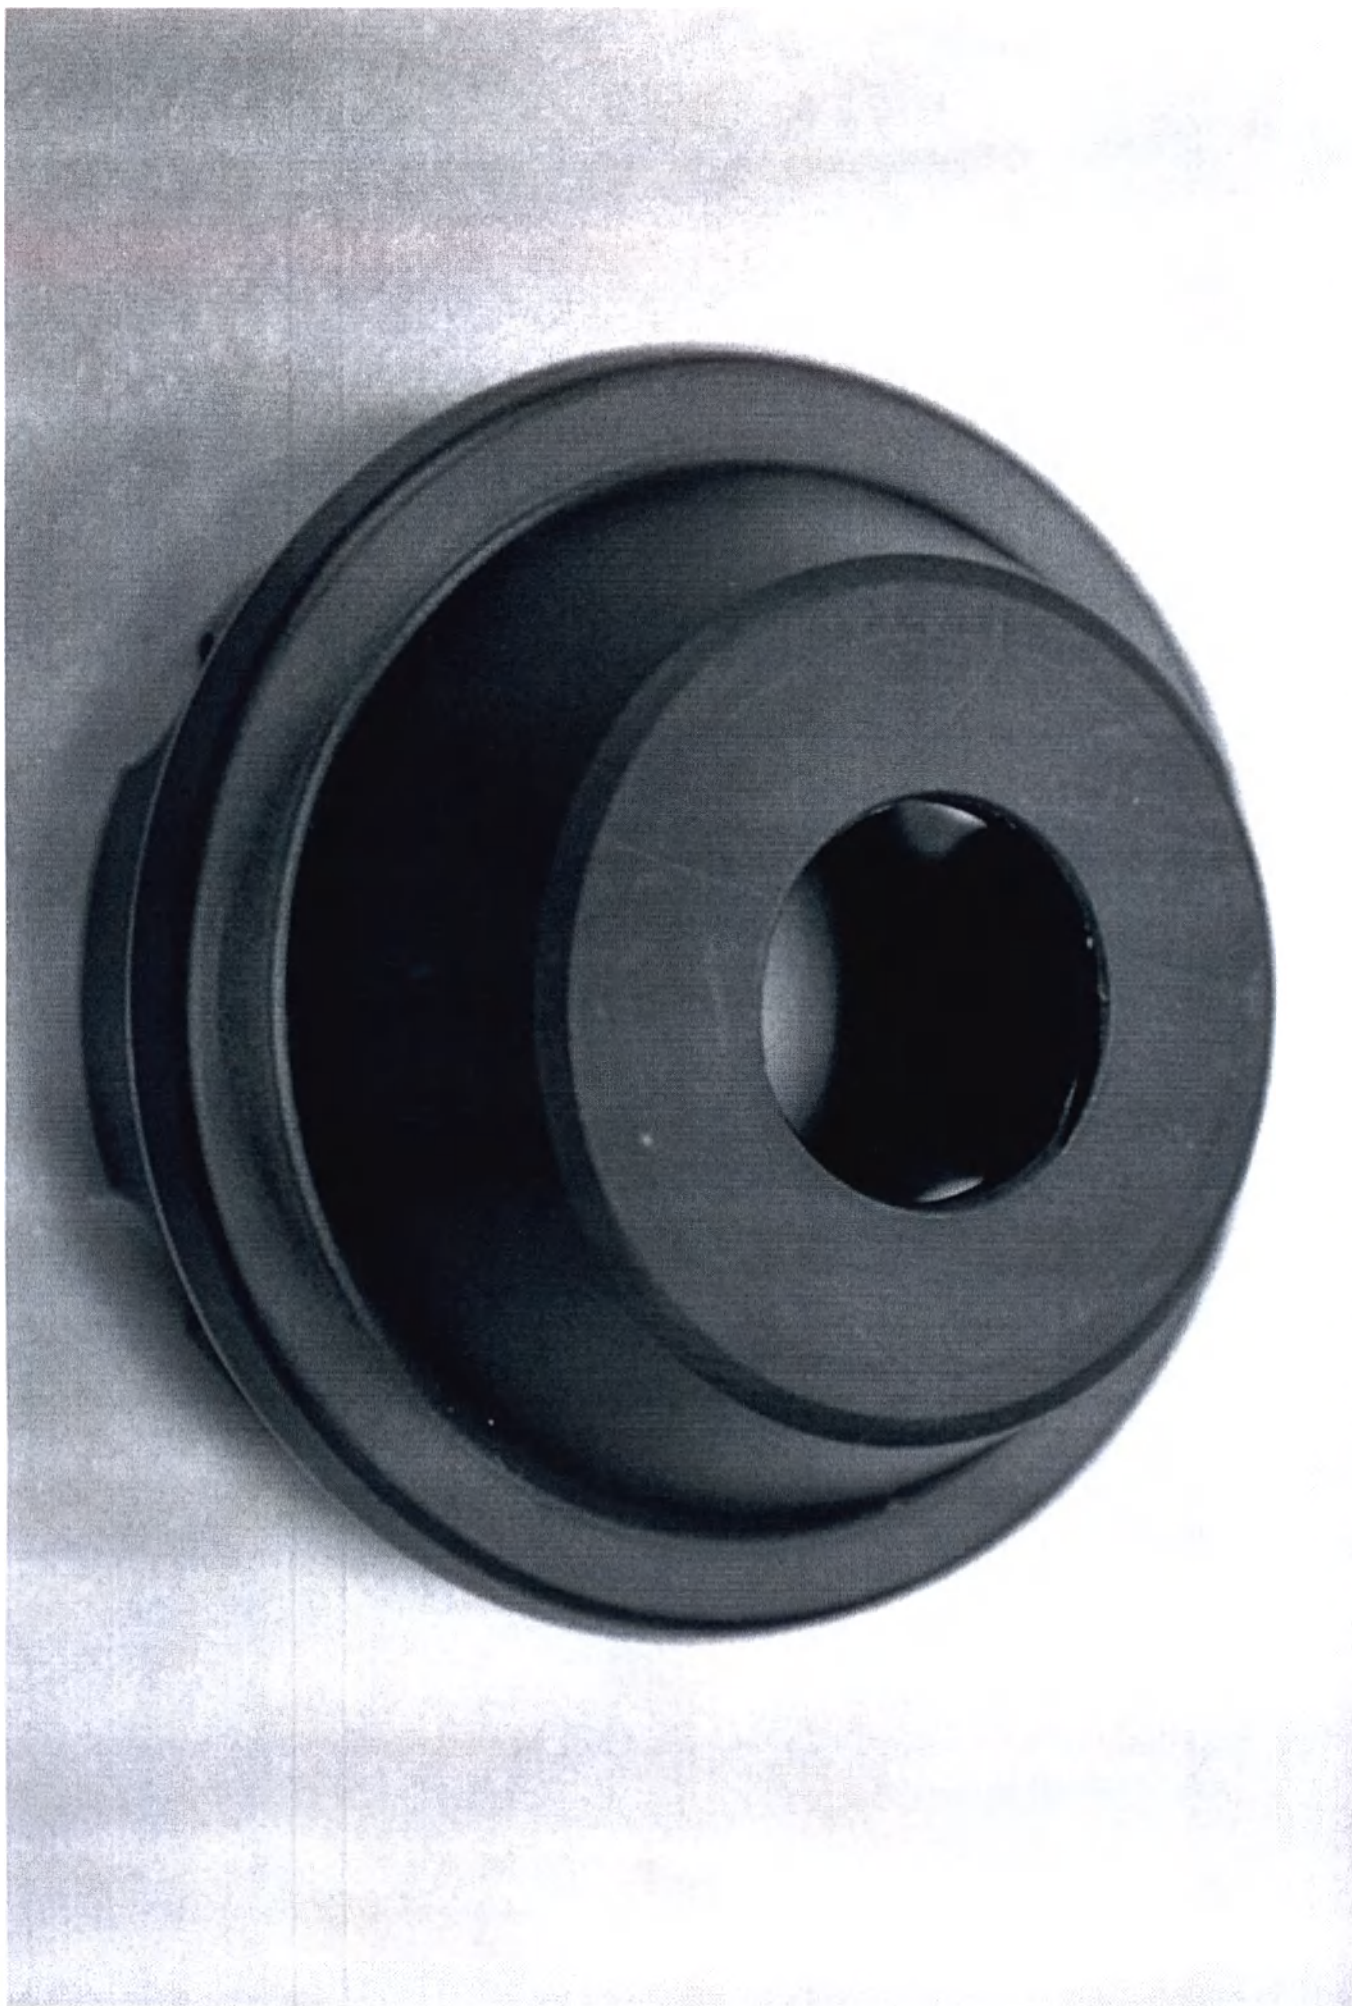
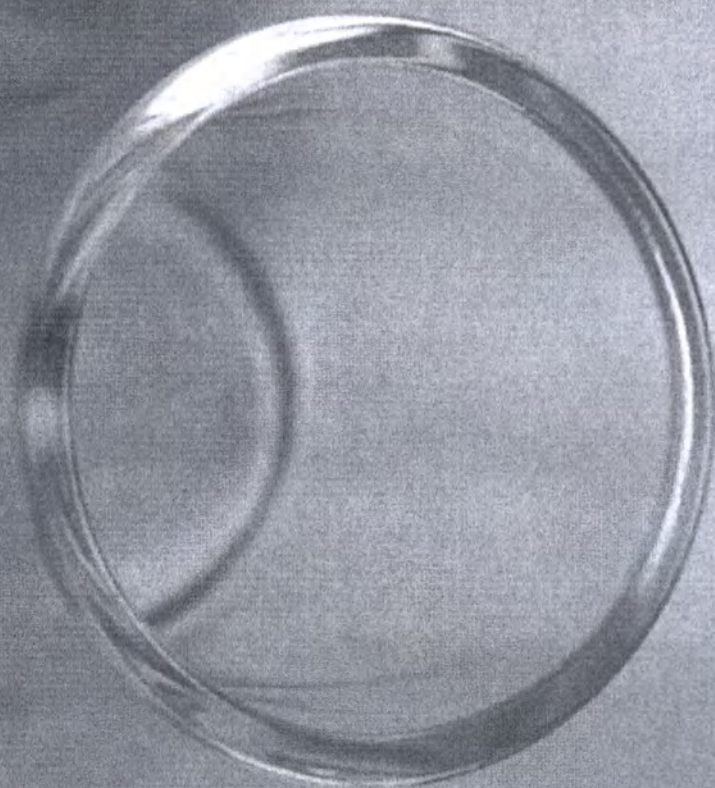
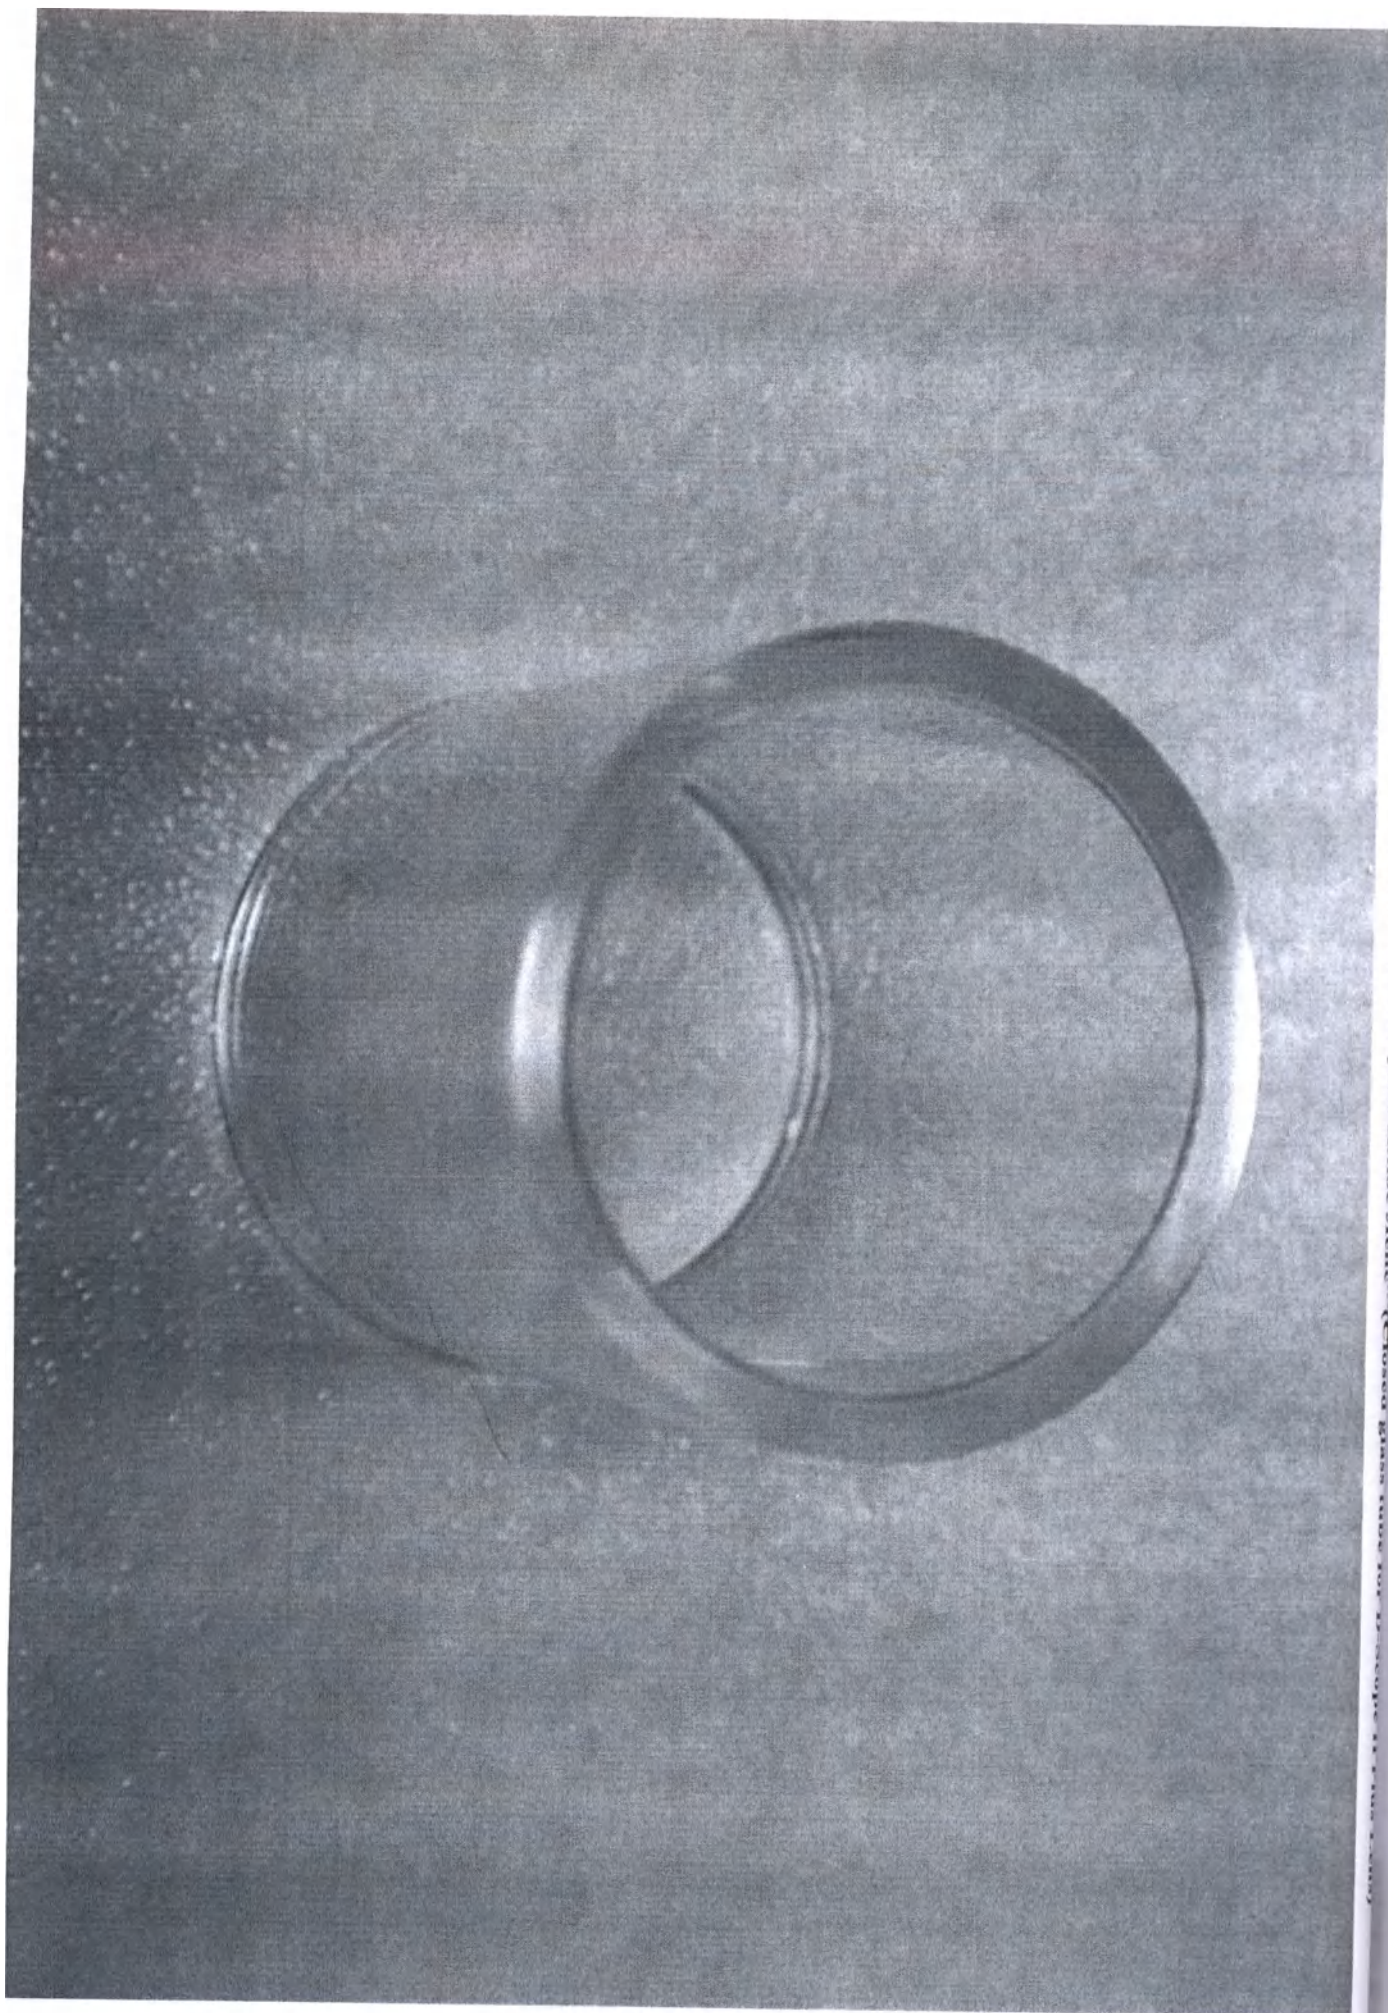




Рис. 2. Закрытая верхняя часть для D-SCOPE II Plus (линза)





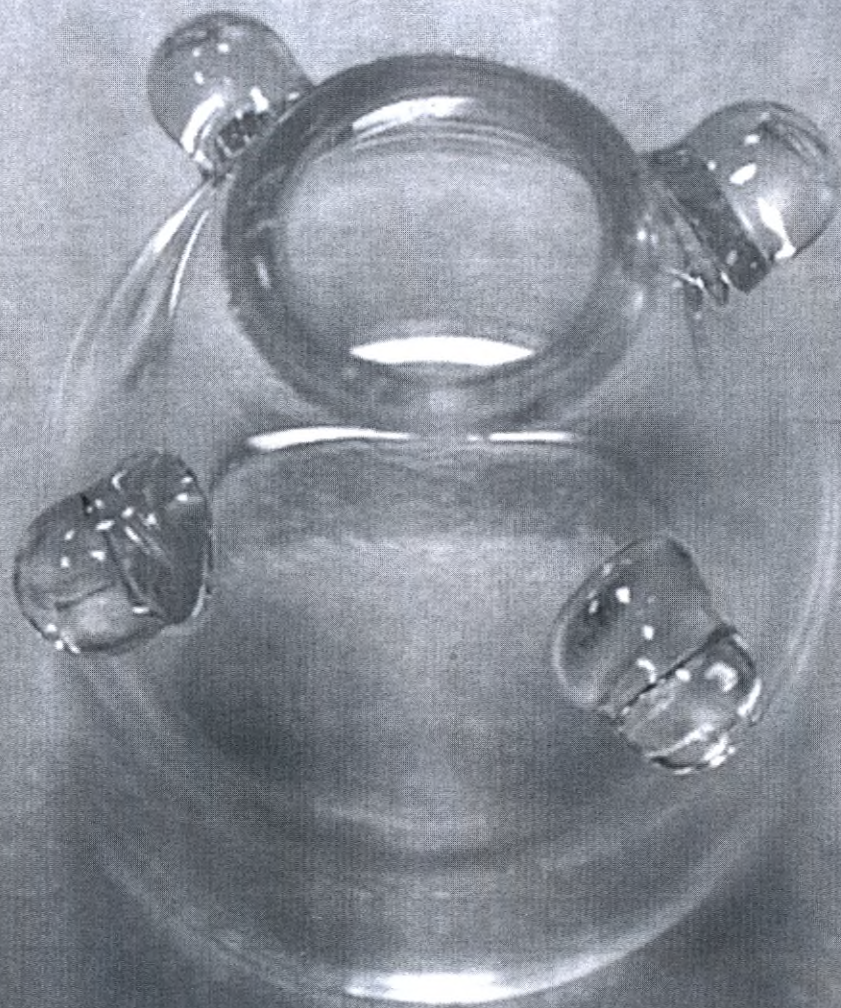


Фото 30. Объектив "Ди-Скоуп 3 Ленс" (D-Scope III Lens)

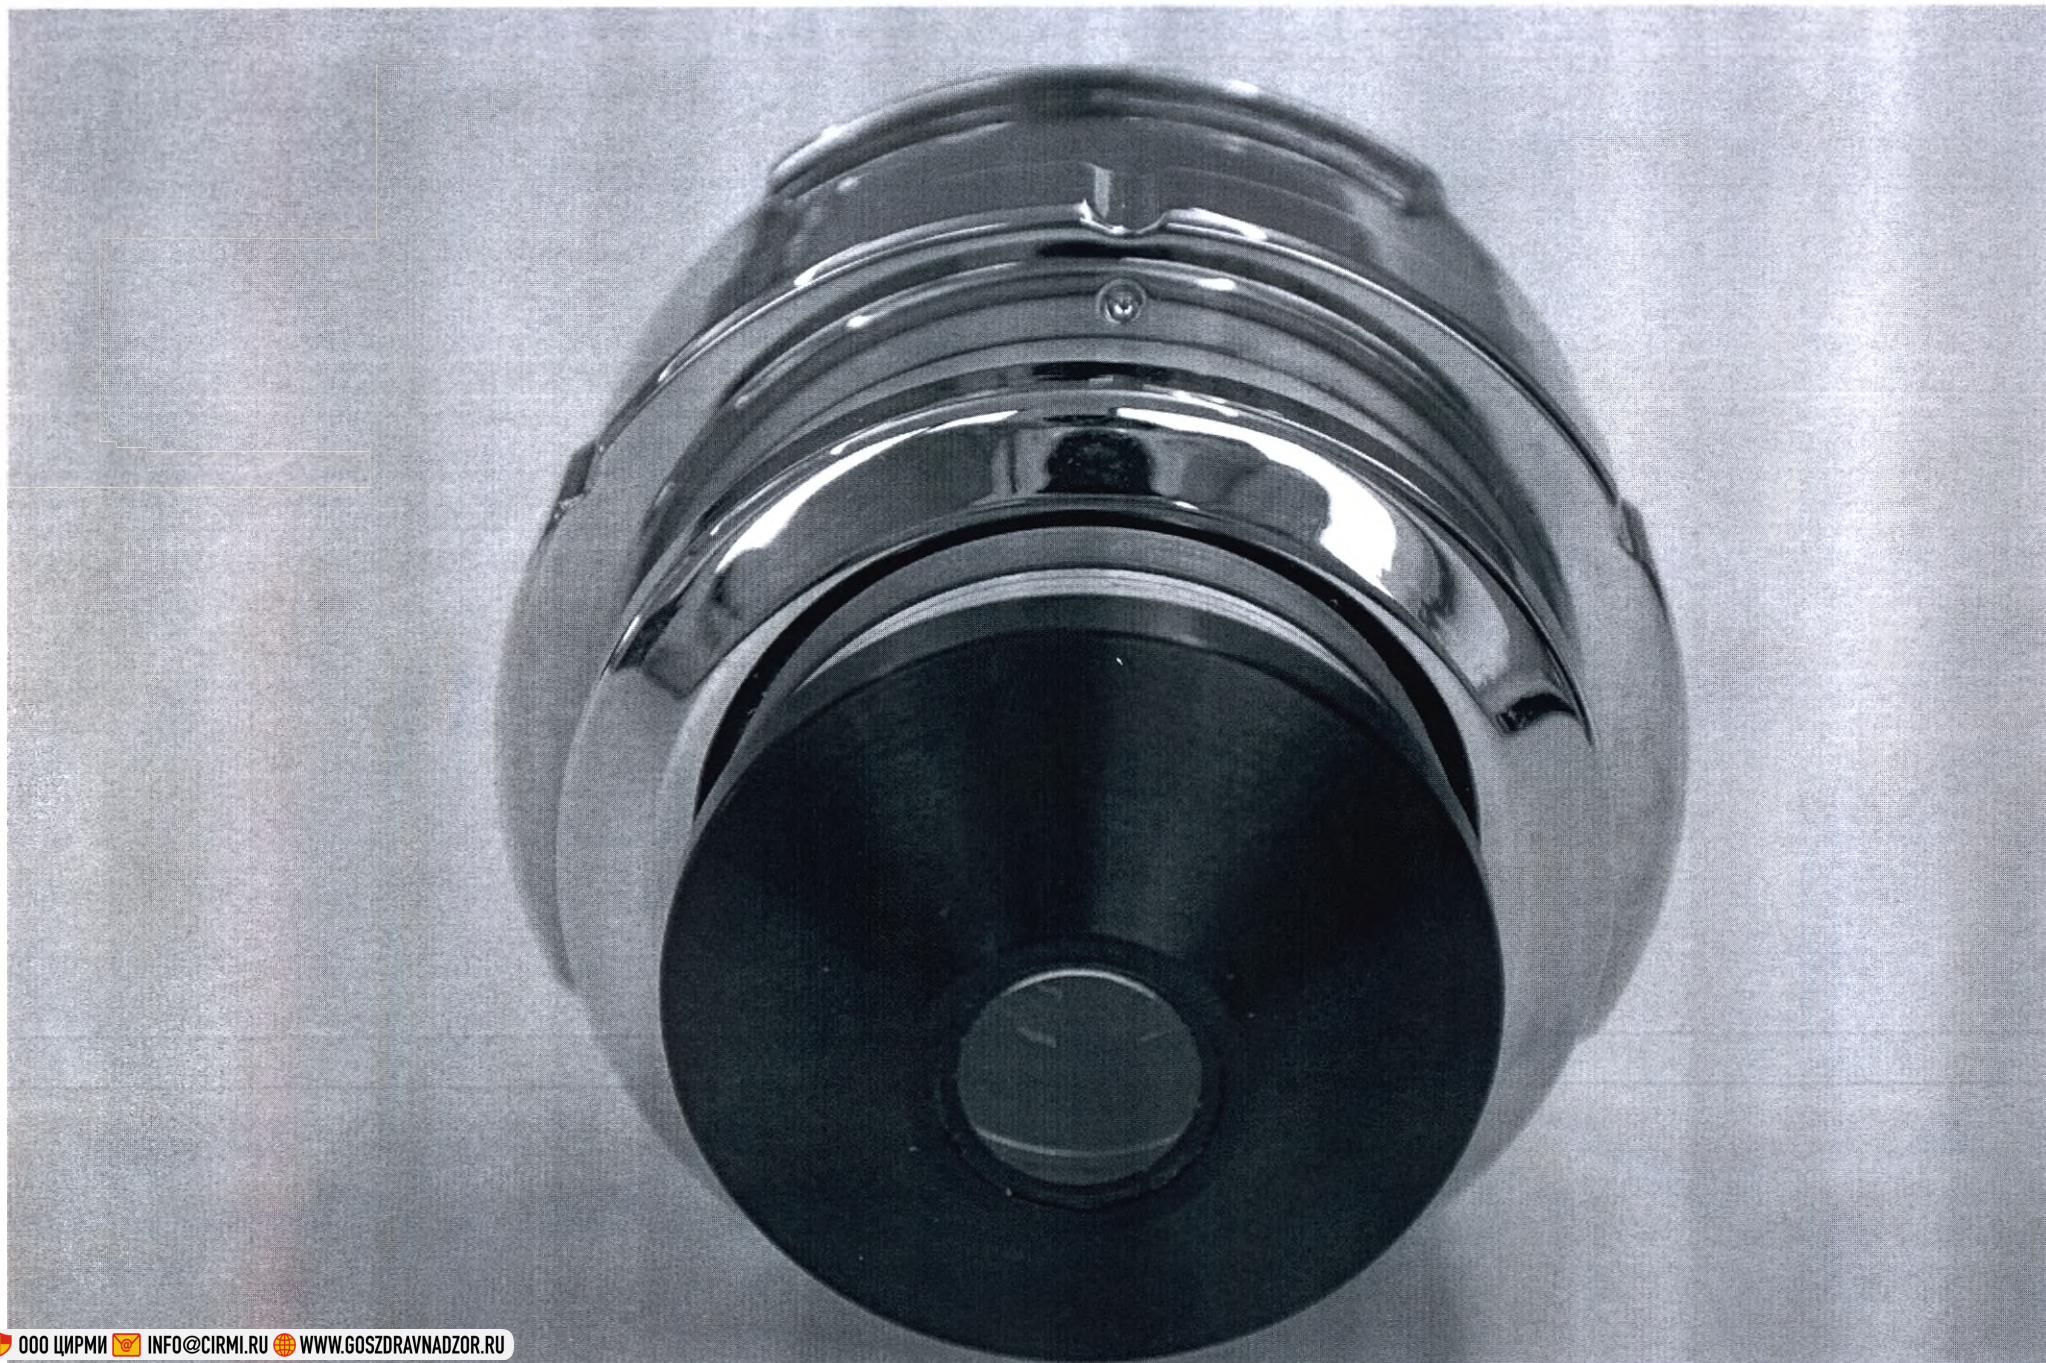


Фото 31. ФД-объектив (FD-Lens)



Фото 32. Накидка из чёрной ткани для ФД-объектива (Black cloth for FD-Lens)

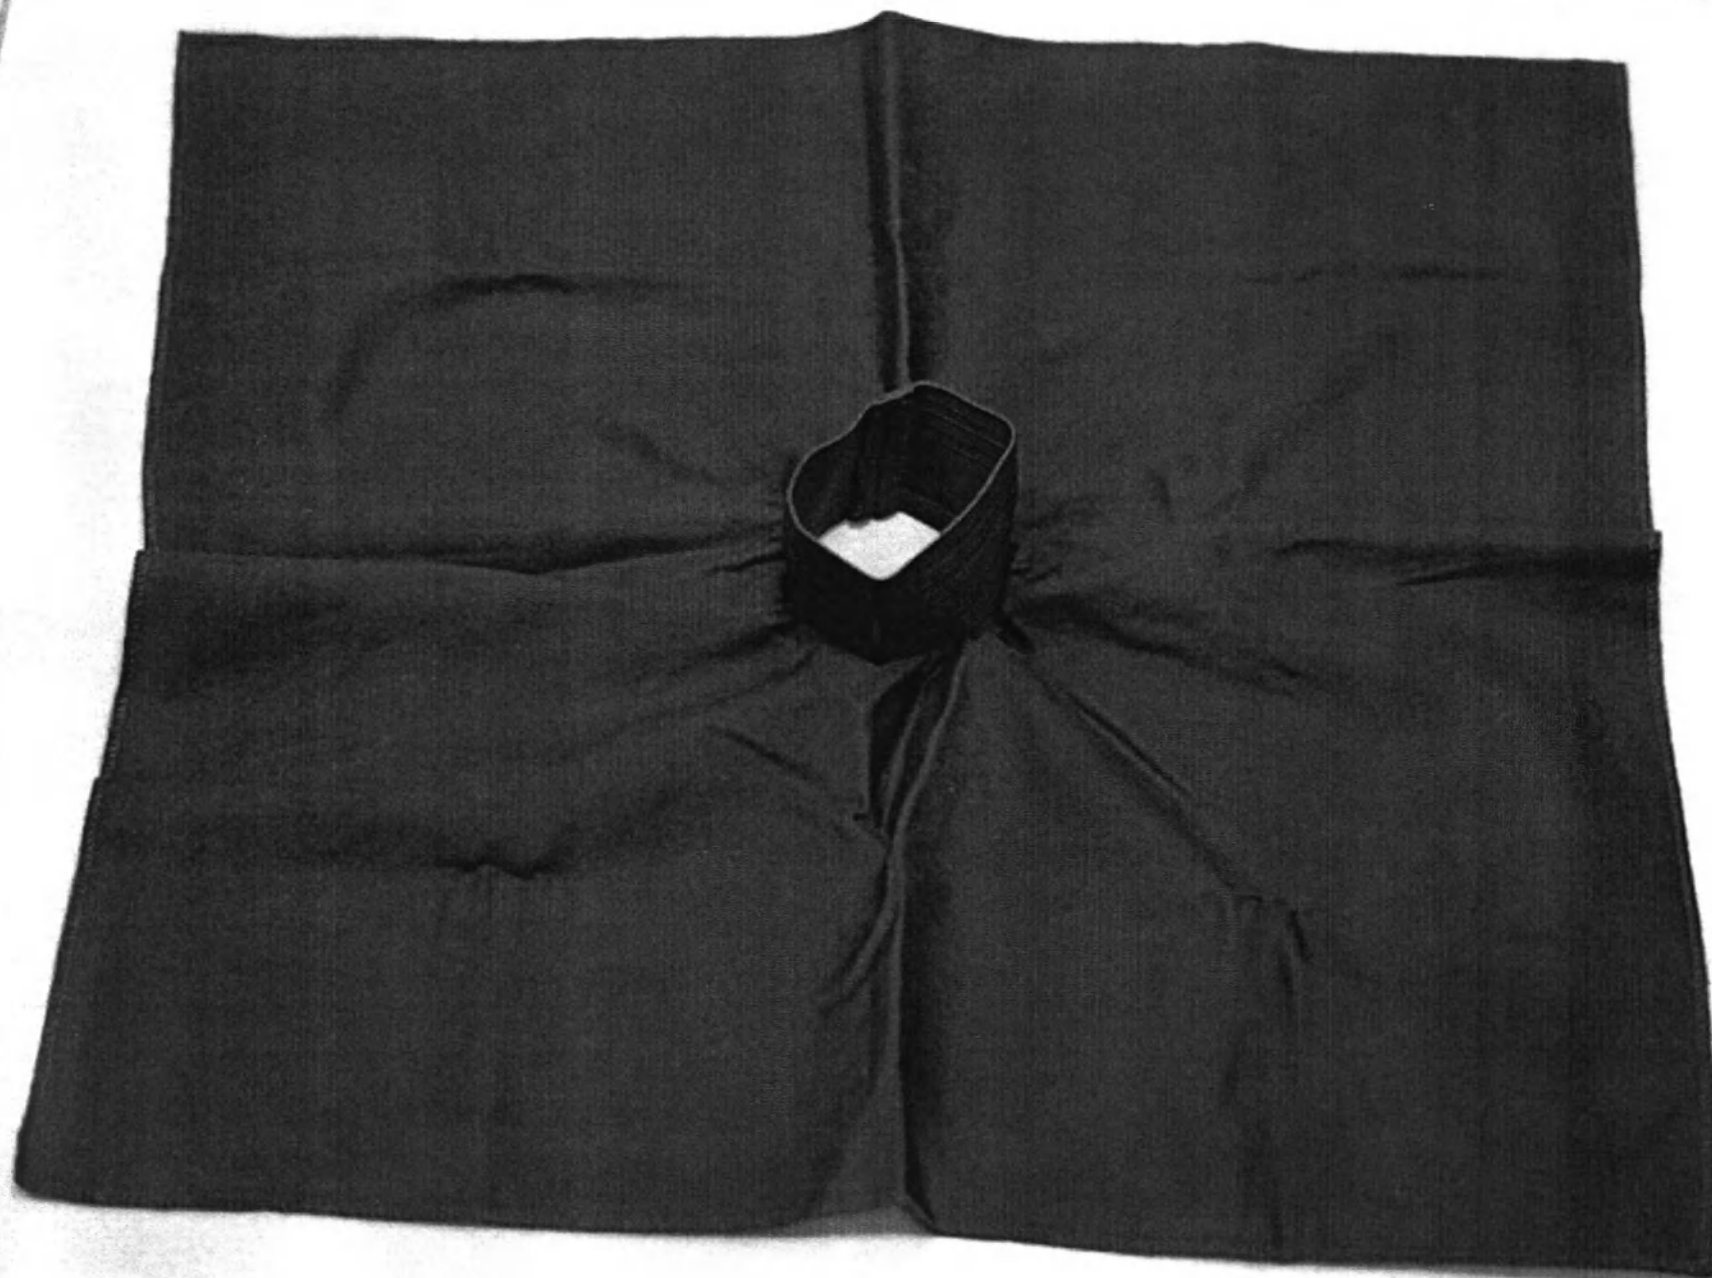


Фото 33. Фильтр поляризующий для фотокамеры (FotoFinder Pol Body)

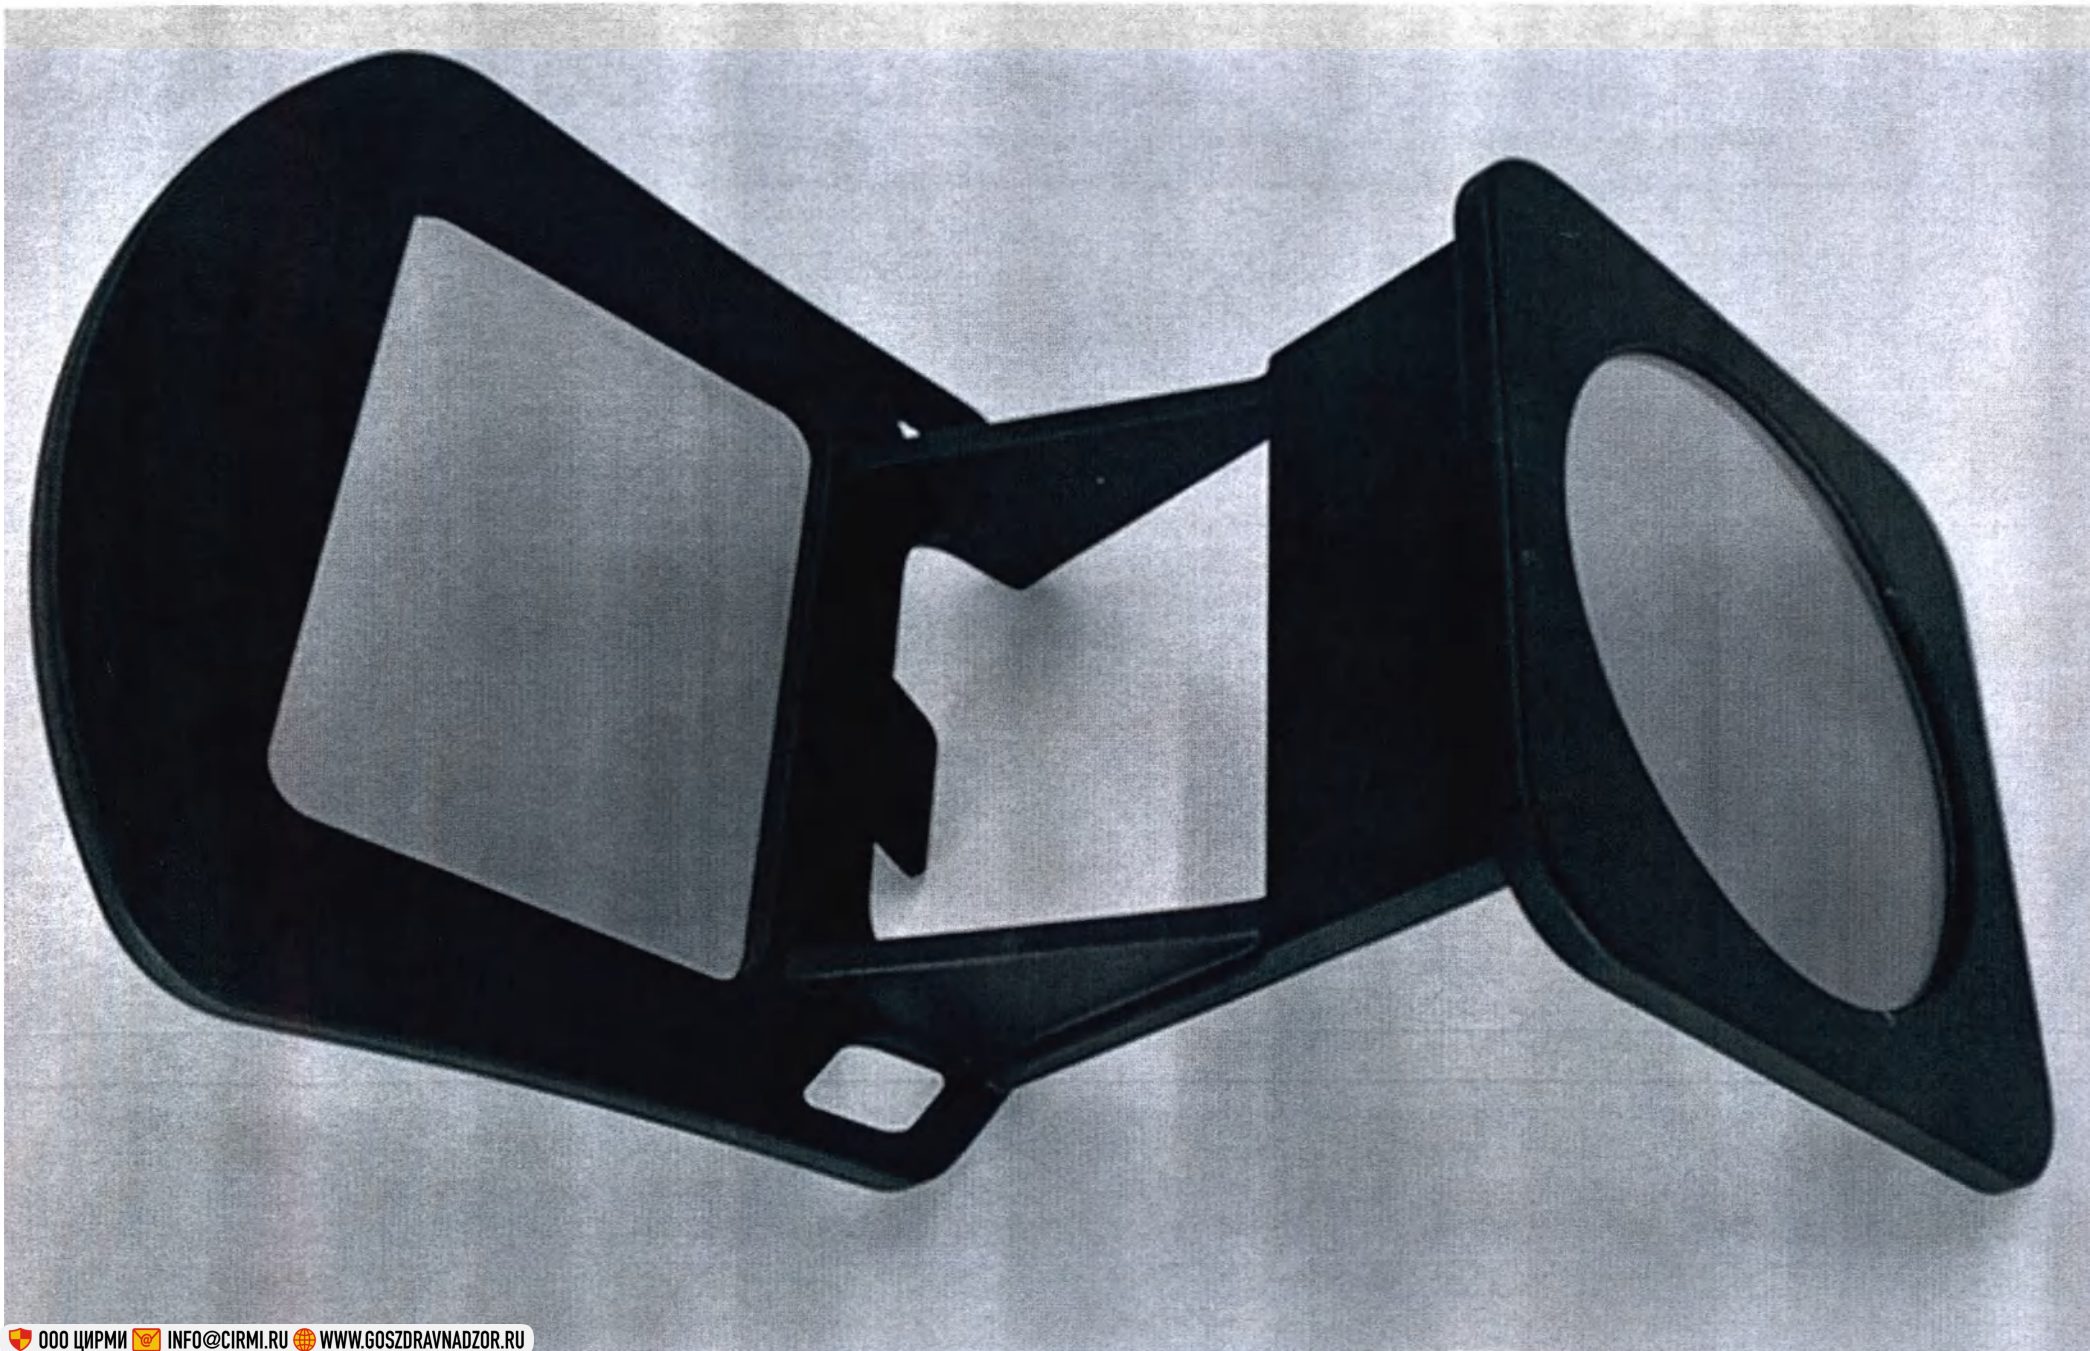


Фото 34. Коврик для фотосъёмки пациента (Positioning mat)


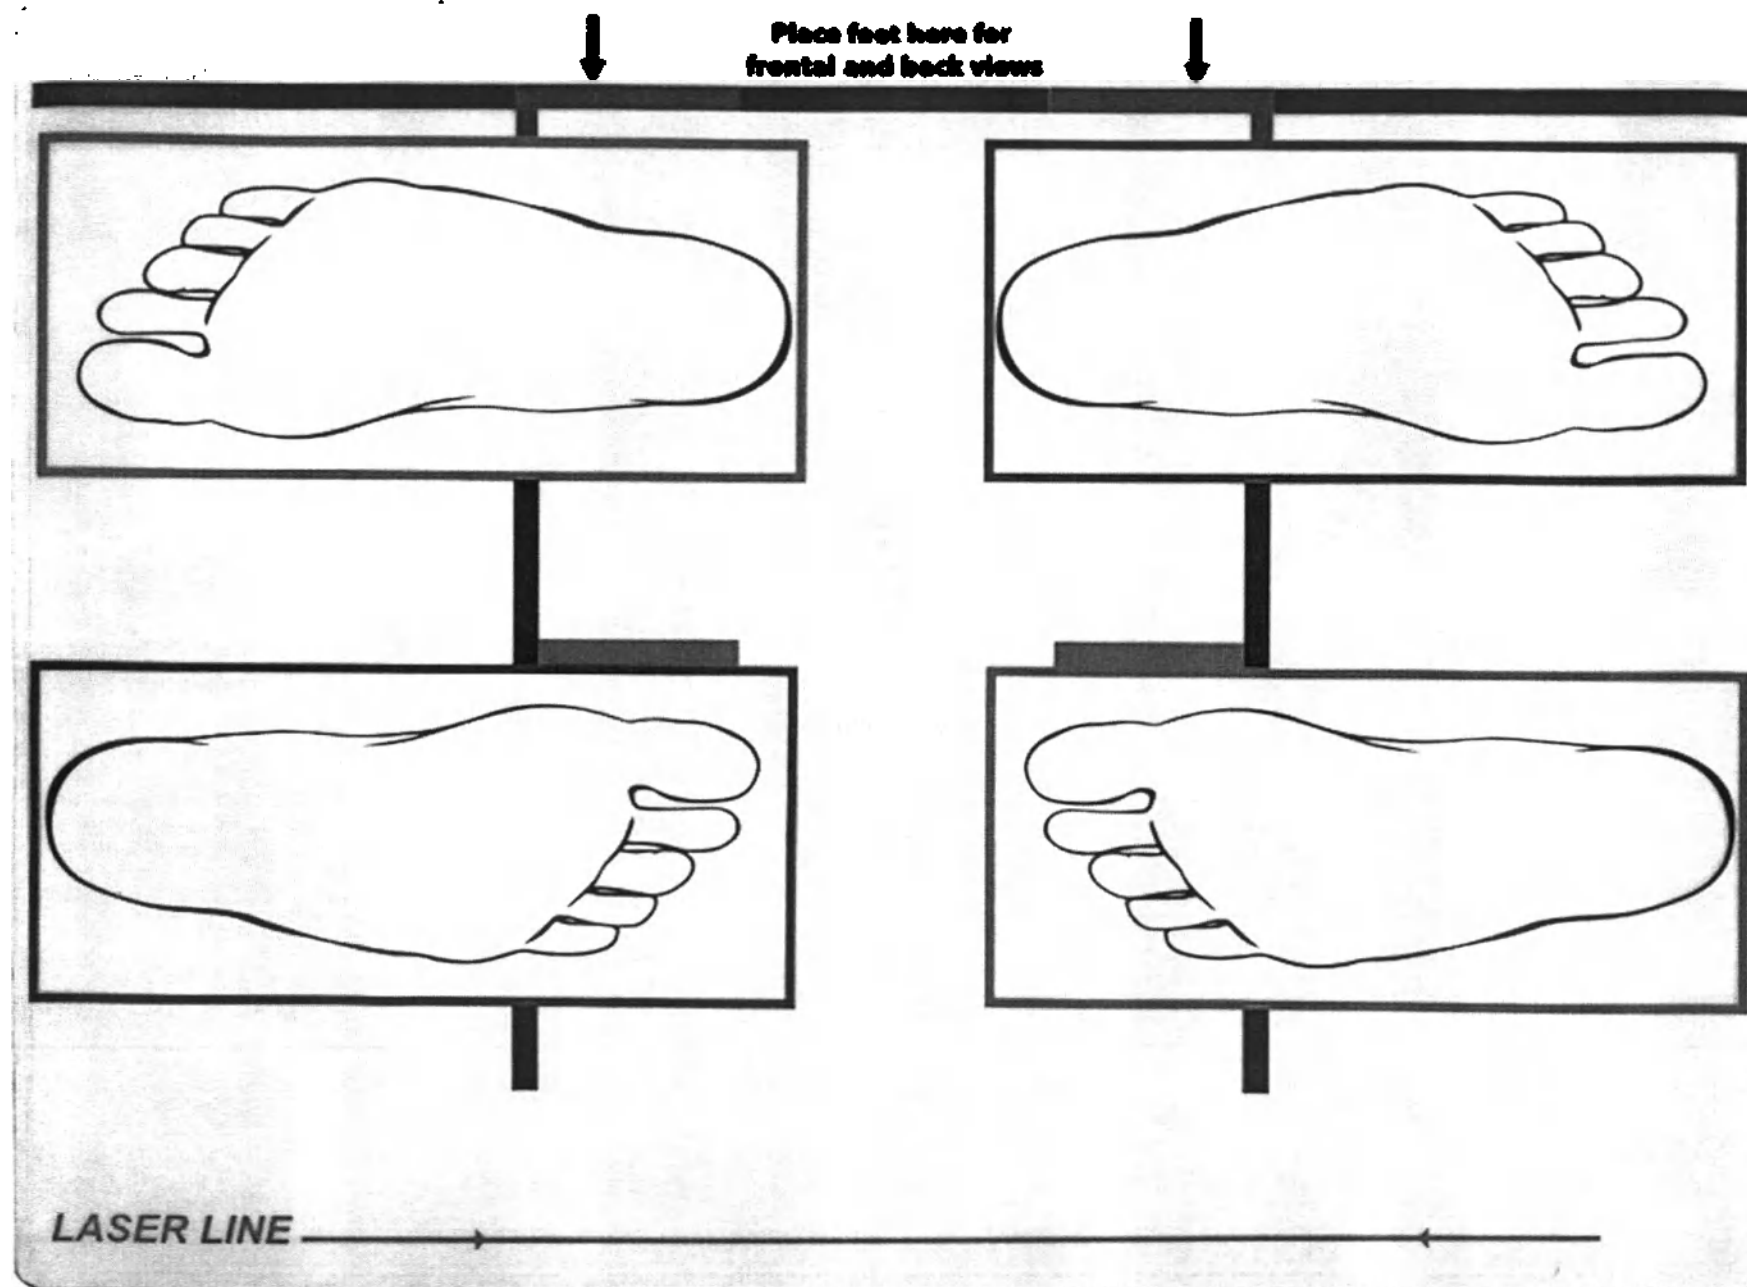


Фото 35. Полотно фоновое синее для фотосъёмки (ATBM Photo Background (blue))

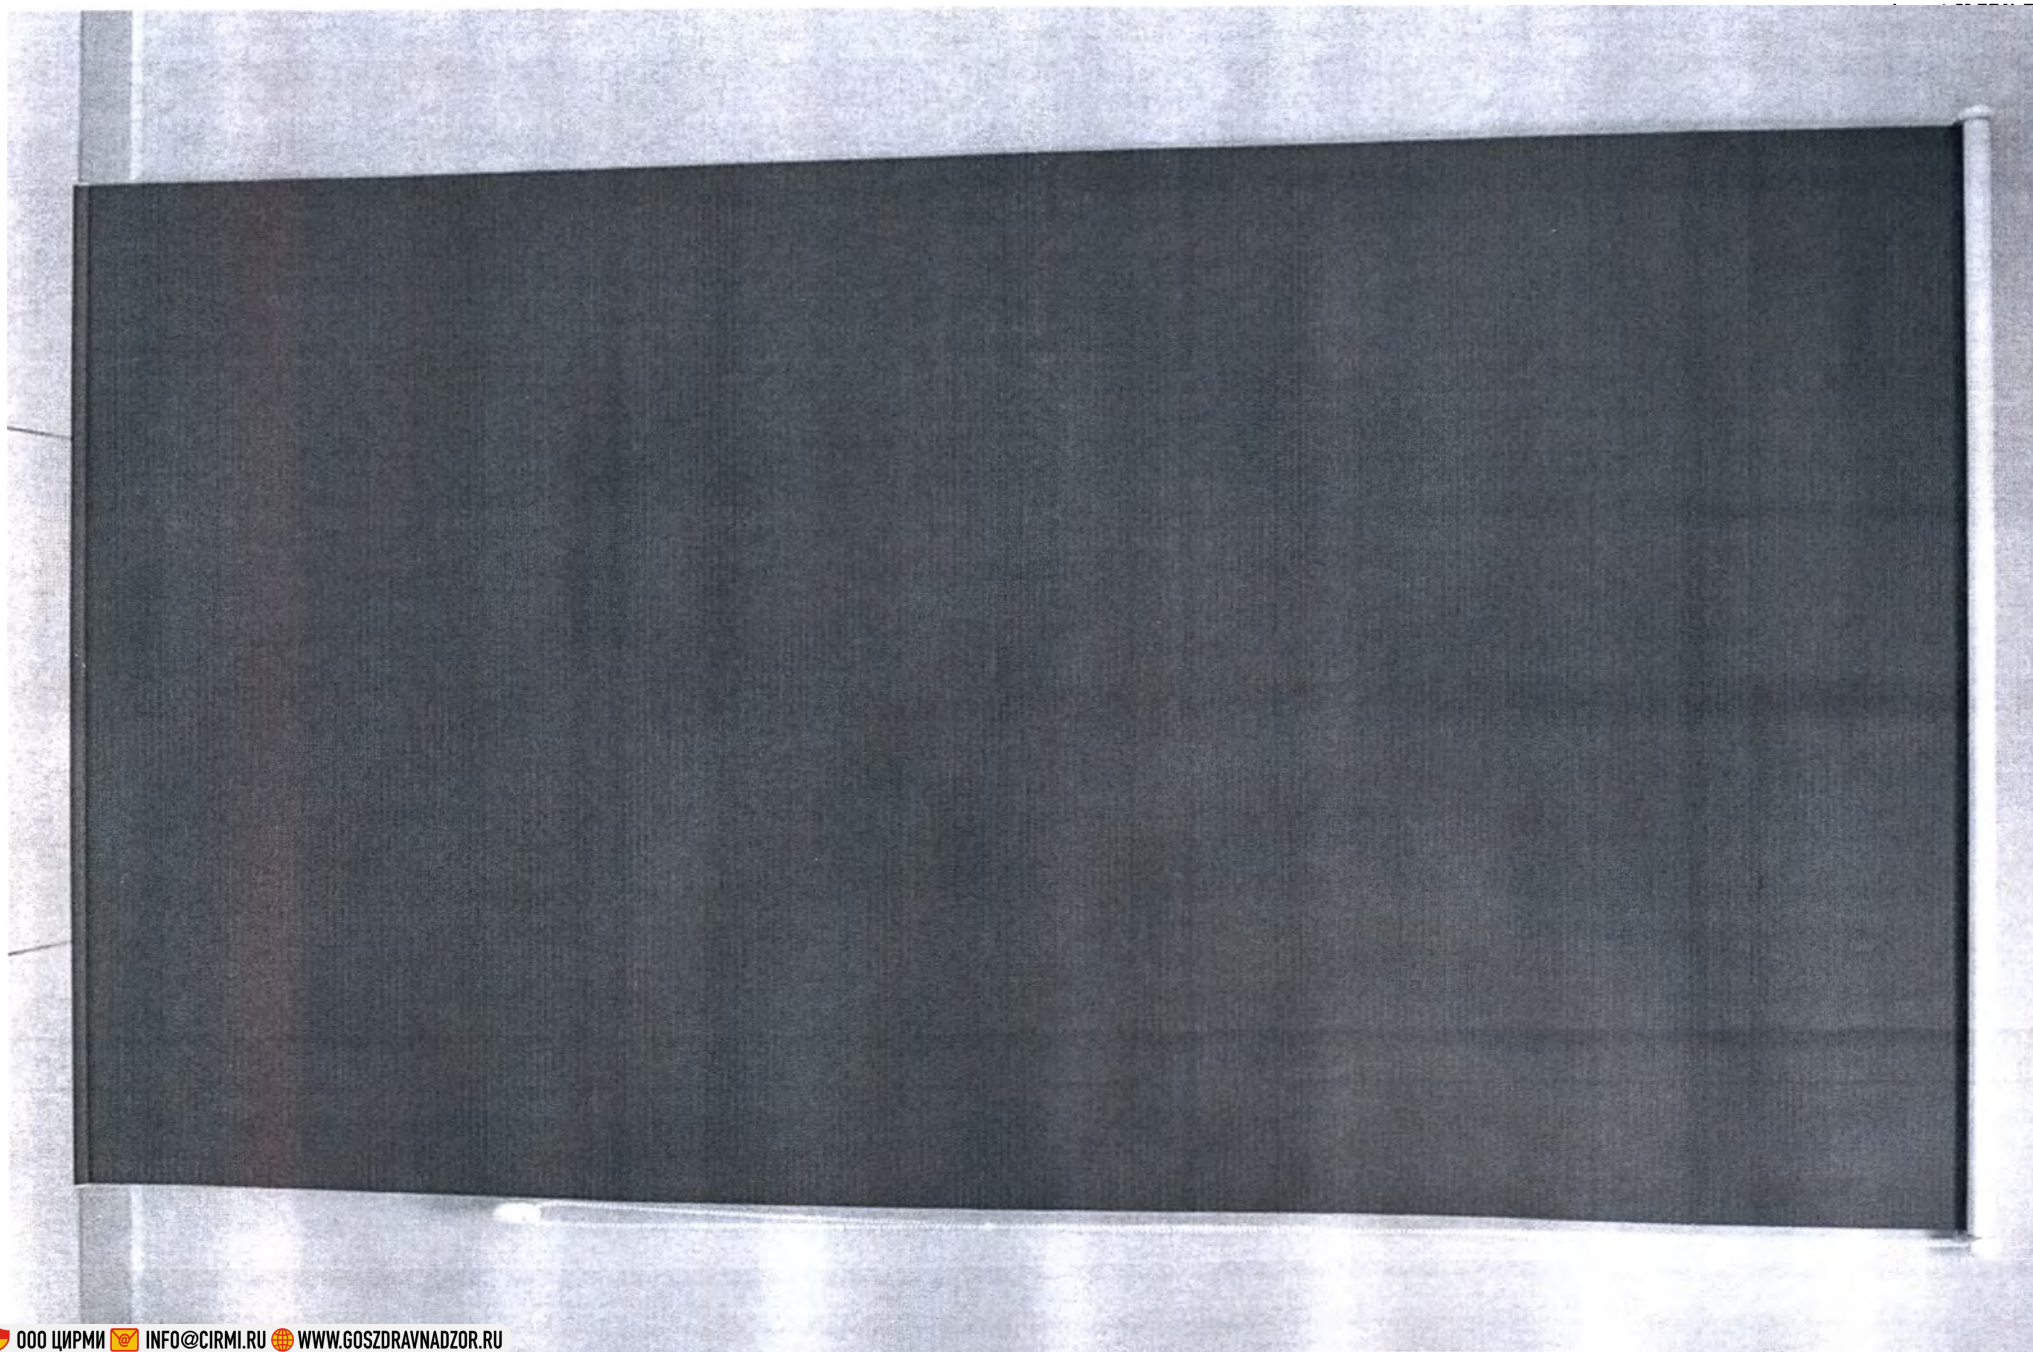

Генеральный директор _____

Фомин Г. Г.

ООО "МАКСмедикал"

" 08 " *февраль* 2016 г.





Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 39
лист (-а, -ов)

Генеральный директор
ООО "МАКСМЕДИКАЛ"

+ Фомин Г. Г.