

congelar. • Conservar en la caja original. • No utilizar el producto después de la fecha de caducidad. • Conservar en la caja original. Aunque no es necesario, se aconseja conservar el producto en el frigorífico. En este caso, habrá que esperar a que alcance la temperatura ambiente antes de usarlo. No congelarlo. • Mantener lejos del alcance de los niños.

ADVERTÊNCIAS E CONSERVAÇÃO: Produto descartável • Esteril. Não deve ser esterilizado de novo. • Não utilize o FISIOGRAFT após a data de validade indicada na embalagem. • Conservar na caixa de origem. Embora não seja necessário, é preferível conservar o produto no frigorífico; nesse caso, antes de utilização, aguarde que o produto atinja a temperatura ambiente. • Conserve fora do alcance das crianças.

5

CE 0426

FISIOGRAFT
SPUGNA SPONGE
SCHWAMM
EPONGE ESPONJA





FISIOGRAFT SPUGNA - POLVERE - GEL

LSP 1005

Il nome del medicinale FISIOGRAFT è registrato.

Indicazioni: FISIOGRAFT è un medicinale a base di silicio, che agisce sulla circolazione sanguigna, migliorando la microcircolazione e favorendo la rigenerazione dei tessuti. È indicato per il trattamento delle varicosità, dell'eczema, della psoriasi, della dermatite, della cellulite, della stasi venosa, della tromboflebitide, della sindrome da congestione venosa, della sindrome da congestione linfatica, della sindrome da congestione linfatica e della sindrome da congestione linfatica.

Confezionamento: FISIOGRAFT è disponibile in tre forme: SPUGNA, POLVERE e GEL. La SPUGNA è un medicinale a base di silicio, che agisce sulla circolazione sanguigna, migliorando la microcircolazione e favorendo la rigenerazione dei tessuti. È indicato per il trattamento delle varicosità, dell'eczema, della psoriasi, della dermatite, della cellulite, della stasi venosa, della tromboflebitide, della sindrome da congestione venosa, della sindrome da congestione linfatica, della sindrome da congestione linfatica e della sindrome da congestione linfatica.

Modalità d'uso: FISIOGRAFT è un medicinale a base di silicio, che agisce sulla circolazione sanguigna, migliorando la microcircolazione e favorendo la rigenerazione dei tessuti. È indicato per il trattamento delle varicosità, dell'eczema, della psoriasi, della dermatite, della cellulite, della stasi venosa, della tromboflebitide, della sindrome da congestione venosa, della sindrome da congestione linfatica, della sindrome da congestione linfatica e della sindrome da congestione linfatica.

FISIOGRAFT	SPUGNA	POLVERE	GEL
Forma farmacia	SPUGNA	POLVERE	GEL
Confezione	100 mg	100 mg	100 mg
Modalità d'uso	100 mg	100 mg	100 mg
Indicazioni	100 mg	100 mg	100 mg
Confezionamento	100 mg	100 mg	100 mg

Avvertenze: FISIOGRAFT è un medicinale a base di silicio, che agisce sulla circolazione sanguigna, migliorando la microcircolazione e favorendo la rigenerazione dei tessuti. È indicato per il trattamento delle varicosità, dell'eczema, della psoriasi, della dermatite, della cellulite, della stasi venosa, della tromboflebitide, della sindrome da congestione venosa, della sindrome da congestione linfatica, della sindrome da congestione linfatica e della sindrome da congestione linfatica.

FISIOGRAFT

SPUGNA SPONGE SCHWAMM EPONGE ESPONJA

Indicazioni: FISIOGRAFT è un medicinale a base di silicio, che agisce sulla circolazione sanguigna, migliorando la microcircolazione e favorendo la rigenerazione dei tessuti. È indicato per il trattamento delle varicosità, dell'eczema, della psoriasi, della dermatite, della cellulite, della stasi venosa, della tromboflebitide, della sindrome da congestione venosa, della sindrome da congestione linfatica, della sindrome da congestione linfatica e della sindrome da congestione linfatica.

Confezionamento: FISIOGRAFT è disponibile in tre forme: SPUGNA, POLVERE e GEL. La SPUGNA è un medicinale a base di silicio, che agisce sulla circolazione sanguigna, migliorando la microcircolazione e favorendo la rigenerazione dei tessuti. È indicato per il trattamento delle varicosità, dell'eczema, della psoriasi, della dermatite, della cellulite, della stasi venosa, della tromboflebitide, della sindrome da congestione venosa, della sindrome da congestione linfatica, della sindrome da congestione linfatica e della sindrome da congestione linfatica.

Modalità d'uso: FISIOGRAFT è un medicinale a base di silicio, che agisce sulla circolazione sanguigna, migliorando la microcircolazione e favorendo la rigenerazione dei tessuti. È indicato per il trattamento delle varicosità, dell'eczema, della psoriasi, della dermatite, della cellulite, della stasi venosa, della tromboflebitide, della sindrome da congestione venosa, della sindrome da congestione linfatica, della sindrome da congestione linfatica e della sindrome da congestione linfatica.

5

CE 0426



FISIOGRAFT Губка PFOF0015 (5шт.) упаковка с содержимым

FISIOGRAFT SPUGNA - POLVERE - GEL

LEOF 9100

L'uso dei Copolimeri PLA-PGA in odontoiatria:

I polimeri sintetici biodegradabili quali l'acido polilattico e l'acido poliglicolico, in varie composizioni percentuali, sono ormai da molti anni i costituenti più affidabili di numerosi dispositivi medici in campo chirurgico odontoiatrico, maxillo-facciale ed ortopedico, nelle forme di placche, viti, chiodi e viti di sintesi. Per suture, lamine sagomate per uso maxillo-facciale. Diversamente dai prodotti per ortopedia e per chirurgia maxillo-facciale, ad elevata resistenza meccanica, in campo chirurgico odontoiatrico, questi copolimeri polilattico-poliglicolici, possono avere basse densità, dovendo semplicemente funzionare come mantengono di spazio e, proprio per il suo basso grado di densità, garantiscono tempi di totale riassorbimento compresi fra i 4 e gli 8 mesi, in relazione alla dimensione dell'impianto, alla reattività individuale ed al grado di anidride carbonica e acqua. L'uso principale di FISIOGRAFT è di spaziatore biocompatibile riassorbibile, lasciando permeare dal sangue e stabilizzando il coagulo ematico che viene poi sostituito progressivamente dalle cellule osteoprogenitrici, fino alla formazione di nuovo tessuto osseo. La struttura spugnosa di FISIOGRAFT non offre ostacoli all'avanzata degli osteoni poi, riassorbendosi in modo fisiologico, favorisce la loro successiva solidificazione in tessuto osseo. Dalle prove di tipo istologico, poi, ricomfermate con controlli in SEM (Scanning Electron Microscopy), non si rilevano, infatti, reazioni tissutali indesiderate né a breve, né a medio né a lungo termine. Tutti i successivi studi di biocompatibilità prima sull'animale poi sull'uomo documentano che FISIOGRAFT è ottimamente biocompatibile.

FISIOGRAFT è disponibile in tre forme: SPUGNA, POLVERE, GEL. Le tre diverse forme rendono più facile l'utilizzo di FISIOGRAFT sia in relazione al tipo d'intervento chirurgico, sia in relazione al sito d'impianto, perché ogni tipo può essere usato singolarmente oppure può essere usato mescolando fra loro i tre tipi.

Dispositivo medico invasivo di tipo chirurgico di contatto sottomucoso ed intraosseo.
utilizzato in chirurgia odontoiatrica e maxillo-facciale.
Materiale di riempimento osseo a base di copolimero PLA/PGA.

CE 0426

FISIOGRAFT	SPUGNA	POLVERE	GEL
	confezioni monouso sterilizzate ai raggi gamma		
Presentazione	1-5 pezzi	1-5 pezzi	1-5 siringhe
Formato	220 mg	500 mg	500 mg
Peso unitario	0,56 ml ca.	2 ml ca.	0,5 ml
Volume unitario	Acido Polilattico copolimero poliglicolico; Destrano	Acido Polilattico copolimero poliglicolico; Destrano	Copolimeri e omopolimeri di acido lattico e glicolico; PEG
Composizione			

Avvertenze: Non deve essere sterilizzato. Se i bolli sulla confezione interna, che indicano la sterilità del prodotto, NON dovessero essere di colore rosso NON utilizzare il prodotto. In caso di confezione anomala, isolare le confezioni non conformi e smaltire come rifiuto speciale. Se il Safety Thermal Test sulla confezione dovesse essere di colore grigio scuro, NON utilizzare il prodotto. Il Dentista è tenuto a garantire la tracciabilità del prodotto, ovvero Egli deve essere in grado di risalire al paziente a cui ha impiantato il prodotto. Si consiglia di allegare la etichetta del prodotto alla cartella clinica del paziente. Il materiale non utilizzato rimasto nella siringa o nel flacone deve essere eliminato (smaltito) dopo il trattamento per evitare il rischio di infezioni crociate dovute all'utilizzo su altri pazienti.

FISIOGRAFT

SPUGNA SPONGE SCHWAMM EPONGE ESPONJA

AVVERTENZE E CONSERVAZIONE: Prodotto Monouso • Sterile. Non deve essere sterilizzato. • Non utilizzare FISIOGRAFT dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. • Conservare nel suo originale. Anche se non necessario, è preferibile conservare il prodotto in frigorifero; in tal caso, prima dell'uso, riportare il prodotto a temperatura ambiente. Non congelare. • Tenere lontano dalla portata dei bambini.

WARNINGS AND CONSERVATION: Product is for single use only • Sterile. It cannot be re-sterilized. • Do not use FISIOGRAFT after the expiration date which is indicated on the package. • Conserve in original box. Even though it is not necessary, it is preferable to store the product in the refrigerator; in this case the product should be brought to room temperature prior to use. Do not freeze. • Keep out of reach of children.

WARNUNG UND AUFBEWAHRUNGSHINWEISE: UNIGES-Produkt. Steril. Keine Neusterilisation möglich. • FISIOGRAFT darf nach Ablauf des auf der Packung vermerkten Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden. • Im originalen Packung Behälter. Es ist zwar nicht notwendig, aber empfehlenswert, das Produkt im Kühlschrank aufzubewahren, in diesem Fall wird es vor der Anwendung auf Raumtemperatur gebracht. Nicht einfrieren. • FG Kinder unzugänglich aufbewahren.

PRECAUTIONS ET CONSERVATION: Produit unique • stérile. Ne pas stériliser une deuxième fois. • Ne pas utiliser FISIOGRAFT après la date indiquée sur l'emballage. • Conserver dans l'original. Même si ce n'est pas indispensable, il est préférable de conserver le produit au réfrigérateur; dans ce cas, attendre que le produit soit à température ambiante avant l'emploi. Ne pas congeler. • Conserver hors de la portée des enfants.

ADVERTENCIAS Y CONSERVACIÓN: Producto monouso • estéril. No puede ser reesterilizado. • No utilizar FISIOGRAFT después de la fecha de caducidad. • Conservar en la caja original. Aunque no es necesario, se sugiere conservar el producto en el frigorífico. En este caso, habrá que esperar a que alcance la temperatura ambiente antes de usarlo. No congelarlo. • Mantener lejos del alcance de los niños.

ADVERTÊNCIAS E CONSERVAÇÃO: Produto descartável • Estéril. Não deve ser esterilizado de novo. • Não utilize o FISIOGRAFT após a data de validade indicada na embalagem. • Conservar na caixa de origem. Embora não seja necessário, é preferível conservar o produto no frigorífico; nesse caso, antes da utilização, aguardar que o produto atinja a temperatura ambiente. • Conservar fora do alcance das crianças.

5

CE 0426







5

CE 0426

SAFETY THERMAL TEST

BOLLINO AZZURRO CON RIQUADRO TERMICO

RIQUADRO BIANCO: prodotto UTILIZZABILE

RIQUADRO GRIGIO SCURO: prodotto da NON UTILIZZARE

BLUE STAMP WITH THERMAL INDICATOR

WHITE COLOUR ON INDICATOR: UTILIZABLE product

DARK- GREY COLOUR ON INDICATOR: NON-UTILIZABLE product



POLVERE POWDER PULVER POUDRE POLVO PO

* Prodotto riservato ai dentisti.
COMPOSIZIONE E MODALITÀ D'USO
vedere...

* Produit réservé pour l'Art Dentaire.
COMPOSITION ET MODE D'EMPLOI
voir...

ESIMOL

ESIMOL DENTISTICAL



FISIOGRAFT Порошок в стеклянных ампулах

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8

пластиковые одноразовые стерильные
подложки в индивидуальных упаковках
для работы с FISIOGRAFT порошком



стерильные стеклянные ампулы с
FISIOGRAFT порошком

5




картонная упаковка


пластиковые одноразовые стерильные подложки в индивидуальных упаковках для работы с FISIOGRAFT порошком

стерильные стеклянные ампулы с FISIOGRAFT порошком



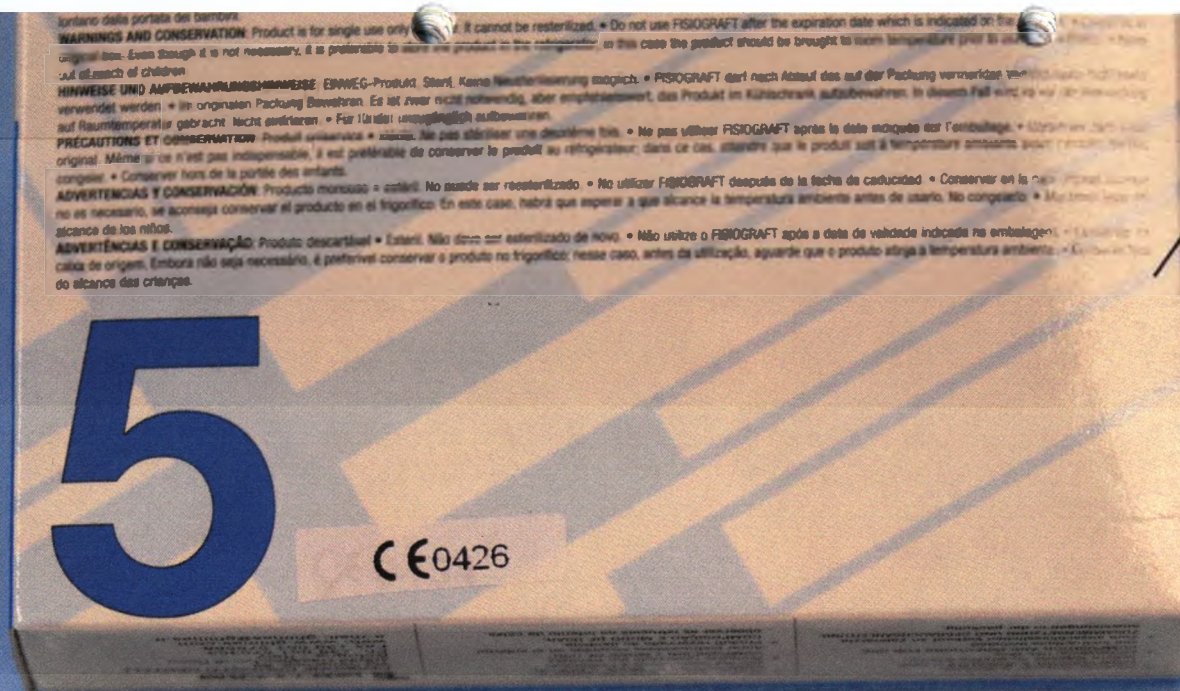


картонная упаковка

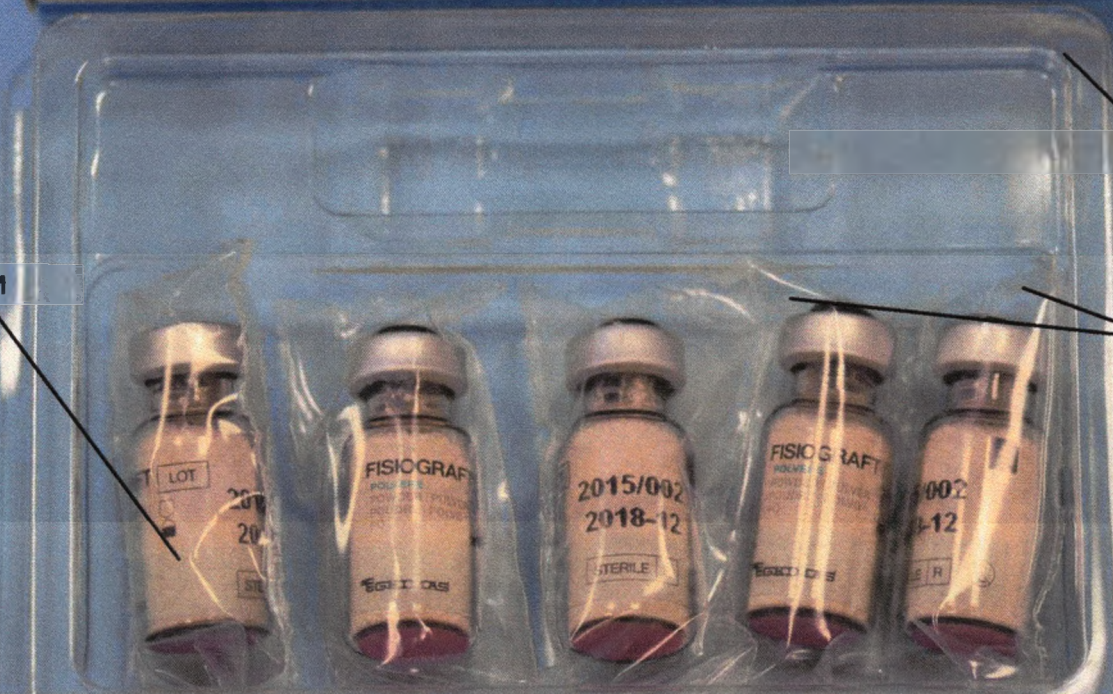

пластиковая подложка для ампул

стерильные стеклянные ампулы с FISIOGRAFT порошком

индивидуальная пластиковая упаковка для каждой ампулы

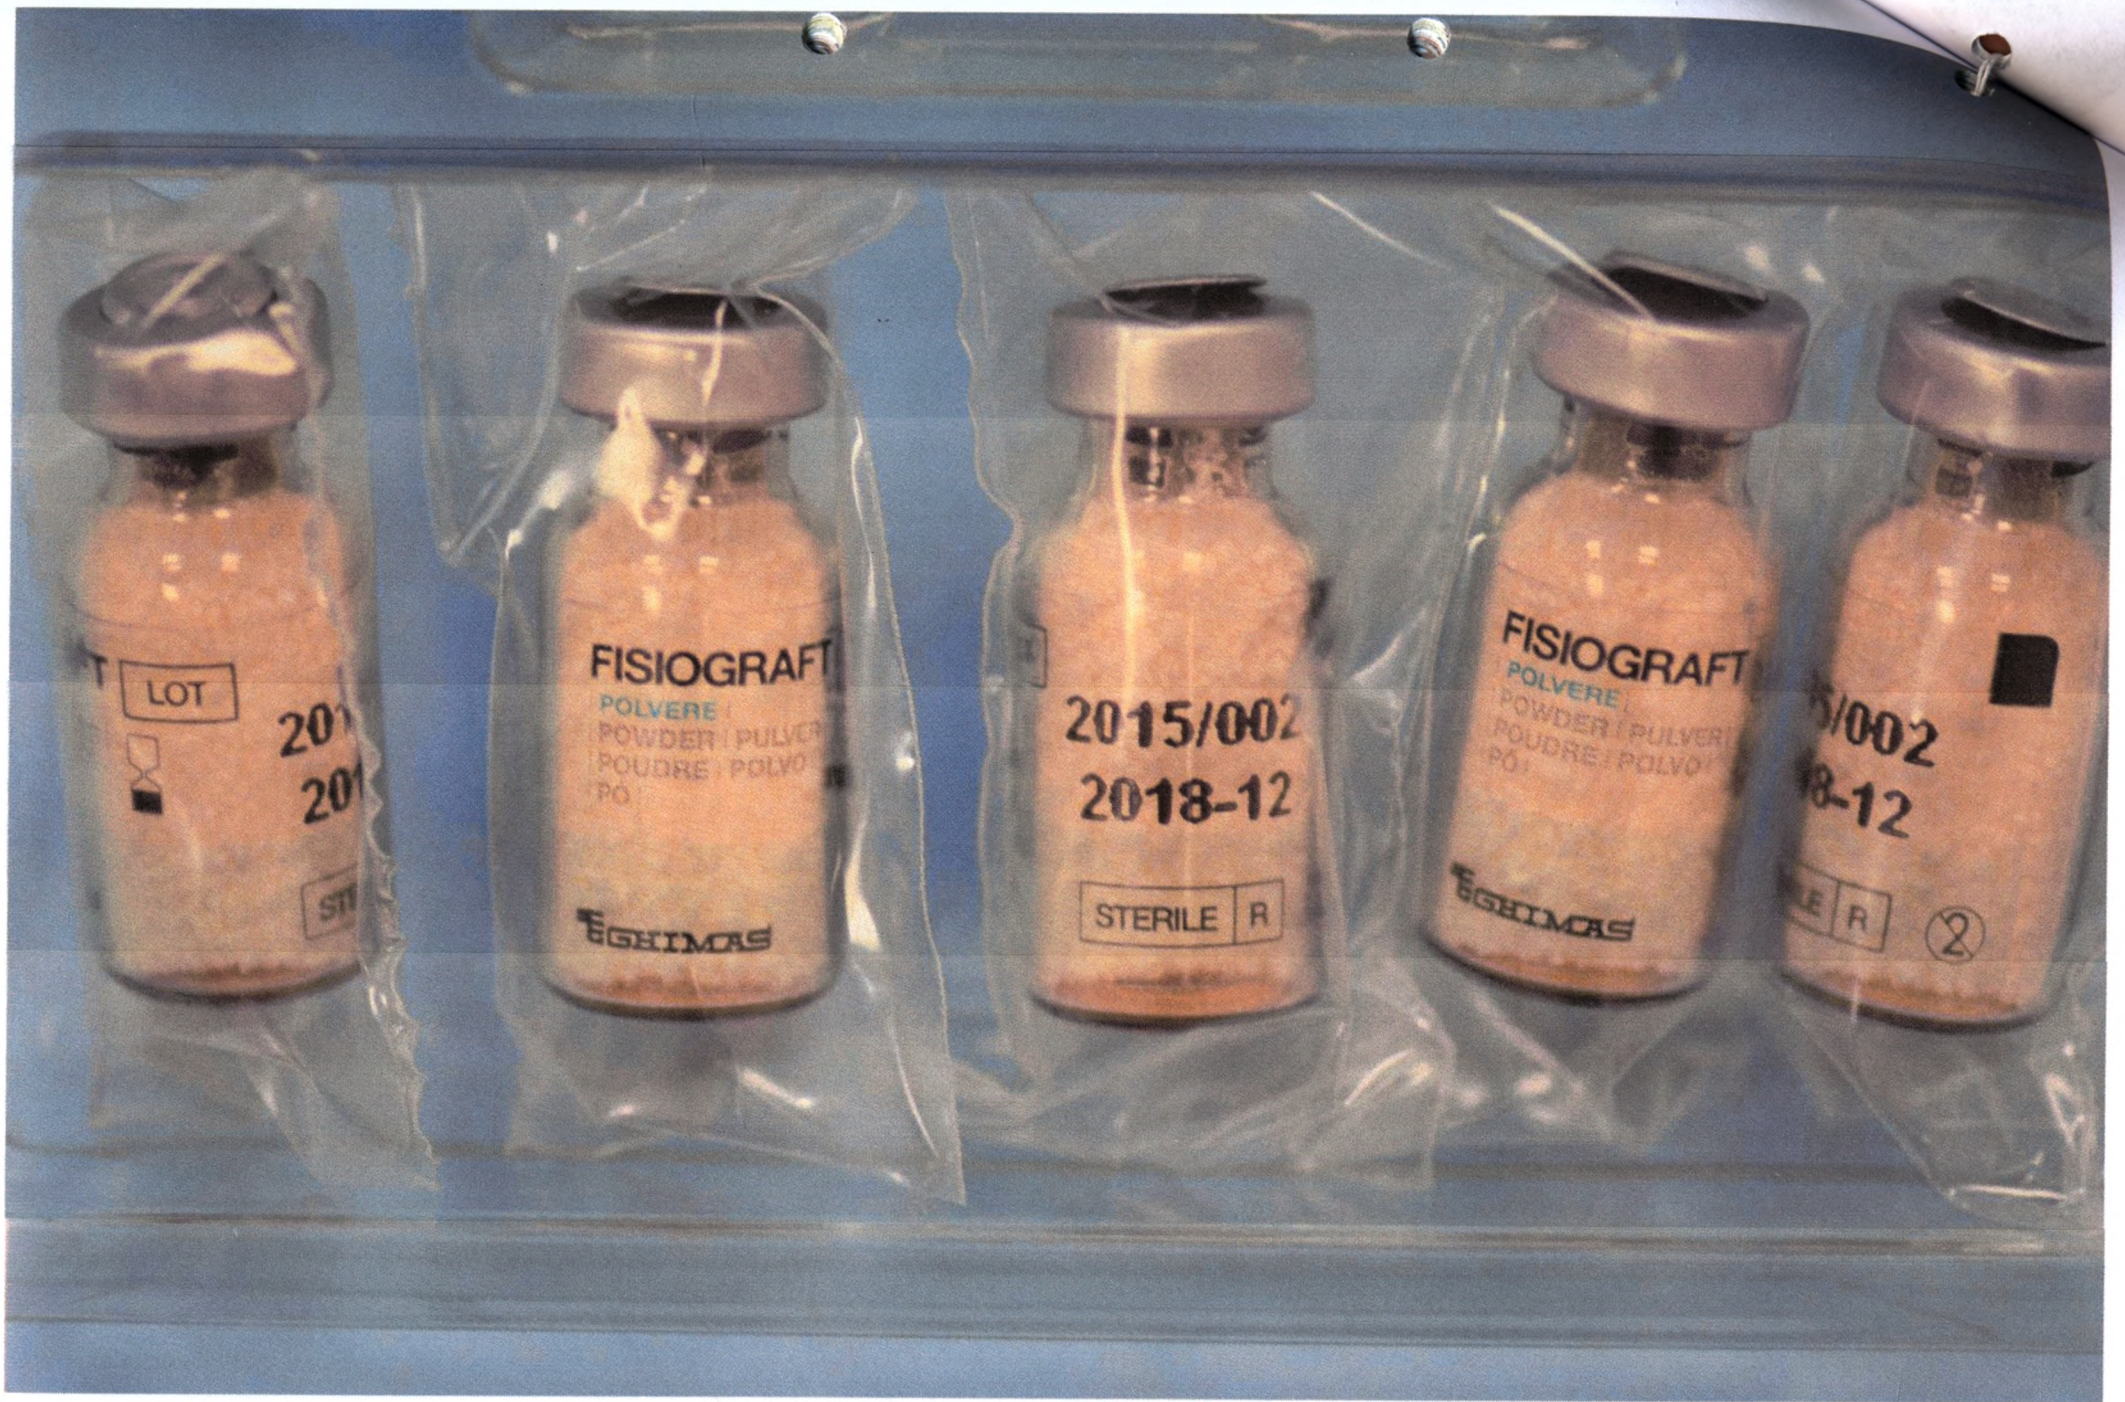

000 ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Порошок РФОФ0025 (5шт) в стеклянных ампулах



POLVERE : POWDER : PULVER : POUDRE : POLVO : PÓ

C-E0426

SAFETY
THERMAL TEST



1. *What is the purpose of the study?*
 2. *What are the research questions or hypotheses?*
 3. *What is the study design?*
 4. *What are the variables?*
 5. *What are the results?*
 6. *What are the conclusions?*
 7. *What are the limitations?*
 8. *What are the implications?*
 9. *What are the strengths?*
 10. *What are the weaknesses?*
 11. *What are the contributions?*
 12. *What are the future directions?*
 13. *What are the ethical considerations?*
 14. *What are the funding sources?*
 15. *What are the conflicts of interest?*
 16. *What are the acknowledgments?*
 17. *What are the references?*
 18. *What are the appendices?*
 19. *What are the tables?*
 20. *What are the figures?*
 21. *What are the footnotes?*
 22. *What are the endnotes?*
 23. *What are the glosses?*
 24. *What are the indexes?*
 25. *What are the supplements?*
 26. *What are the errata?*
 27. *What are the corrections?*
 28. *What are the updates?*
 29. *What are the revisions?*
 30. *What are the changes?*
 31. *What are the deletions?*
 32. *What are the insertions?*
 33. *What are the modifications?*
 34. *What are the alterations?*
 35. *What are the adjustments?*
 36. *What are the amendments?*
 37. *What are the supplements?*
 38. *What are the errata?*
 39. *What are the corrections?*
 40. *What are the updates?*
 41. *What are the revisions?*
 42. *What are the changes?*
 43. *What are the deletions?*
 44. *What are the insertions?*
 45. *What are the modifications?*
 46. *What are the alterations?*
 47. *What are the adjustments?*
 48. *What are the amendments?*
 49. *What are the supplements?*
 50. *What are the errata?*
 51. *What are the corrections?*
 52. *What are the updates?*
 53. *What are the revisions?*
 54. *What are the changes?*
 55. *What are the deletions?*
 56. *What are the insertions?*
 57. *What are the modifications?*
 58. *What are the alterations?*
 59. *What are the adjustments?*
 60. *What are the amendments?*
 61. *What are the supplements?*
 62. *What are the errata?*
 63. *What are the corrections?*
 64. *What are the updates?*
 65. *What are the revisions?*
 66. *What are the changes?*
 67. *What are the deletions?*
 68. *What are the insertions?*
 69. *What are the modifications?*
 70. *What are the alterations?*
 71. *What are the adjustments?*
 72. *What are the amendments?*
 73. *What are the supplements?*
 74. *What are the errata?*
 75. *What are the corrections?*
 76. *What are the updates?*
 77. *What are the revisions?*
 78. *What are the changes?*
 79. *What are the deletions?*
 80. *What are the insertions?*
 81. *What are the modifications?*
 82. *What are the alterations?*
 83. *What are the adjustments?*
 84. *What are the amendments?*
 85. *What are the supplements?*
 86. *What are the errata?*
 87. *What are the corrections?*
 88. *What are the updates?*
 89. *What are the revisions?*
 90. *What are the changes?*
 91. *What are the deletions?*
 92. *What are the insertions?*
 93. *What are the modifications?*
 94. *What are the alterations?*
 95. *What are the adjustments?*
 96. *What are the amendments?*
 97. *What are the supplements?*
 98. *What are the errata?*
 99. *What are the corrections?*
 100. *What are the updates?*
 101. *What are the revisions?*
 102. *What are the changes?*
 103. *What are the deletions?*
 104. *What are the insertions?*
 105. *What are the modifications?*
 106. *What are the alterations?*
 107. *What are the adjustments?*
 108. *What are the amendments?*
 109. *What are the supplements?*
 110. *What are the errata?*
 111. *What are the corrections?*
 112. *What are the updates?*
 113. *What are the revisions?*
 114. *What are the changes?*
 115. *What are the deletions?*
 116. *What are the insertions?*
 117. *What are the modifications?*
 118. *What are the alterations?*
 119. *What are the adjustments?*
 120. *What are the amendments?*
 121. *What are the supplements?*
 122. *What are the errata?*
 123. *What are the corrections?*
 124. *What are the updates?*
 125. *What are the revisions?*
 126. *What are the changes?*
 127. *What are the deletions?*
 128. *What are the insertions?*
 129. *What are the modifications?*
 130. *What are the alterations?*
 131. *What are the adjustments?*
 132. *What are the amendments?*
 133. *What are the supplements?*
 134. *What are the errata?*
 135. *What are the corrections?*
 136. *What are the updates?*
 137. *What are the revisions?*
 138. *What are the changes?*
 139. *What are the deletions?*
 140. *What are the insertions?*
 141. *What are the modifications?*
 142. *What are the alterations?*
 143. *What are the adjustments?*
 144. *What are the amendments?*
 145. *What are the supplements?*
 146. *What are the errata?*
 147. *What are the corrections?*
 148. *What are the updates?*
 149. *What are the revisions?*
 150. *What are the changes?*
 151. *What are the deletions?*
 152. *What are the insertions?*
 153. *What are the modifications?*
 154. *What are the alterations?*
 155. *What are the adjustments?*
 156. *What are the amendments?*
 157. *What are the supplements?*
 158. *What are the errata?*
 159. *What are the corrections?*
 160. *What are the updates?*
 161. *What are the revisions?*
 162. *What are the changes?*
 163. *What are the deletions?*
 164. *What are the insertions?*
 165. *What are the modifications?*
 166. *What are the alterations?*
 167. *What are the adjustments?*
 168. *What are the amendments?*
 169. *What are the supplements?*
 170. *What are the errata?*
 171. *What are the corrections?*
 172. *What are the updates?*
 173. *What are the revisions?*
 174. *What are the changes?*
 175. *What are the deletions?*
 176. *What are the insertions?*
 177. *What are the modifications?*
 178. *What are the alterations?*
 179. *What are the adjustments?*
 180. *What are the amendments?*
 181. *What are the supplements?*
 182. *What are the errata?*
 183. *What are the corrections?*
 184. *What are the updates?*
 185. *What are the revisions?*
 186. *What are the changes?*
 187. *What are the deletions?*
 188. *What are the insertions?*
 189. *What are the modifications?*
 190. *What are the alterations?*
 191. *What are the adjustments?*
 192. *What are the amendments?*
 193. *What are the supplements?*
 194. *What are the errata?*
 195. *What are the corrections?*
 196. *What are the updates?*
 197. *What are the revisions?*
 198. *What are the changes?*
 199. *What are the deletions?*
 200. *What are the insertions?*
 201. *What are the modifications?*
 202. *What are the alterations?*
 203. *What are the adjustments?*
 204. *What are the amendments?*
 205. *What are the supplements?*
 206. *What are the errata?*
 207. *What are the corrections?*
 208. *What are the updates?*
 209. *What are the revisions?*
 210. *What are the changes?*
 211. *What are the deletions?*
 212. *What are the insertions?*
 213. *What are the modifications?*
 214. *What are the alterations?*
 215. *What are the adjustments?*
 216. *What are the amendments?*
 217. *What are the supplements?*
 218. *What are the err*

C-60426

FISIOGRAFT SPUGNA - POLVERE - GEL

Case 11-13007 Document 1-1 Filed 07/26/11 Page 1 of 1

United States Capitalism and the U.S. in Latin America

[illegible]

此等文字，皆係古人所遺，不可不讀。

0426 CE

[illegible]

卷之四
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

800-451-4037

Effect of Conditioning PLA-PGA in Odontoblasts

[illegible]

singolarmente oppure può essere usato mescolando le due

Dispositivo medico invasivo di tipo chirurgico, utilizzato in chirurgia odontostomatologica e maxillofaciale.

0426 CE

Materiali di trattamento osteo a base di copopolimeri			
FISSIONI	SPONGA	POLVERE	GEL
Preparazione	1-5 pezzi	condensati in un unico emulsionati in 100 g di glicerina	1-5 siringhe
Formato	1-5 pezzi	1-5 pezzi	300 mg
Peso unitario	500 mg	500 mg	0,5 ml
Volume unitario	0,8 ml in ca.	2 ml in ca.	0,5 ml
Composizione	Acido polilattico copopolimeri poliglicolici. Puro	Acido polilattico copopolimeri poliglicolici. Puro	Copolimeri e componenti (5 mg/ml) in soluzione in acqua

[illegible]


FISIOGRAFT

Dispositivo innovativo a lungo termine di tipo chirurgico, di controllo sofisticatissimo ed interamente utilizzato in clinica.

[illegible]

C 60426

[illegible]

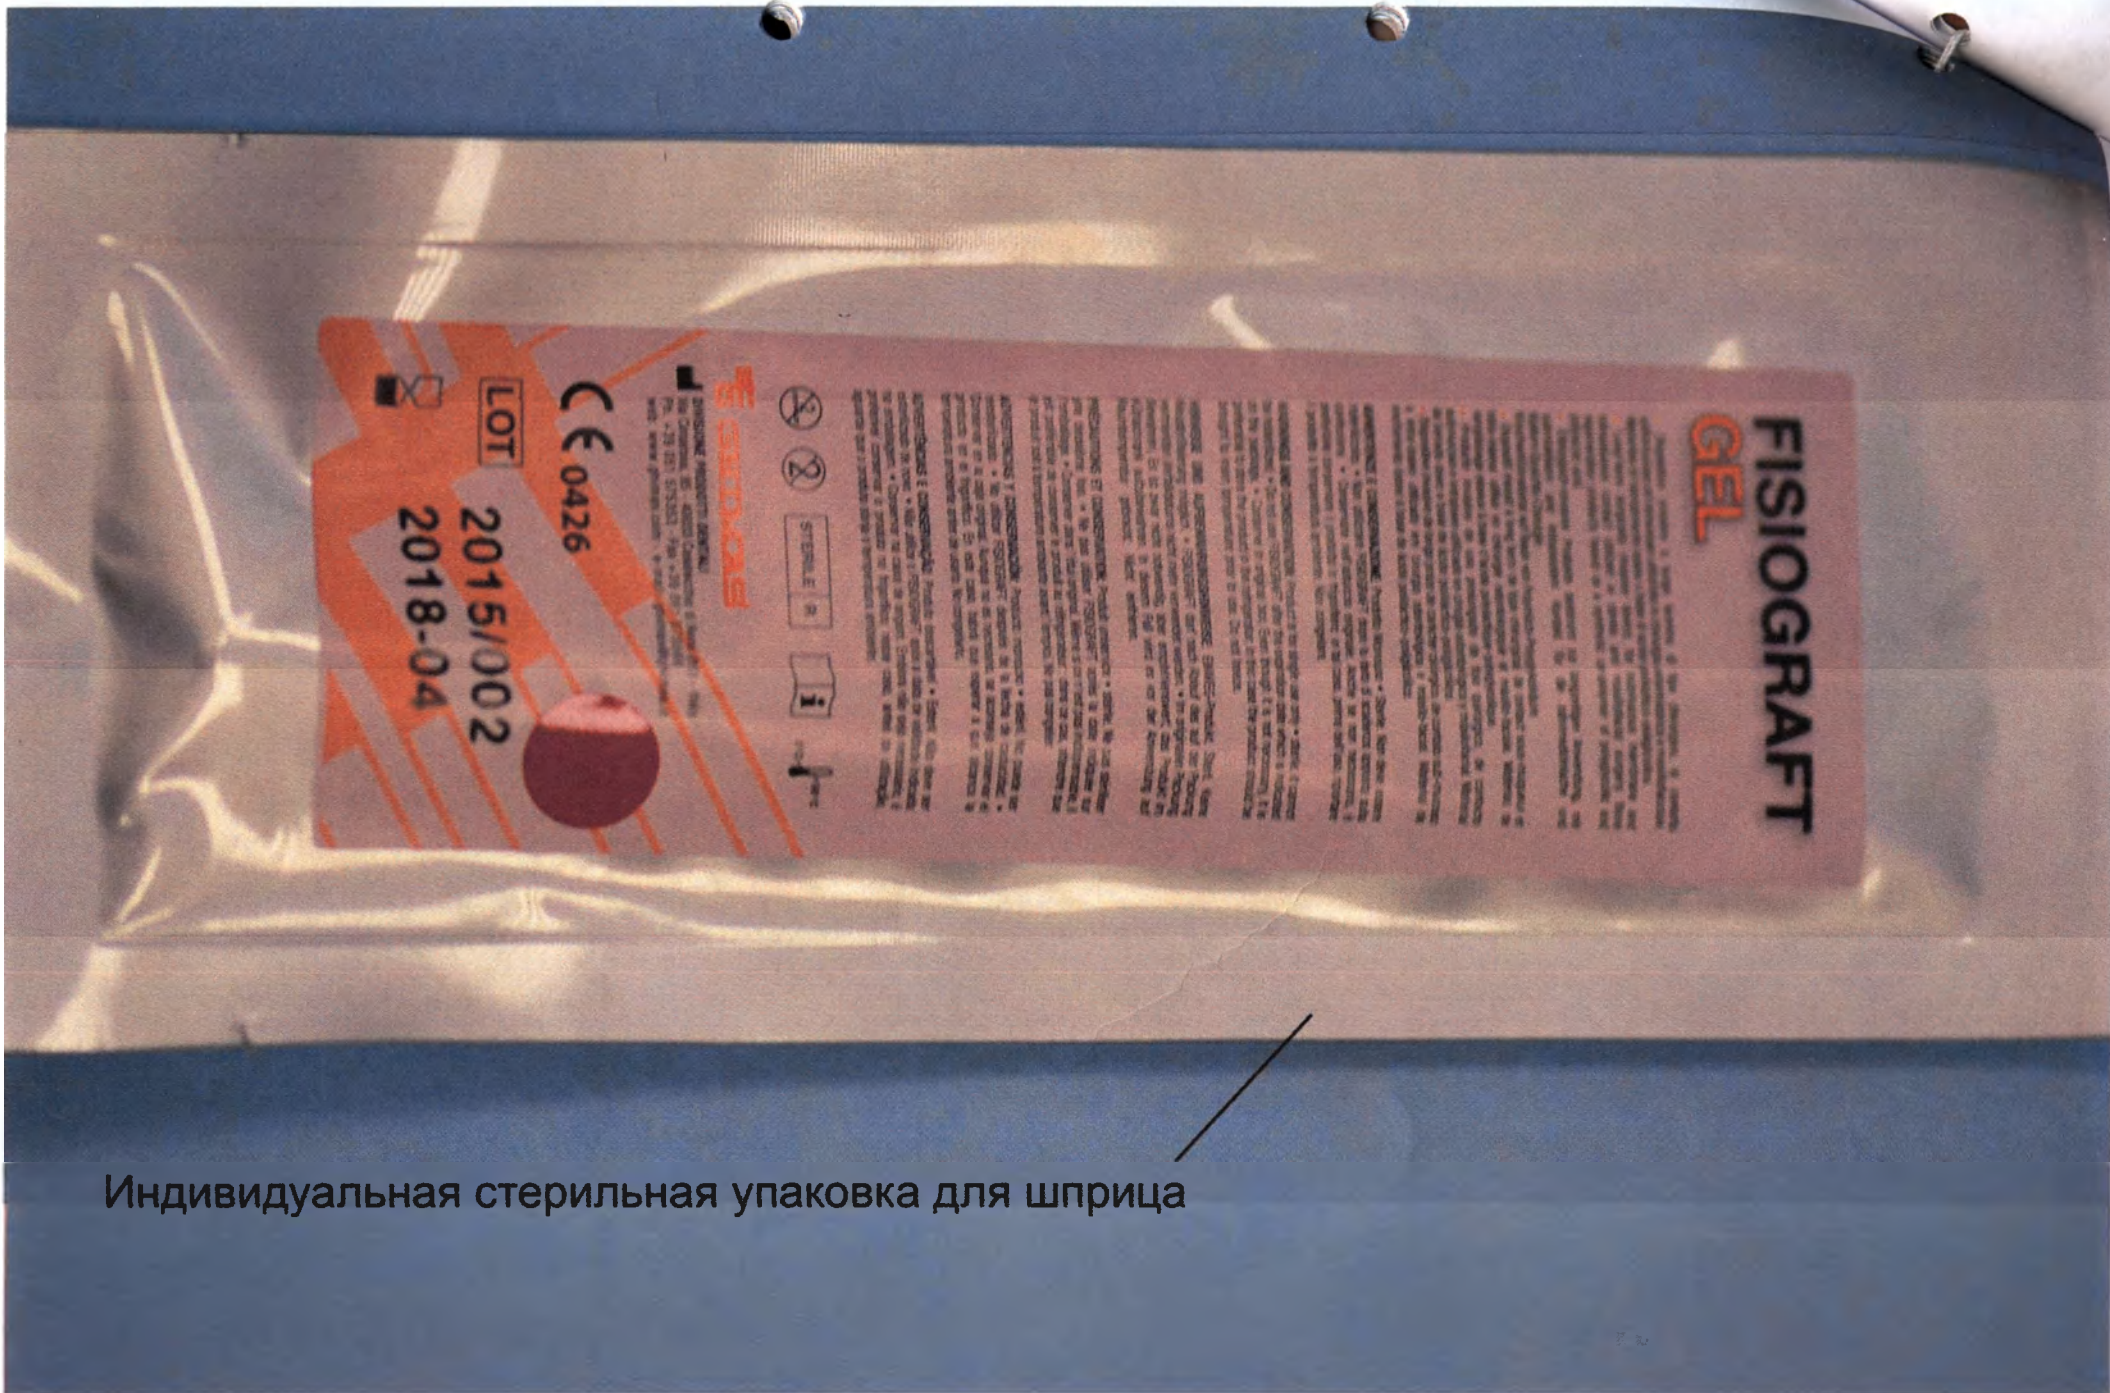

Индивидуальная стерильная упаковка для шприца

FISIOGRAFT

GEL

SAFETY
THERMAL TEST

Il prodotto è stato sottoposto a test di sicurezza termica secondo la norma EN ISO 10993-10. I risultati dei test sono riportati nel foglio di accompagnamento. Il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza termica.

5

CE 0426

- Dispositivo invasivo a lungo termine di tipo chirurgico, di contatto sottomucoso ed intraosseo utilizzato in chirurgia odontoiatrica e maxillo-facciale. Materiale di riempimento osseo a base di acido polilattico-poliglicolico.
- Long-term surgically invasive device, for submucous membrane and intraosseous contact utilized in dental and maxillofacial surgery. Bone regeneration products based on a synthetic co-polymer of polylactide and polyglycolic acid.
- Chirurgisch-invasives Produkt bestimmt zur langzeitigen Anwendung, mit submukösem und intraossealem Kontakt für die Zahnmedizinische und Kiefer-Gesichts-Chirurgie. Knochenfüllmaterial auf Basis von Polymilch-Polyglykolsäure.
- Dispositif invasif à long terme de type chirurgical, de contact sous-muqueux et intra-osseux utilisé en chirurgie odontologique et maxillo-faciale. Matériau de remplissage osseux à base d'acide polylactique-poliglycolique.
- Producto invasivo de uso prolongado de tipo quirúrgico, de contacto submucoso e intraóseo utilizado en cirugía odontológica y maxilofacial. Material de llenado óseo a base de ácido poliláctico-poliglicólico.
- Dispositivo invasivo de longo prazo de carácter cirúrgico, de contato sub-mucoso e intra-ósseo utilizado em cirurgia odontológica e maxilo-facial. Material de enchimento ósseo à base de ácido polilático-poliglicólico.

FISIOGRAFT SPUGNA - POLVERE - GEL

L'uso del Copolimeri PLA-PGA in odontologia:
L'odontologia è una disciplina che si occupa della salute e della funzione della bocca. In odontologia, il materiale di riempimento osseo è un prodotto che viene utilizzato per riempire le cavità ossee. Il materiale di riempimento osseo è un prodotto che viene utilizzato per riempire le cavità ossee. Il materiale di riempimento osseo è un prodotto che viene utilizzato per riempire le cavità ossee.

FISIOGRAFT	SPUGNA	POLVERE	GEL
Presentazione	1-5 pezzi	confezioni monodose sterili di 100g e 500g	1-5 servizi
Peso netto	3,00 mg	1-5 pezzi	5,00 mg
Volume netto	0,50 ml	500 mg	0,50 ml
Composizione	Acido Polilattico Copolimeri poliglicolico, Ossidato	Acido Polilattico Copolimeri poliglicolico, Ossidato	Copolimeri e derivati di acido lattico e glicolico, PEG

CE 0426

FISIOGRAFT
GEL

CE 0426
LOT 2015/002
2018-04

FISIOGRAFT
GEL

CE 0426
LOT 2015/002
2018-04

FISIOGRAFT
GEL

CE 0426
LOT 2015/002
2018-04

FISIOGRAFT
GEL

CE 0426
LOT 2015/002
2018-04

FISIOGRAFT
GEL

CE 0426
LOT 2015/002
2018-04

4300

1.2.2.4 **Development PMA/PMA in subcutaneous**

[illegible]

Advertisement: No drug is more effective than the one you're already taking. So why waste your money on a generic drug? The only way to get the most out of your medicine is to take the brand name. Because brand name drugs are made to the highest standards, they're the only ones you can be sure will work for you. So when you're taking a drug, make sure it's the brand name. It's the only way to get the most out of your medicine.

உ

- [illegible]

[illegible]

CE 0426


FISIOGRAFT
GEL

[illegible]

CONTINUED

CE 0124

LOT 2016/001
2018-09

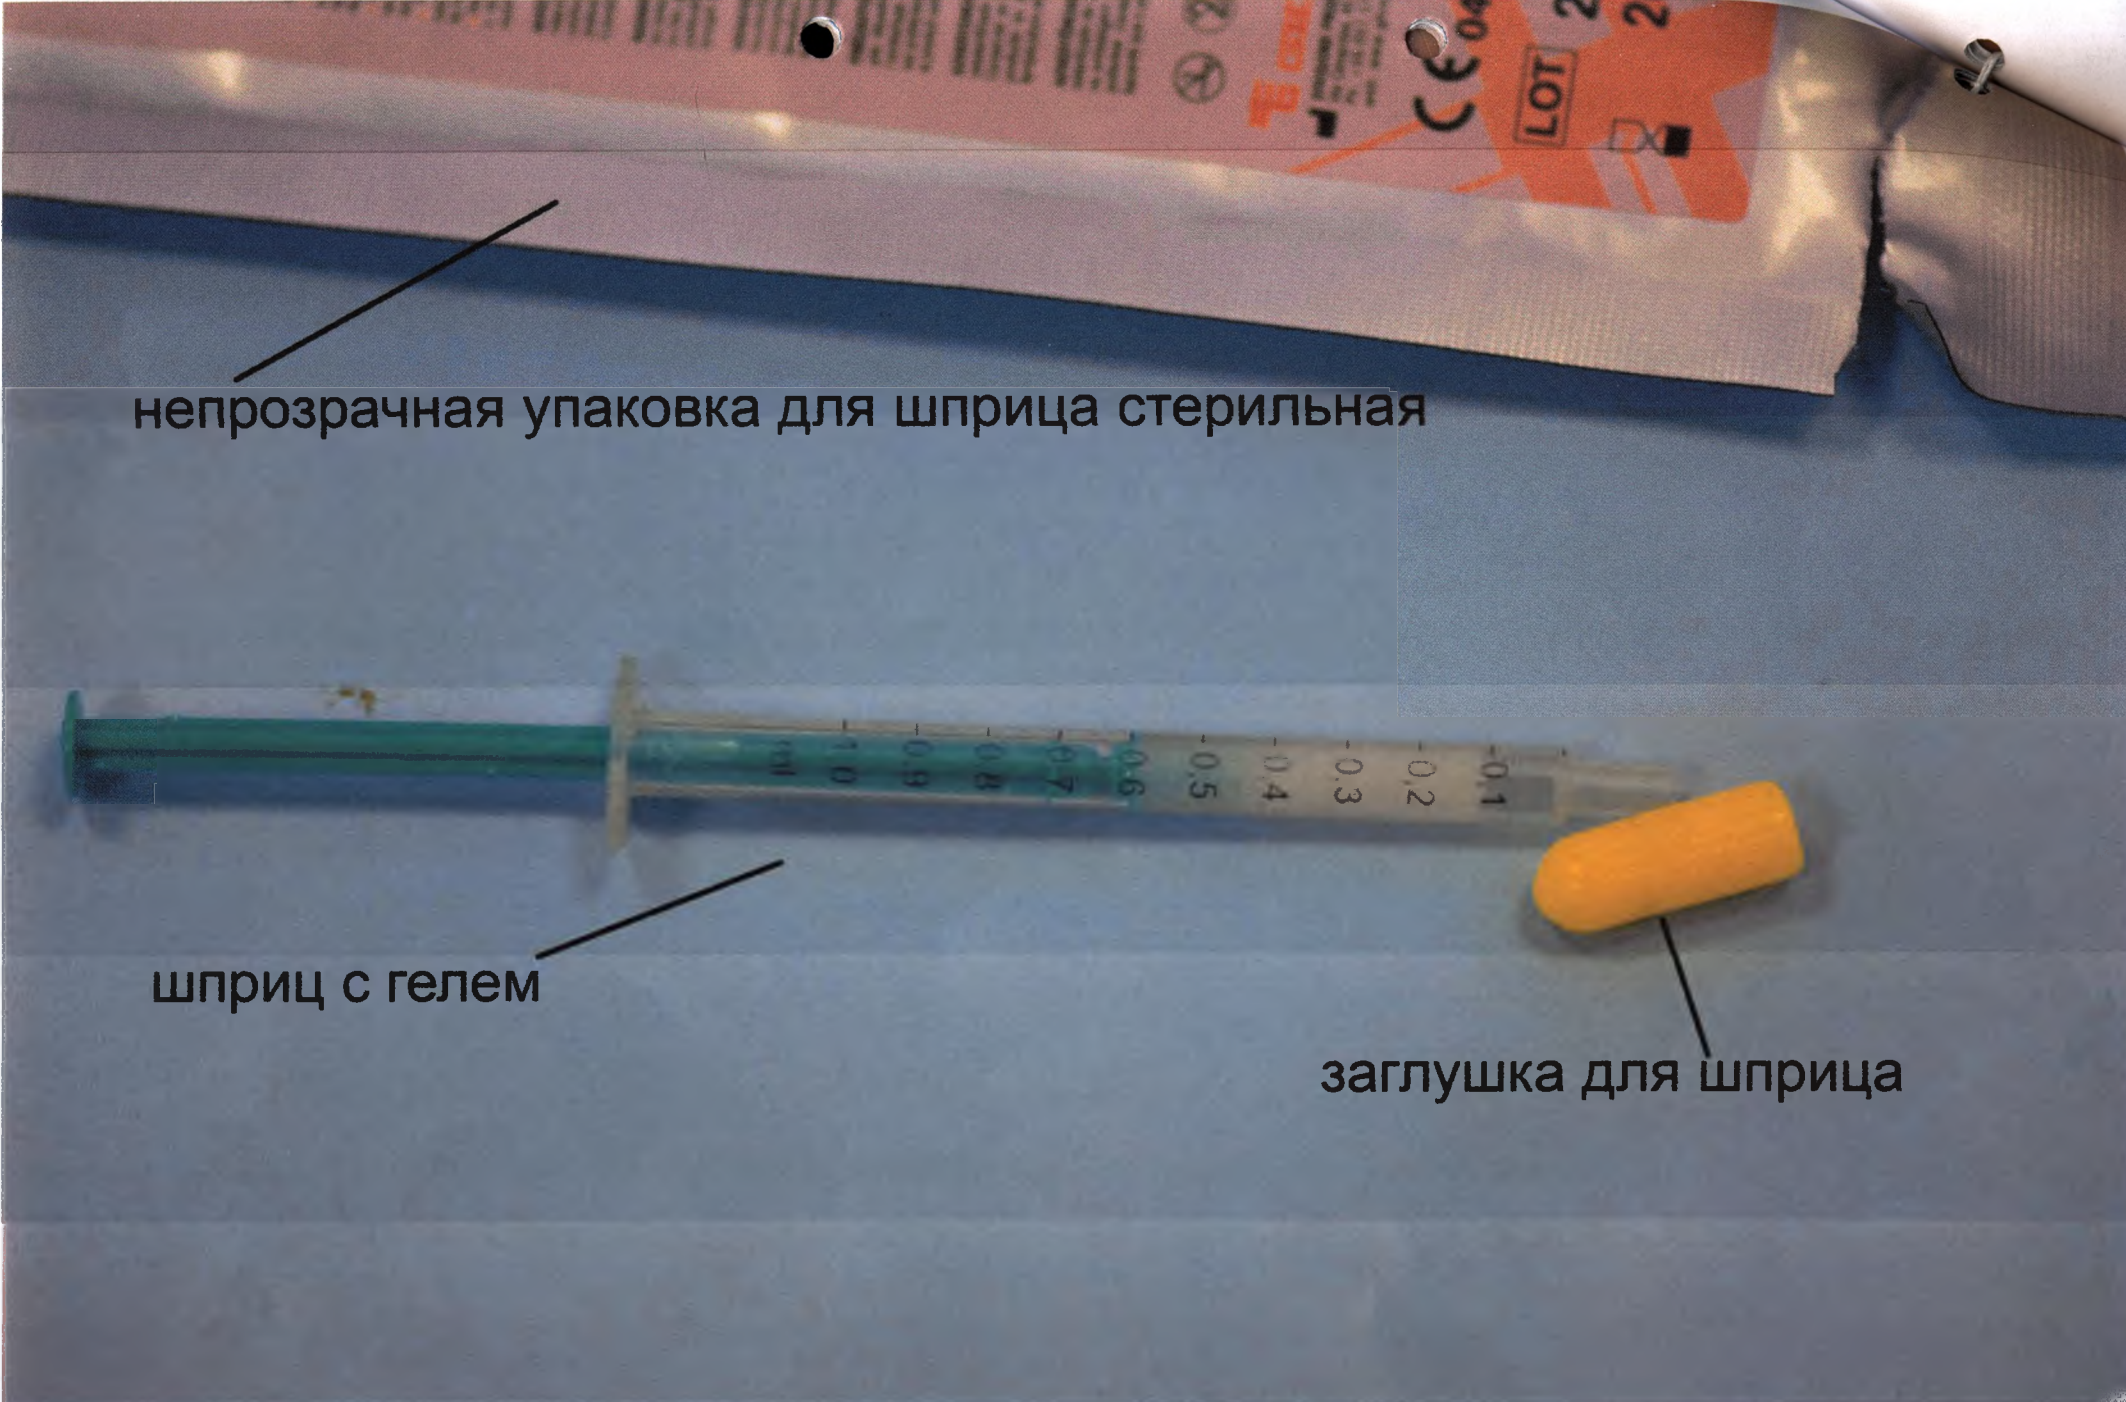

непрозрачная упаковка для шприца стерильная

шприц с гелем

заглушка для шприца

шприц с гелем

заглушка от шприца

FISIOGRAFT nanoH.A.reinforced



Dispositivo medico invasivo di tipo chirurgico di contatto sottomucoso ed intracavità utilizzato in chirurgia odontologica e maxillo-facciale. Materiale di riempimento osseo a base di nanoidrossiapatite e copolimero PLAPGA.
Invasive material for submucous membrane and intracavity contact, utilized in dental and maxillofacial surgery. Bone regeneration products based on hydroxyapatite copolymer PLAPGA.
Invasives medizinische Vorrichtung chirurgischer Art mit submukösem und intracavitärem Kontakt für die zahnärztliche und Kiefer-Gesichts-Chirurgie. Knochenfüllmaterial auf Basis von Hydroxyapatit und Copolymer PLAPGA.
Dispositif médical invasif de type chirurgical de contact sous-muqueux et intra-cavité utilisé en chirurgie odontologique et maxillo-faciale. Matériau de remplissage osseux à base de hydroxyapatite et copolymère PLAPGA.
Dispositivo médico invasivo de tipo quirúrgico de contacto submucoso e intracavidad utilizado en cirugía odontológica y maxilofacial. Material de llenado óseo a base de hidroxiapatita y copolímero PLAPGA.
Dispositivo médico invasivo de tipo quirúrgico de contacto sub-mucoso e intra-cavidade utilizado em cirurgia odontológica e maxilo-facial. Material de enchimento ósseo à base de hidroxiapatite e copolímero PLAPGA.

2

CE 0426

FISIOGRAFT nanoH.A.-reinforced

FISIOGRAFT nanoH.A.-reinforced è un dispositivo costituito da un granulato inserito all'interno di una siringa che ne consente l'applicazione diretta nel difetto osseo. I granuli sono stati realizzati in materiale composito nanoidrossiapatite-destrano, utilizzando come veicolante una miscela di copolimero polilattico-poliglicolico e di polietilenglicole. Tutti i citati costituenti sono da anni utilizzati in mantenitori di spazio dentale alla rigenerazione guidata del tessuto osseo.

Tali dispositivi trovano impiego nella rigenerazione di difetti ossei parodontali, implantari, post-estrattivi e per lesioni ossee a seguito di interventi di chirurgia odontoiatrica e maxillo-facciale.

La peculiarità di FISIOGRAFT nanoH.A.-reinforced è di poter disporre di una sostanza che si lascia permeare dal sangue proveniente da osso corticale, quindi progenitore di nuovo tessuto osseo nel sito d'applicazione, da applicare comodamente in un difetto osseo nel quale è necessario lo sviluppo di nuovo osso. La formulazione in granuli permette così al sangue di penetrare ovunque.

I costituenti di FISIOGRAFT nanoH.A.-reinforced

- in parte sono riassorbibili per lasciare spazio al nuovo osso: il copolimero polilattico-poliglicolico, in incontro ad idrolisi e viene degradato nel tempo, il destrano ed il polietilenglicole sono allontanati dal sito dai fluidi organici
- in parte non vanno incontro a riassorbimento, diventando peraltro nuclei di ossificazione per il deposito dell'idrossiapatite prodotta dagli osteoblasti: l'idrossiapatite nanometrica, infatti, per le caratteristiche dimensionali e chimico-fisiche, permane nel sito e costituisce il punto di aggregazione dell'idrossiapatite prodotta dagli osteoblasti, fino ad essere totalmente inglobata nel nuovo osso.

Dispositivo medico invasivo di tipo chirurgico di contatto sottomucoso ed intracavità utilizzato in chirurgia odontoiatrica e maxillo-facciale.

Materiale di riempimento osseo a base di nanoidrossiapatite e copolimero PLAPGA.

Presentazione: confezioni monodoso sterilizzate al raggi gamma

Formato: 2 siringhe

Peso netto: 1000 mg


CE 0426


FISIOGRAFT

FISIOGRAFT


CE 0426
LOT 2015/003
2018-04

CE 0426
LOT 2015/003
2018-04

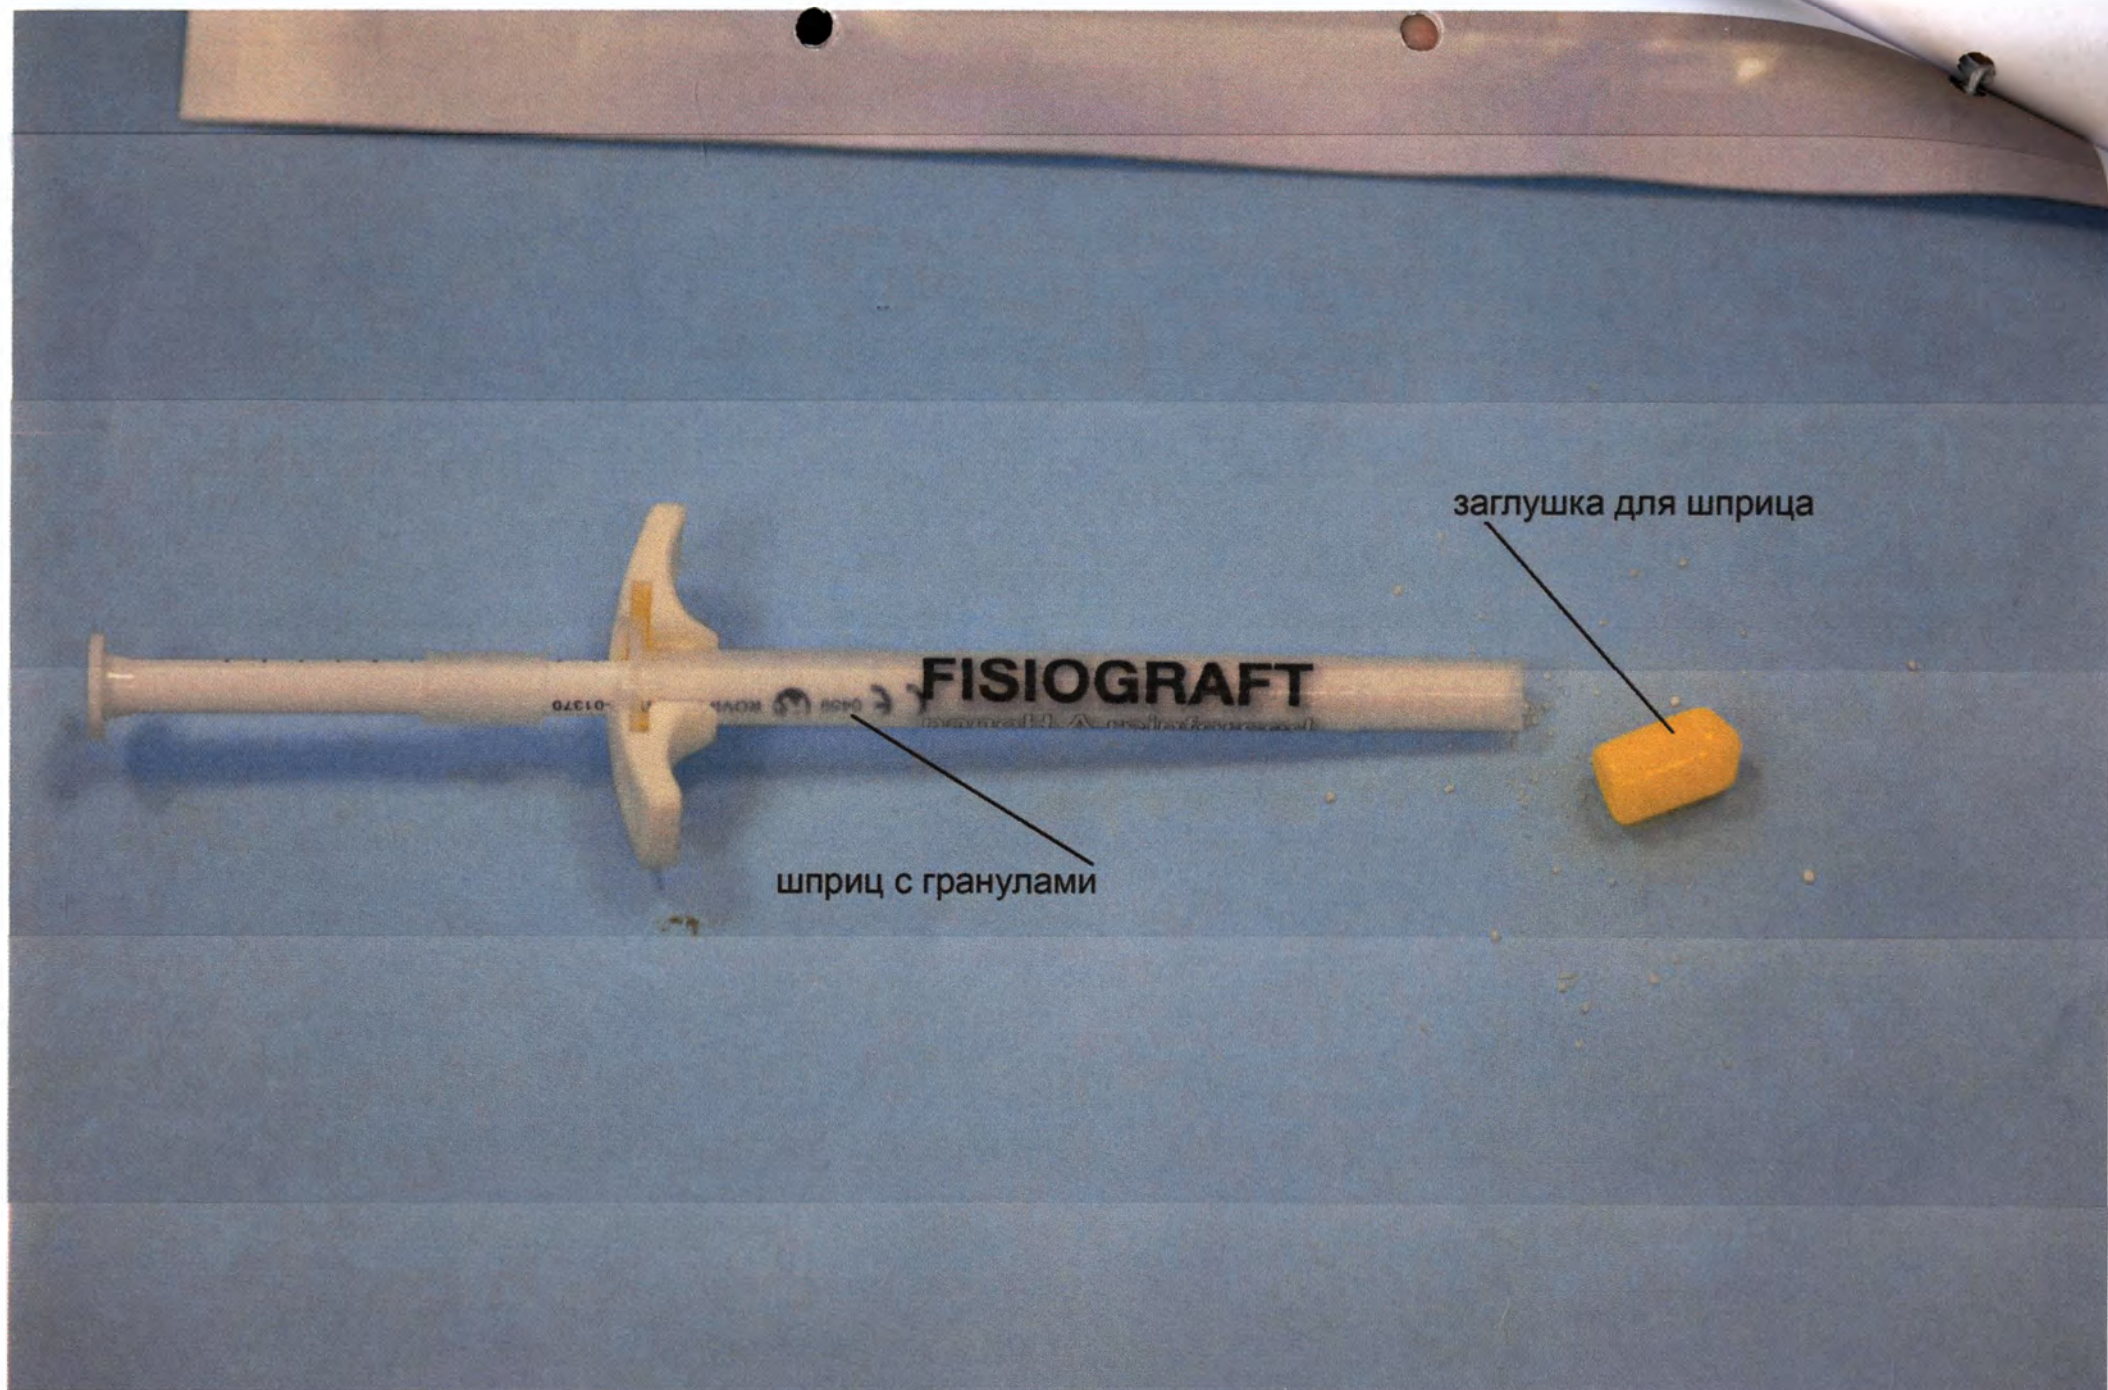

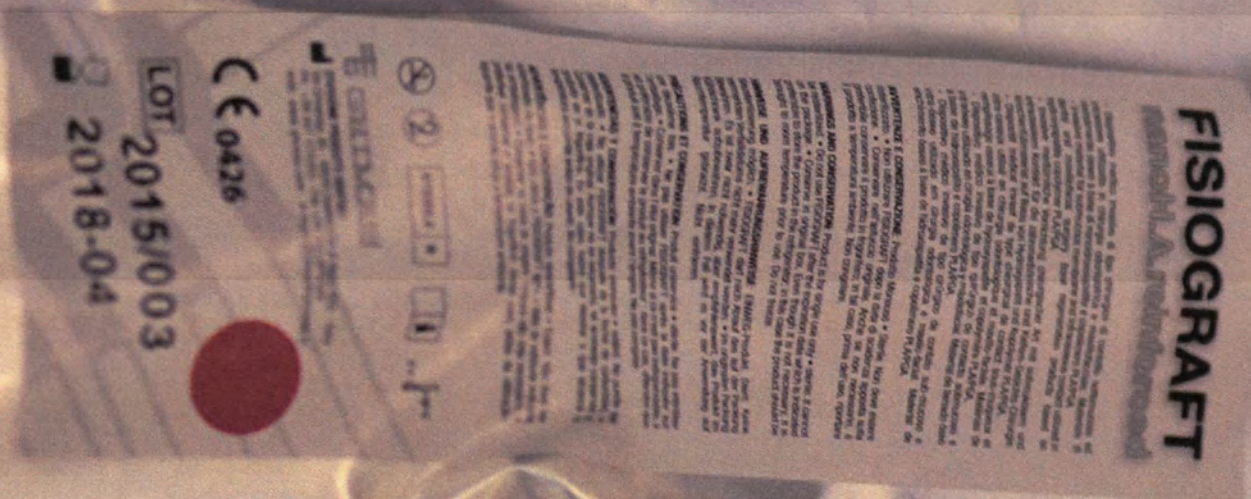

индивидуальная стерильная упаковка для шприца

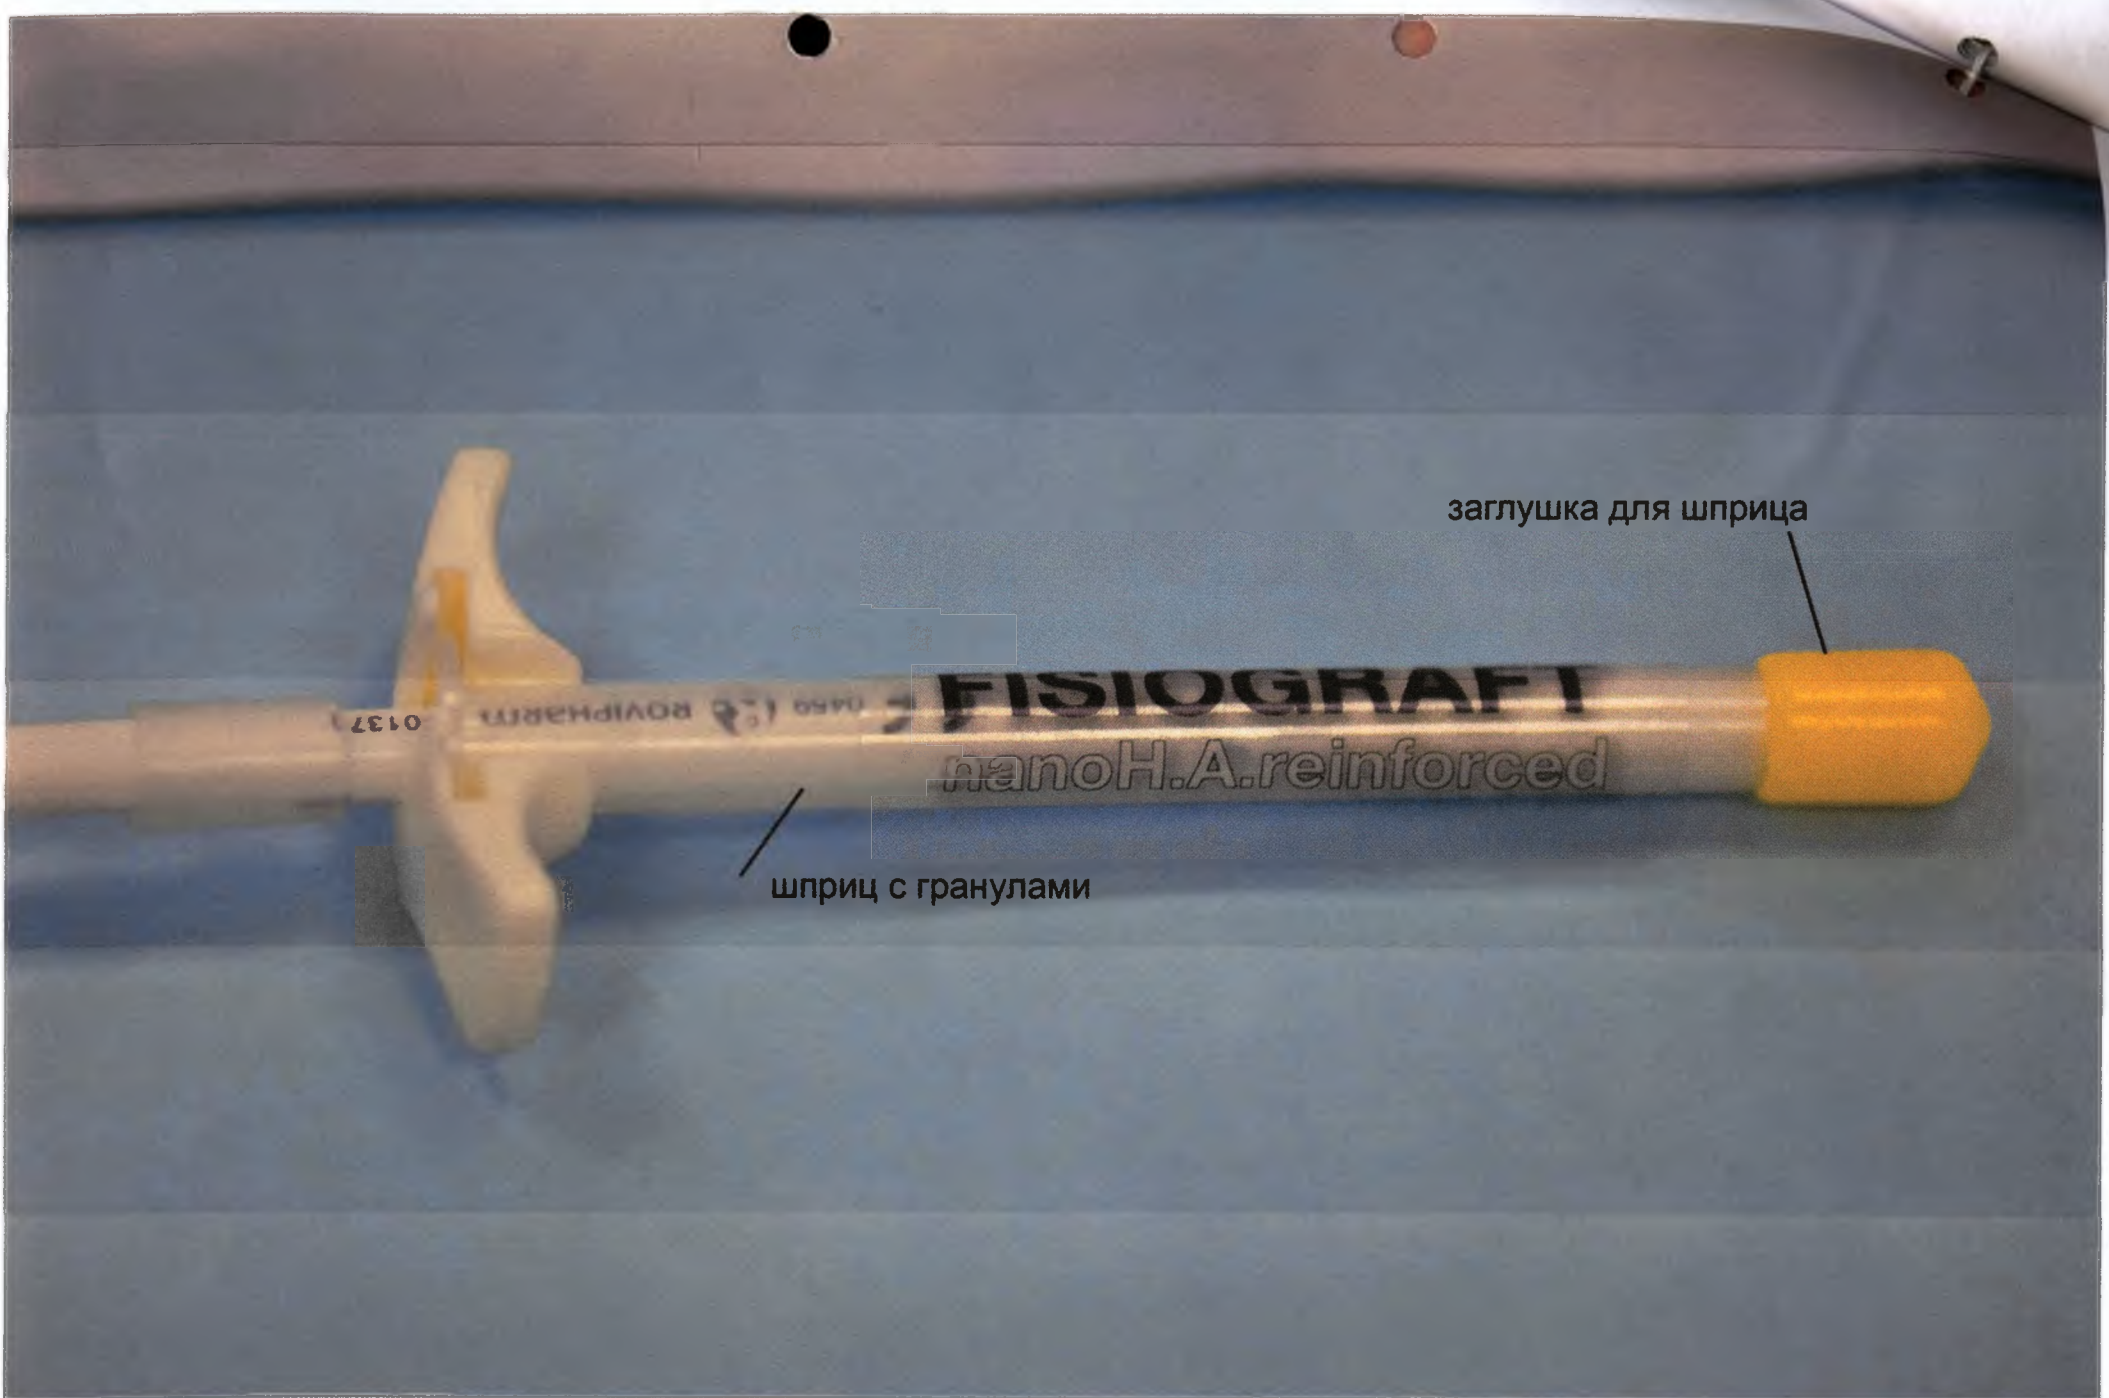

заглушка для шприца

шприц с гранулами

Прошито и
и скреплено
листа
Дата: «