

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



А.Г. Плехов

2019 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

КАЛИЙ-ВИТАЛ

**Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме)
крови турбидиметрическим методом без депротеинизации.**

КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF B 26.01

Набор реагентов для определения концентрации
калия в сыворотке (плазме) крови
турбидиметрическим методом без депротеинизации.

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1x50 мл

ТУ 9398-282-52145831-00

Калибратор: 1x1 мл

ФСР 2011/10917 от 25.10.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+18-25°C



4 606453 849072



5010232954236



Только для in vitro диагностики

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF B 26.01

REF B 26.11

50 мл

монореагент



+18-25°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF B 26.01

REF B 26.11

1 мл

5,0 ммоль/л



+18-25°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF B 26.11

Набор реагентов для определения концентрации
калия в сыворотке (плазме) крови
турбидиметрическим методом без депротеинизации.

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 2x50 мл

ТУ 9398-282-52145831-00

Калибратор: 2x1 мл

ФСР 2011/10917 от 25.10.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+18-25°C



4 606453 849072



Только для in vitro диагностики



5010232954236



EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC REP

КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF B 26.01

REF B 26.11

50 мл

монореагент



+18-25°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF B 26.01

REF B 26.11

50 мл

монореагент



+18-25°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



КАЛИБРАТОР

КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF В 26.01

REF В 26.11

1 мл

5,0 ммоль/л

+18-25°C

LOT xxxx

годен до: гггг.мм

CE Только для in vitro диагностики



КАЛИБРАТОР

КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF В 26.01

REF В 26.11

1 мл

5,0 ммоль/л

+18-25°C

LOT xxxx

годен до: гггг.мм

CE Только для in vitro диагностики



Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 4 листа(ов)

Ген. директор Плехов А.Г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**



КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF B 26.01

Набор реагентов для определения концентрации
калия в сыворотке (плазме) крови
турбидиметрическим методом без депротеинизации



Реагент №1: 1 x 50 мл
Калибратор: 1 x 1 мл

TU 9398-282-52145831-00
ФСР 2011/10917 от 25.10.2016

LOT

Серия:
xxxx



Дата выпуска:
гггг.мм




Годен до:
гггг.мм

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 56, литера А

EC REP


EUROPE
P.O. Box 1000
The Hague, The Netherlands



КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF B 26.11

Набор реагентов для определения концентрации
калия в сыворотке (плазме) крови
турбидиметрическим методом без депротеинизации



Реагент №1 2 x 50 мл
Калибратор 2 x 1 мл

TU 9398-282-52145831-00
ФСР 2011/10917 от 25.10.2016

LOT

Серия:
XXXX



Дата выпуска:
ГГГГ.ММ



Годен до:
ГГГГ.ММ




только для in vitro диагностики




АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Колонию
дом 55, литера А

EC REP

ENERGIC EUROPE
Pohlweg 11, 20149
Hamburg, Germany



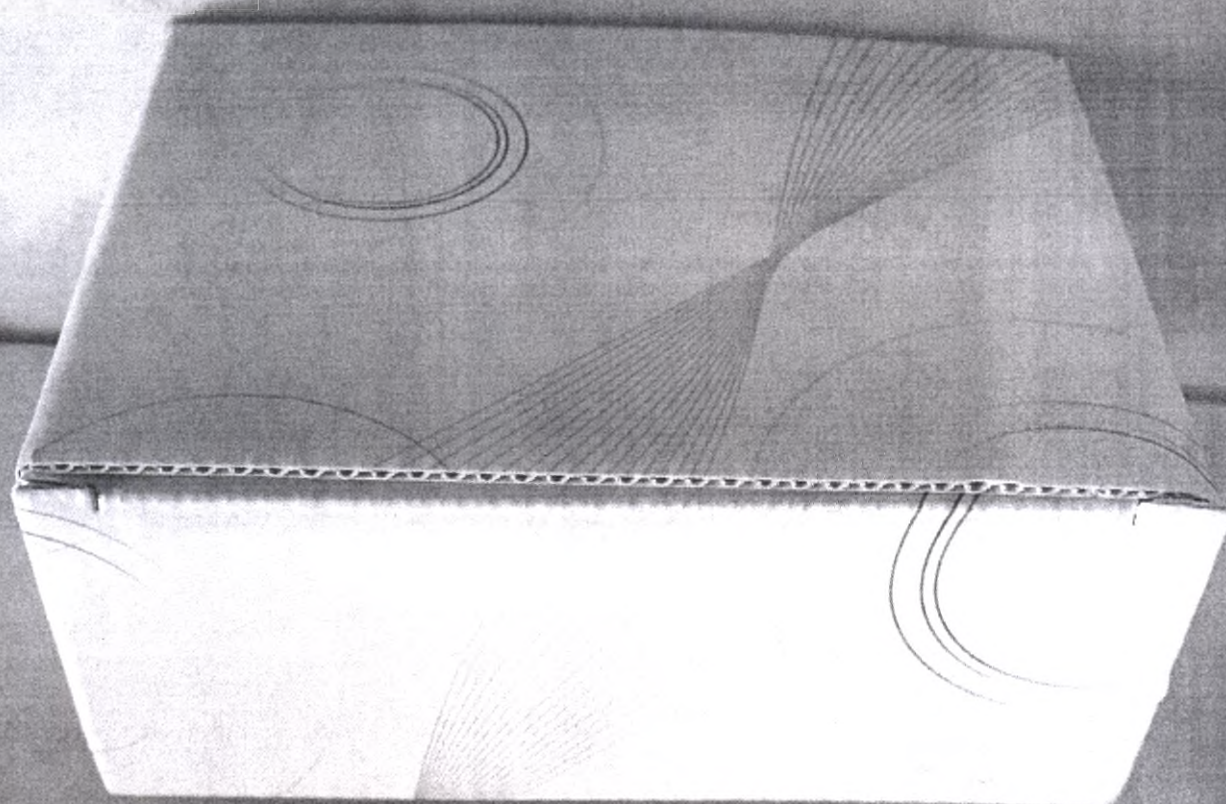

**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего 4 листа(ов)

Ген. директор Писков А.Г.

