

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**



ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

REF

B 17.02

Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов
в сыворотке (плазме) крови
энзиматическим колориметрическим методом



Реагент №1: 1 x 50 мл
Реагент №2: 1 флакон
Калибратор: 1 x 1 мл

ТУ 9398-007-52145831-2004
ФСР 2011/10900 от 25.10.2016

LOT

Серия:
XXXX



Дата выпуска:
ГГГГ.ММ



Годен до:
ГГГГ.ММ

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 56, литера А

EC REP

ВНЕШНЕЕ ВЛИЯНИЕ
Испытано в 20.10.14 г.
Специально для диагностики



ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

REF

B 17.12

Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов
в сыворотке (плазме) крови
энзиматическим колориметрическим методом



Реагент №1: 2 x 50 мл
Реагент №2: 2 флакона
Калибратор: 1 x 1 мл

ТУ 9398-007-52145831-2004
ФСР 2011/10900 от 25.10.2016

LOT

Серия:
xxxx



Дата выпуска:
гггг.мм



Годен до:
гггг.мм


только для in vitro диагностики




АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 56, литера А

EC REP

EMERGENCE EUROPE
Rue de la République 23, 25114 AP
The Hague, The Netherlands



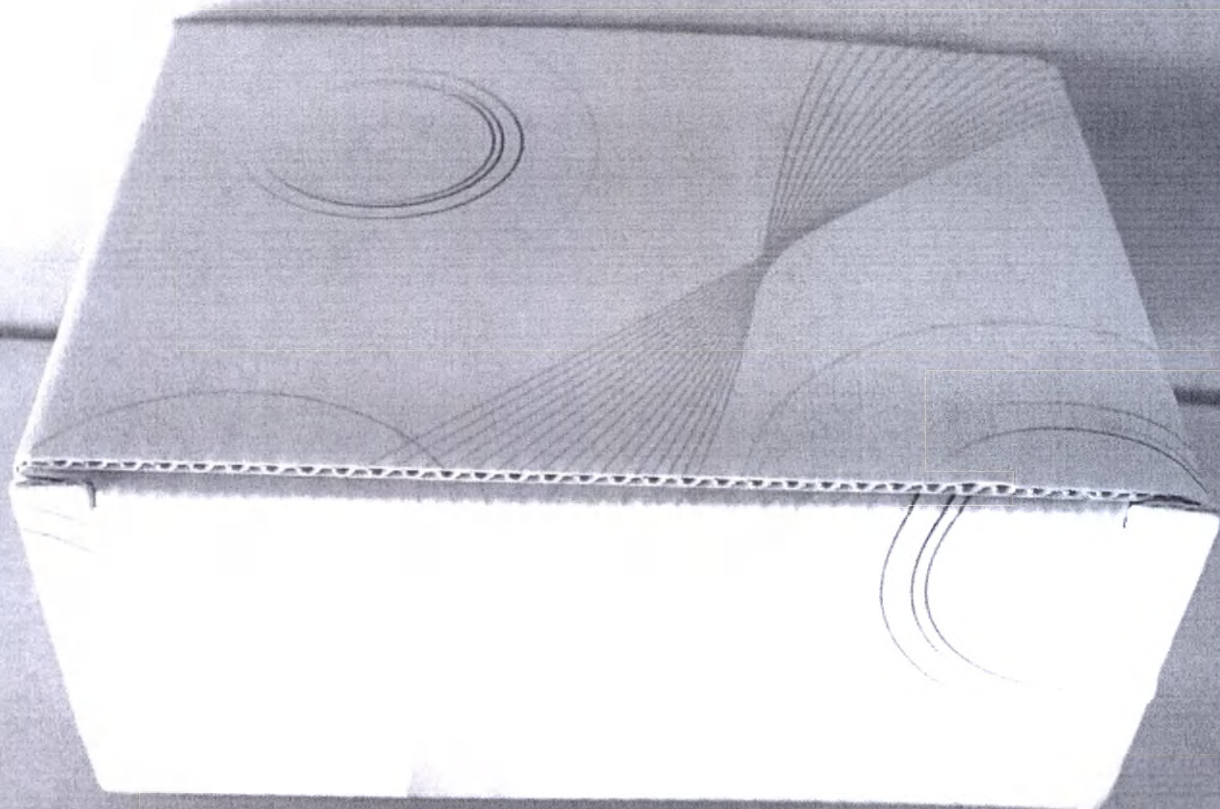

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 4 листа(ов)

Ген. директор

Шехов А.Г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

А.Г. Плехов



2020 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов
в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом.

Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов
в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1 x 50 мл

Реагент №2: 1 флакон

Калибратор: 1 x 1 мл

ТУ 9398-007-52145831-2004

ФСР 2011/10900 от 25.10.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



4 606453 849072



Только для in vitro диагностики



5010232954236



EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC

REP

ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

REF В 17.02

REF В 17.12

50 мл

Буфер



+2-8°C

LOT

xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

REF В 17.02

REF В 17.12

Лиофилизат

Растворить в 50мл. реагента №1



+2-8°C

LOT

xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

1 мл

2,85 ммоль/л



+2-8°C

LOT

xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов
в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 2 x 50 мл

Реагент №2: 2 флакона

Калибратор: 1 x 1 мл

ТУ 9398-007-52145831-2004

ФСР 2011/10900 от 25.10.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



4 606453 849072



Только для in vitro диагностики



5010232954236



EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC

REP

ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

REF В 17.02

REF В 17.12

50 мл

Буфер



+2-8°C



LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

REF В 17.02

REF В 17.12

50 мл

Буфер



+2-8°C



LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

REF В 17.02

REF В 17.12

Лиофилизат

Растворить в 50мл. реагента №1



+2-8°C



LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ

КАЛИБРАТОР

ЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

REF B 17.02

REF B 17.12

Лиофилизат

Растворить в 50мл. реагента №1

+2-8°C

LOT xxxx

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

1 мл

2,85 ммоль/л

+2-8°C

LOT xxxx

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего

4 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.

