


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**



ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

[REF] B 13.12

Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина
в сыворотке (плазме) крови человека
энзиматическим колориметрическим методом



Реагент №1 2 x 100 мл
Реагент №2 2 флакона
Калибратор 1 x 1,5 мл

ТУ 9398-006-52145831-2004
ФСР 2011/10598 от 25.10.2016

LOT

Серия:
XXXX



Дата выпуска:
ГГГГ.ММ



Годен до:
ГГГГ.ММ

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
124350 Санкт-Петербург, Лерига в Каменку
дом 5Б, корпус А

EC REP

СЕРТИФИКАТ
ИЗДАНИЕ 01/13 СТ. 23-14-01
Тех. Регистр. Гос. Санитарного



4 547 112 6 18555



13132010420944

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.22

Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина
в сыворотке (плазме) крови человека
энзиматическим колориметрическим методом

Реагент №1 2 x 250 мл
Реагент №2 2 флакона
Калибратор 1 x 1,5 мл

ТУ 9398-006-62145631-2004
ФСР 2011/10598 от 25.10.2016



LOT Серия:
XXXX



Дата выпуска:
ГГГГ.ММ




Годен до:
ГГГГ.ММ

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменику
д. 100, литер 10

CE REP



ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ **REF B 13.32**

Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке крови методом ферментативного окисления холестеринсвязывающим ферментом


Реагент №1 4 x 250 мл
 Реагент №2 4 флакона
 Калибратор 2 x 1,5 мл

ТУ 8388-008-82148931-2004
 ФСР 2011/10684 от 28.10.2016

LOT Серия XXXX **Дата выпуска** ГГГГ ММ

Годен до ГГГГ ММ


АО "Витал-Диагностика" 194109 Санкт-Петербург, Дворцовая ул. 28, корпус 2

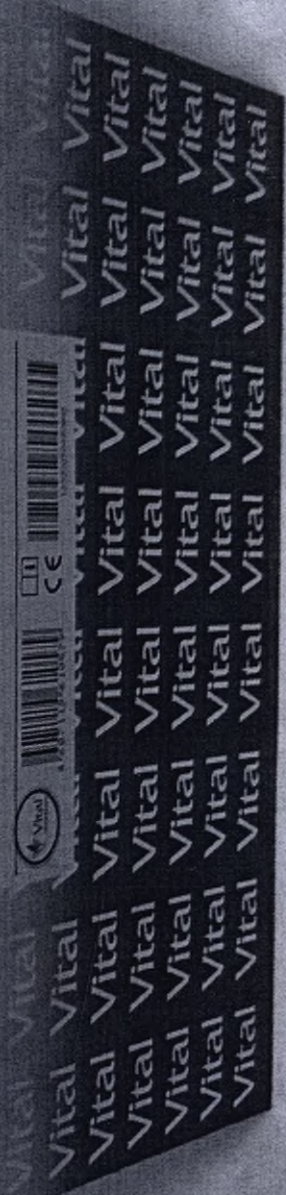

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.11

Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина
в сыворотке (плазме) крови человека
энзиматическим колориметрическим методом



Реагент №1: 2 x 100 мл
Калибратор: 1 x 1,5 мл

ТУ 9398-005-52145831-2004
ФСР 2011/10598 от 25.10.2016

LOT

Серия:
XXXX



Дата выпуска:
ГГГГ.ММ



Годен до:
ГГГГ.ММ

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194366 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 20, литера А

EC REP

Витал Девелопмент Корпорэйшн
Санкт-Петербург, Россия
Тел: +7 (812) 400-00-00




ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.21

Набор реагентов для определения концентрации
общего холестерина в сыворотке (плазме) крови человека
энзиматическим колориметрическим методом

Реагент №1: 2 x 250 мл
Калибратор: 1 x 1,5 мл

ТУ 9398-005-52145831-2004
ФСР 2011/10598 от 25.10.2016



LOT

Серия:
xxxx



Дата выпуска:
гггг.мм




Годен до:
гггг.мм

только для *in vitro* диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 55, литера А

ECRIP



[REF] B 13.71-1.150

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке (плазме) крови человека энзиматическим колориметрическим методом

ТУ 9398-005-62145831-2004
ФСР 2011/10598 от 25.10.2016

Реагент №1: 6 x 40 мл
Калибратор: 2 x 1,5 мл

LOT

Серия:



Дата выпуска:



Годен до:



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

[REF] B 13.71-2.300

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке (плазме) крови человека энзиматическим колориметрическим методом

ТУ 9398-005-62145831-2004
ФСР 2011/10598 от 25.10.2016

Реагент №1: 6 x 40 мл
Калибратор: 2 x 1,5 мл

LOT


Серия:





Дата выпуска:



Годен до:



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

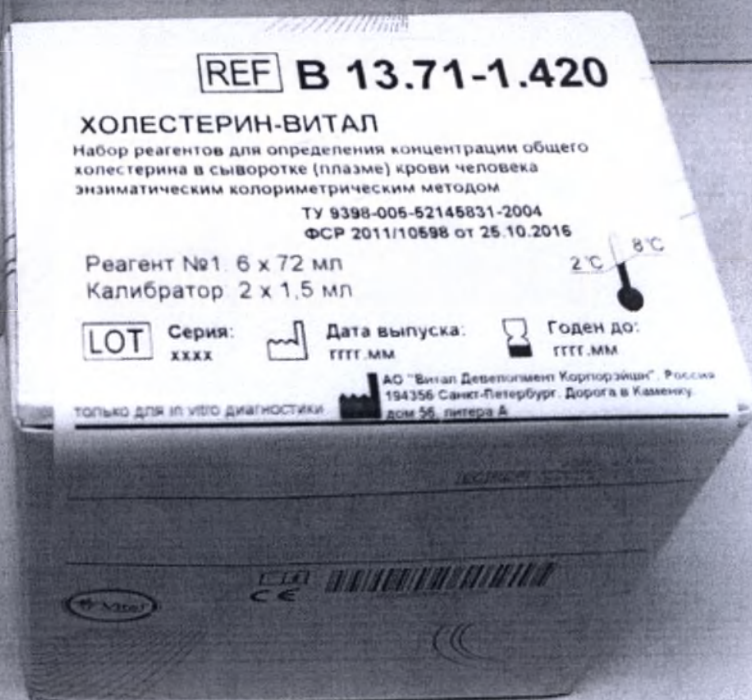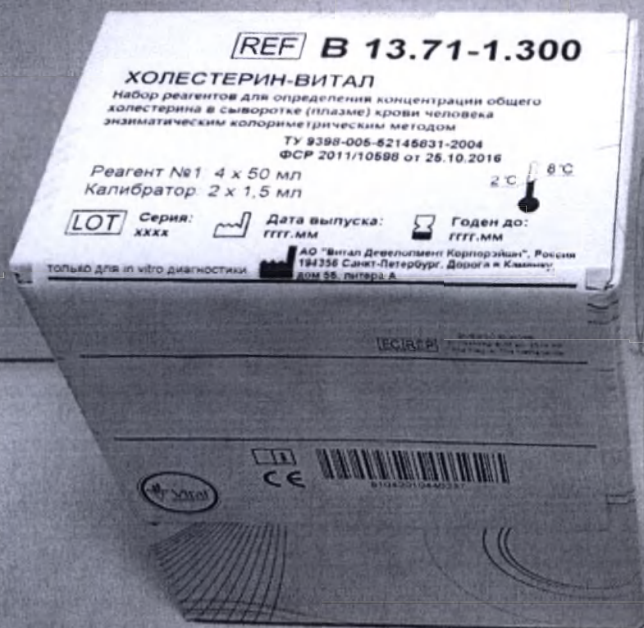

REF В 13.71-2.200

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке (плазме) крови человека энзиматическим колориметрическим методом

ТУ 9398-005-52145831-2004
ФСР 2011/10598 от 25.10.2016

Реагент №1 4 x 40 мл
Калибратор 2 x 1,5 мл



LOT

Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм




Годен до: гггг.мм

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
только для in vitro диагностики

EC REP

Витал Девелопмент Корпорейшн
Информация до 2016 г.
The Medical Time Supply Group



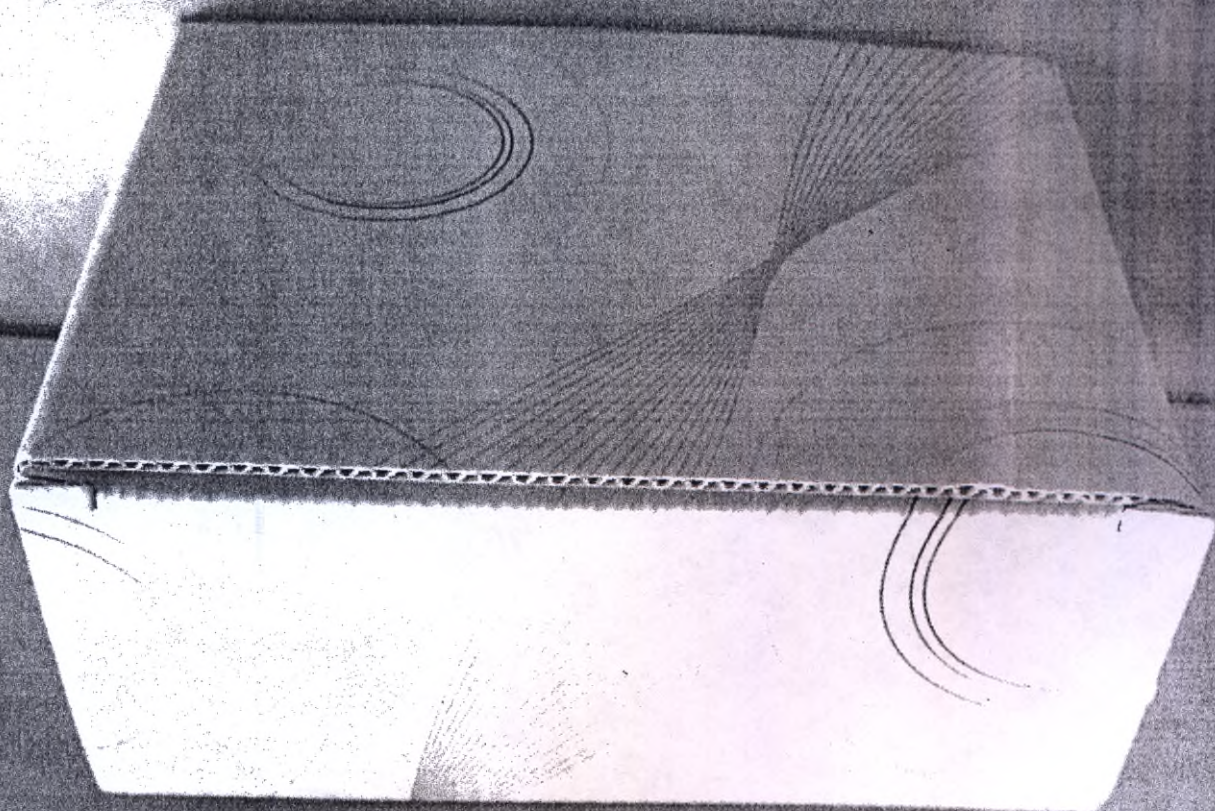

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего

11 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.



УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



Г. Плехов

«24»

2020 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

**Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина
в сыворотке (плазме) крови человека энзиматическим колориметрическим
методом.**

Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке (плазме) крови человека
энзиматическим колориметрическим методом.

LOT Серия: xxxx

 Дата выпуска: гггг.мм Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 2x100 мл

ТУ 9398-005-52145831-2004

Калибратор: 1x 1,5 мл

ФСР 2011/10598 от 25.10.2016

 АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

 +2-8°C 

Только для in vitro диагностики



4 606453 849072

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC REP

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.11

100 мл

Монореагент

РЕАГЕНТ 1

LOT xxxx

 +2-8°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.11

100 мл

Монореагент

РЕАГЕНТ 1

LOT xxxx

 +2-8°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

1,5 мл

5,17 ммоль/л

КАЛИБРАТОР

LOT xxxx

 +2-8°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке (плазме) крови человека
энзиматическим колориметрическим методом.

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 2х250 мл

ТУ 9398-005-52145831-2004

Калибратор: 1х 1,5 мл

ФСР 2011/10598 от 25.10.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



4 606453 849072

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC

REP

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.21

REF В 13.31

250 мл

Монореагент

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.21

REF В 13.31

250 мл

Монореагент

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

1,5 мл

5,17 ммоль/л

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 1

РЕАГЕНТ 1

КАЛИБРАТОР

Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке (плазме) крови человека
энзиматическим колориметрическим методом.

LOT Серия: xxxx

Дата выпуска: гггг.мм

Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 4х250 мл

ТУ 9398-005-52145831-2004

Калибратор: 2х 1,5 мл

ФСР 2011/10598 от 25.10.2016

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

+2-8°C



Только для in vitro диагностики



4 606453 849072

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC

REP

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.21

REF В 13.31

250 мл

Монореагент

LOT xxxx

+2-8°C

Годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.21

REF В 13.31

250 мл

Монореагент

LOT xxxx

+2-8°C

Годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.21

REF В 13.31

250 мл

Монореагент

LOT xxxx

+2-8°C

Годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 1

РЕАГЕНТ 1

РЕАГЕНТ 1

РЕАГЕНТ 1

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.21

REF В 13.31

250 мл

Монореагент

LOT xxxx

 +2-8°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

1,5 мл

5,17 ммоль/л

LOT xxxx

 +2-8°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



КАЛИБРАТОР

КАЛИБРАТОР

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

1,5 мл

5,17 ммоль/л

LOT xxxx

 +2-8°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке (плазме) крови человека
энзиматическим колориметрическим методом.

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 2x100 мл

ТУ 9398-005-52145831-2004

Реагент №2: 2 флакона

ФСР 2011/10598 от 25.10.2016

Калибратор: 1x 1,5 мл



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



5010232954236



Только для in vitro диагностики



4 606453 849072




EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands



РЕАГЕНТ 1

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.12

100 мл

Буфер



xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 1

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.12

100 мл

Буфер



xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 2

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.12

Лиофилизат

растворить в реагенте №1



xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.12

Лиофилизат

Растворить в реагенте №1

LOT xxxx

 +2-8°C годен до: гggг.мм

CE Только для in vitro диагностики



ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

1,5 мл

5,17 ммоль/л

LOT xxxx

 +2-8°C годен до: гggг.мм

CE Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке (плазме) крови человека
энзиматическим колориметрическим методом.

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 2x250 мл

ТУ 9398-005-52145831-2004

Реагент №2: 2 флакона

ФСР 2011/10598 от 25.10.2016

Калибратор: 1x 1,5 мл



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



5010232954236



Только для in vitro диагностики



4 606453 849072



EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC

REP

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.22

REF B 13.32

250 мл

Буфер

LOT

xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.22

REF B 13.32

250 мл

Буфер

LOT

xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 1

РЕАГЕНТ 1

РЕАГЕНТ 2

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.22

REF В 13.32

Лиофилизат

Растворить в реагенте №1

LOT xxxx

+2-8°C



годен до: гggг.мм



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 2

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.22

REF В 13.32

Лиофилизат

Растворить в реагенте №1

LOT xxxx

+2-8°C



годен до: гggг.мм



Только для in vitro диагностики



КАЛИБРАТОР

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

1,5 мл

5,17 ммоль/л

LOT xxxx

+2-8°C



годен до: гggг.мм



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке (плазме) крови человека
энзиматическим колориметрическим методом.

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 4х250 мл

ТУ 9398-005-52145831-2004

Реагент №2: 4 флакона

ФСР 2011/10598 от 25.10.2016

Калибратор: 2х 1,5 мл



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



5010232954236



Только для in vitro диагностики



4 606453 849072



EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC

REP

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.22

REF В 13.32

250 мл

Буфер



LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.22

REF В 13.32

250 мл

Буфер



LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 1

РЕАГЕНТ 1

РЕАГЕНТ 1

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.22

REF В 13.32

250 мл

Буфер

LOT xxxx

+2-8°C

годен до: ГГГГ.ММ



Только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 1

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.22

REF В 13.32

250 мл

Буфер

LOT xxxx

+2-8°C

годен до: ГГГГ.ММ



Только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 2

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.22

REF В 13.32

Лиофилизат

Растворить в реагенте №1

LOT xxxx

+2-8°C

годен до: ГГГГ.ММ



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 2

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.22

REF В 13.32

Лиофилизат

Растворить в реагенте №1

LOT xxxx

+2-8°C

годен до: ГГГГ.ММ



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 2

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.22

REF В 13.32

Лиофилизат

Растворить в реагенте №1

LOT xxxx

+2-8°C

годен до: ГГГГ.ММ



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 2

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.22

REF В 13.32

Лиофилизат

Растворить в реагенте №1

LOT xxxx

+2-8°C

годен до: ГГГГ.ММ

CE Только для in vitro диагностики



КАЛИБРАТОР

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

1,5 мл

5,17 ммоль/л

LOT xxxx

+2-8°C

годен до: ГГГГ.ММ

CE Только для in vitro диагностики



КАЛИБРАТОР

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

1,5 мл

5,17 ммоль/л

LOT xxxx

+2-8°C

годен до: ГГГГ.ММ

CE Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке (плазме) крови человека
энзиматическим колориметрическим методом.

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 6x72 мл

ТУ 9398-005-52145831-2004

Калибратор: 2x 1,5 мл

ФСР 2011/10598 от 25.10.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



4 606453 849072

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC REP

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.71-1.420

72 мл

РЕАГЕНТ 1



xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», Россия

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

1,5 мл

5,17 ммоль/л

КАЛИБРАТОР



xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

1,5 мл

5,17 ммоль/л

КАЛИБРАТОР



xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке (плазме) крови человека
энзиматическим колориметрическим методом.

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 4х40 мл

ТУ 9398-005-52145831-2004

Калибратор: 2х 1,5 мл

ФСР 2011/10598 от 25.10.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,

194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



4 606453 849072

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC

REP

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.71-2.200

40 мл

РЕАГЕНТ 1

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», Россия

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

1,5 мл

5,17 ммоль/л

КАЛИБРАТОР

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

1,5 мл

5,17 ммоль/л

КАЛИБРАТОР

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке (плазме) крови человека
энзиматическим колориметрическим методом.

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 6х40 мл

ТУ 9398-005-52145831-2004

Калибратор: 2х 1,5 мл

ФСР 2011/10598 от 25.10.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



4 606453 849072

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC REP

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.71-2.300

40 мл

РЕАГЕНТ 1



xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», Россия

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

1,5 мл

5,17 ммоль/л

КАЛИБРАТОР



xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

1,5 мл

5,17 ммоль/л

КАЛИБРАТОР



xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке (плазме) крови человека
энзиматическим колориметрическим методом.

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 4x50 мл

ТУ 9398-005-52145831-2004

Калибратор: 2x 1,5 мл

ФСР 2011/10598 от 25.10.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



4 606453 849072

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC

REP

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.71-1.300

50 мл

РЕАГЕНТ 1

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», Россия

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

1,5 мл

5,17 ммоль/л

КАЛИБРАТОР

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

1,5 мл

5,17 ммоль/л

КАЛИБРАТОР

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке (плазме) крови человека
энзиматическим колориметрическим методом.

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 5x40 мл

ТУ 9398-005-52145831-2004

Калибратор: 2x 1,5 мл

ФСР 2011/10598 от 25.10.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



4 606453 849072

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC REP

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.71-1.150

40 мл

РЕАГЕНТ 1



xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», Россия

ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

1,5 мл

5,17 ммоль/л

КАЛИБРАТОР



xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

1,5 мл

5,17 ммоль/л

КАЛИБРАТОР



xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью



Всего

14 листа(ов)

Генеральный директор

Плехов А.Г.