


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**



ЦИНК-ВИТАЛ

REF B 22.01

Набор реагентов для определения концентрации цинка
в сыворотке (плазме) крови
колориметрическим методом без депротеинизации



Реагент №1. 1 x 50 мл
Калибратор. 1 x 1 мл

ТУ 9398-017-94568735-2010
ФСР 2011/10924 от 31.10.2016

LOT

Серия:
xxxx



Дата выпуска:
гггг.мм



Годен до:
гггг.мм

только для in vitro диагностики




АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194366 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 68, литера А

EG16EP

Витал Девелопмент Корпорэйшн
Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 68, литера А



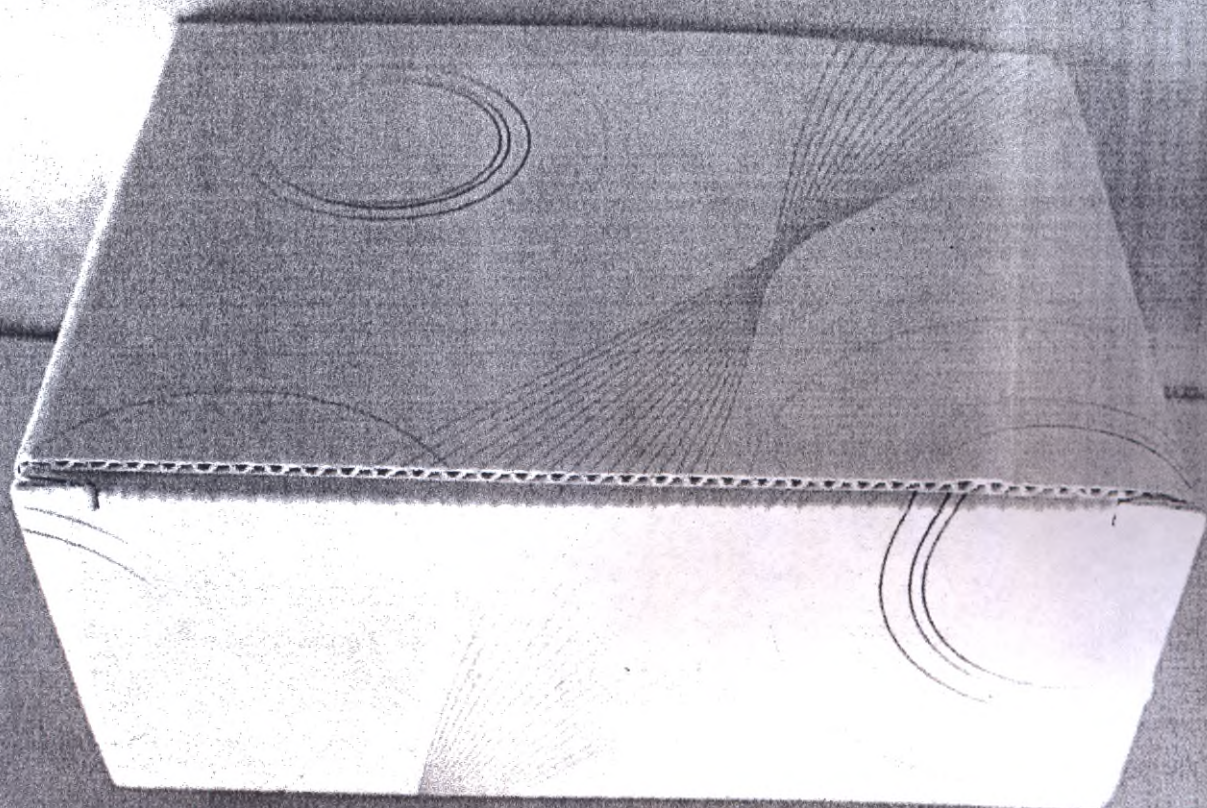

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего

3

листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



А.Г. Плехов

« 12 » 2019 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

ЦИНК-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации цинка в сыворотке (плазме)
крови
колориметрическим методом без депротенинизации.

ЦИНК-ВИТАЛ

REF В 22.01

Набор реагентов для определения концентрации цинка в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом без депротеинизации.

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гтгг.мм



Годен до: гтгг.мм

Реагент №1: 1 × 50 мл

ТУ 9398-017-94568735-2010

Калибратор: 1 x 1 мл

ФСР 2011/10924 от 31.10.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+18-25°C




Только для in vitro диагностики



4 606453 849072



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ЦИНК-ВИТАЛ

REF В 22.01

50 мл

Монореагент

LOT xxxx



+18-25°C



годен до: гтгг.мм



Только для in vitro диагностики

ЦИНК-ВИТАЛ

REF В 22.01

1 мл

30,6 мкмоль/л

LOT xxxx



+18-25°C



годен до: гтгг.мм



Только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 1

КАЛИБРАТОР

**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего 2 листа(ов)
Ген. директор Плехов А.Г.

