

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**



ГЛЮКОЗА-ВИТАЛ

REF B 05.04

Набор реагентов для определения концентрации
глюкозы в цельной крови энзиматическим
колориметрическим методом с депротеинизацией



Реагент №1: 2 x 100 мл
Реагент №2: 2 флакона
Реагент №3: 1 x 50 мл
Калибратор: 1 x 2 мл

ТУ 9398-016-94565735-2011
ФСР 2011/10919 от 31.10.2016

LOT

Серия:
XXXX



Дата выпуска:
ГГГГ.ММ



Годен до:
ГГГГ.ММ

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194358 Санкт-Петербург, Дорога в Колетку,
дом 58, литера А

CE REP

EN ISO 13485
Registration No. 2614 AP
The way, the way forward



08042012630887

ГЛЮКОЗА-ВИТАЛ

REF B 05.14

Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в цельной крови энзиматическим колориметрическим методом с депротеинизацией



Реагент №1: 2 x 250 мл
Реагент №2: 2 флакона
Реагент №3: 1 x 125 мл
Калибратор: 1 x 2 мл

TU 8398-016-84685735-2011
ФСР 2011/10918 от 31.10.2019

LOT

Серия: XXXX



Дата выпуска: ГГГГ.ММ



Годен до: ГГГГ.ММ

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194350 Санкт-Петербург, Дворца в Ушакову,
вход 55, литер А

ECREP

ВНИМАНИЕ!
После вскрытия упаковки
использовать в течение 30 дней



ГЛЮКОЗА-ВИТАЛ

REF B 06.34

Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в цельной крови. Калиметрические фотоколориметрические методы с дефракционированием.



Реагент №1: 4 x 250 мл
Реагент №2: 4 флакона
Реагент №3: 1 x 250 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 9398-018-04866783-2011
ФСР 2011/0919 от 31.10.2018



Серия:
XXXX



Дата выпуска:
ГГГ.ММ




Годен до:
ГГГ.ММ

Галыма для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Варна
14130 Бачко-Питроуш, Девот в Кашану,
Автомобиль А


CEIPED

ВЕРНО В.И.И.И.
Витал Девелопмент Корпорейшн, Варна
14130 Бачко-Питроуш, Девот в Кашану,
Автомобиль А



05342102530958



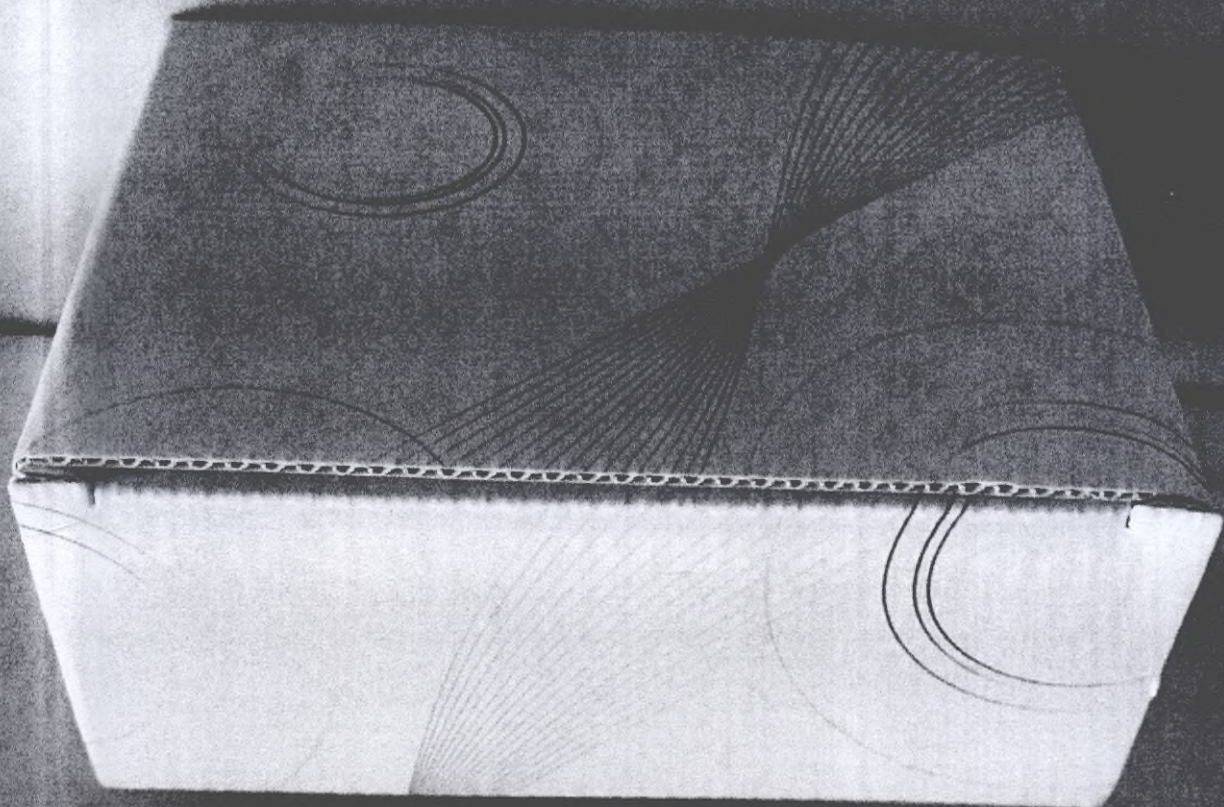

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью



Всего

5

листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

_____ А.Г. Плехов

_____ 2021 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ ГЛЮКОЗА-ВИТАЛ

**Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в цельной крови
энзиматическим колориметрическим методом
с депротеинизацией**

Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в цельной
крови энзиматическим колориметрическим методом
с депротенизацией

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 2x100 мл

ТУ 9398-016-94568735-2011

Реагент №2: 2 флакона

ФСР 2011/10919 от 31.10.2016

Реагент №3: 1x 50 мл

Калибратор: 1x2 мл



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



4 606453 849072



5010232954236

Только для in vitro диагностики



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC REP

ГЛЮКОЗА-ВИТАЛ

REF В 05.02

REF В 05.04

Буфер

100 мл



+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



ГЛЮКОЗА-ВИТАЛ

REF В 05.02

REF В 05.04

Лиофилизат

Растворить в реагенте №1



+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 1

РЕАГЕНТ 2

РЕАГЕНТЫ

ГЛЮКОЗА-ВИТАЛ
REF B 05.04
Кислота перхлорная
50 мл

 +2-8°C

LOT xxxx
 годен до: гggг.мм

CE Только для in vitro диагностики  

КАЛИБРАТОР

ГЛЮКОЗА-ВИТАЛ
2 мл
10 ммоль/л

 +2-8°C

LOT xxxx
 годен до: гggг.мм

CE Только для in vitro диагностики 

Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в цельной
крови энзиматическим колориметрическим методом
с депротенизацией

[LOT] Серия: xxxx



Дата выпуска: гтгг.мм



Годен до: гтгг.мм

Реагент №1: 2x250 мл

ТУ 9398-016-94568735-2011

Реагент №2: 2 флакона

ФСР 2011/10919 от 31.10.2016

Реагент №3: 1 x125 мл

Калибратор: 1x2 мл



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



4 606453 849072



5010232954236

Только для in vitro диагностики



EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC REP

ГЛЮКОЗА-ВИТАЛ

REF В 05.12, REF В 05.32

REF В 05.14, REF В 05.34

Буфер

250 мл

РЕАГЕНТ 1



+2-8°C

[LOT]

xxxx



годен до: гтгг.мм



Только для in vitro диагностики



ГЛЮКОЗА-ВИТАЛ

REF В 05.12, REF В 05.32

REF В 05.14, REF В 05.34

Лиофилизат

Растворить в реагенте №1

РЕАГЕНТ 2



+2-8°C

[LOT]

xxxx



годен до: гтгг.мм



Только для in vitro диагностики



ГЛЮКОЗА-ВИТАЛ

REF В 05.14

Кислота перхлорная

125 мл

РЕАГЕНТ 3



+2-8°C

[LOT]

xxxx



годен до: гтгг.мм



ОЗА-ВИТАЛ

ммоль/л

+2-8°C

LOT XXXX

годен до: ГГГГ.ММ



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в цельной крови
энзиматическим колориметрическим методом
с депротенинизацией

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 4х250 мл

ТУ 9398-016-94568735-2011

Реагент №2: 4 флакона

ФСР 2011/10919 от 31.10.2016

Реагент №3: 1х250 мл

Калибратор: 2х2 мл



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



4 606453 849072



5010232954236

Только для in vitro диагностики



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

РЕАГЕНТ 1

ГЛЮКОЗА-ВИТАЛ

REF В 05.12, REF В 05.32

REF В 05.14, REF В 05.34

Буфер

250 мл

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 2

ГЛЮКОЗА-ВИТАЛ

REF В 05.12, REF В 05.32

REF В 05.14, REF В 05.34

Лиофилизат

Растворить в реагенте №1

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 3

ГЛЮКОЗА-ВИТАЛ

REF В 05.34

Кислота перхлорная

250 мл

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



КОЗА-ВИТАЛ

ммоль/л

LOT xxxx

+2-8°C

годен до: гggг.мм



Только для in vitro диагностики



**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**



Всего

7

листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.