

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



А.Г. Плехов

2021 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

**Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов
высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим
колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения.**

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов
высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим
колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1 x 45 мл

ТУ 9398-006-94568735-2009

Реагент №2: 1 x 15 мл

ФСР 2010/07450 от 01.11.2016

Калибратор: 1 флакон



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,

194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



5010232954236

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC REP

РЕАГЕНТ 1

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.05

REF B 13.15

REF B 13.85

REF B 13.95

45 мл

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 2

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.05

REF B 13.15

REF B 13.85

REF B 13.95

15 мл

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



КАЛИБРАТОР

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.55c

3 мл

Растворить в 3 мл дистиллированной воды

Концентрация-1,44 ммоль/л

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 2 x 45 мл

Реагент №2: 2 x 15 мл

Калибратор: 1 флакон


ТУ 9398-006-94568735-2009

ФСР 2010/07450 от 01.11.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,

194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



Только для in vitro диагностики



5010232954236

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC REP

РЕАГЕНТ 1

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.05

REF B 13.15

REF B 13.85


REF B 13.95

45 мл

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 2

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.05

REF B 13.15

REF B 13.85


REF B 13.95

15 мл

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



КАЛИБРАТОР

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.55c

3 мл


Растворить в 3 мл дистиллированной воды

Концентрация-1,44 ммоль/л

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов
высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим
колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 2 x 40 мл

ТУ 9398-006-94568735-2009

Реагент №2: 2 x 14 мл

ФСР 2010/07450 от 01.11.2016

Калибратор: 1 флакон



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,

194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



5010232954236

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC

REP

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.75-1.150

40 мл

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 1

HDL-ВИТАЛ

REF В 13.75-1.150

14 мл

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 2

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.55с

3 мл

Растворить в 3 мл дистиллированной воды

Концентрация-1,44 ммоль/л

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



КАЛИБРАТОР

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ**REF B 13.75-1.300**

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения

LOT Серия: xxxx

Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 3 x 50 мл

ТУ 9398-006-94568735-2009


Реагент №2: 3 x 17 мл

ФСР 2010/07450 от 01.11.2016

Калибратор: 1 флакон



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А




Только для in vitro диагностики



5010232954236

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



РЕАГЕНТ 1

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ**REF B 13.75-1.300**

50 мл

LOT xxxx

годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 2

HDL-ВИТАЛ**REF B 13.75-1.300**

17 мл

LOT xxxx

годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

КАЛИБРАТОР

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ**REF B 13.55c**

3 мл

Растворить в 3 мл дистиллированной воды

Концентрация-1,44 ммоль/л

LOT xxxx

+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ**REF B 13.75-1.420**

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения

LOT Серия: xxxx

Дата выпуска: гтгг.мм



Годен до: гтгг.мм

Реагент №1: 2 x 70 мл

ТУ 9398-006-94568735-2009

Реагент №2: 2 x 23 мл

ФСР 2010/07450 от 01.11.2016

Калибратор: 1 флакон



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

+2-8°C



Только для in vitro диагностики



5010232954236

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



РЕАГЕНТ 1

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ**REF B 13.75-1.420**

70 мл

LOT xxxx

годен до: гтгг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 2

HDL-ВИТАЛ**REF B 13.75-1.420**

23 мл

LOT xxxx

годен до: гтгг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

КАЛИБРАТОР

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ**REF B 13.55c**

3 мл

Растворить в 3 мл дистиллированной воды

Концентрация-1,44 ммоль/л

LOT xxxx

+2-8°C



годен до: гтгг.мм



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуоингибированием, без осаждения

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1 x 40 мл

Реагент №2: 1 x 14 мл

Калибратор: 1 флакон

ТУ 9398-006-94568735-2009

ФСР 2010/07450 от 01.11.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



5010232954236

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC REP

РЕАГЕНТ 1

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.75-2.200

40 мл

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 2

HDL-ВИТАЛ

REF В 13.75-2.200

14 мл

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

КАЛИБРАТОР

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.55с

3 мл

Растворить в 3 мл дистиллированной воды

Концентрация-1,44 ммоль/л



LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 4 x 40 мл

Реагент №2: 2 x 28 мл

Калибратор: 1 флакон

ТУ 9398-006-94568735-2009

ФСР 2010/07450 от 01.11.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,

194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C




Только для in vitro диагностики



5010232954236

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

РЕАГЕНТ 1

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.75-2.300

40 мл

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 2

HDL-ВИТАЛ

REF В 13.75-2.300

28 мл

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

КАЛИБРАТОР

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.55с

3 мл

Растворить в 3 мл дистиллированной воды

Концентрация-1,44 ммоль/л



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего

8 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**



HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ REF B 13.05

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения

Реагент №1: 1 x 45 мл
Реагент №2: 1 x 15 мл
Калибратор: 1 флакон

ТУ 9398-006-94568735-2009
ФСР 2010/07450 от 01.11.2016

LOT

Серия:
XXXX



Дата выпуска:
ГГГГ.ММ



Годен до:
ГГГГ.ММ

только для in vitro диагностики


АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194355 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 59, литер А

ECIRP

Витал Девелопмент Корпорэйшн
Санкт-Петербург, Россия



13802108230081

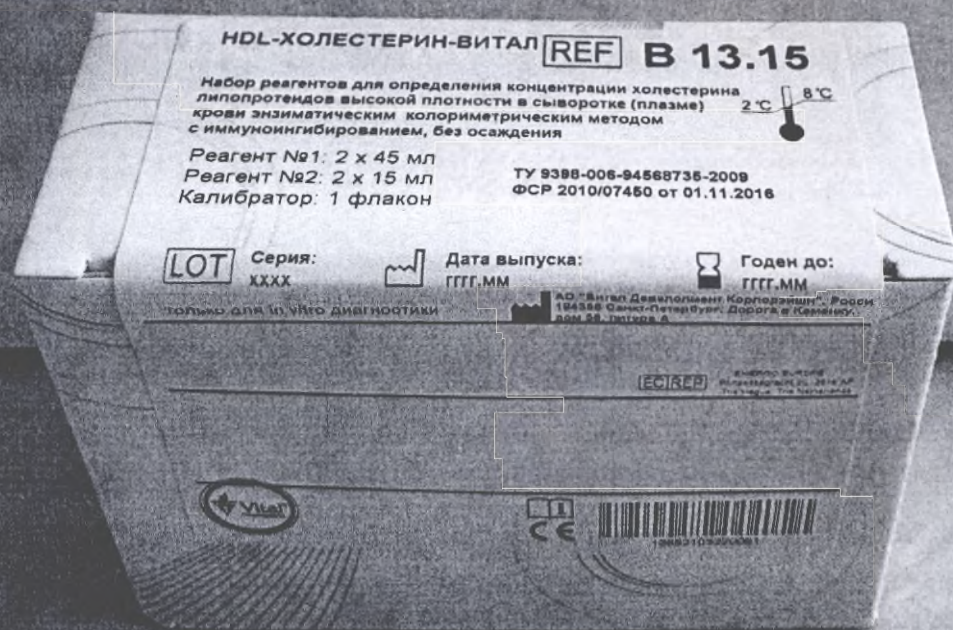

REF B 13.75-1.150

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации комплексов липопротеидов высокой плотности (HDL) в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием. Без осаждения

ТУ 9398-006-94569735-2009
ФСР 2010/07450 от 01.11.2016

Реагент №1 2 x 40 мл
Реагент №2 2 x 14 мл
Калибратор 1 флакон

2°C 8°C

LOT Серия: XXXX Дата выпуска: ГГГГ.ММ Годен до: ГГГГ.ММ

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

REF B 13.75-1.300

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения

ТУ 9398-006-94569735-2009
ФСР 2010/07450 от 01.11.2016


Реагент №1 3 x 50 мл
Реагент №2 3 x 17 мл
Калибратор 1 флакон


2°C 8°C

LOT Серия: XXXX Дата выпуска: ГГГГ.ММ Годен до: ГГГГ.ММ


только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

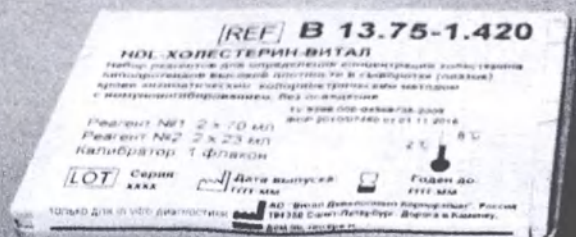

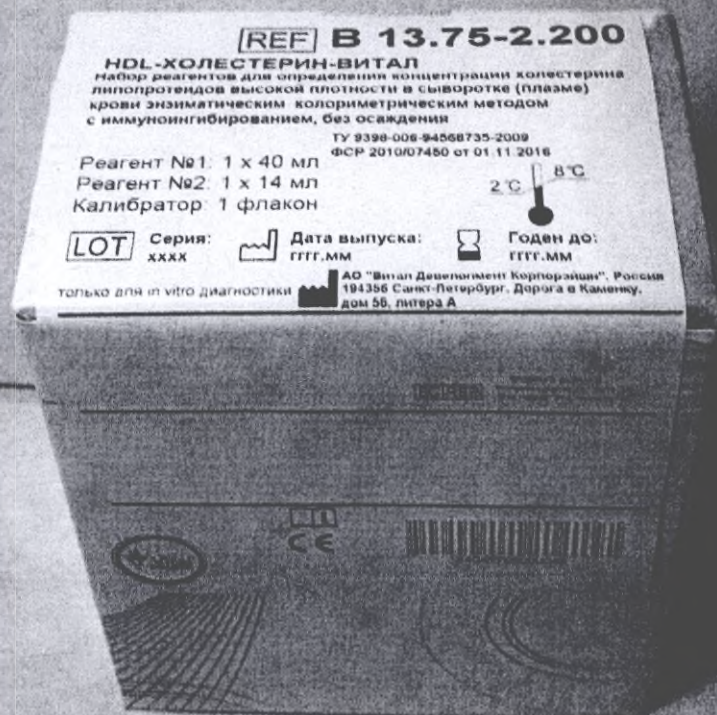

7

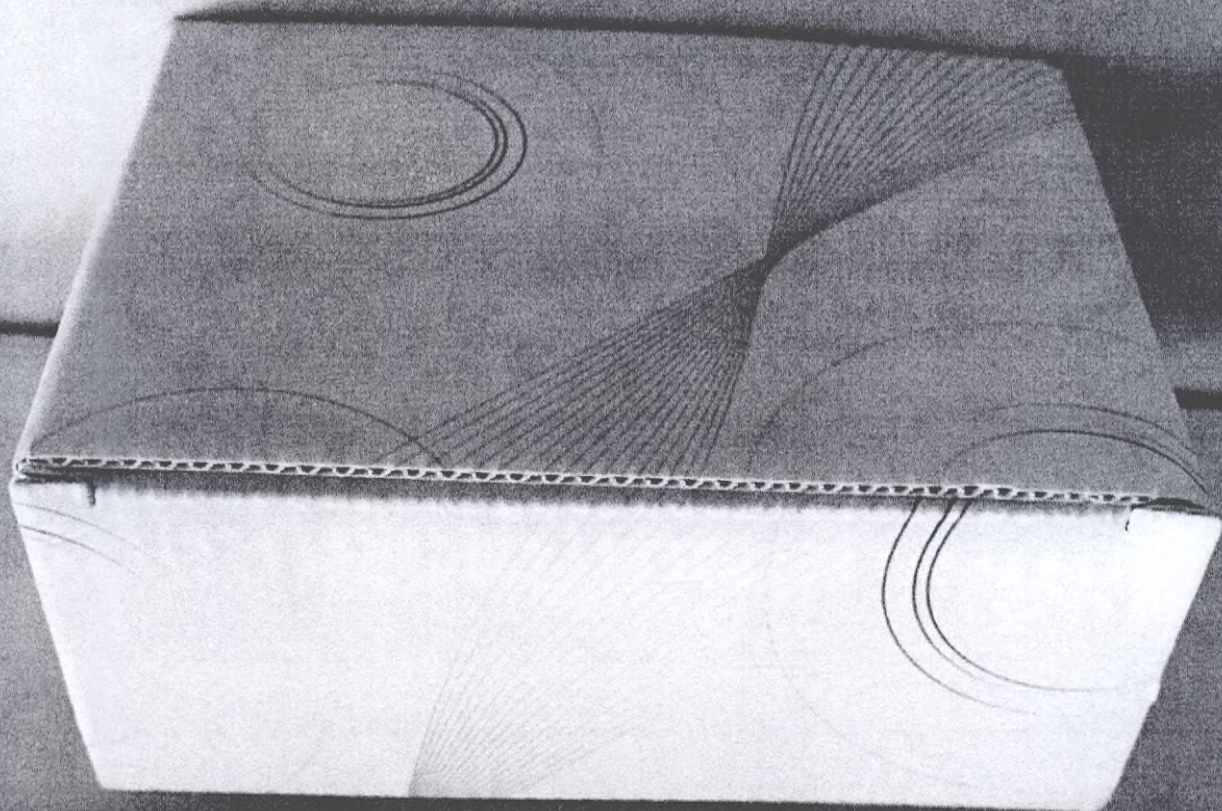

**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**



Всего

7

листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.