

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**


КОПИЯ БЕРНА
ГЕН ДИРЕКТОР
А.Г. ПЛЕХОВ



**ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ**

REF B 15.11

Набор реагентов для определения концентрации
гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови
иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 4 x 7,5 мл
Реагент №2: 1 x 9,5 мл
Реагент №3: 1 x 0,5 мл
Реагент №4: 1 x 200 мл

TU 9398-012-94668735-2010
ФСР 2011/10920 от 02.11.2016

LOT

Серия:
XXXX



Дата выпуска:
ГГГГ.ММ



Годен до:
ГГГГ.ММ

только для in vitro диагностики


АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
184356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
д.км 35, литера А

EC REP

ВВЕДЕНИЕ
Положение 20-2016-01
The name of the product



184356103000001

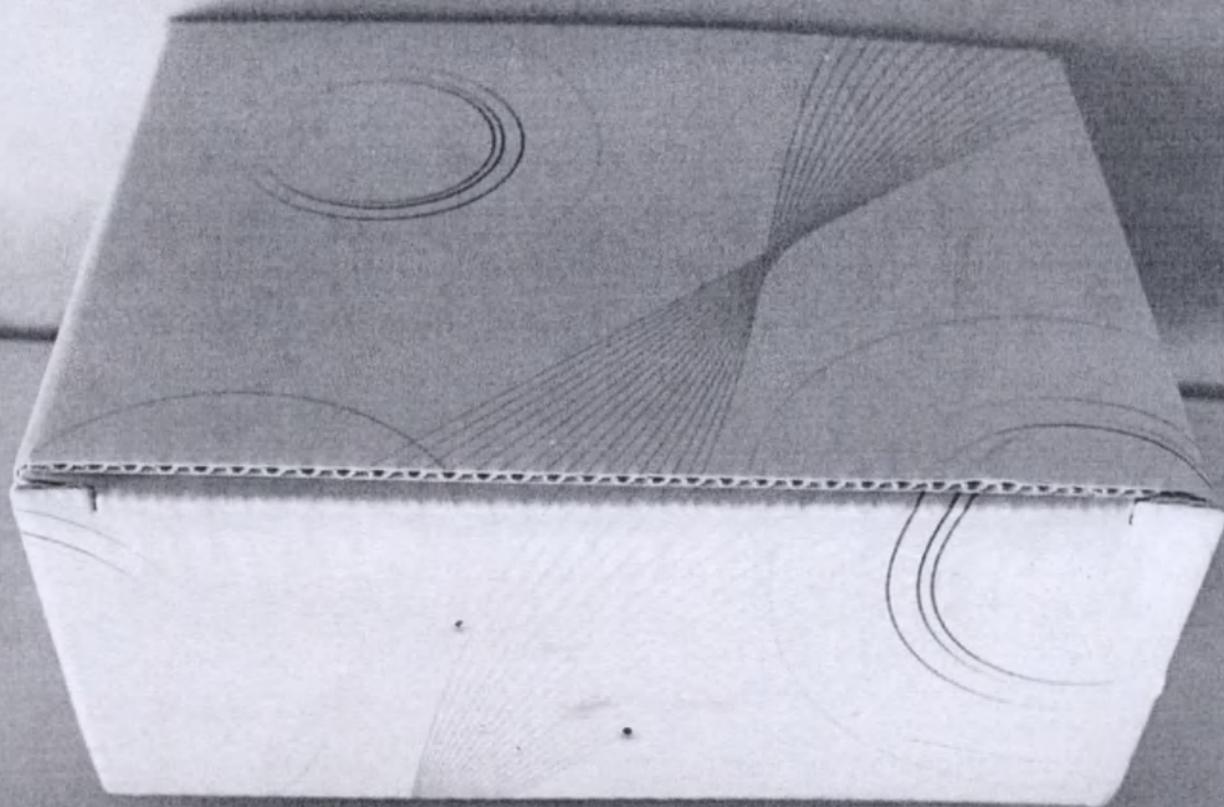

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего

3 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



А.Г. Плехов

2021 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

**Набор реагентов для определения концентрации гликозилированного
гемоглобина (HbA1c) в цельной крови
иммунотурбидиметрическим методом**

Набор реагентов для определения концентрации гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови имунотурбидиметрическим методом

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гтгг.мм



Годен до: гтгг.мм

Реагент №1: 4x7,5 мл

Реагент №2: 1x9,5 мл

Реагент №3: 1x0,5 мл

Реагент №4: 1x200 мл

ТУ 9398-012-94568735-2010

ФСР 2011/10920 от 02.11.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



4 606453 849072



5010232954236

Только для in vitro диагностики



EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC REP

РЕАГЕНТ 1

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

REF B 15.11

7,5 мл

Латекс



+2-8°C



xxxx



годен до: гтгг.мм



Только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 2

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

REF B 15.11

9,5 мл

Буфер



+2-8°C



xxxx



годен до: гтгг.мм



Только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 3

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН -ВИТАЛ

REF B 15.11

0,5 мл

Антитела



+2-8°C



xxxx



годен до: гтгг.мм



Только для in vitro диагностики

ПОЛИМЕРИЗОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

Полимеризирующий реагент

+2-8°C

LOT xxxx

годен до: гggг.мм



Только для in vitro диагностики

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 3 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.

