


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**







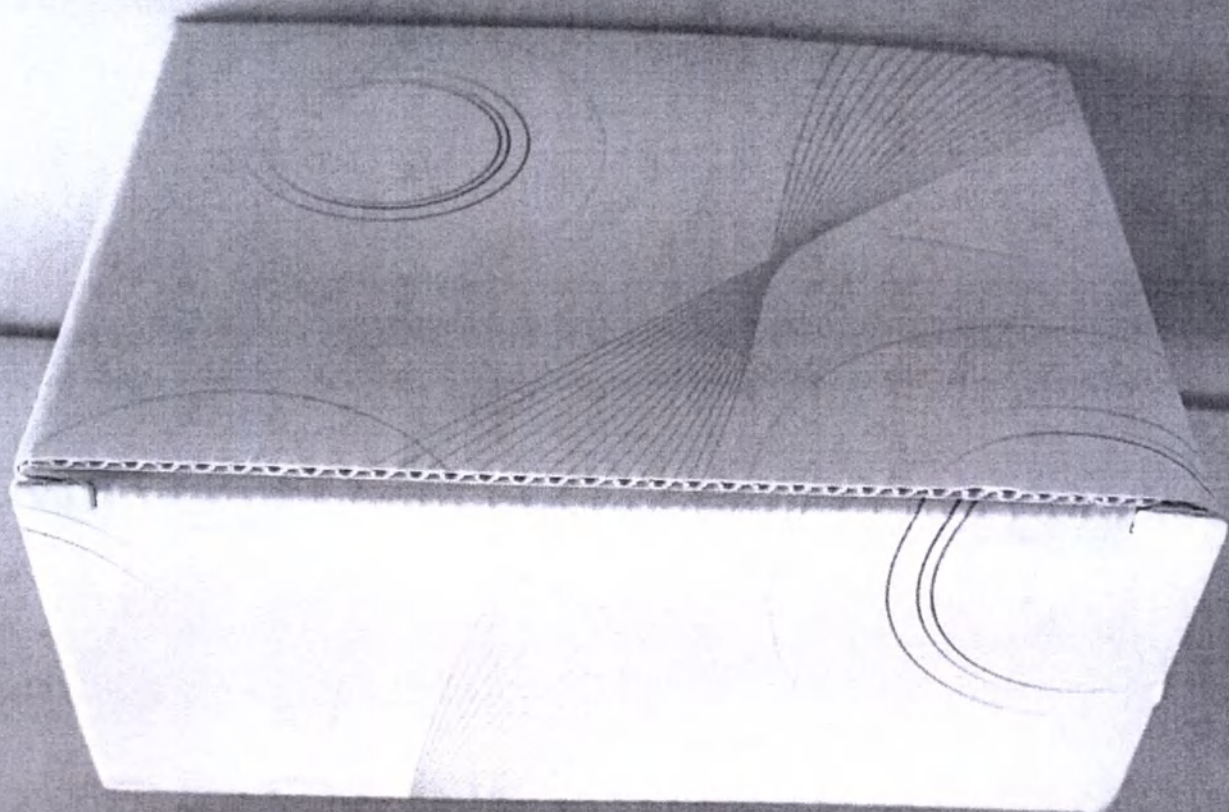

**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего 5 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



А.Г. Плехов

«24» 01 2020 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

МУЛЬТИКОНТ-ВИТАЛ-ПАТОЛОГИЯ

Набор контрольных сывороток для биохимических исследований
(патологический уровень).

Набор контрольных сывороток для биохимических исследований (патологический уровень).

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гтгг.мм



Годен до: гтгг.мм

1 флакон х 5 мл

ТУ 9398-002-94568735-2009

ФСР 2009/05451 от 02.11.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



4 606453 849072

МУЛЬТИКОНТ-ВИТАЛ-ПАТОЛОГИЯ

REF В 32.01

REF В 32.11

REF В 32.21

5 мл

Патологический уровень

Растворить в 5,0 мл. деионизованной воды

LOT

xxxx



+2-8°C



годен до: гтгг.мм

Только для in vitro диагностики



Набор контрольных сывороток для биохимических исследований (патологический уровень).

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

8 флаконов х 5 мл

ТУ 9398-002-94568735-2009

ФСР 2009/05451 от 02.11.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



4 606453 849072

МУЛЬТИКОНТ-ВИТАЛ-ПАТОЛОГИЯ

REF В 32.01

REF В 32.11

REF В 32.21

5 мл

Патологический уровень

Растворить в 5,0 мл. деионизованной воды



LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

Набор контрольных сывороток для биохимических исследований (патологический уровень).

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

20 флаконов х 5 мл

ТУ 9398-002-94568735-2009

ФСР 2009/05451 от 02.11.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



4 606453 849072

МУЛЬТИКОНТ-ВИТАЛ-ПАТОЛОГИЯ

REF В 32.01

REF В 32.11

REF В 32.21

5 мл

Патологический уровень

Растворить в 5,0 мл. деионизованной воды

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм

Только для in vitro диагностики



**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего _____ листа(ов)

Ген. директор

