

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



А.Г. Плехов

2021 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

**Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов
низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим
колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения.**

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов
низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим
колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения

LOT Серия: xxxx

Дата выпуска: гггг.мм

Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1 x 45 мл


ТУ 9398-005-94568735-2009

Реагент №2: 1 x 15 мл

ФСР 2010/07451 от 31.10.2016

Калибратор: 1 флакон

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



5010232954236

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC REP

РЕАГЕНТ 1

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.06

REF B 13.16

REF B 13.86

REF B 13.96

45 мл

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 2

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.06

REF B 13.16

REF B 13.86

REF B 13.96

15 мл

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



КАЛИБРАТОР

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.56c

1 мл

Растворить в 1 мл дистиллированной воды

Концентрация-2,85 ммоль/л

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 2 x 45 мл

ТУ 9398-005-94568735-2009


Реагент №2: 2 x 15 мл

ФСР 2010/07451 от 31.10.2016

Калибратор: 1 флакон



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



Только для in vitro диагностики



5010232954236

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC

REP

РЕАГЕНТ 1

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.06

REF B 13.16

REF B 13.86


REF B 13.96

45 мл

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 2

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.06

REF B 13.16

REF B 13.86


REF B 13.96

15 мл

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



КАЛИБРАТОР

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.56c

1 мл


Растворить в 1 мл дистиллированной воды

Концентрация-2,85 ммоль/л

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов
низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим
колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гтгг.мм



Годен до: гтгг.мм

Реагент №1: 2 x 70 мл

ТУ 9398-005-94568735-2009

Реагент №2: 2 x 23 мл

ФСР 2010/07451 от 31.10.2016

Калибратор: 1 флакон



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,

194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



5010232954236

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC

REP

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.76-1.420

70 мл

LOT xxxx



годен до: гтгг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

LDL-ВИТАЛ

REF В 13.76-1.420

23 мл

LOT xxxx



годен до: гтгг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.56с

1 мл

Растворить в 1 мл дистиллированной воды

Концентрация-2,85 ммоль/л

LOT xxxx



годен до: гтгг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.76-2.200

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1 x 40 мл

ТУ 9398-005-94568735-2009

Реагент №2: 1 x 14 мл

ФСР 2010/07451 от 31.10.2016

Калибратор: 1 флакон



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Vital
Development



Только для in vitro диагностики




5010232954236

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands



РЕАГЕНТ 1

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.76-2.200

40 мл

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 2

LDL-ВИТАЛ

REF В 13.76-2.200

14 мл

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

КАЛИБРАТОР

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.56с

1 мл

Растворить в 1 мл дистиллированной воды

Концентрация-2,85 ммоль/л

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 4 x 40 мл

Реагент №2: 2 x 28 мл

Калибратор: 1 флакон

ТУ 9398-005-94568735-2009

ФСР 2010/07451 от 31.10.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,

194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики




5010232954236

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands



РЕАГЕНТ 1

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.76-2.300

40 мл

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 2

LDL-ВИТАЛ

REF B 13.76-2.300

28 мл

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

КАЛИБРАТОР

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.56c

1 мл

Растворить в 1 мл дистиллированной воды

Концентрация-2,85 ммоль/л

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ**REF B 13.76-1.150**

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения

LOT Серия: xxxx

Дата выпуска: гтгг.мм



Годен до: гтгг.мм

Реагент №1: 2 x 40 мл

ТУ 9398-005-94568735-2009

Реагент №2: 2 x 14 мл

ФСР 2010/07451 от 31.10.2016

Калибратор: 1 флакон



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



5010232954236

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



РЕАГЕНТ 1

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ**REF B 13.76-1.150**

40 мл

LOT xxxx

годен до: гтгг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 2

LDL-ВИТАЛ**REF B 13.76-1.150**

14 мл

LOT xxxx

годен до: гтгг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

КАЛИБРАТОР

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ**REF B 13.56c**

1 мл

Растворить в 1 мл дистиллированной воды

Концентрация-2,85 ммоль/л

LOT xxxx

+2-8°C



годен до: гтгг.мм



Только для in vitro диагностики



LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ**REF B 13.76-1.300**

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения

LOT Серия: xxxx Дата выпуска: гггг.мм Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 3 x 50 мл

ТУ 9398-005-94568735-2009

Реагент №2: 3 x 17 мл

ФСП 2010/07451 от 31.10.2016

Калибратор: 1 флакон

 АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

 +2-8°C

Только для in vitro диагностики



5010232954236

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC REP**РЕАГЕНТ 1****LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ****REF B 13.76-1.300**

50 мл

LOT xxxx годен до: гггг.мм +2-8°C

Только для in vitro диагностики

 Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия**РЕАГЕНТ 2****LDL-ВИТАЛ****REF B 13.76-1.300**

17 мл

LOT xxxx годен до: гггг.мм +2-8°C

Только для in vitro диагностики

 Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия**КАЛИБРАТОР****LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ****REF B 13.56c**

1 мл

Растворить в 1 мл дистиллированной воды

Концентрация-2,85 ммоль/л

LOT xxxx годен до: гггг.мм +2-8°C

Только для in vitro диагностики



**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**



Всего

8


листа(ов)

Ген. директор


Плехов А.Г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**



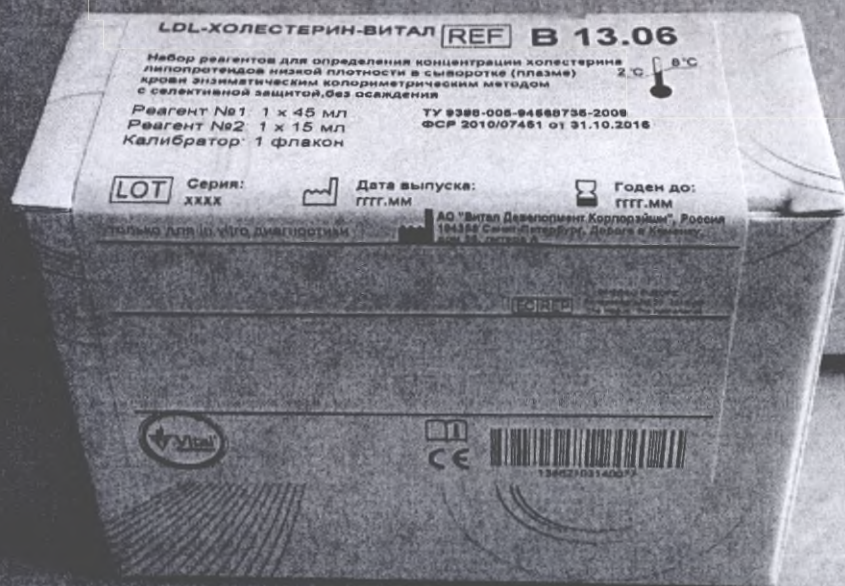

3

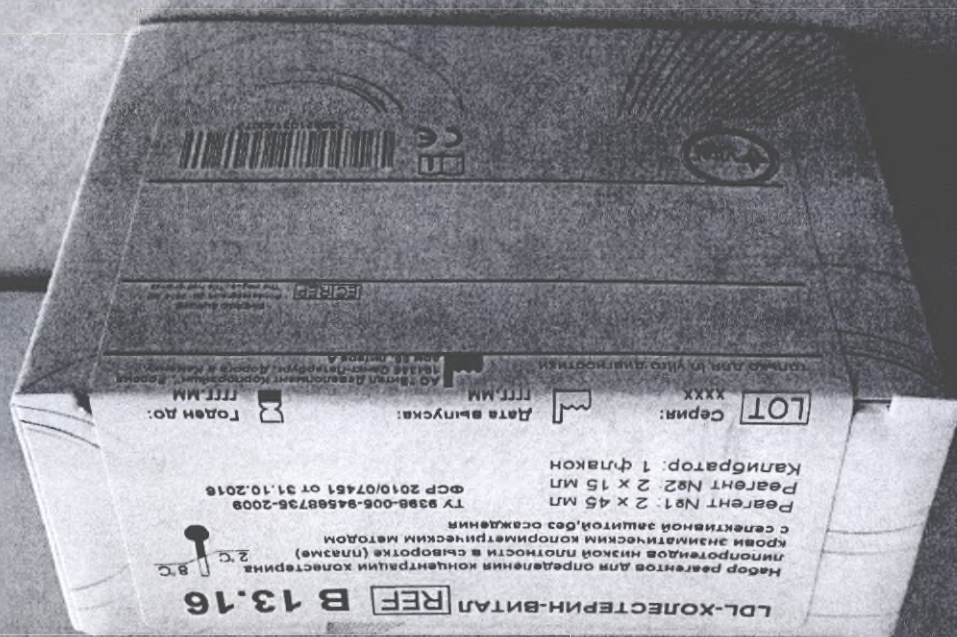

REF B 13.76-2.200

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ


Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения

ТУ 9398-005-94568735-2009
ФСР 2010/07451 от 31.10.2016

Реагент №1: 1 x 40 мл

Реагент №2: 1 x 14 мл

Калибратор: 1 флакон



LOT

Серия:
xxxx



Дата выпуска:
гггг.мм





Годен до:
гггг.мм


только для in vitro диагностики

АО "Витал Деэлопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 55, литер А



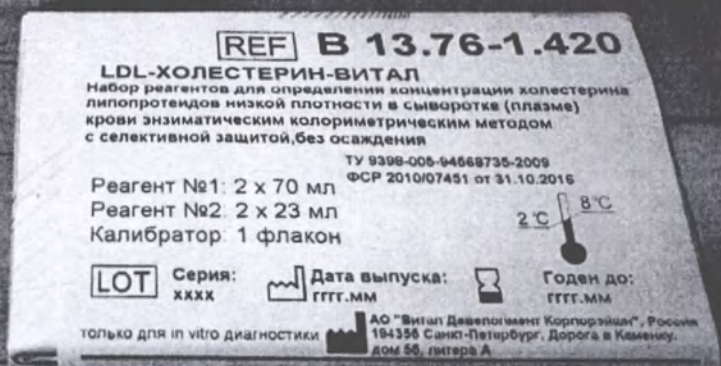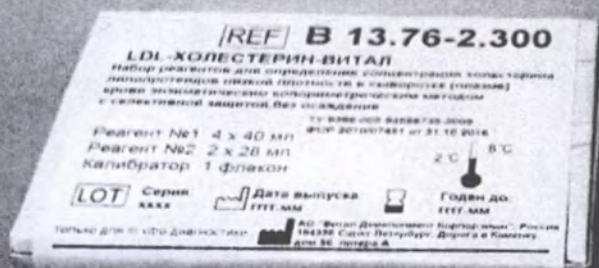

4

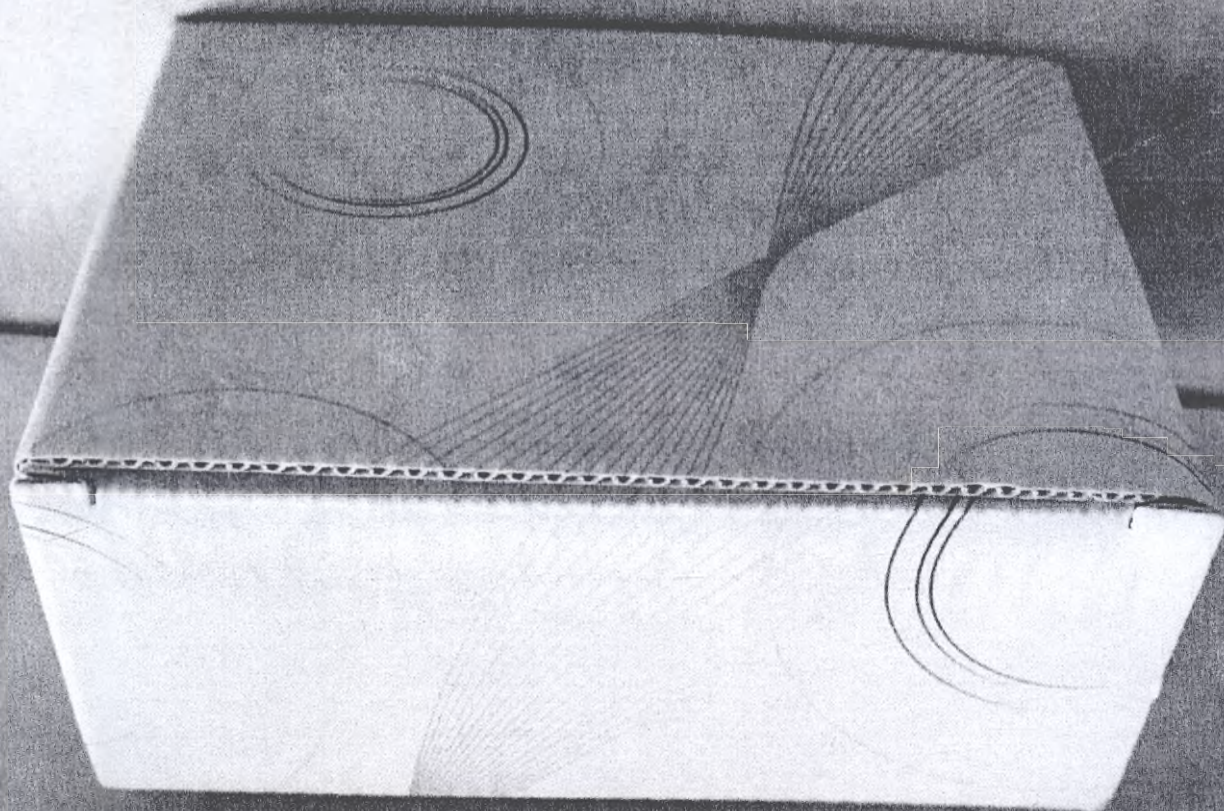

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью



Всего

листа(ов)

Плехов А.Г.