

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

А.Г. Плехов

2019 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ КРЕАТИНИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче методом Яффе «по конечной точке» с депротеинизацией.

Набор реагентов для определения концентрации
креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче
методом Яффе «по конечной точке» с депротеинизацией.

LOT

Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1х100 мл

Реагент №2: 1х100 мл

Реагент №3: 1х100 мл

Калибратор: 1х20 мл

ТУ 9398-259-52145831-2002

ФСР 2011/10910 от 01.11.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,

194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+18-25°C



4 606453 849072



5010232954236



Только для in vitro диагностики

КРЕАТИНИН-ВИТАЛ

REF В 04.02

Пикриновая кислота

100 мл

LOT

xxxx



+18-25°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



КРЕАТИНИН-ВИТАЛ

REF В 04.02

Гидроокись натрия

100 мл

LOT

xxxx



+18-25°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



КРЕАТИНИН-ВИТАЛ

REF В 04.02

Трихлорукусная кислота

100 мл

LOT

xxxx



+18-25°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



КРЕАТИНИН-ВИТАЛ

REF В 04.02

REF В 04.12

177 мкмоль/л

20 мл

LOT

xxxx



+18-25°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

Набор реагентов для определения концентрации
креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче
методом Яффе «по конечной точке» с депротенинизацией.

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1x250 мл

Реагент №2: 1x250 мл

Реагент №3: 1x250 мл

Калибратор: 1x20 мл

ТУ 9398-259-52145831-2002

ФСР 2011/10910 от 01.11.2016

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

+18-25°C



4 606453 849072



5010232954236



Только для in vitro диагностики

КРЕАТИНИН-ВИТАЛ

REF В 04.02

Пикриновая кислота

250 мл



xxxx



+18-25°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



КРЕАТИНИН-ВИТАЛ

REF В 04.02

Гидроокись натрия

250 мл



xxxx



+18-25°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



КРЕАТИНИН-ВИТАЛ

REF В 04.02

Трихлоруксусная кислота

250 мл



xxxx



+18-25°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



КРЕАТИНИН-ВИТАЛ

REF В 04.02

REF В 04.12

177 мкмоль/л

20 мл



xxxx



+18-25°C



годен до: гггг.мм



**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего 3 листа(ов)

Ген. директор Пихов А.Г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**



КРЕАТИНИН-ВИТАЛ

REF B 04.02

Набор реагентов для определения концентрации
креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче
методом Яффе "по конечной точке" с депротеинизацией

18 °C 25 °C

ТУ 9398-259-52146831-2002
ФСР 2011/10910 от 01.11.2016

Реагент №1 1 x 100 мл
Реагент №2 1 x 100 мл
Реагент №3 1 x 100 мл
Калибратор 1 x 20 мл

LOT Серия:
xxxx



Дата выпуска:
гггг.мм



Годен до:
гггг.мм

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорная в Комсомольск
дом 56, литера А



КРЕАТИНИН-ВИТАЛ

REF В 04.12

Набор реагентов для определения концентрации
креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче
методом Яффе "по конечной точке" с депротенизацией



Реагент №1 1 x 250 мл
Реагент №2 1 x 250 мл
Реагент №3 1 x 250 мл
Калибратор 1 x 20 мл

ТУ 9398-259-52145831-2002
ФСР 2011/10910 от 01.11.2016

LOT Серия:
xxxx



Дата выпуска:
гггг.мм



Годен до:
гггг.мм

только для in vitro диагностики




АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194350 Санкт-Петербург, Дворец в Казанском
дом 56, литера А



0412300916010

4

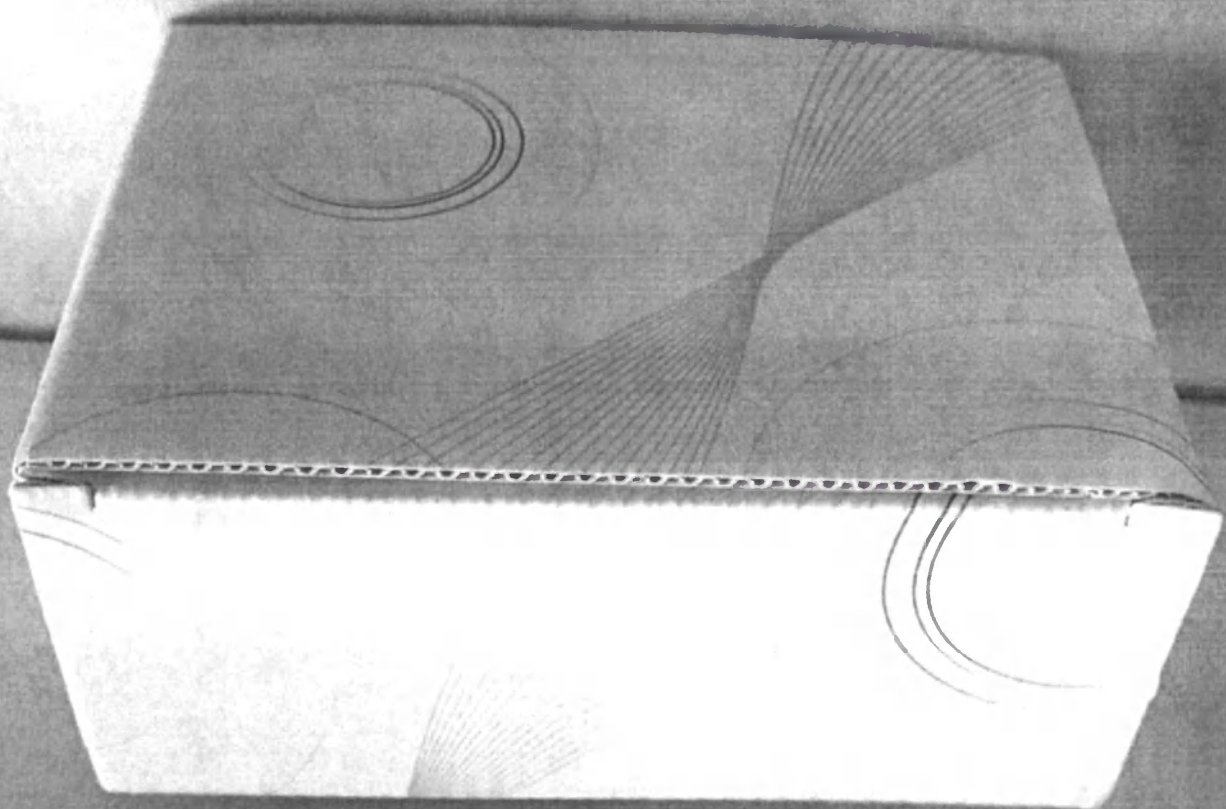

**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего _____ листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.

