

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

А.Г. Плехов

«24»



2020 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения процентного содержания гликозилированного гемоглобина (HbA1) в цельной крови бесколоночным ионообменным методом.

Набор реагентов для определения процентного содержания гликозилированного гемоглобина (HbA1) в цельной крови бесколоночным ионообменным методом

LOT Серия: xxxx

Дата выпуска: гггг.мм

Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1 x 12 мл

ТУ 9398-026-94568735-2011

Реагент №2: 20 x 2,5 мл

ФСР 2012/13137 от 01.11.2016

Калибратор лиофилизированный: 1 фл.

Сепараторы: 20 шт.

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

+2-8°C



Только для in vitro диагностики



5010232954236

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC REP

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

REF В 15.05

12 мл

Лизирующий реагент

LOT xxxx

+2-8°C

годен до: гггг.мм

CE Только для in vitro диагностики



ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

REF В 15.05

REF В 15.15

2,5 мл

Ионообменная смола в разделяющем буфере

LOT xxxx

+2-8°C

годен до: гггг.мм

CE Только для in vitro диагностики



ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

REF В 15.05

REF В 15.15

0,5 мл

Растворить в 0,5 мл дистиллированной воды

Концентрация-4,5 %

LOT xxxx

+2-8°C

годен до: гггг.мм

CE Только для in vitro диагностики



ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

REF В 15.05

REF В 15.15

Сепараторы



Набор реагентов для определения процентного содержания гликозилированного гемоглобина (HbA1) в цельной крови бесколоночным ионообменным методом

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1 x 24 мл

ТУ 9398-026-94568735-2011

Реагент №2: 40 x 2,5 мл

ФСР 2012/13137 от 01.11.2016

Калибратор лиофилизированный: 1 фл.

Сепараторы: 40 шт.



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



5010232954236

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC

REP

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

REF В 15.05

24 мл

Лизирующий реагент



LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

REF В 15.05

REF В 15.15

2,5 мл

Ионообменная смола в разделяющем буфере



LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

REF В 15.05

REF В 15.15

0,5 мл

Растворить в 0,5 мл дистиллированной воды

Концентрация-4,5 %



LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

REF В 15.05

REF В 15.15

Сепараторы



Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 3 листа(ов)

Ген. директор Плехов А.Г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**



**ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ**

REF B 15.05

Набор реагентов для определения процентного содержания
гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови
бескolumnным ионообменным методом



Реагент №1: 1 x 12 мл
Реагент №2: 20 x 2,5 мл
Калибратор
лиофилизированный: 1фл
Сепараторы: 20шт.

ТУ 9398-026-94568735-2011
ФСР 2012/13137 от 01.11.2016

LOT

Серия:
xxxx



Дата выпуска:
гггг.мм



Годен до:
гггг.мм

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Казанку
дом 56, литера А

ECIREP

ВЕРСИЯ 15.05.05
Анализаторы: 20 x 2,5 мл
Температура: 20-25°C



15063010030102

**ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЕ
ГЕМОГЛОБИНЫ-ВИТАЛ**

набор реагентов для определения процентного содержания
гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови
бескислородными консомбными методами

Реагент №1 1 x 24 мл
Реагент №2 40 x 2,5 мл
Калибратор
Фла
плюсифилизованные
Сепараторы 40шт

LOT Серии: XXXX

Годен до: 11/11/2016

АД "Ветеринарный препарат" ООО, Россия
г. Москва, м. Давыдовское, д. 10
тел. 8 (495) 550-0000


[EC[REP]]

A barcode is located at the bottom of the page, with the CE mark positioned to its left.

Vital

Vital Vital Vital Vital Vital
Vital Vital Vital Vital Vital
Vital Vital Vital Vital Vital
Vital Vital Vital Vital Vital
Vital Vital Vital Vital Vital

(01) 683-79

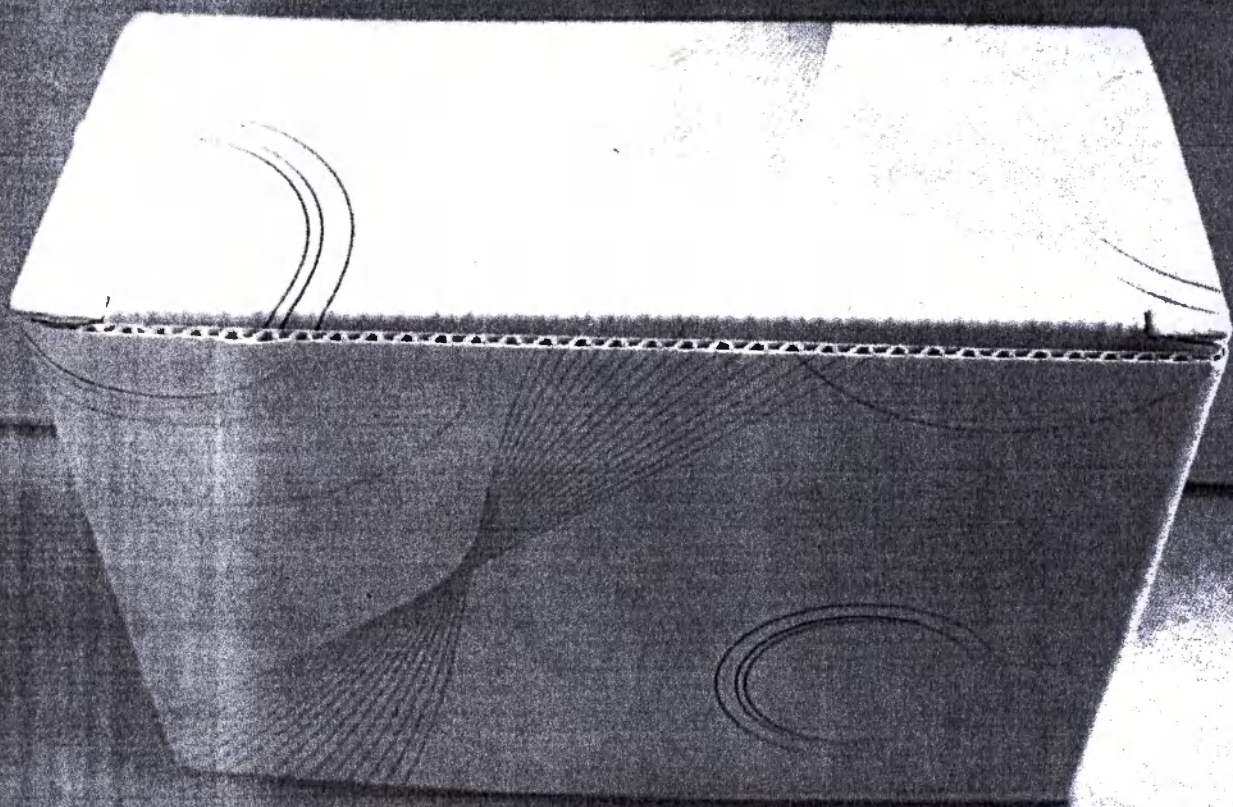

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего

4

листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.

