







Фотографическое изображение макета маркировки изделия «Аппарат магнитотерапевтический «АЛМАГ-02» по ГИКС.941519.104 ТУ.

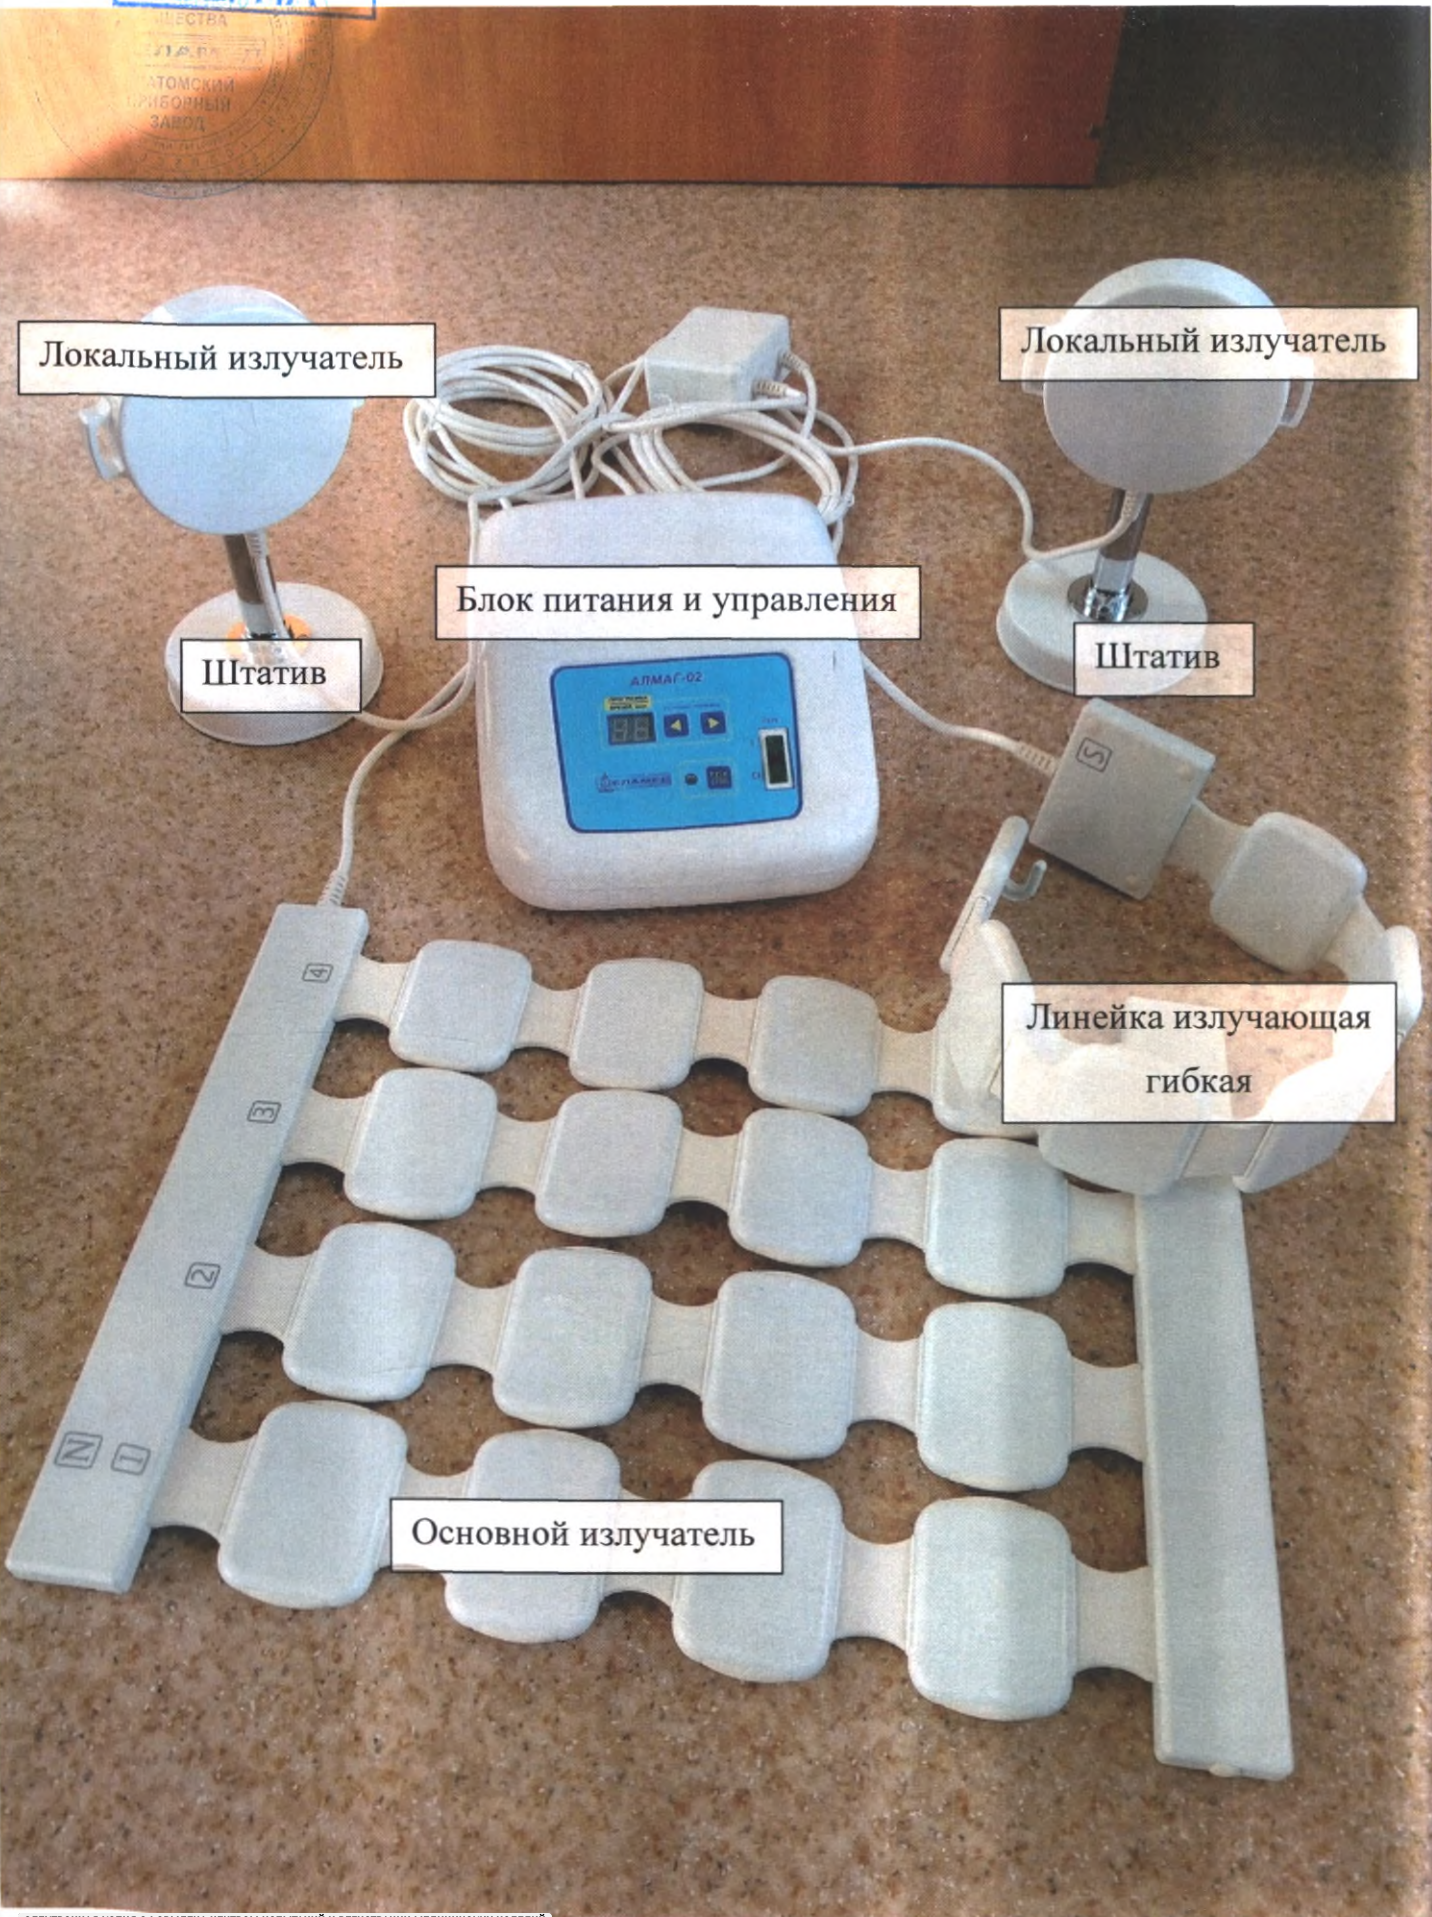

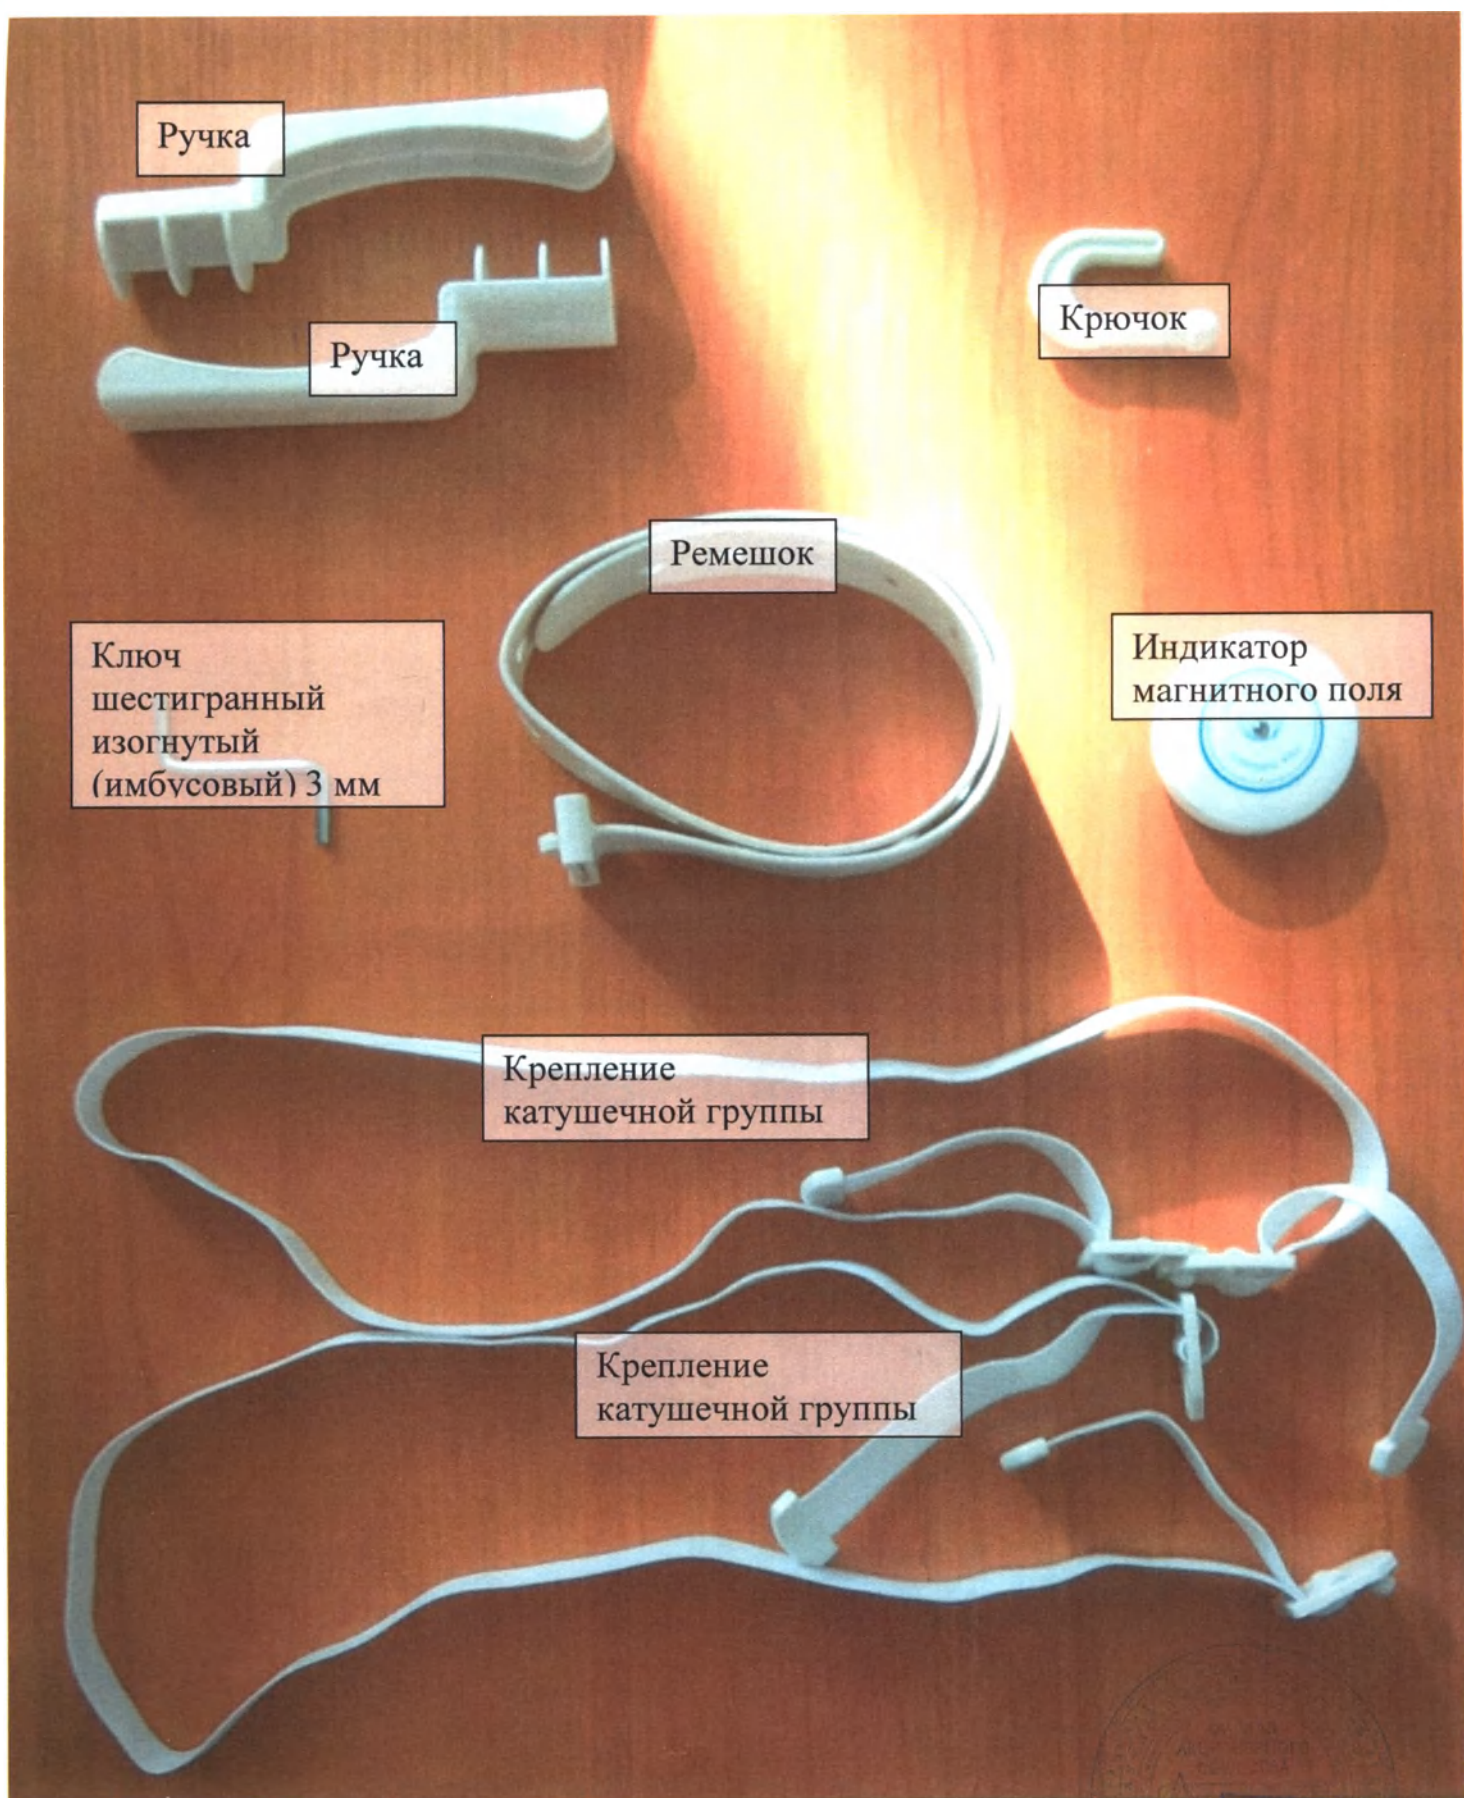

АЛМАГ-02

Всё для здоровья. Здоровье для Вас.

Условия транспортировки: температура воздуха от -50 °С до +50 °С, относительная влажность воздуха до 100% при +25 °С


Условия хранения: температура воздуха от -50 °С до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 98% при +25 °С

Вариант поставки №



4 602 122 00 066 0

Вариант поставки №



4 602 122 00 066 7

~230 В, 50 Гц
45 В·А

АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ «АЛМАГ-02» по ГИКС.941519.104 ТУ
Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04790

Компания ЕЛАМЕД*

Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,
Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25.

Тел./факс: (49131) 2-04-57, 2-21-09, 4-38-29

E-mail: admin@elamed.com

www.elamed.com

*Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»


Предприятие сертифицировано на соответствие ISO 13485

Сделано в России



Дата выпуска 01.13

Штамп ОТК



ОМ №29.267.02

Уважаемый покупатель, внимание!
Убедитесь в полном соответствии
комплектации изделия с информацией,
указанной в разделе Комплект поставки
руководства по эксплуатации





Компания **ЕЛАМЕД***

Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,
Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25.

Тел./факс: (49131) 2-04-57, 4-38-29

E-mail: admin@elamed.com

www.elamed.com

*Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»

Вариант поставки изд. №

Delivery option №

1



1 48 02132 00030 7

Вариант поставки изд. №

Delivery option №

2



1 48 02132 00030 4

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ
ЗАВОД

АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ

АЛМАГ-02

по ГИКС 941519.104 ТУ

ГИКС 941519.104 ТУ

45 В А, ~230 В, 50 Гц

КОЛИЧЕСТВО 1 шт.

ШТАМП ОТК

ДАТА УПАКОВЫВАНИЯ 01.2015

СЕРИЙНЫЙ № 00048

YELATMA
INSTRUMENT
MAKING ENTERPRISE, JSC

MAGNETOTHERAPY DEVICE

ALMAG-02

ACCORDING TO GOST R 519.104 TU

45 В А, ~230 В, 50 Гц

QUANTITY 1 UNIT

STAMP FROM


PACKAGING DATE 01.2015

SERIAL NO. 00048



АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ «АЛМАГ-02» по ГИКС.941519.104 ТУ


АЛМАГ®-02

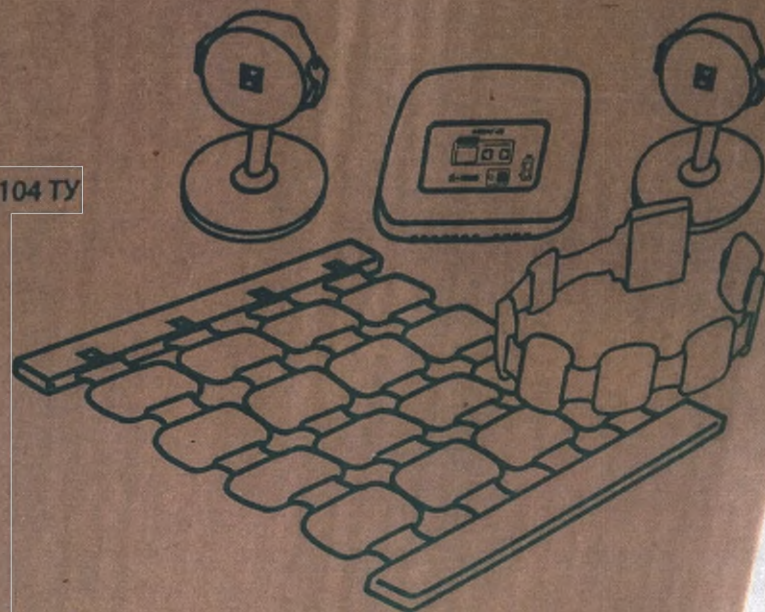


КОПИЯ
ВЕРНА

Фотографическое изображение общего вида изделия «Аппарат магнитотерапевтический
«АЛМАГ-02» по ГИКС.941519.104 ТУ (экспортное исполнение)

Стр 1/2

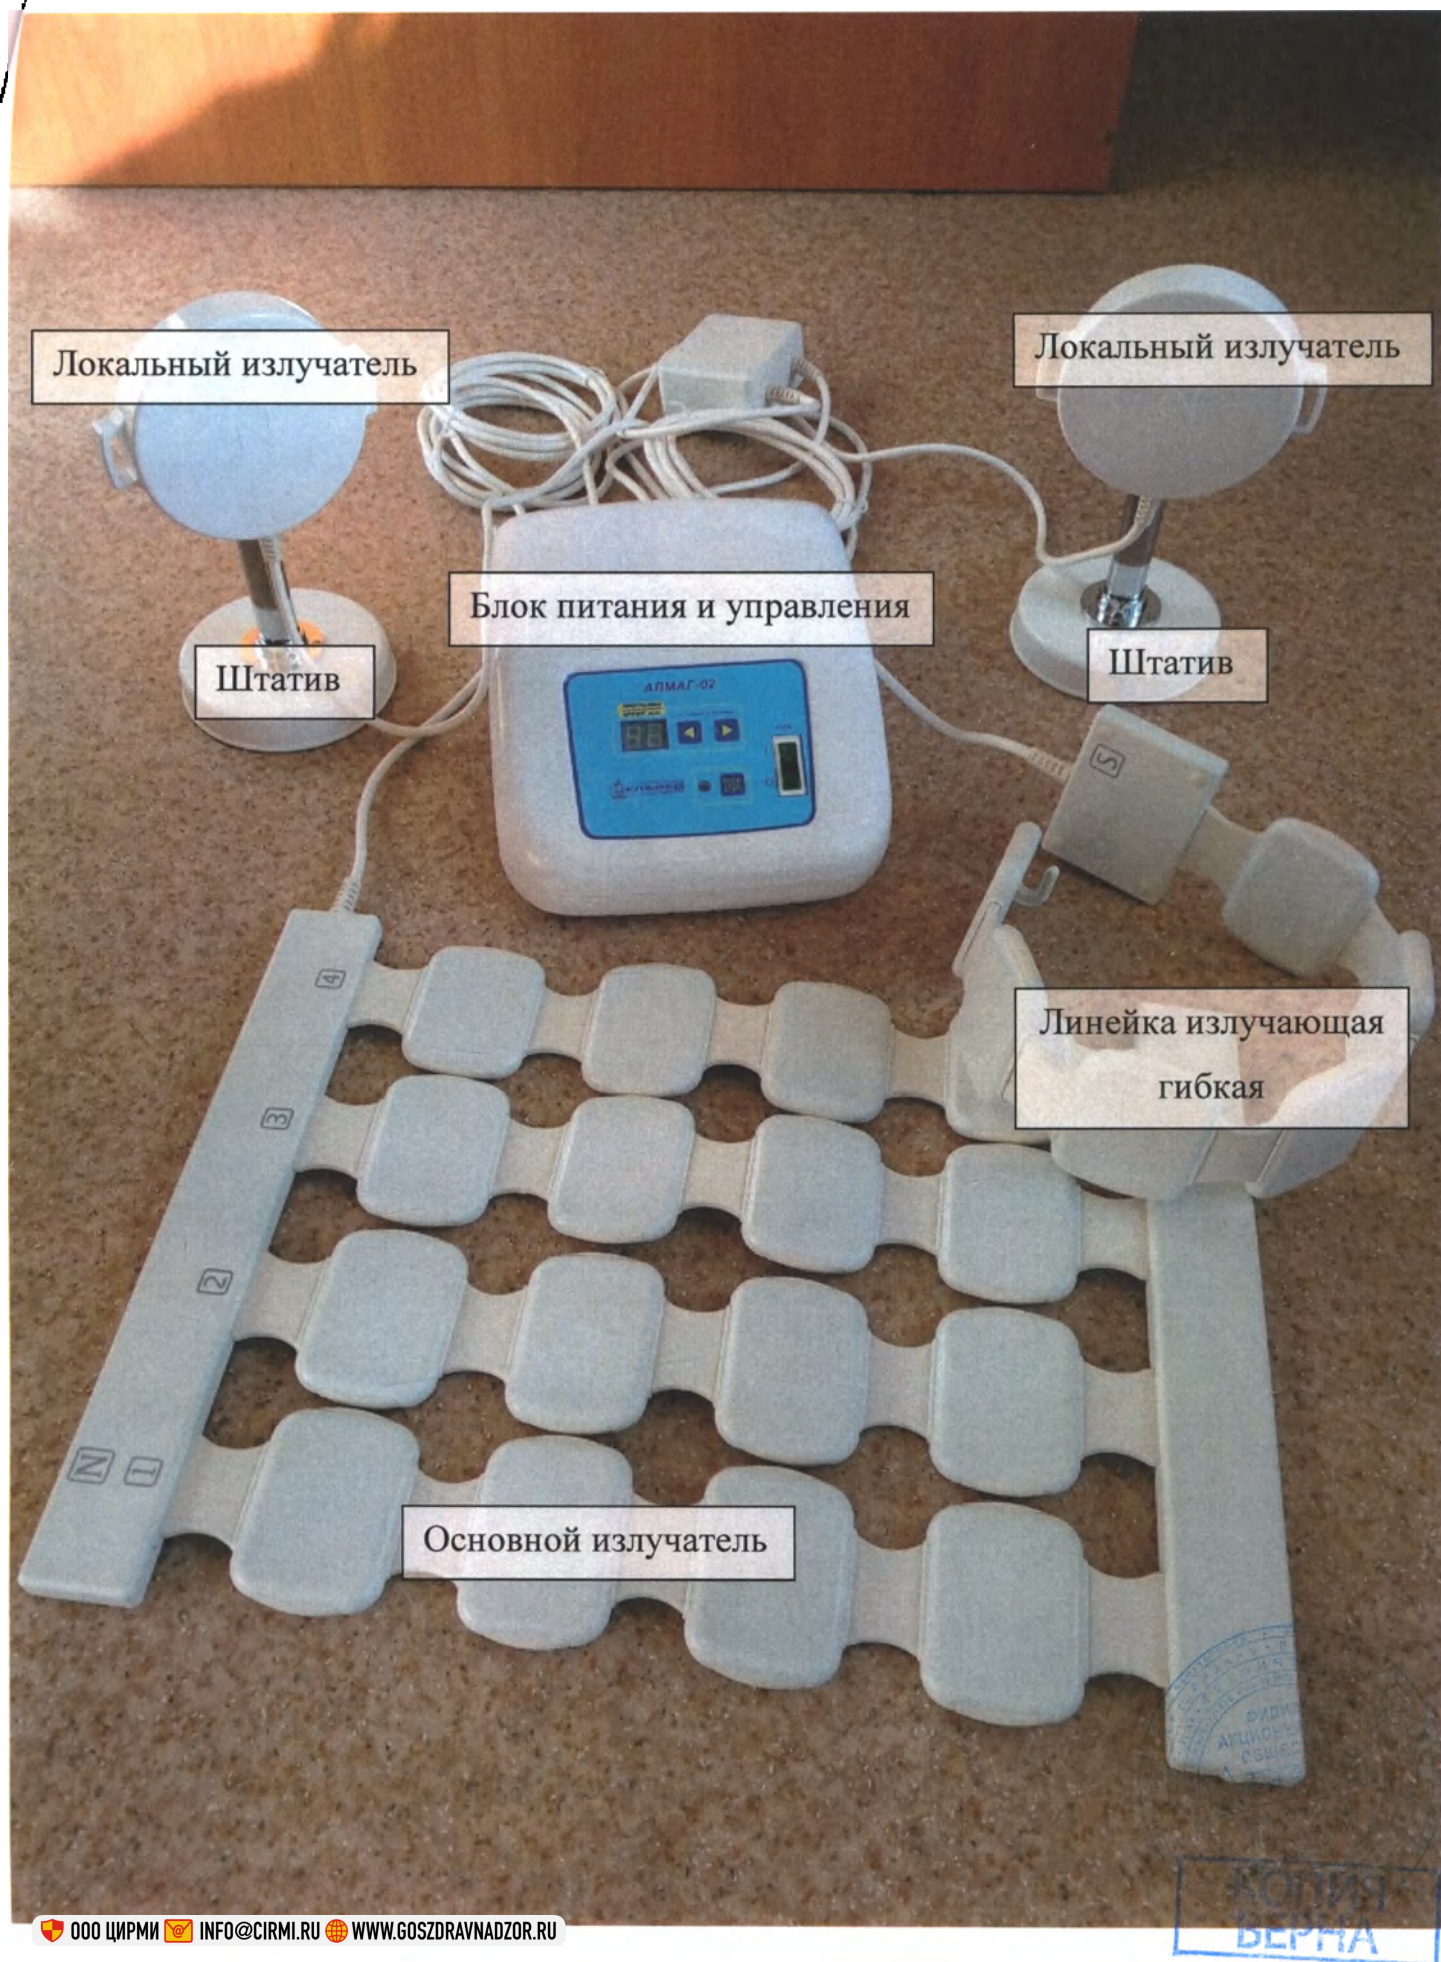

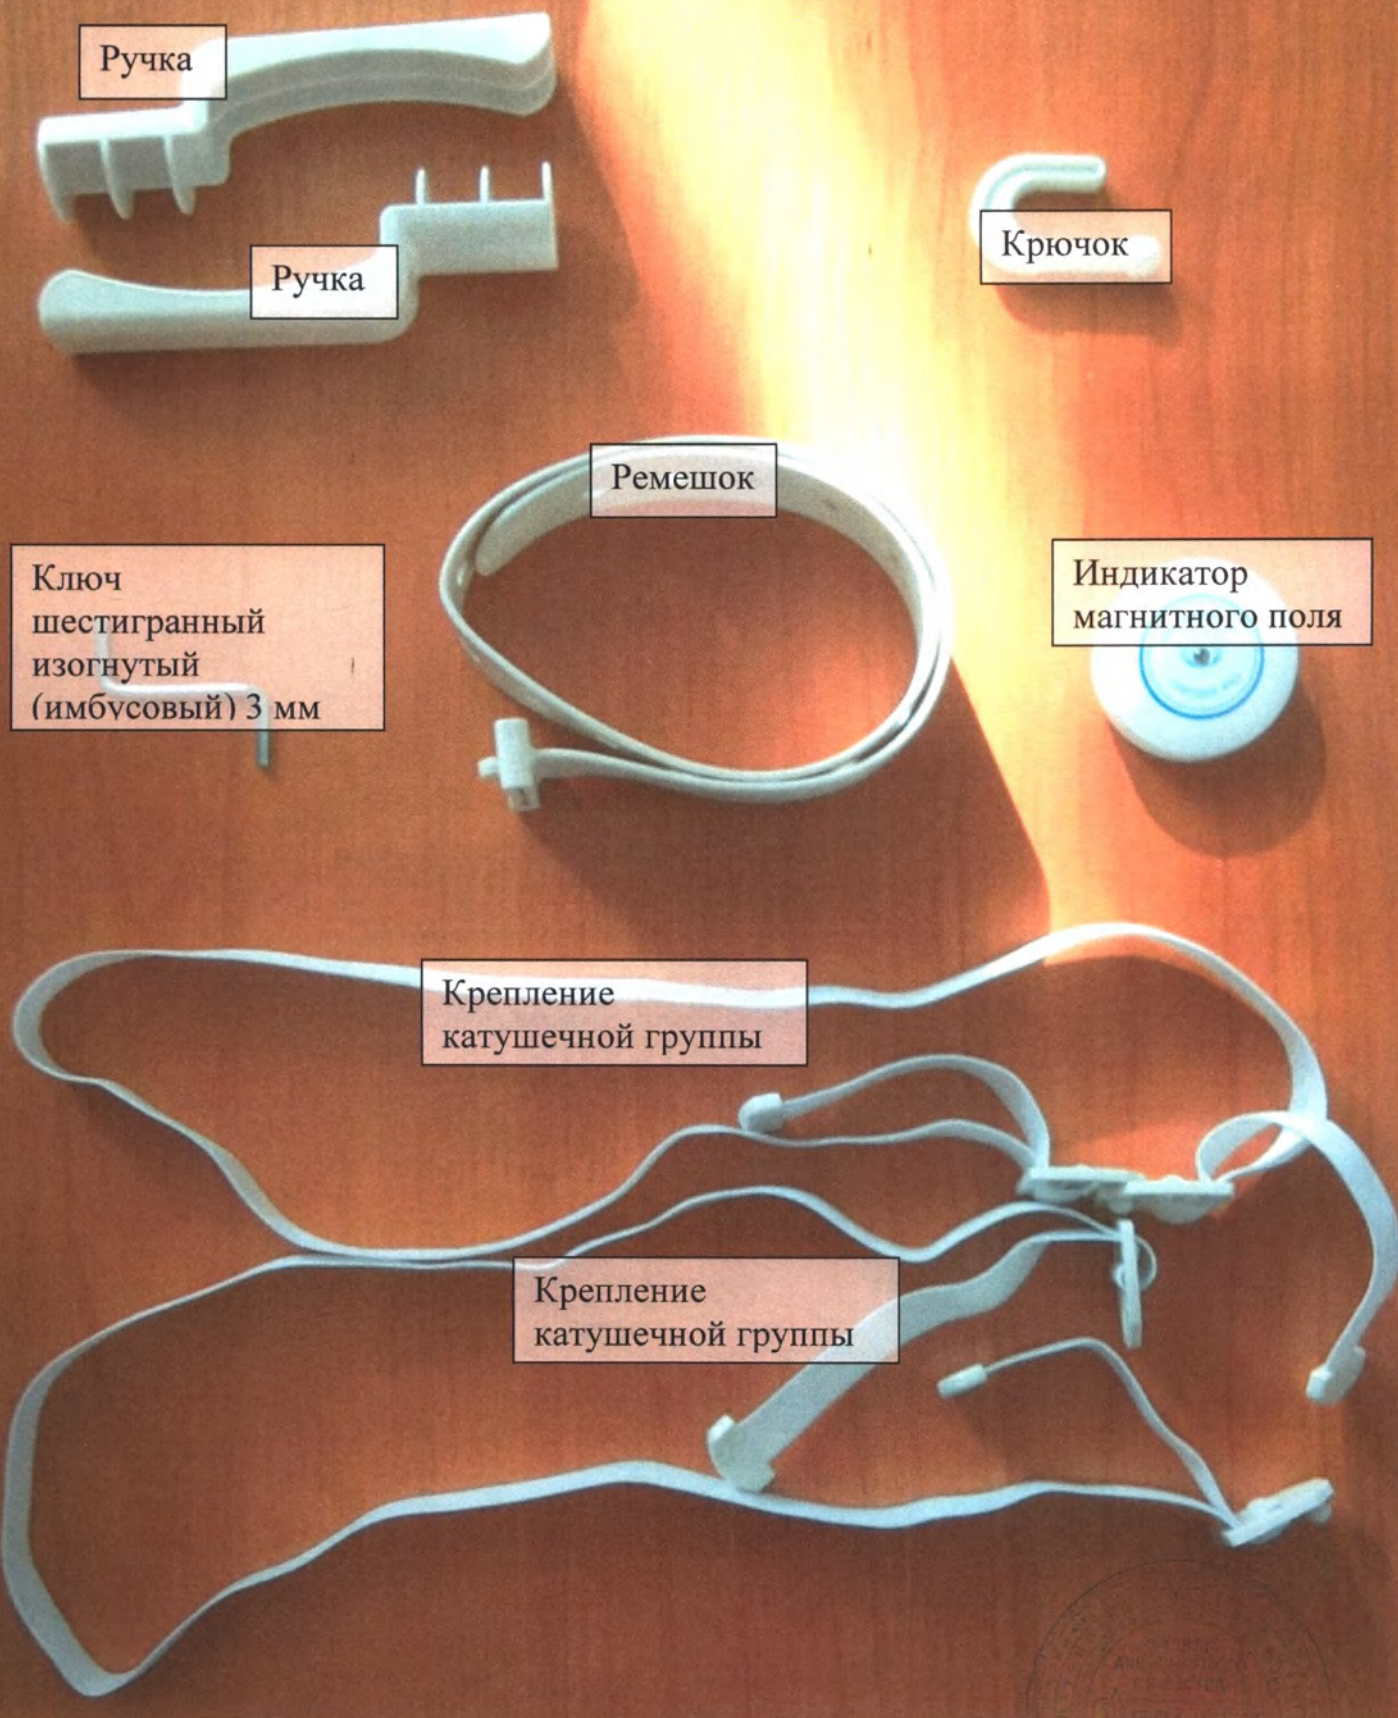

КОПИЯ
ВЕРНА

фотографическое изображение макета маркировки изделия «Аппарат
магнитотерапевтический «АЛМАГ-02» по ГИКС.941519.104 ТУ (экспортное исполнение)



АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ «АЛМАГ-02» ПО ГИКС.941519.104 ТУ (экспортное исполнение)

АЛМАГ®-02

Всё для здоровья. Здоровье для Вас.

Условия транспортировки: температура воздуха от -50 °С до +50 °С, относительная влажность воздуха до 100% при +25 °С

Условия хранения: температура воздуха от -50 °С до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 98% при +25 °С

Вариант поставки № ☐ 1 ☐



4 602 122 000 560

Вариант поставки № ☒ 2 ☐



4 602 122 000 867

~120 В, 60 Гц
50 В·А

АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ «АЛМАГ-02» по ГИКС.941519.104 ТУ (экспортное исполнение)

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04790

Компания ЕЛАМЕД*

Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,
Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25.

Тел./факс: (49131) 2-04-57, 2-21-09, 4-38-29

E-mail: admin@elamed.com

www.elamed.com

*Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Предприятие сертифицировано на соответствие ISO 13485

Сделано в России



Дата выпуска 01.18

Штамп ОТК



Уважаемый покупатель, внимание!
Убедитесь в полном соответствии
комплектации изделия с информацией,
указанной в разделе Комплект поставки
руководства по эксплуатации



Компания **ЕЛАМЕД***

Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,
Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25.

Тел./факс: (49131) 2-04-57, 4-38-29

E-mail: admin@elamed.com

www.elamed.com

*Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»

Вариант поставки изд. №
Delivery option №

1



1 48 02122 00030 7

Вариант поставки изд. №
Delivery option №

2



1 48 02122 60036 4

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ
ЗАВОД

АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ

АЛМАГ-02

(ЭКСПОРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)
по ГИКС.941519.104 ТУ

ГИКС.941519.104 ТУ

50 В-А, ~120 В, 60 Гц

КОЛИЧЕСТВО 1 шт.

ШТАМП ОТК

ДАТА УПАКОВЫВАНИЯ 01.2018

СЕРИЙНЫЙ № 00036

YELATMA
INSTRUMENT
MAKING ENTERPRISE, JSC

MAGNETOTHERAPY DEVICE

ALMAG-02

(EXPORT VERSION)
ACCORDING TO GHS REGISTRATION

ГИКС.941519.104 ТУ

50 В-А, ~120 В, 60 Гц

КОЛИЧЕСТВО 1 шт.

ШТАМП ОТК

ДАТА УПАКОВЫВАНИЯ 01.2018

СЕРИЙНЫЙ № 00036

