

Фотографические изображения на медицинское изделие:

Аппарат медицинский компьютеризированный навигационный для позиционирования инструментов серии PIGA CT, варианты исполнения: V2P, ROBIO EZ, ROBIO EX, MAXIO с принадлежностями

I. Аппарат медицинский компьютеризированный навигационный для позиционирования инструментов серии PIGA CT, варианты исполнения: V2P, ROBIO EZ, ROBIO EX, MAXIO с принадлежностями

V2P,



PRODUCT NAME: PIGA CT
MODEL NO. : V2P




MEDICAL EQUIPMENT
UL 60601-1,
IEC 60601-1
CAN/CSA-C22.2 No. 601.1



Input Voltage: 110- 230 V
Frequency: 50/60 Hz
Max. Current Rating: 2 Amps
Weight : 150 Kg



EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2513 BH, The Hague
The Netherlands
Phone: +31.70.345.8570
Fax: +31.70.346.7299




CONTINUOUS
OPERATION WITH
INTERMITTENT LOADING



Made in India




Perfint Healthcare Pvt. Ltd
3rd Floor #16 South West Boag Road
T.Nagar, Chennai-600 017
www.perfinttech.com

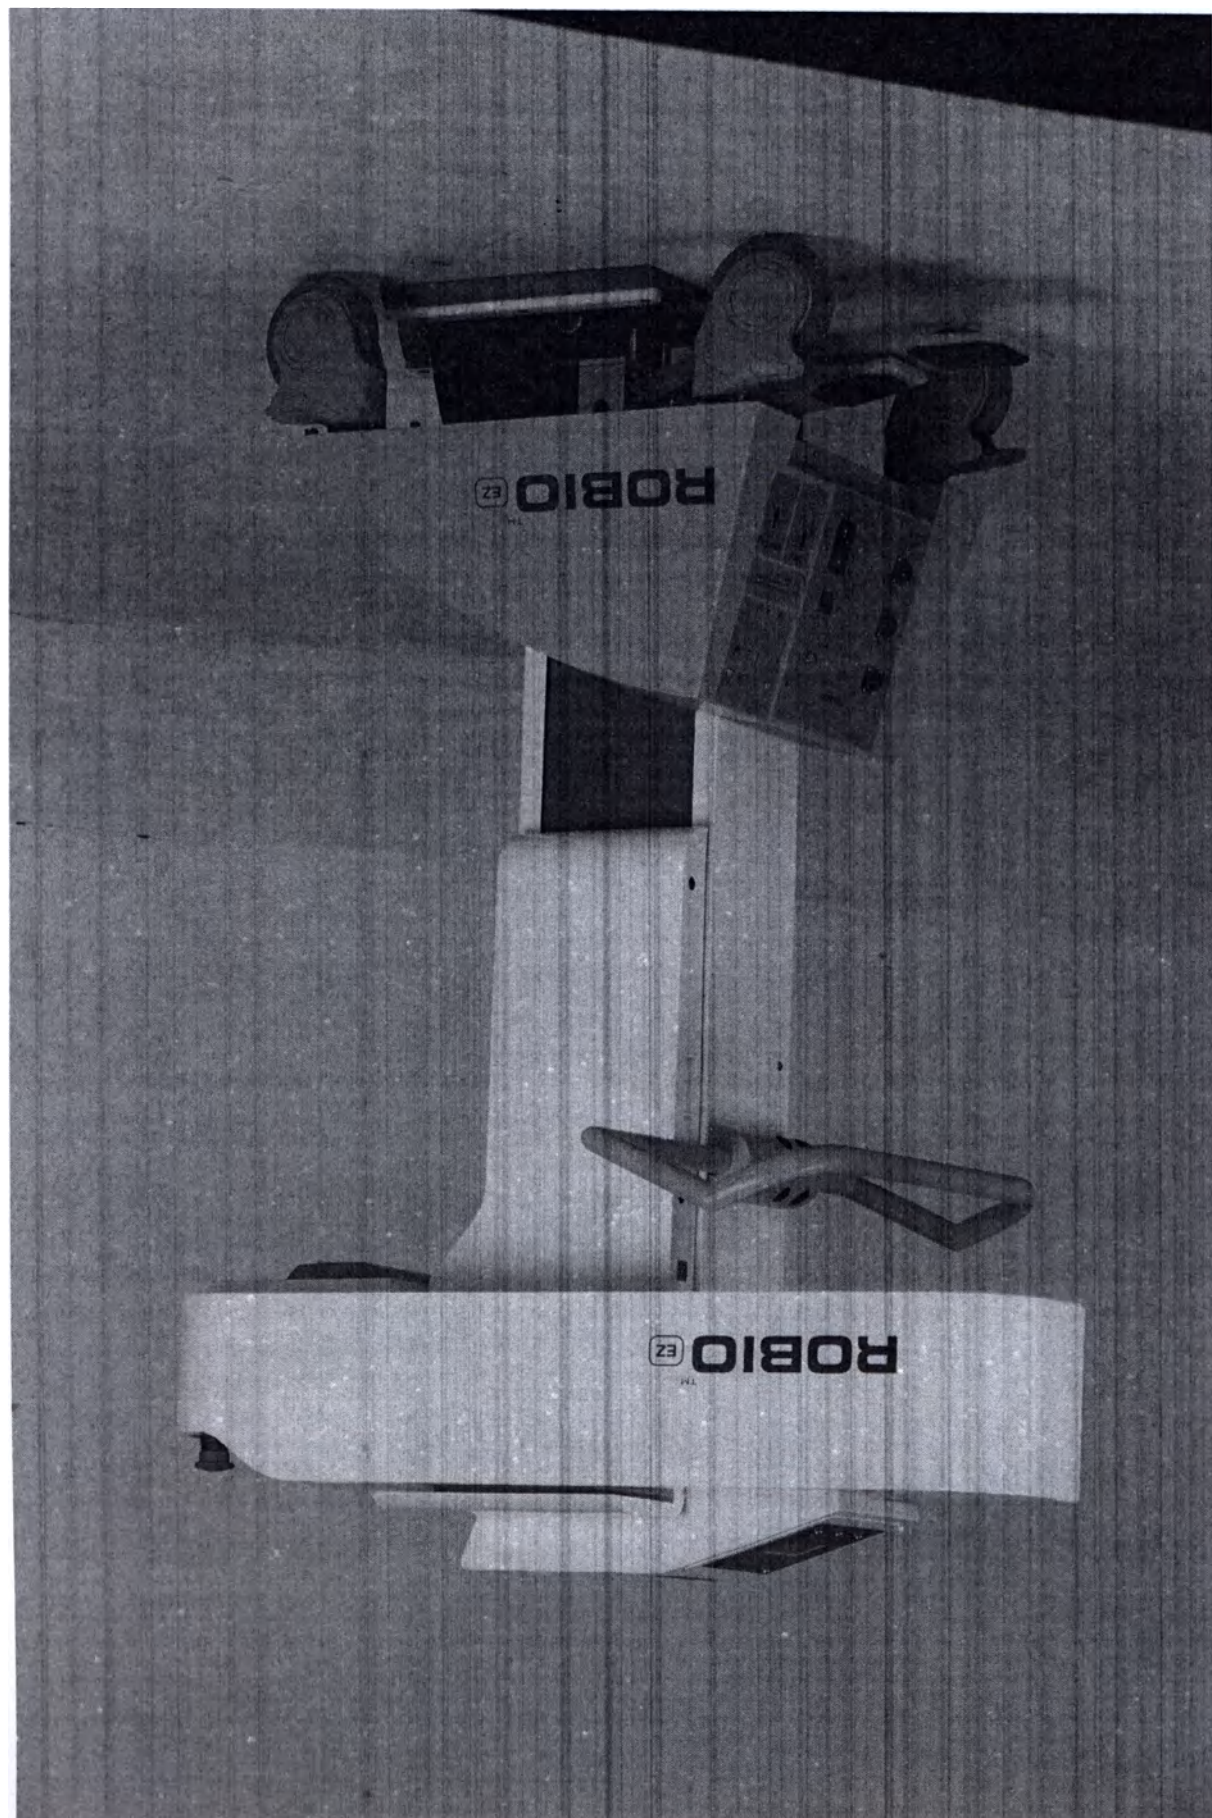

ROBIO EZ,

PRODUCT NAME: PIGA CT
MODEL NO: Roblo EX

CE
0843

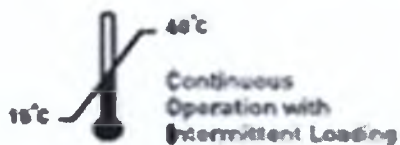


Emergo Europe
Molenstraat 15
2513 BH, The Hague
The Netherlands
Phone: +31.70.345.6570
Fax: +31.70.346.7299

Perfint

Perfint healthcare Pvt. Ltd.
3rd Floor, No. 14, South West Boag Road
T Nagar, Chennai - 600 017
www.perfinttech.com
Made in India

ROBIO EX,

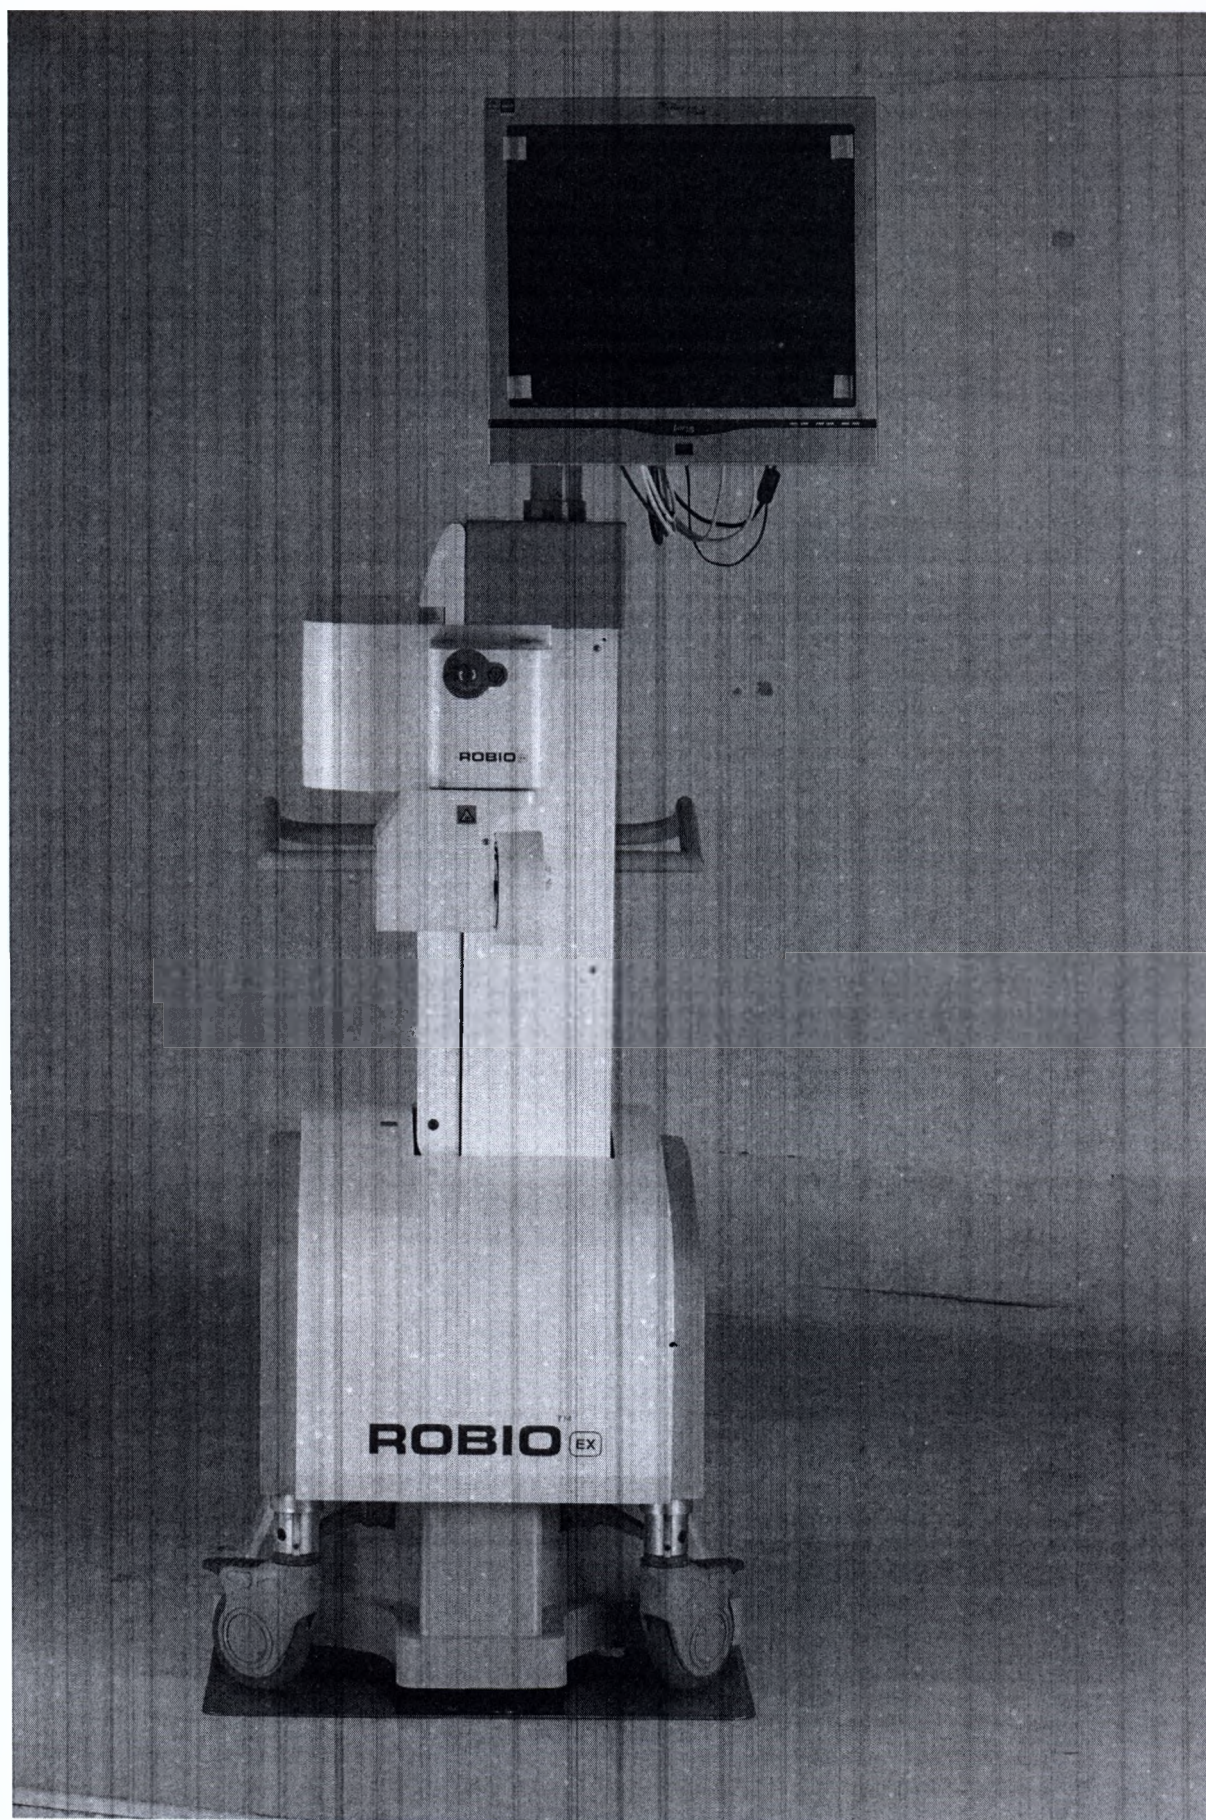

PRODUCT NAME: PIGA CT
MODEL NO: Robio EX

CE
0843



Continuous
Operation with
Intermittent Loading




Emergo Europe
Molensstraat 15
2513 BH, The Hague
The Netherlands
Phone: +31.70.345.8570
Fax: +31.70.344.7299

Perfint

Perfint healthcare Pvt. Ltd.
3rd Floor, No. 14, South West Boag Road
T Nagar, Chennai - 600 017
www.perfinttech.com
Made in India



MAXIO

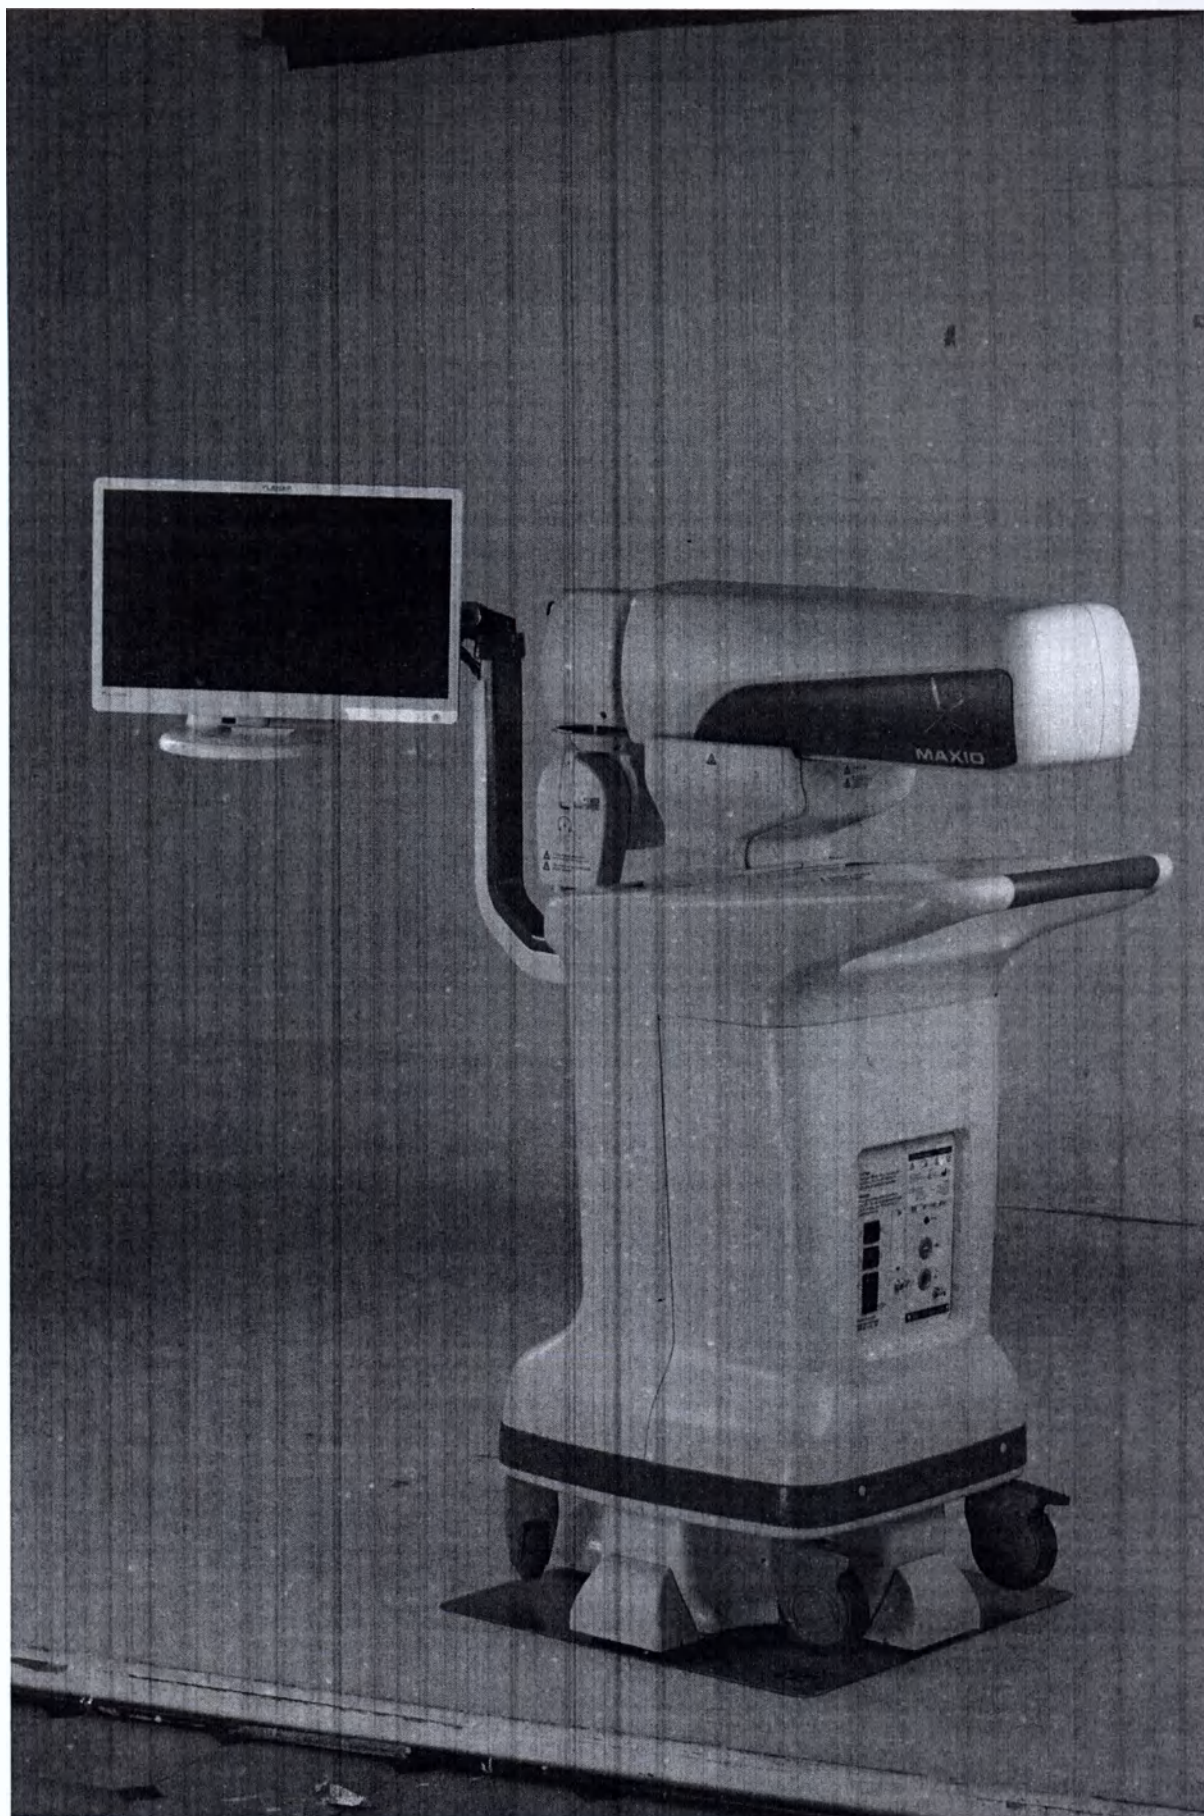



WARNING

WARNING
Keep safe distance while System is in operation. No user serviceable parts inside. Do not remove cover. Refer service to qualified personnel.

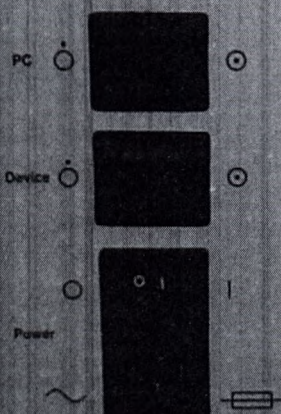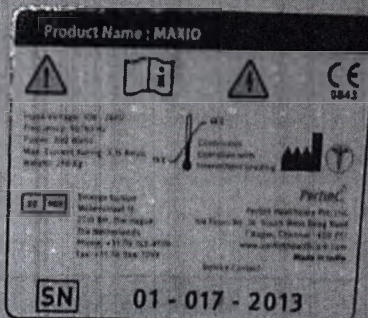


 Replace fuse with same type and rating (250V AC, 3.15A, 5B)




Базовый состав:



1. Стойка манипулятора с колесной группой.

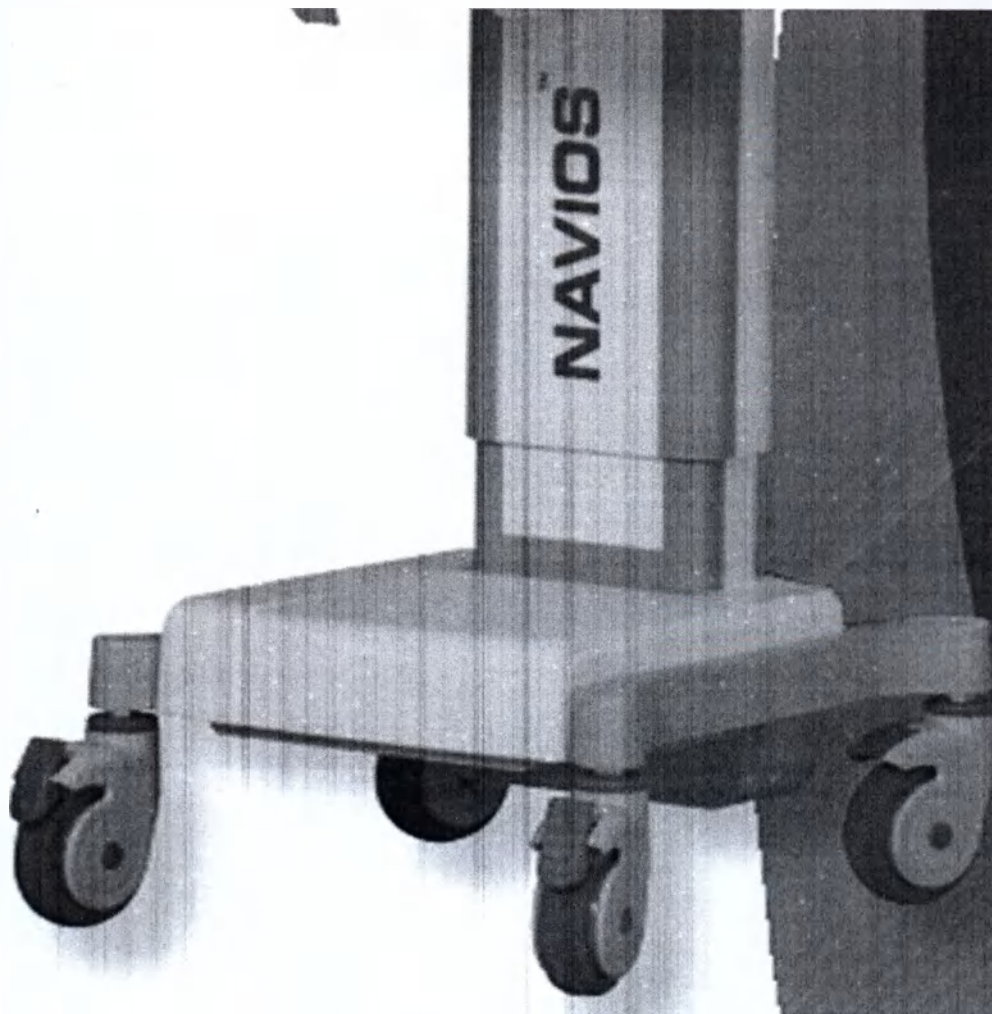




2. Пластина стыковочная (крепежная).


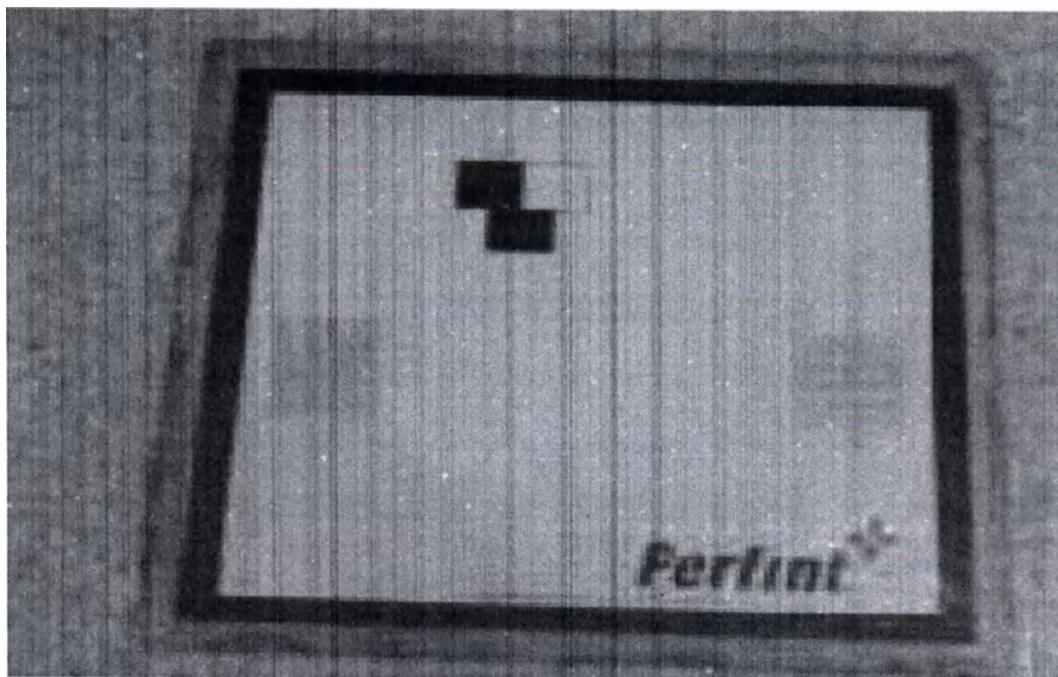


3. Индикатор дыхания пациента.

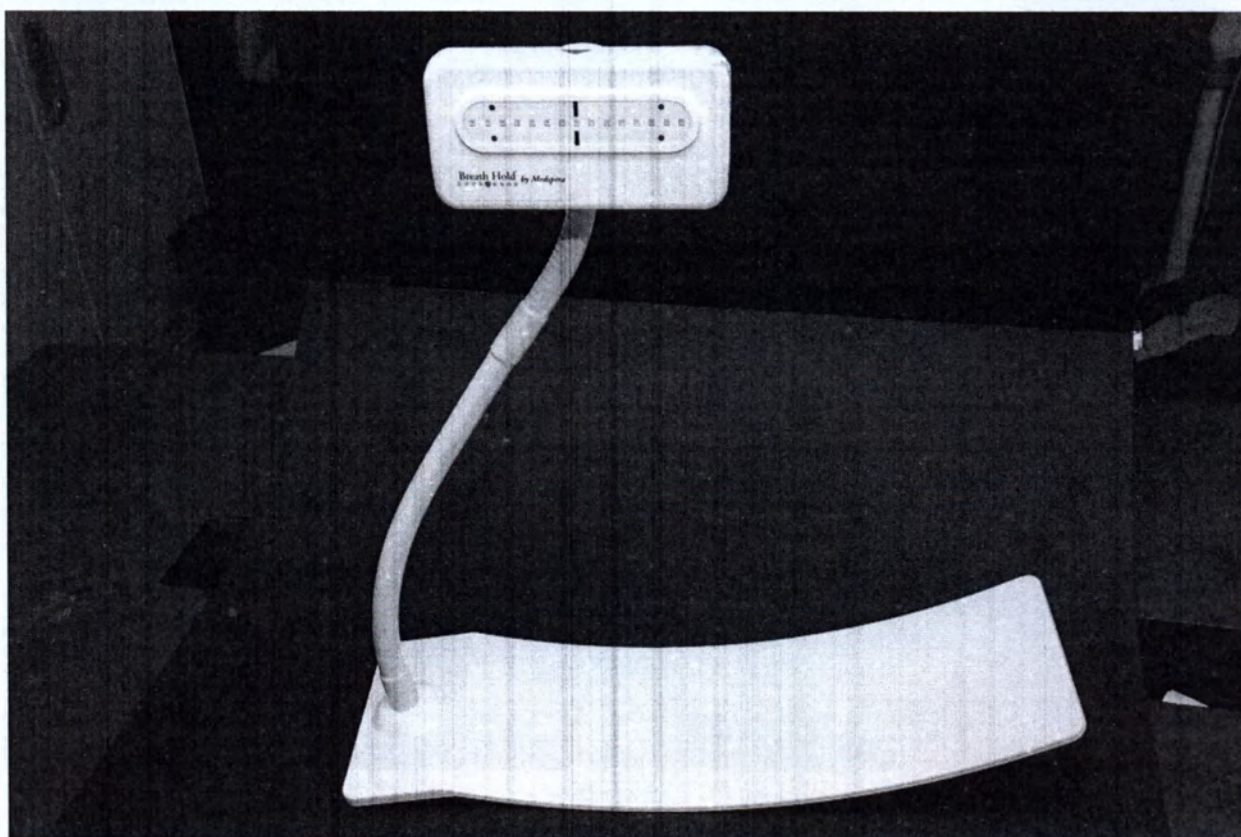
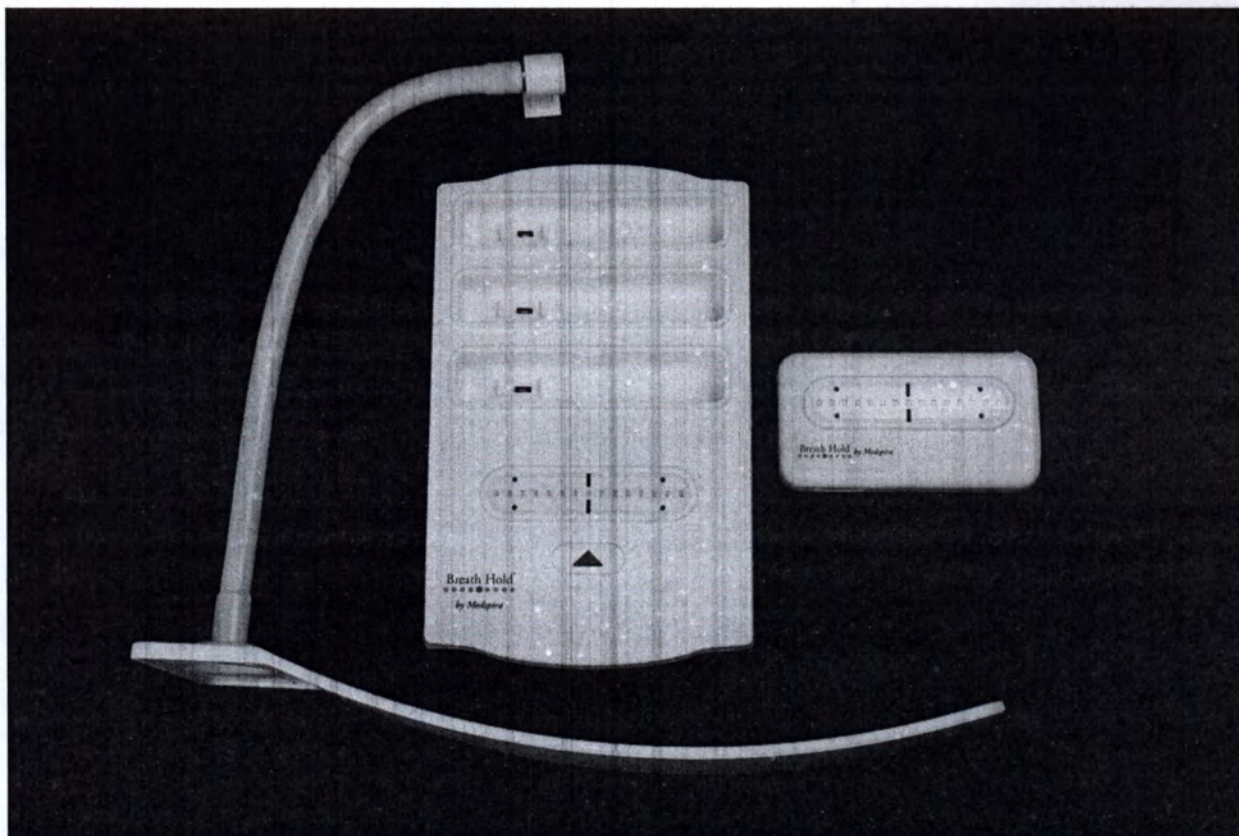


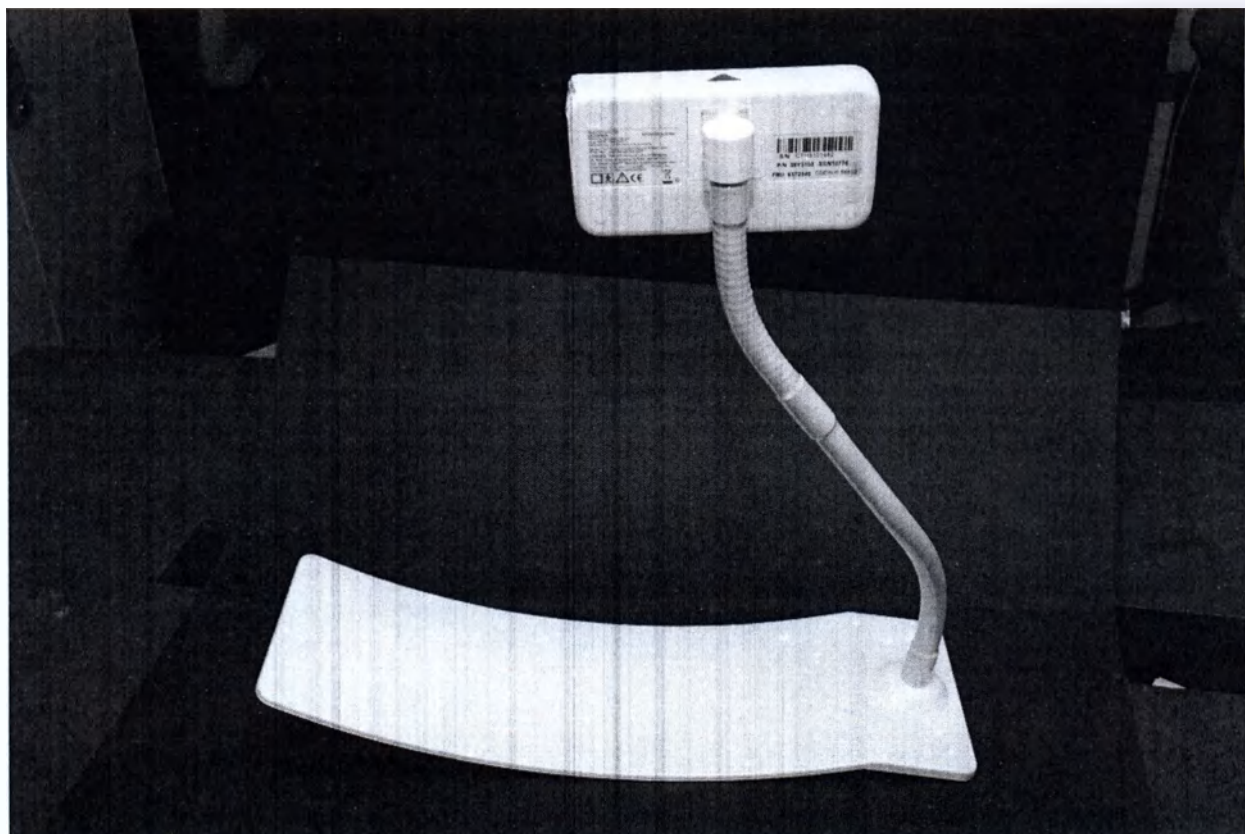

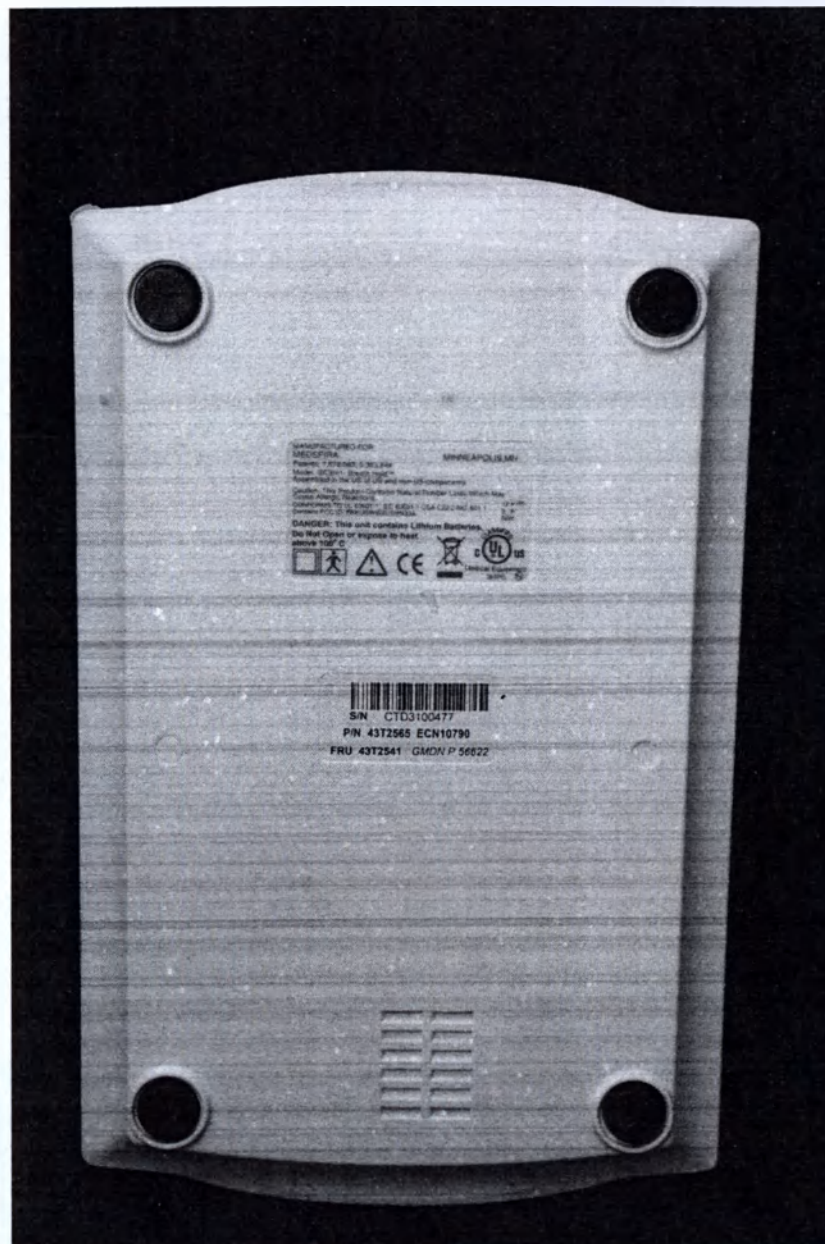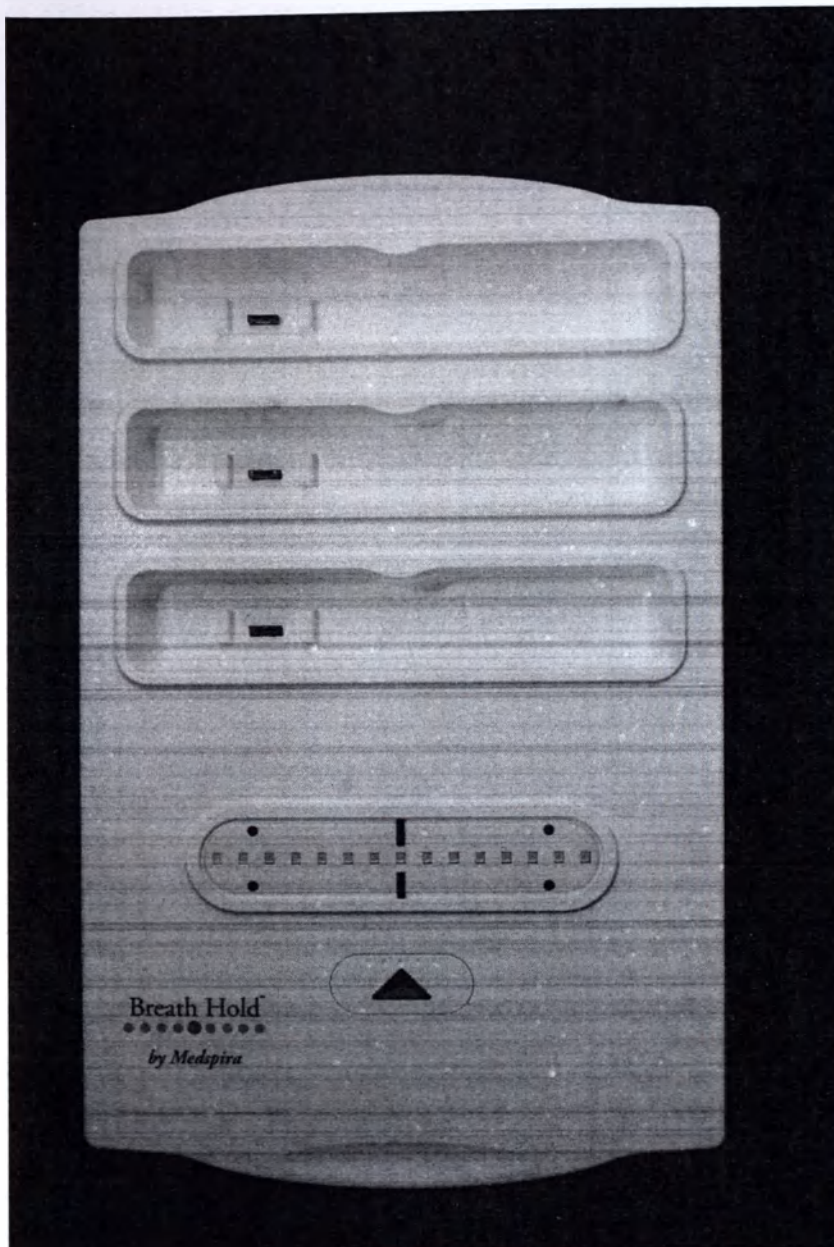


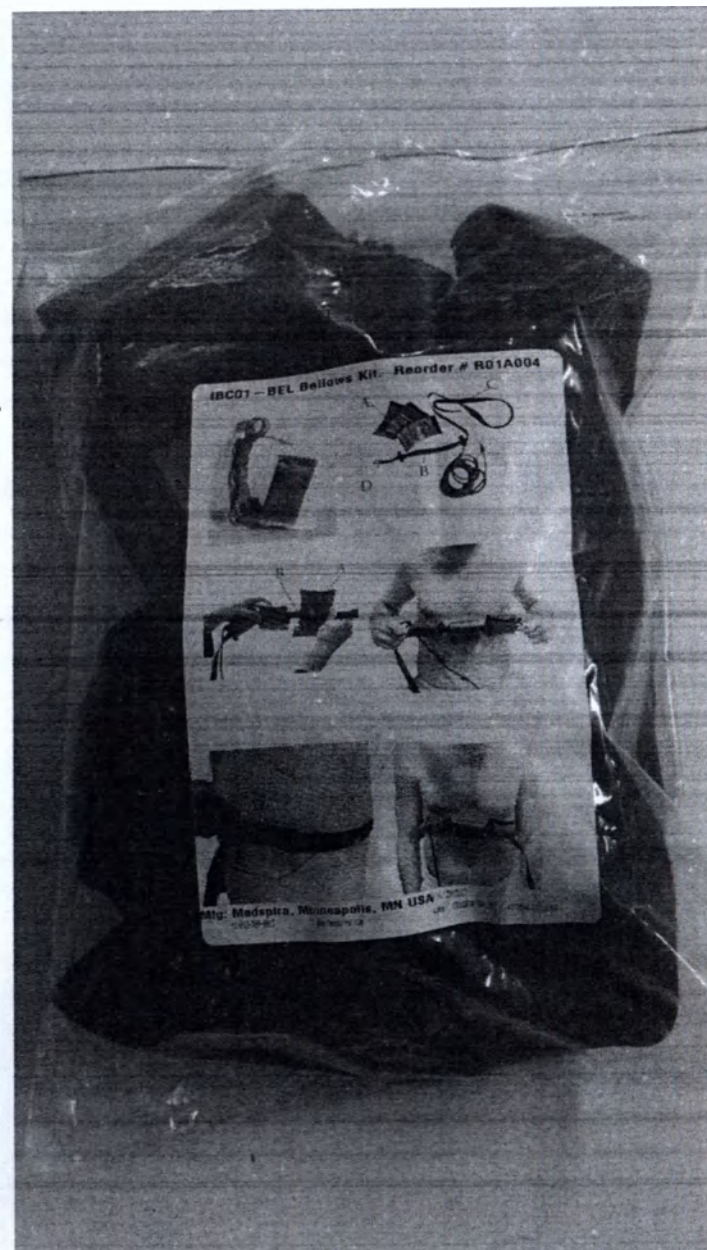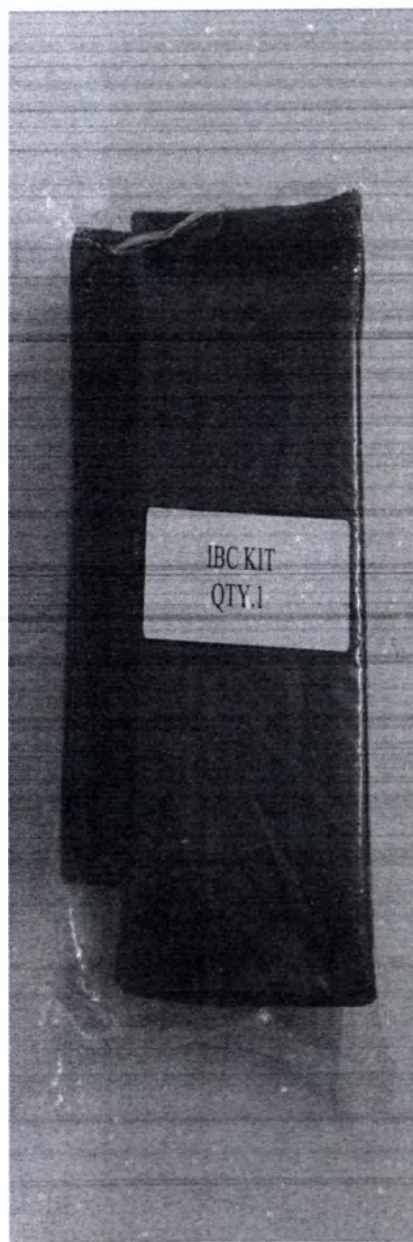

4. Матрац вакуумный для фиксации пациента с вакуумным насосом.

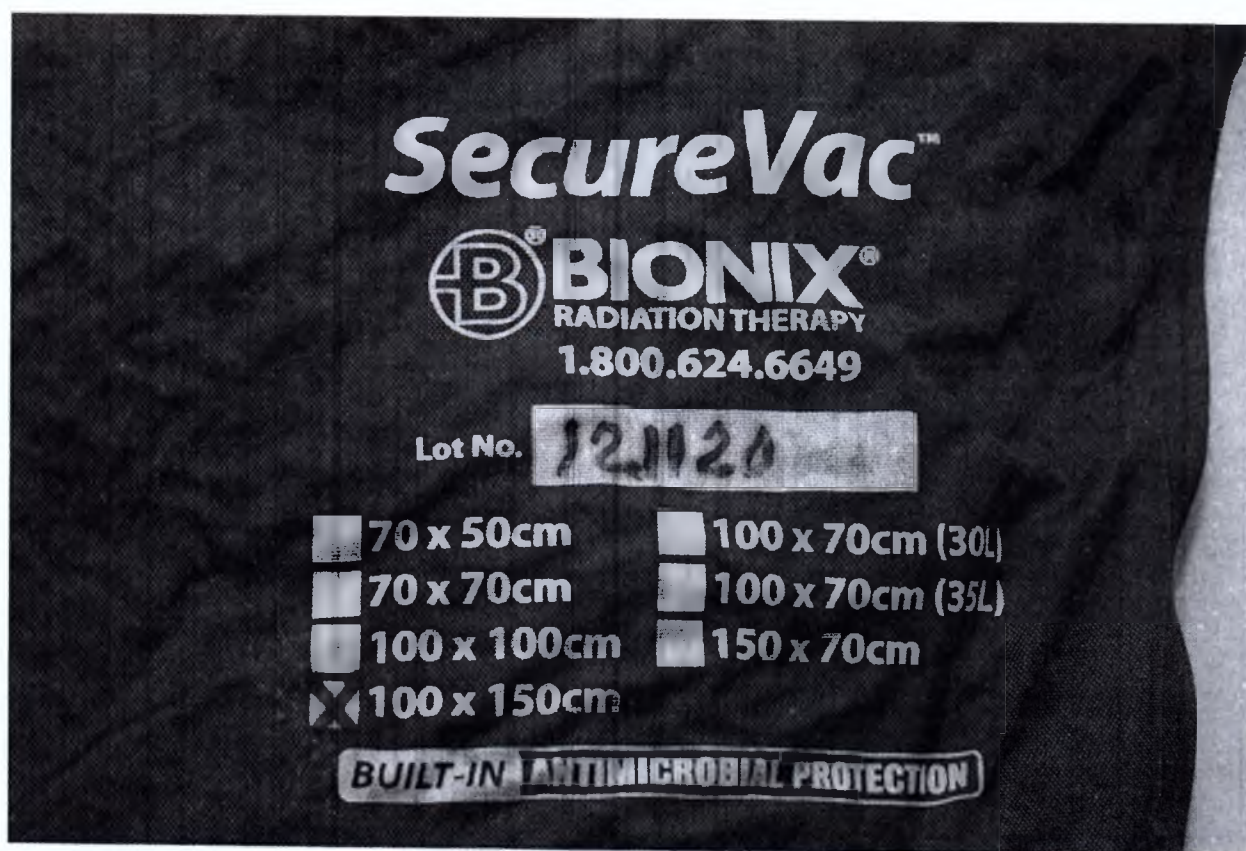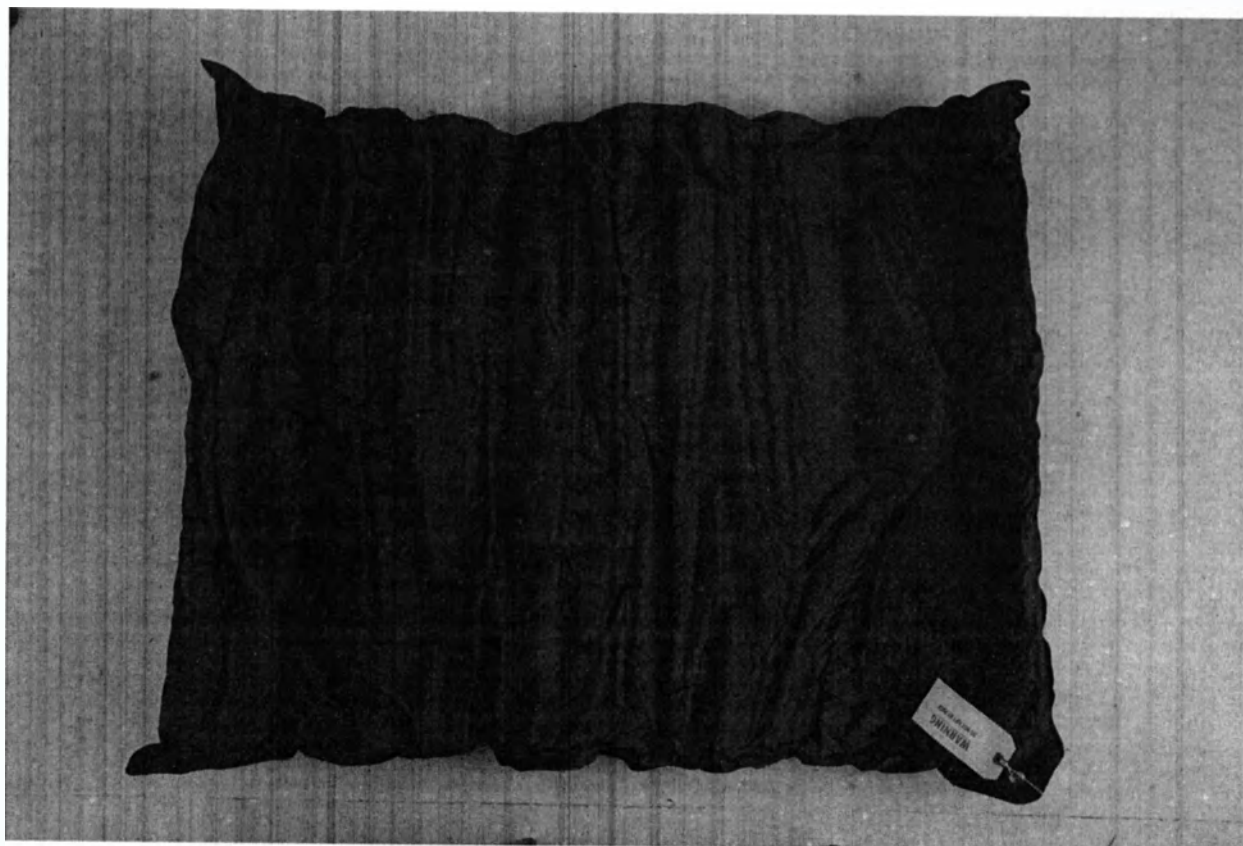


5. Блок педальный.

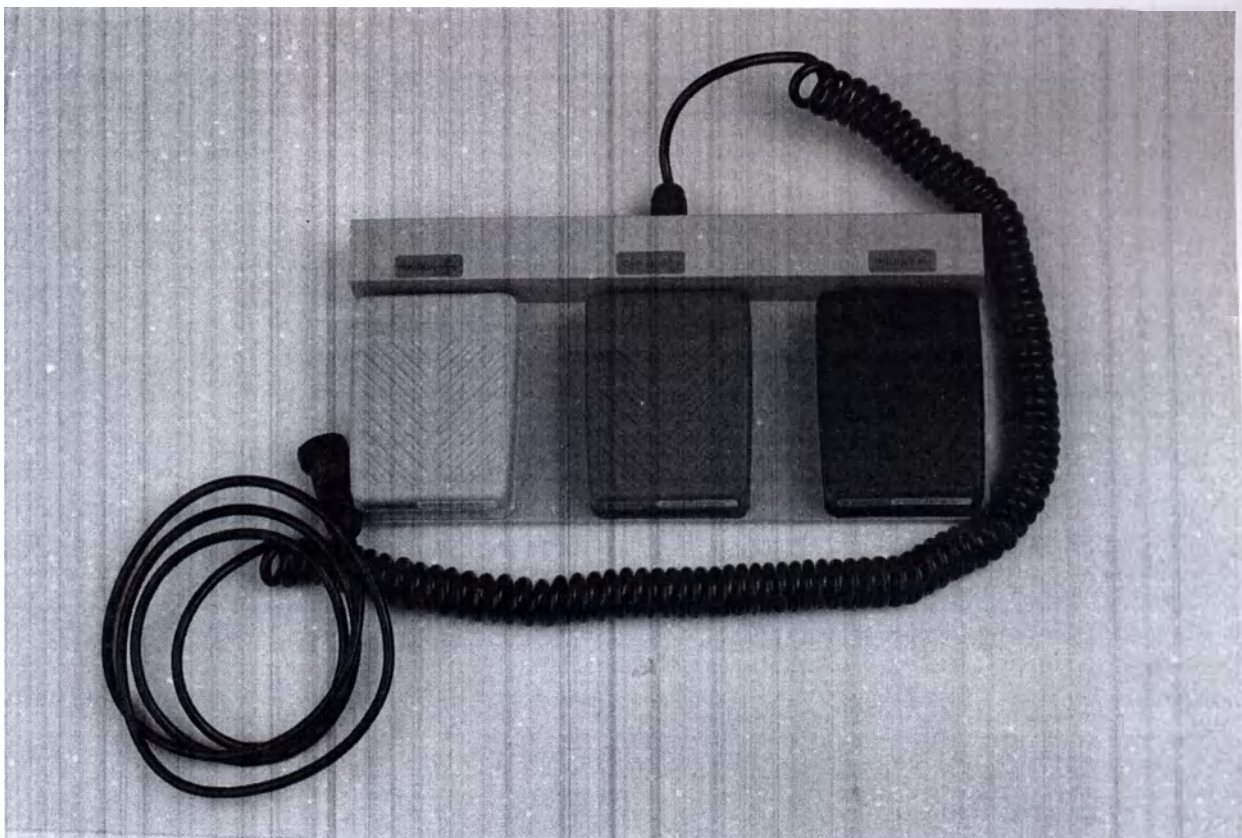

6. Модуль управления:

- встроенный, с сенсорным дисплеем диагональю 17'' до 22'' или

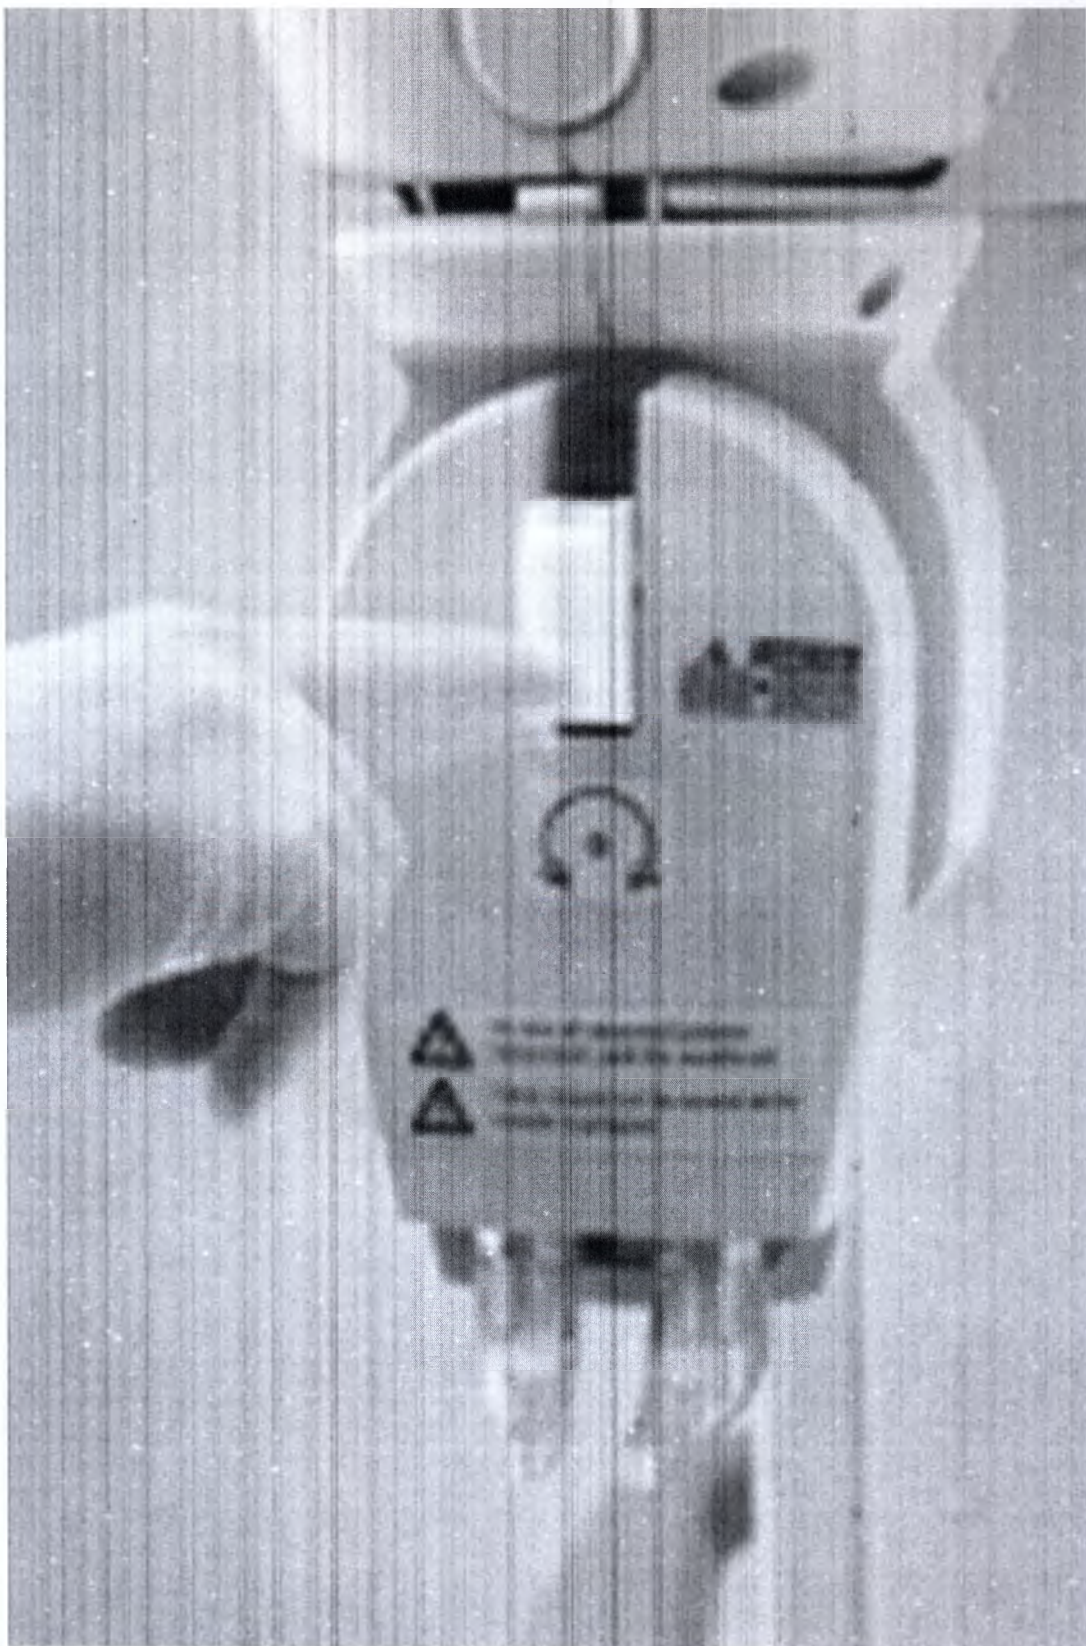


- внешний на базе ПК стандартной конфигурации



7. Кабель питания.



8. Кабель RJ45, сетевой.

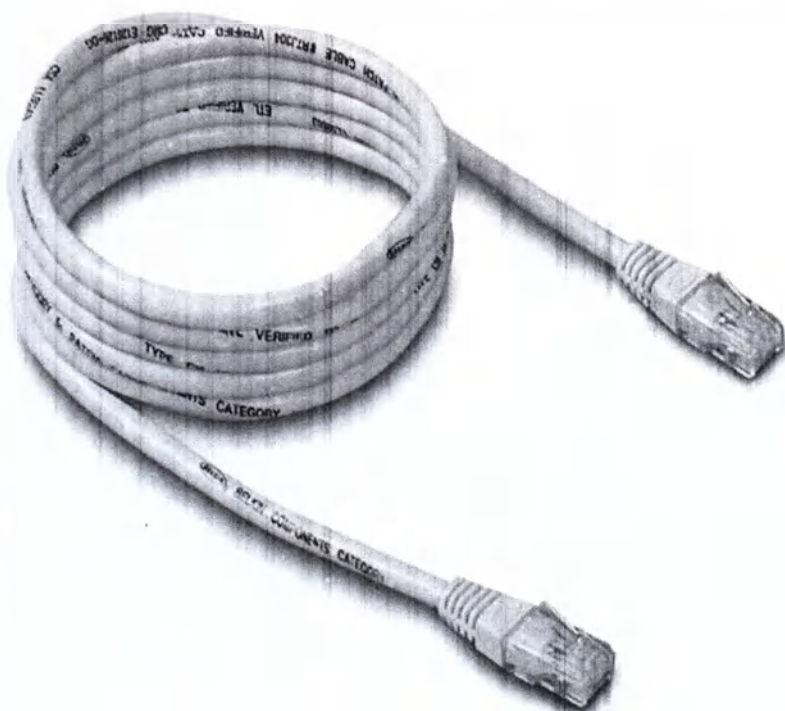

9. Эксплуатационная документация


II. Принадлежности:

1. Рабочая станция для просмотра, обработки снимков и планирования процедур в составе:


- системный блок;
- монитор медицинский;
- клавиатура;
- манипулятор типа "мышь";
- навигационное программное обеспечение на CD диске - 1 комплект.



2. Специализированное программное обеспечение экспертного класса NAVIOS для планирования (подготовки) и проверки процедуры на CD – 1 штука.

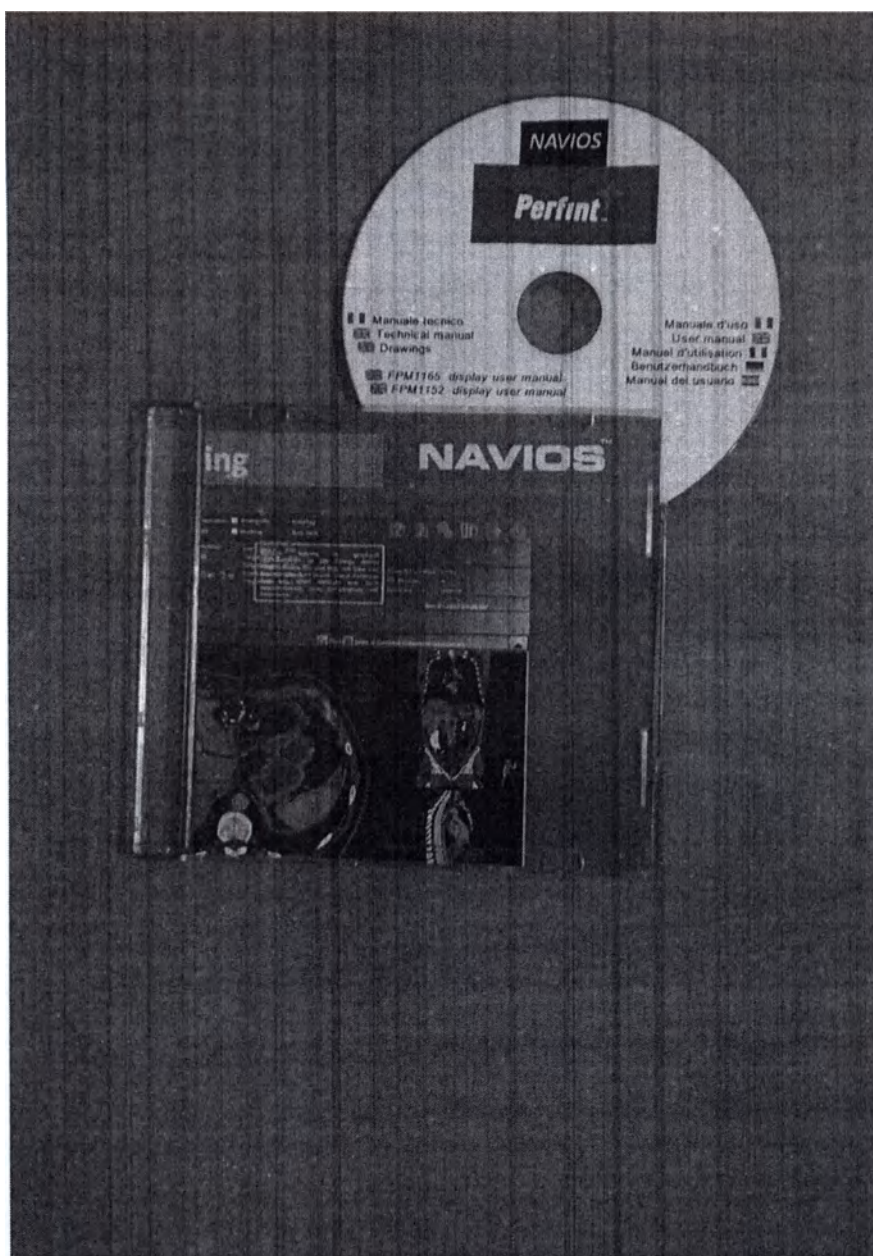

3. Стойка для сенсорного монитора NAVIOS.

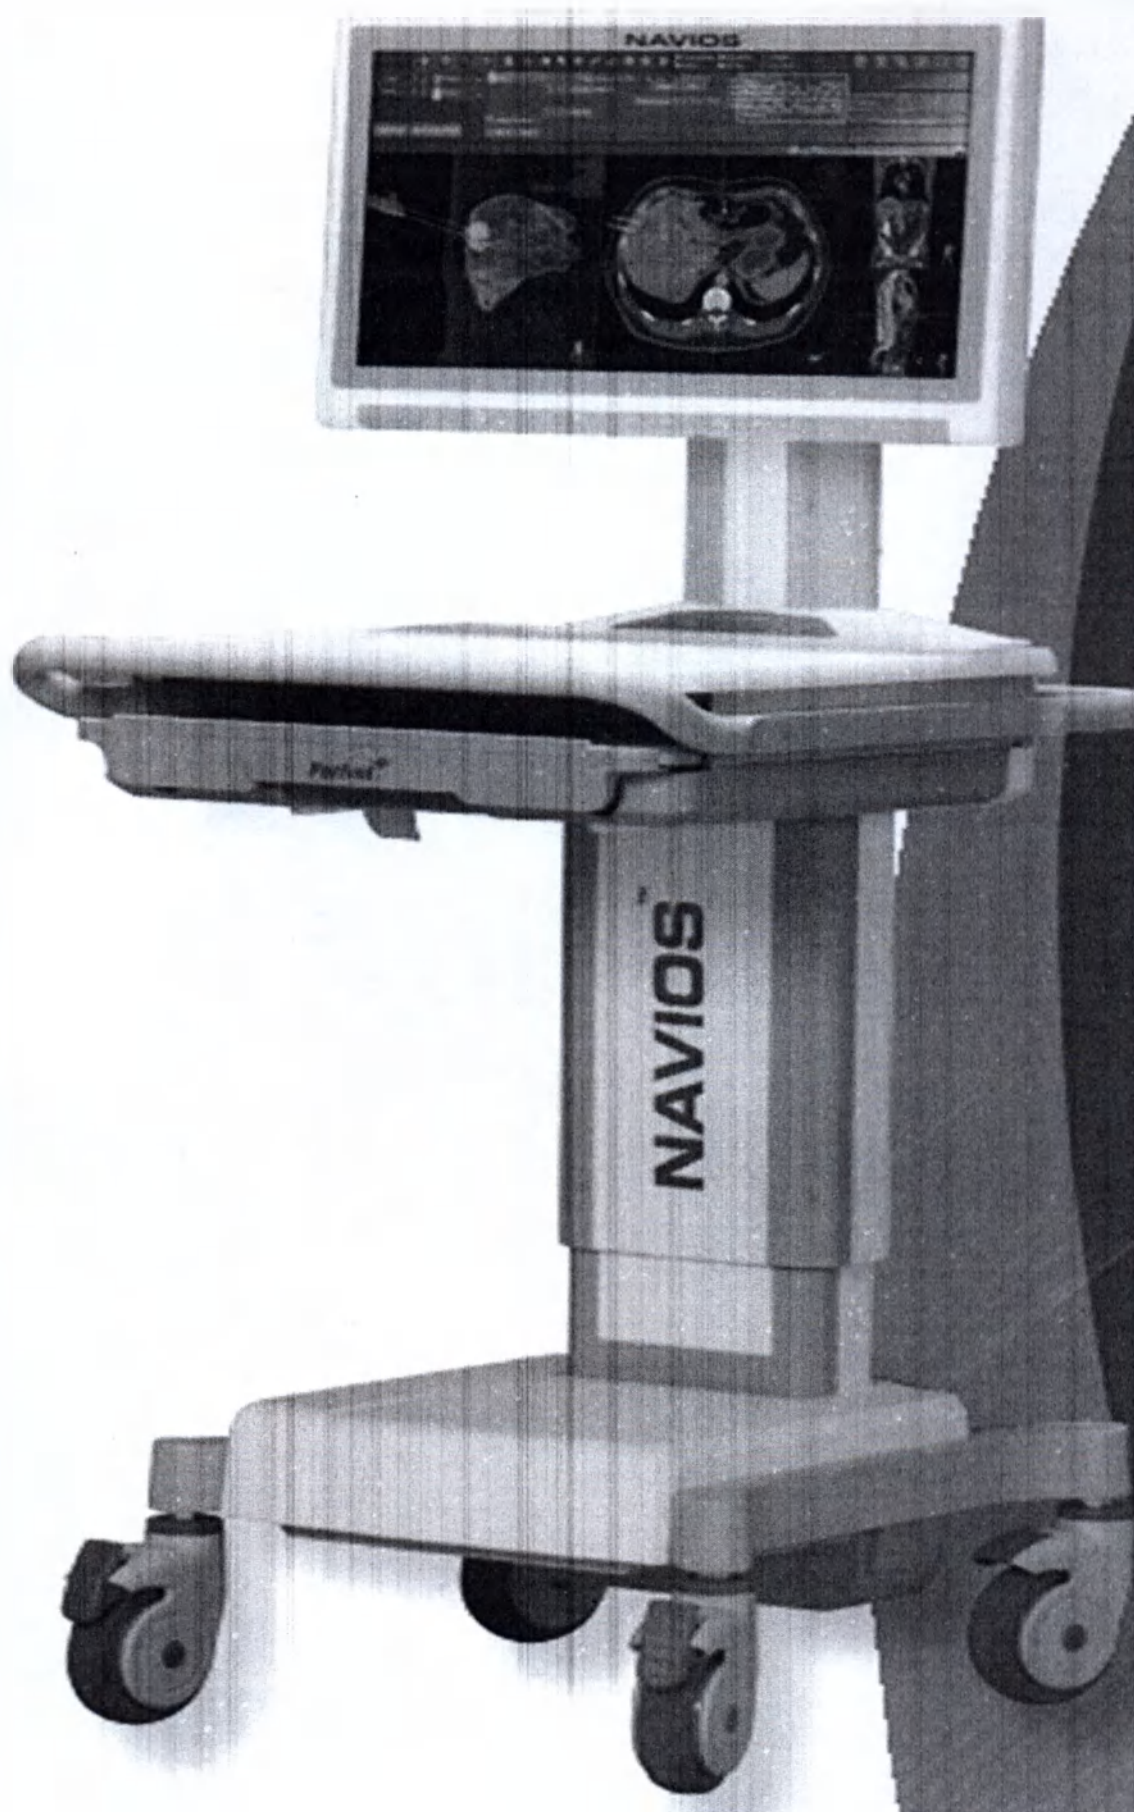

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ²² ~~акционерных~~ ^{штук} мест

