



REF

D-4352

набор реагентов для
иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G
к *Mycoplasma hominis*

***Mycoplasma hominis* – IgG – ИФА – БЕСТ**

LOT 841

СОСТАВ:

LOT

✓ 1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном p120 <i>Mycoplasma hominis</i>	1 шт.	620390
✓ 2. Положительный контрольный образец, инаktivированный	1 фл. 0,5 мл	4145
✓ 3. Отрицательный контрольный образец, инаktivированный	1 фл. 1,0 мл	3504
4. Конъюгат, концентрат	1 фл. 1,5 мл	10451
5. Разводящий буфер для сывороток	1 фл. 13,0 мл	730194
✓ 6. Раствор для разведения конъюгата	1 фл. 13,0 мл	4768
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 28,0 мл	2858
8. Раствор тетраметилбензидаина	1 фл. 13,0 мл	10464
9. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл	1335
Принадлежности:		
Плёнка для заклеивания планшета	3 шт.	
Ванночки для реагентов	2 шт.	
Наконечники для пипеток	16 шт.	

**Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»**

Хусаинов, М. Д.


27.09.2020

БЕКТОР

БЕСТ

Новосибирская область, р.п. Колыцово

С/сч 1025404347350

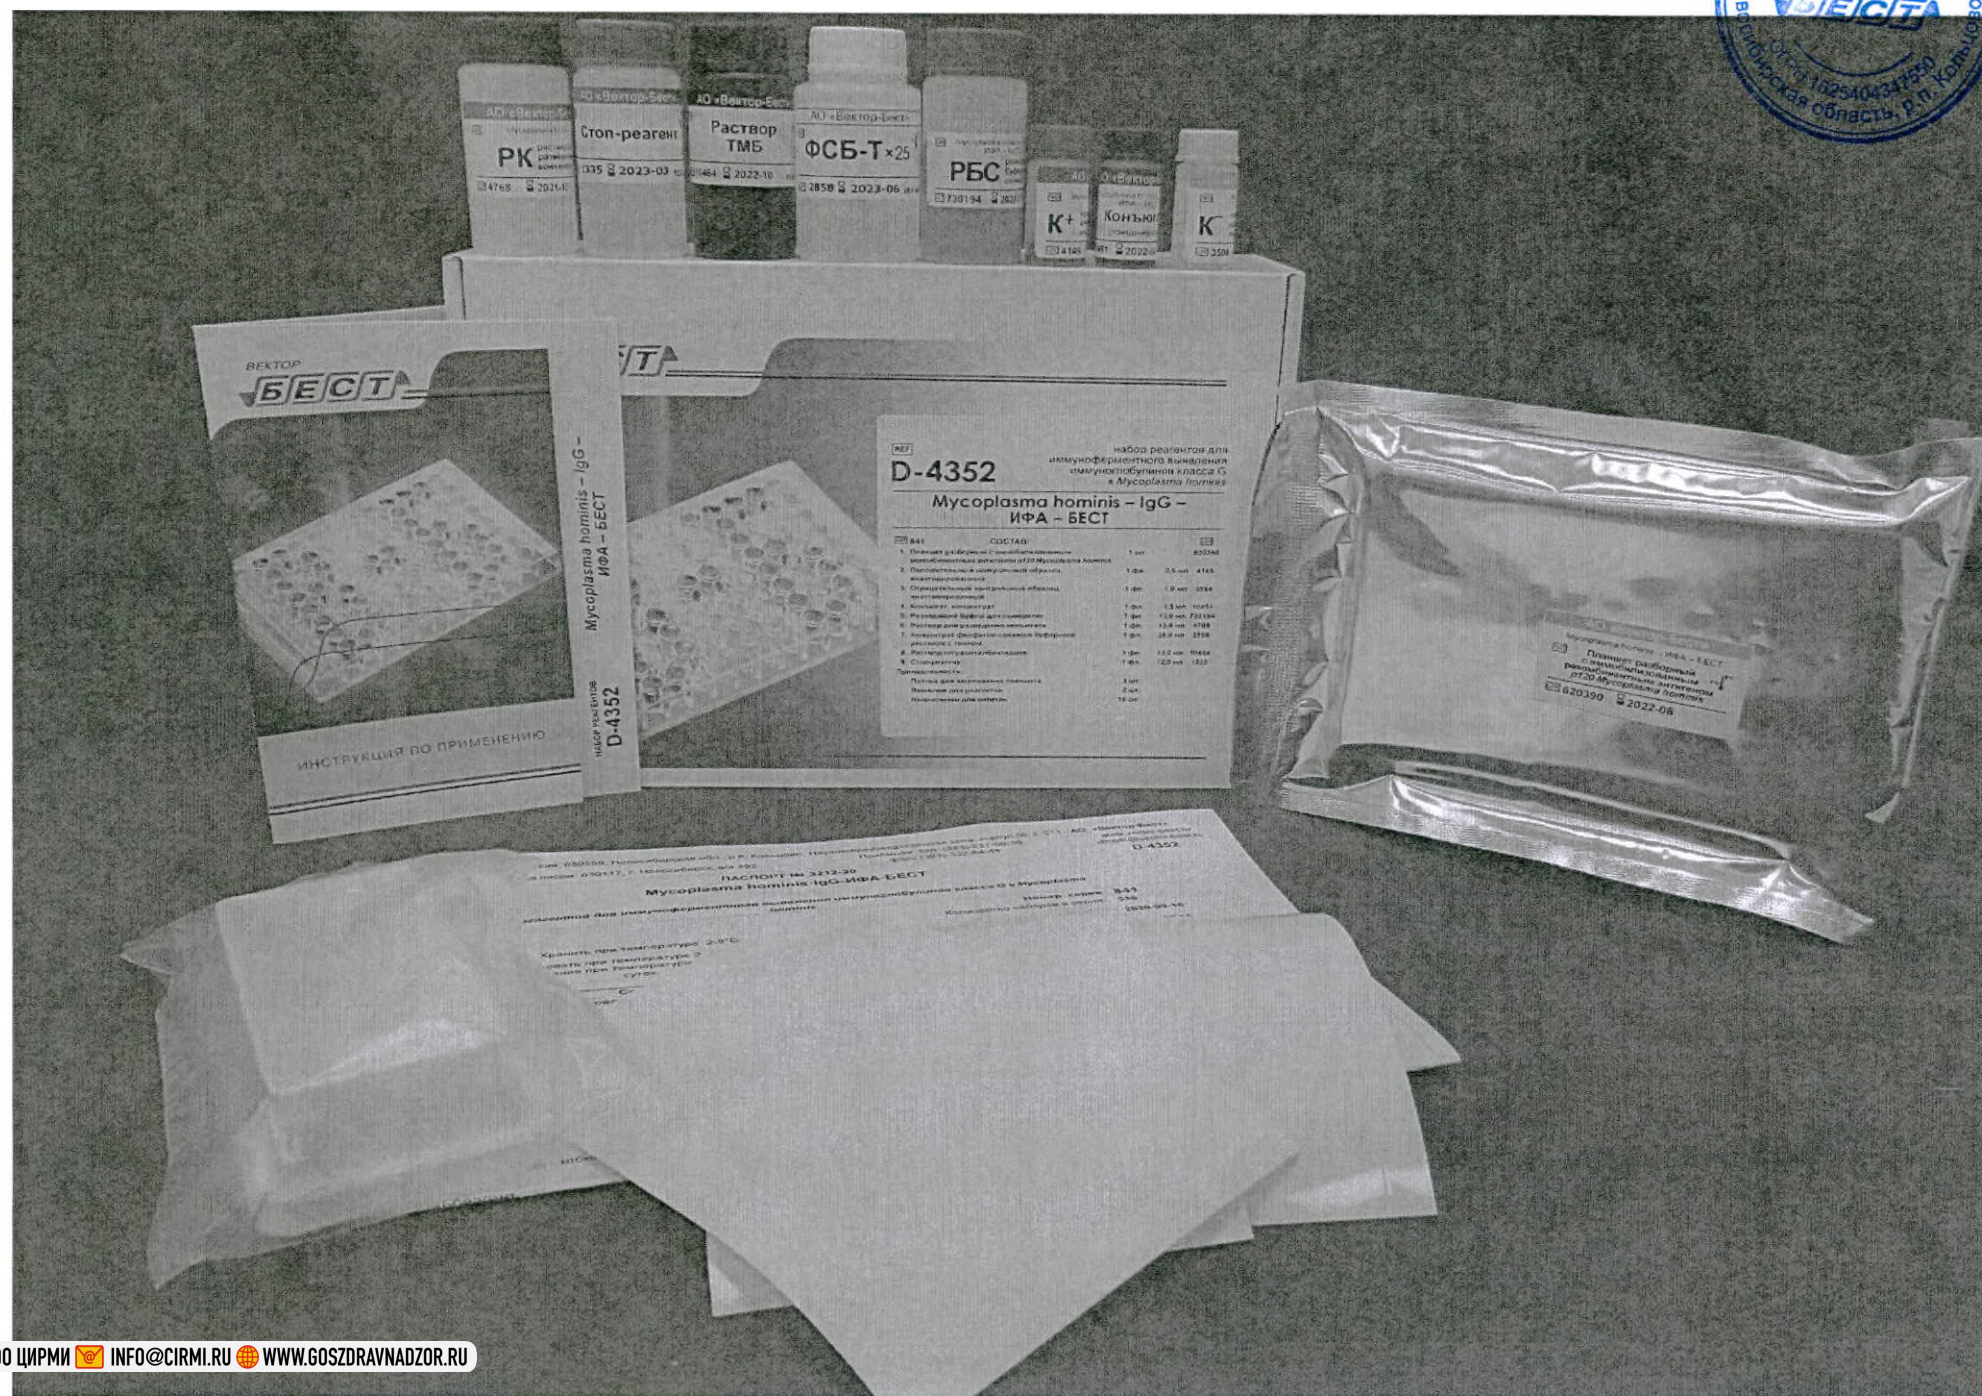

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к *Mycoplasma hominis* (*Mycoplasma hominis* – IgG – ИФА – БЕСТ)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
ОКТ
2020 г.

REF **D-4352**

Σ 12×8

LOT **841**


ТУ 9398-095-23548172-2009

РУ № ФСР 2009/05946 от 24.01.2017

2020-09-16
2021-09-16

***Mycoplasma hominis* – IgG – ИФА – БЕСТ**

IVD



43521609210084100245

Для профессионального применения

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к *Mycoplasma hominis* (*Mycoplasma hominis* – IgG – ИФА – БЕСТ)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2020 г.



АО «Вектор-Бест»
Mycoplasma hominis – ИФА – БЕСТ



Планшет разборный
с иммобилизованным
рекомбинантным антигеном
p120 Mycoplasma hominis



620390




2022-06

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к *Mycoplasma hominis* (*Mycoplasma hominis* – IgG – ИФА – БЕСТ)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2020 г.

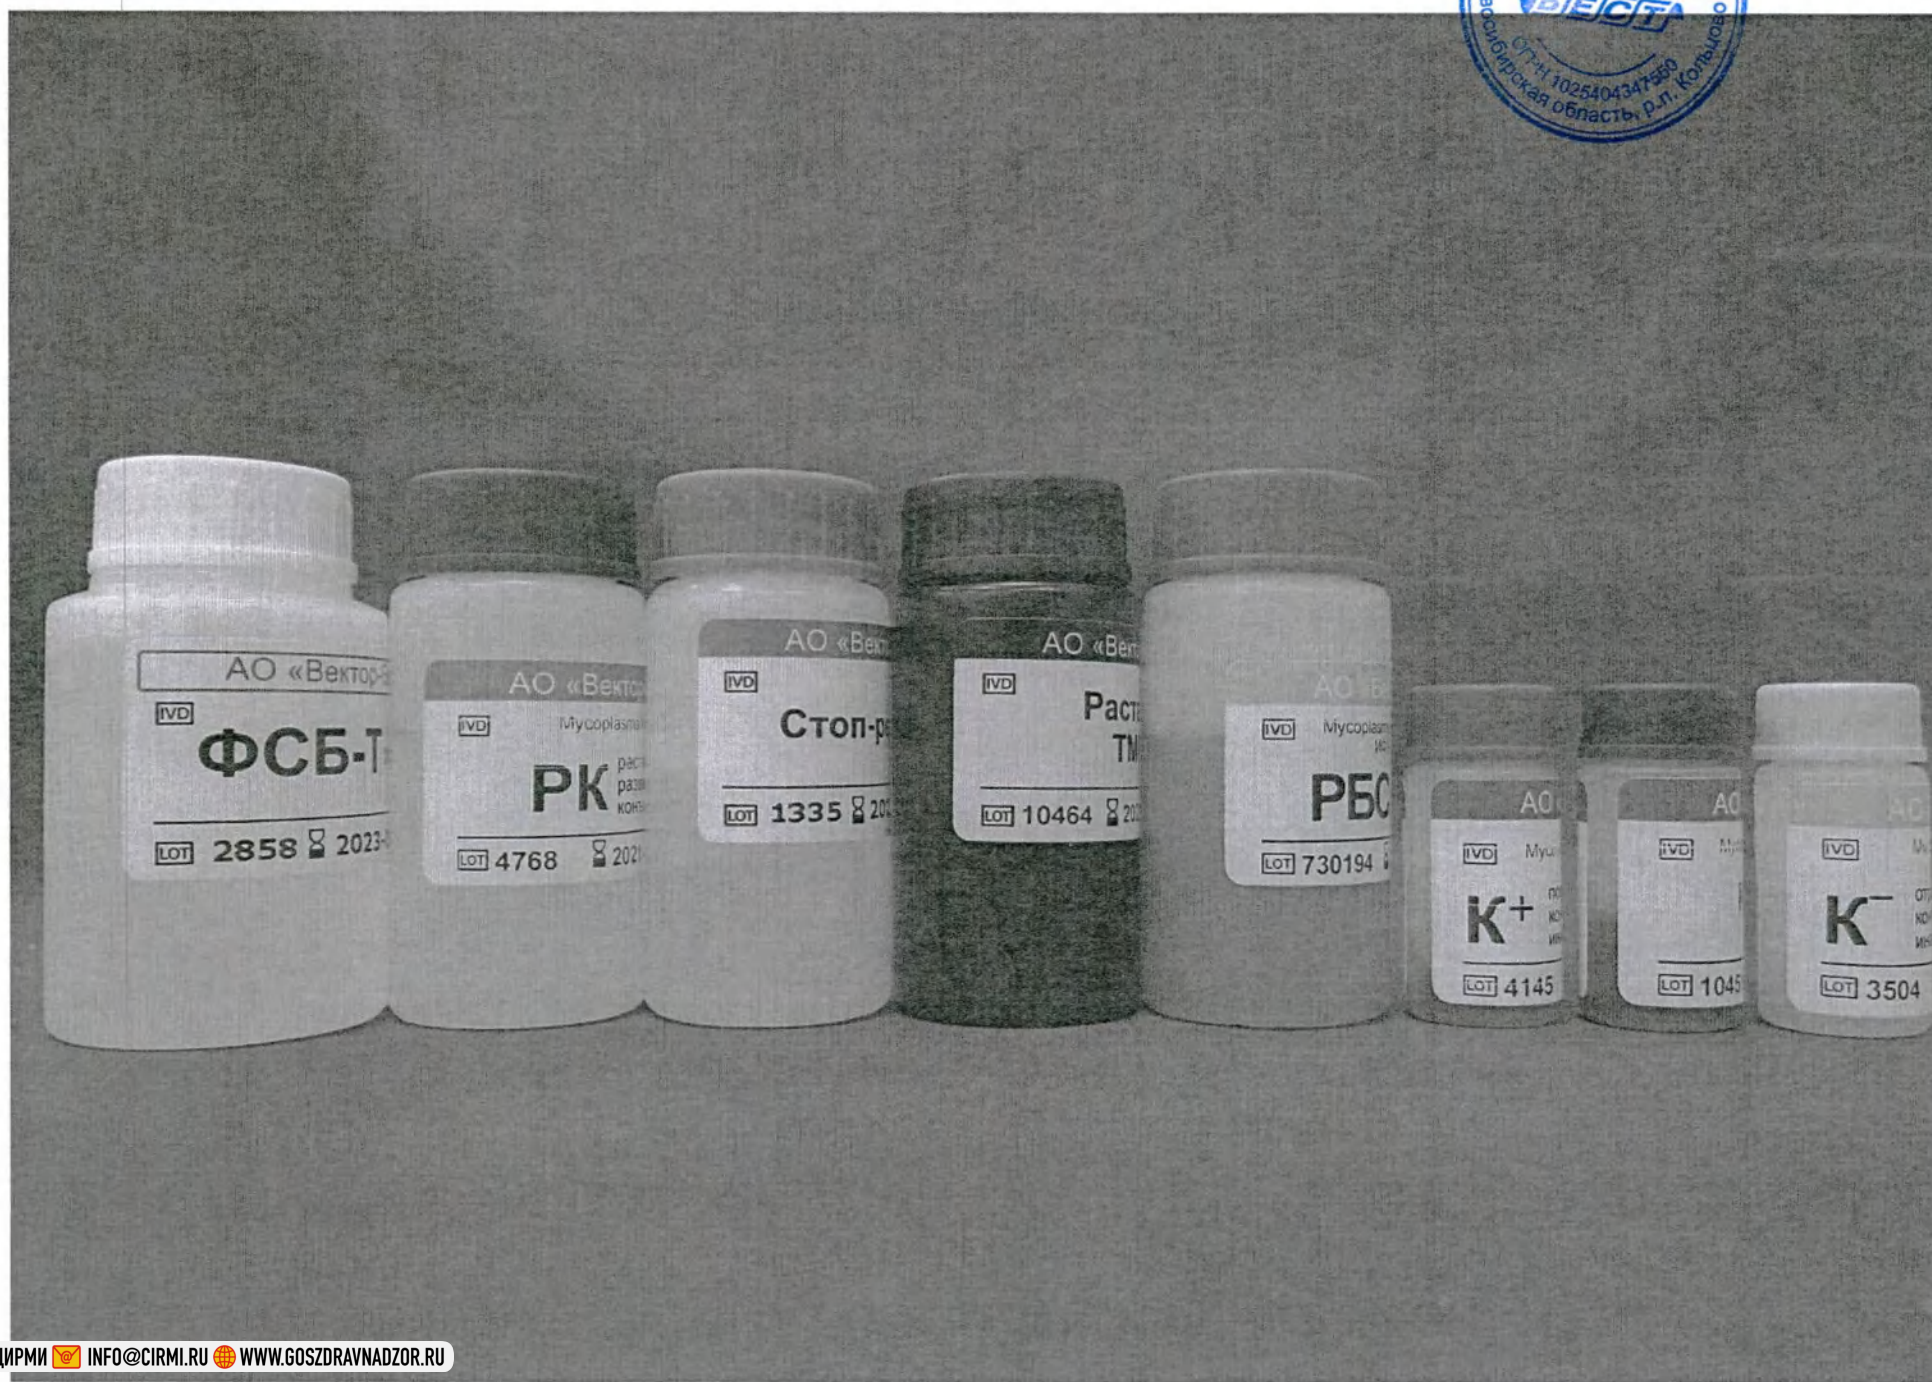


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к *Mycoplasma hominis* (*Mycoplasma hominis* – IgG – ИФА – БЕСТ)» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусайнов М.А. ИТ 2020 г.

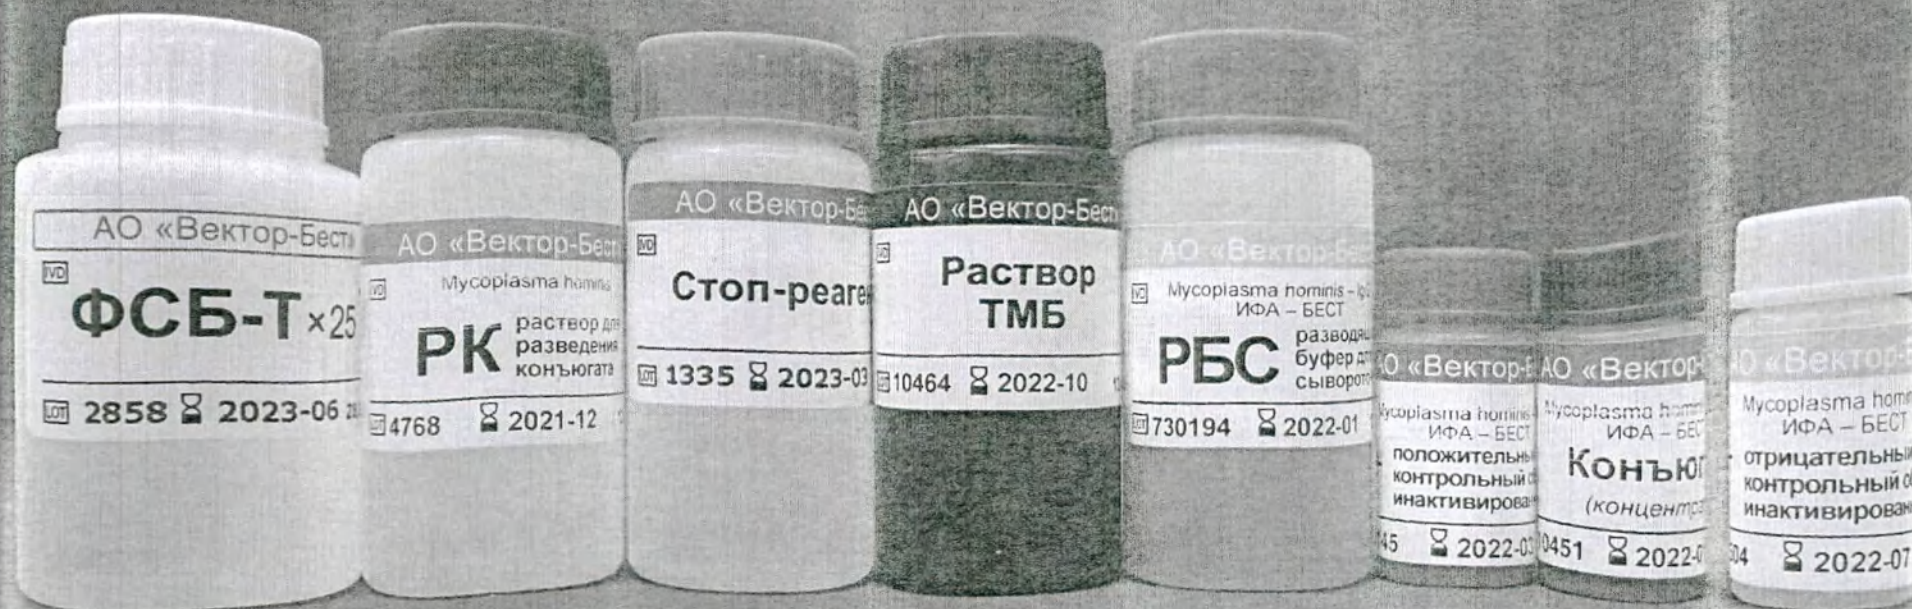

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к *Mycoplasma hominis* (*Mycoplasma hominis* – IgG – ИФА – БЕСТ)» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
2020 г.

