


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Аппарат ультразвуковой диагностический Arogee 3500 с принадлежностями




Принадлежности к аппарату ультразвуковому Арогее 3500:


1. Плата MUX.

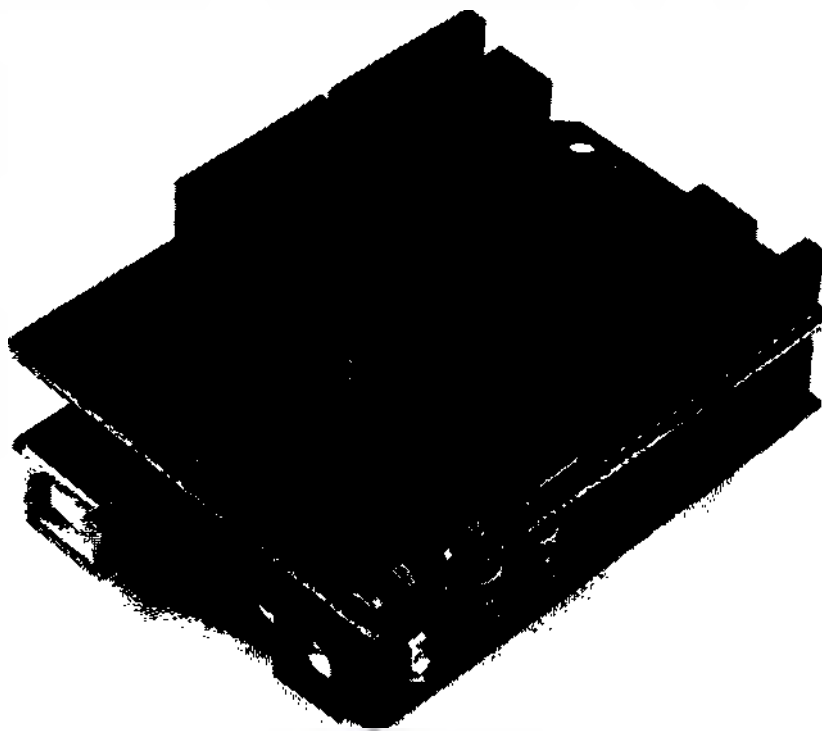


2. Плата MODULE.

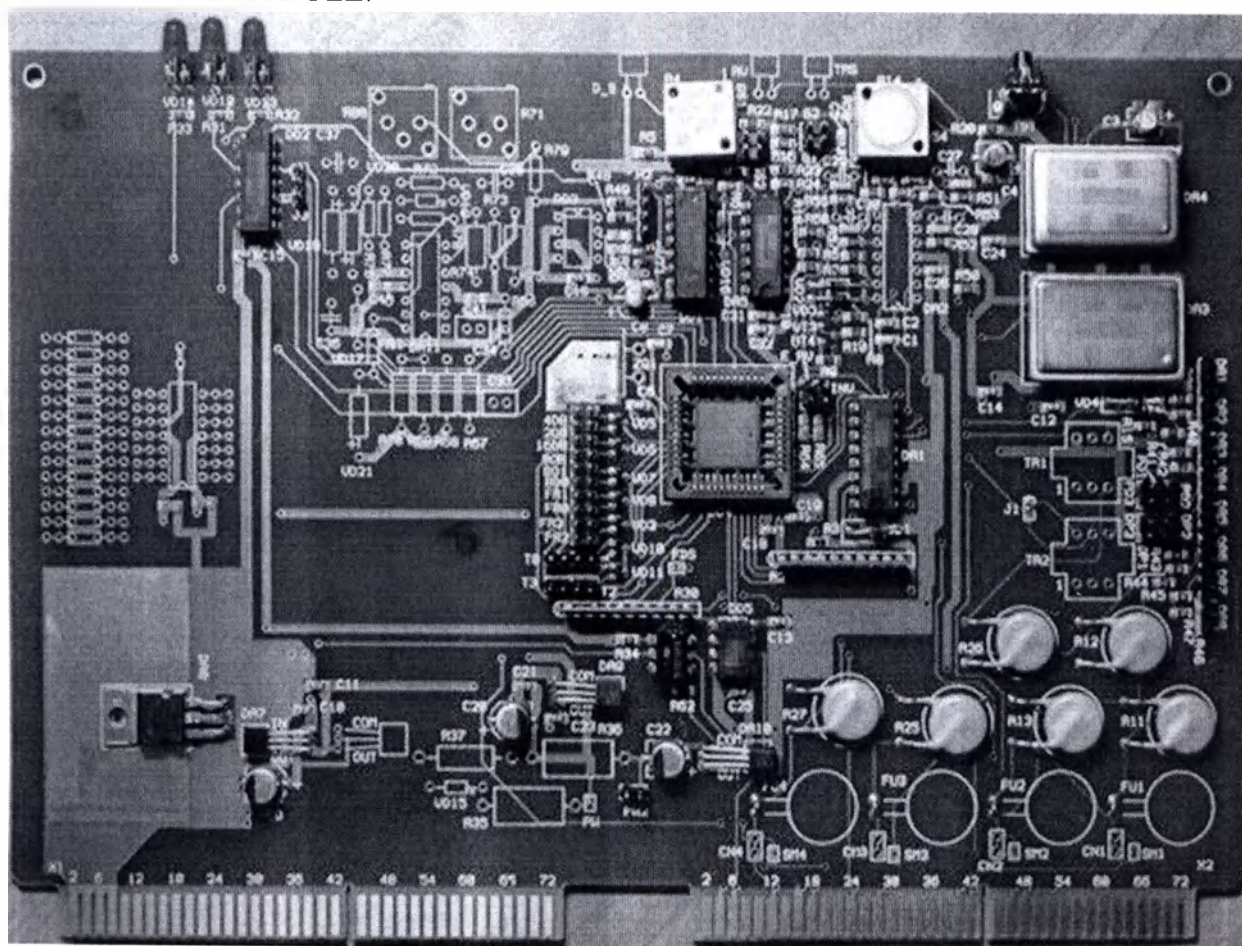


3. Плата РСІ.

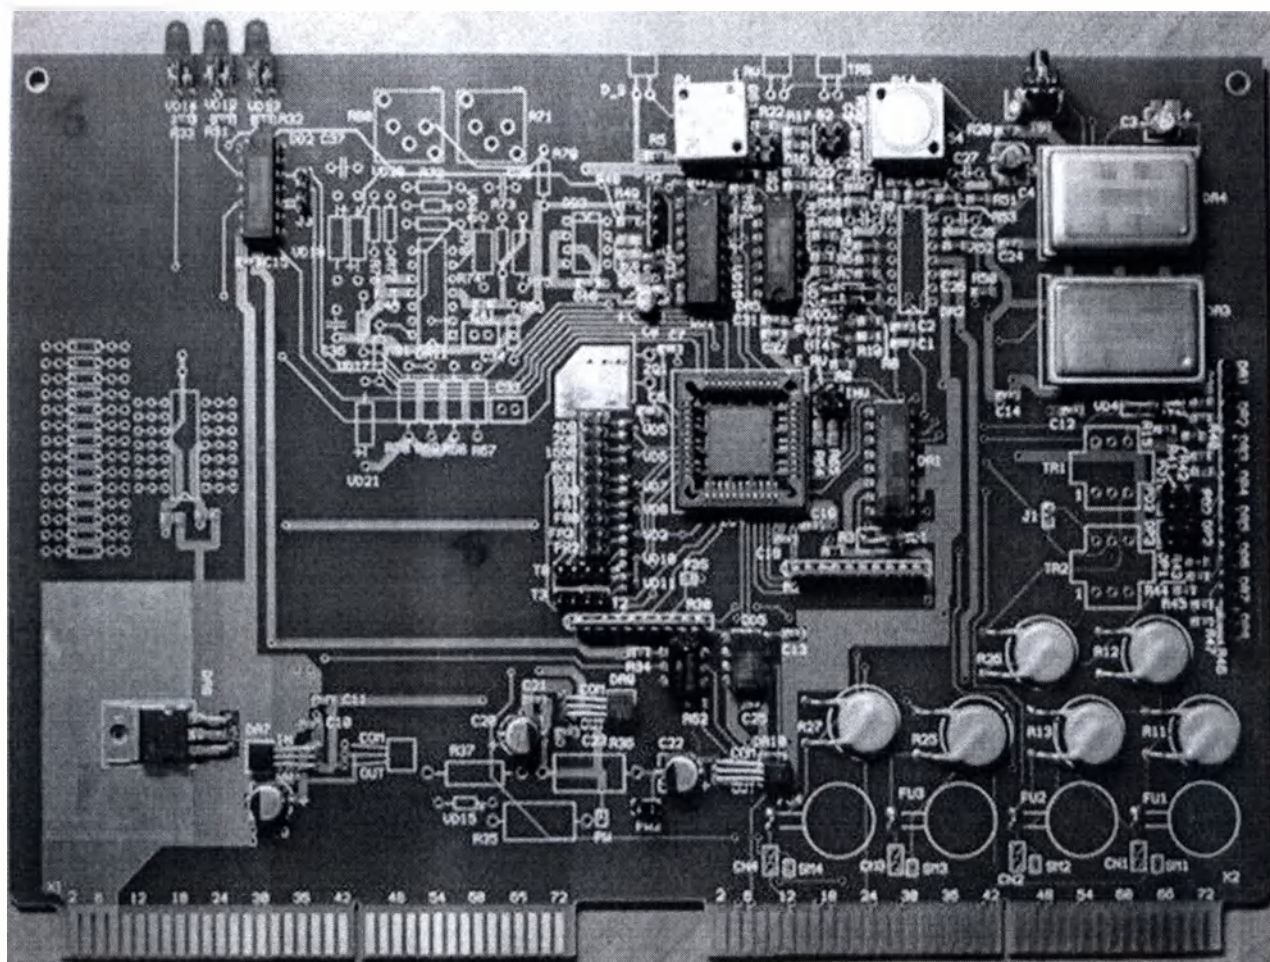


4. Плата PWR.

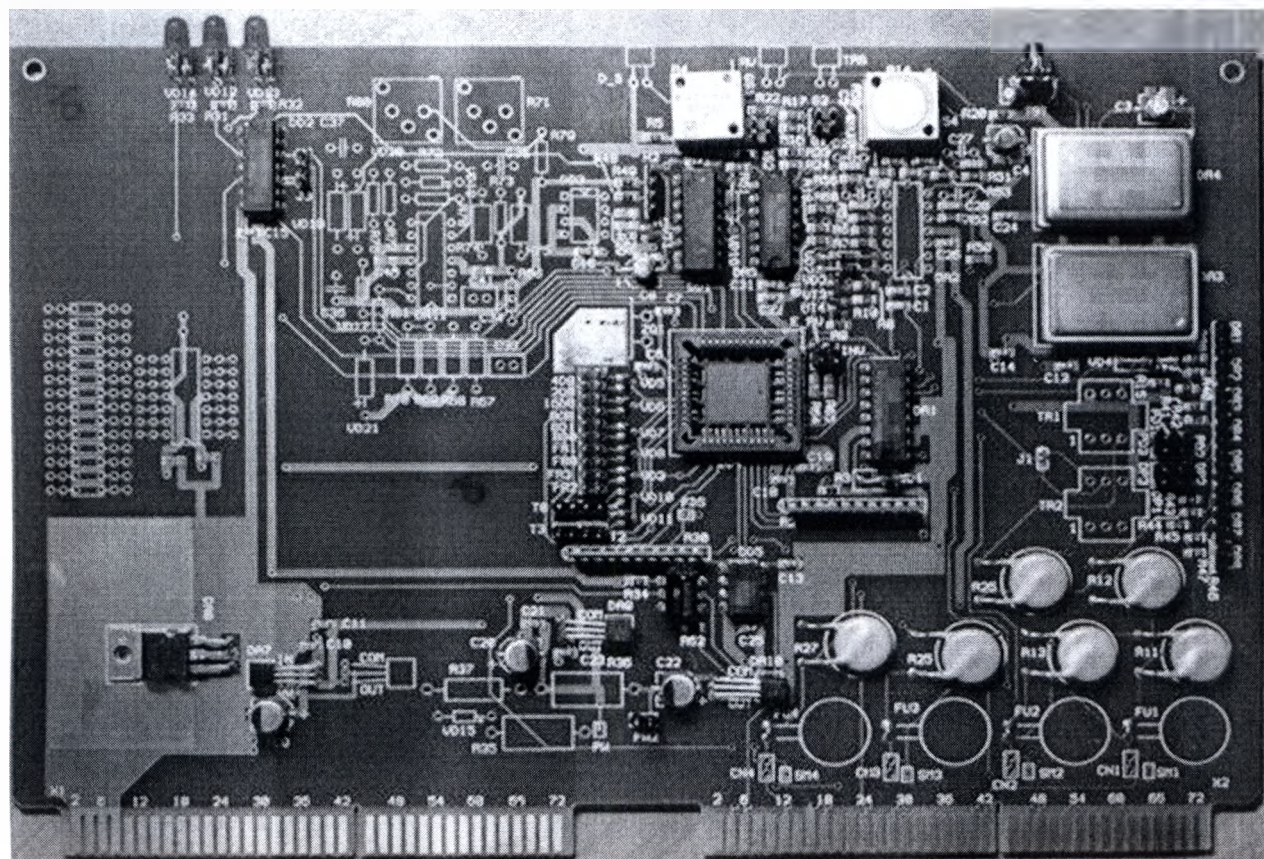

5. Монитор.

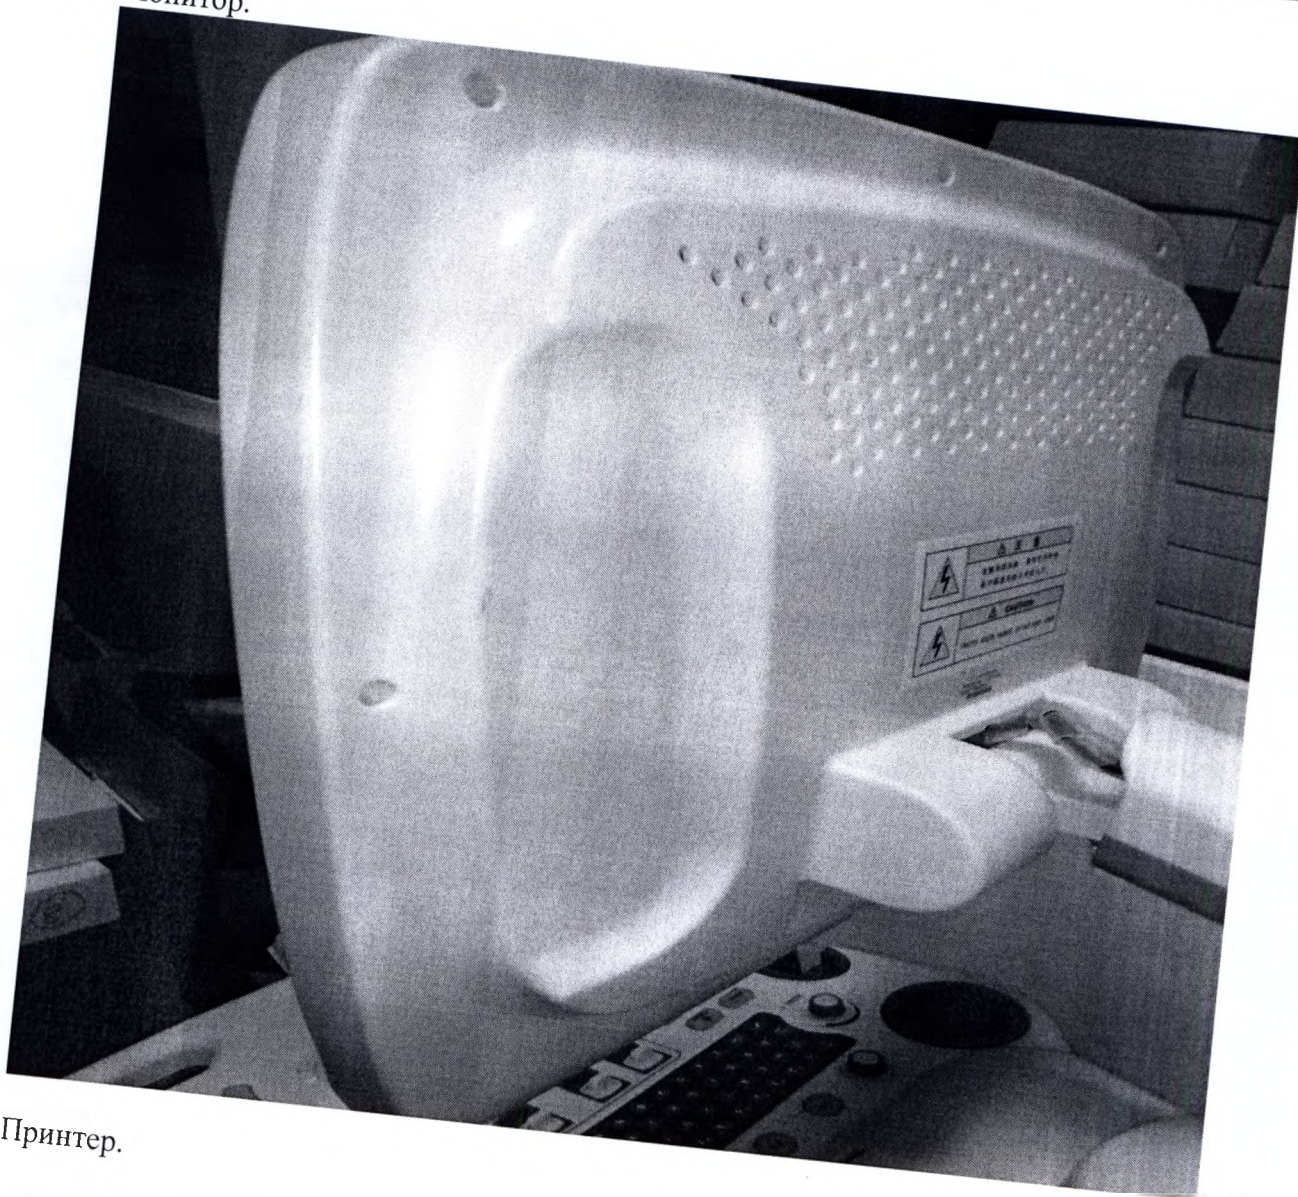

6. Принтер.

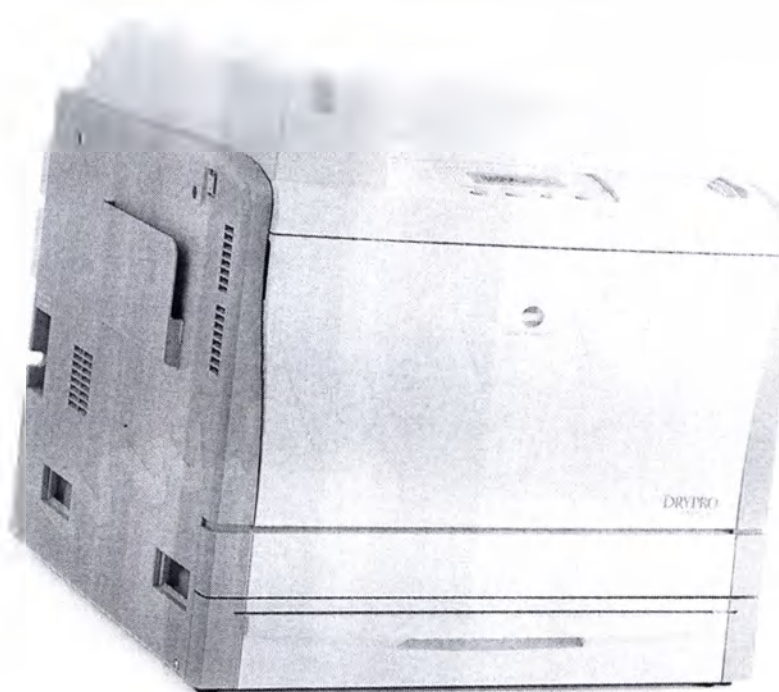


7. ЖК монитор.




8. Запасные части блока.




9. Силовое устройство АТХ.

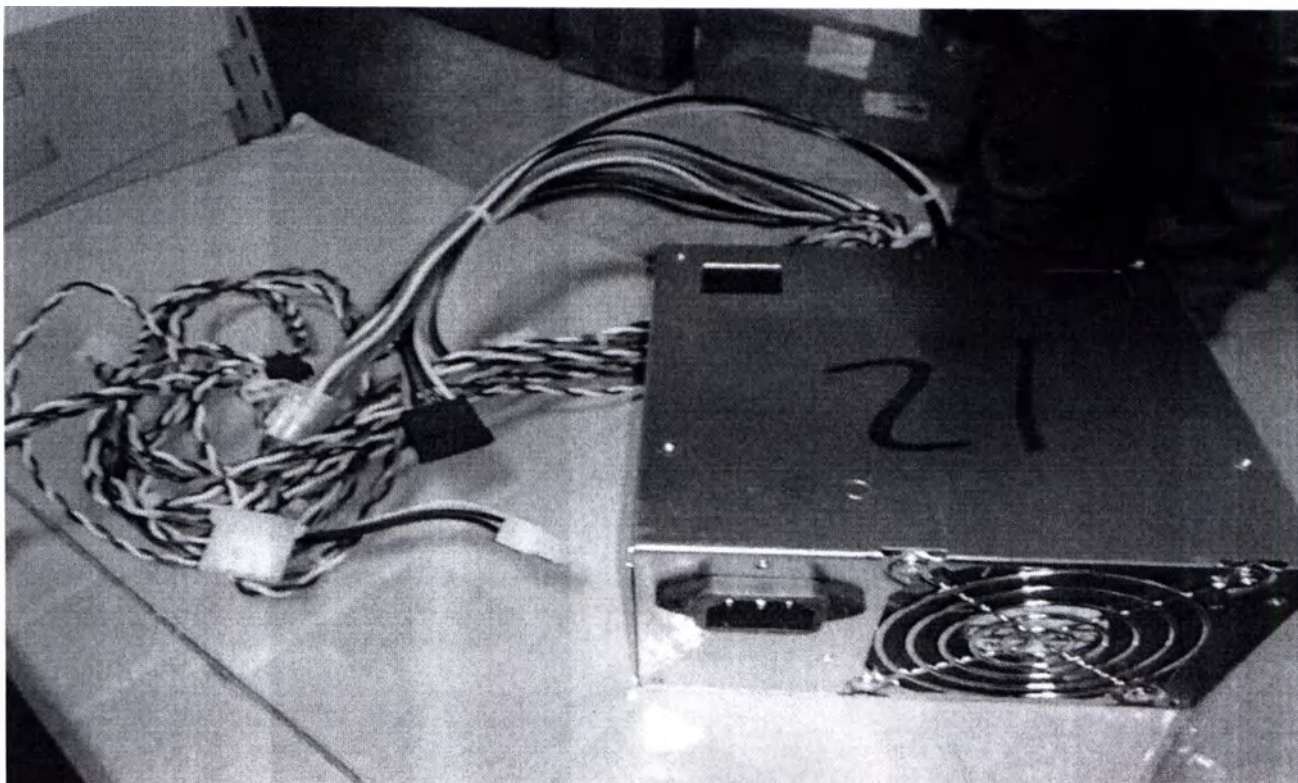

10. Материнская плата.

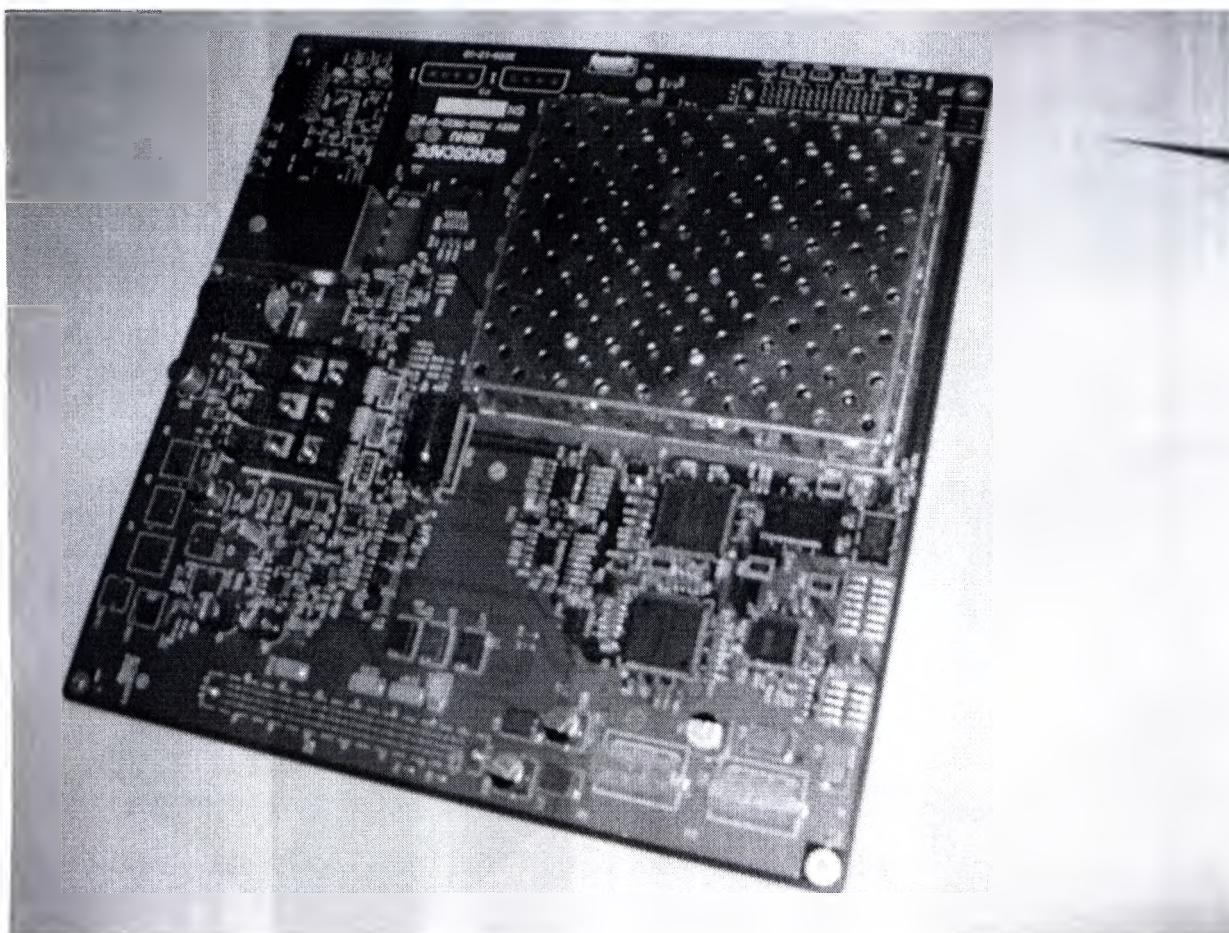

11. Оборудование.

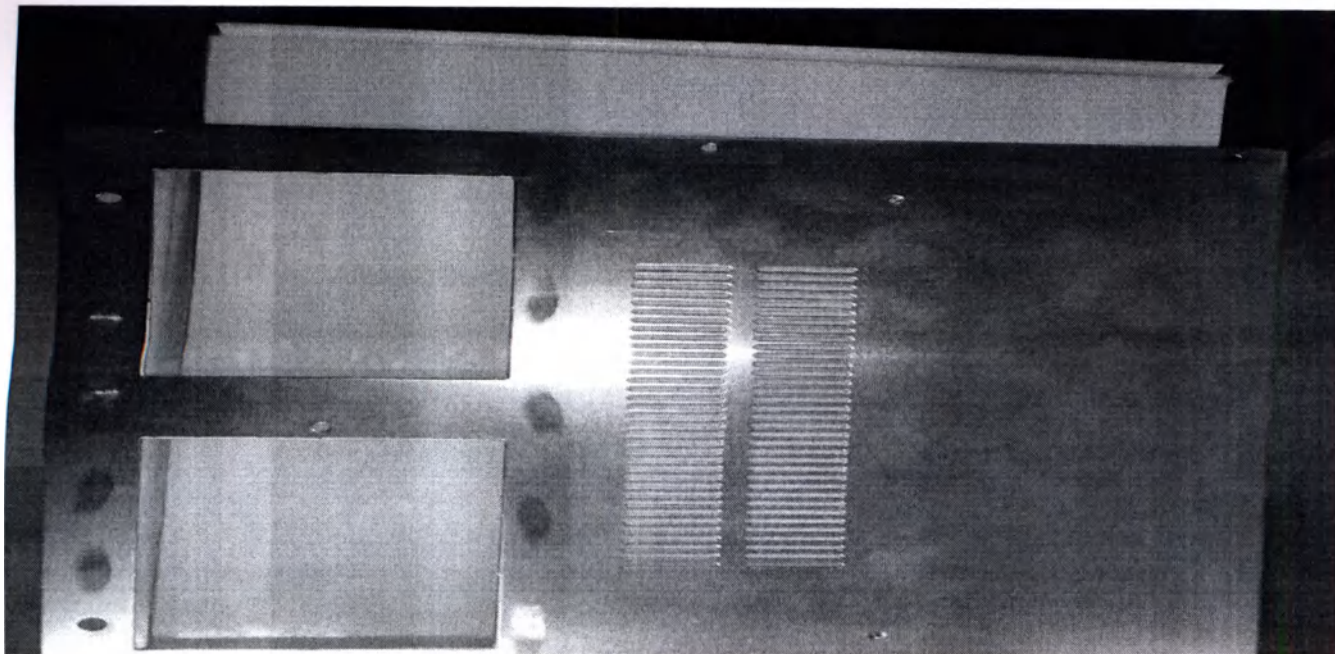

12. Программное обеспечение.



13. CD-ROM.




14. Блок памяти(EMS).




15. Центральный процессор.




16. Видео карта.

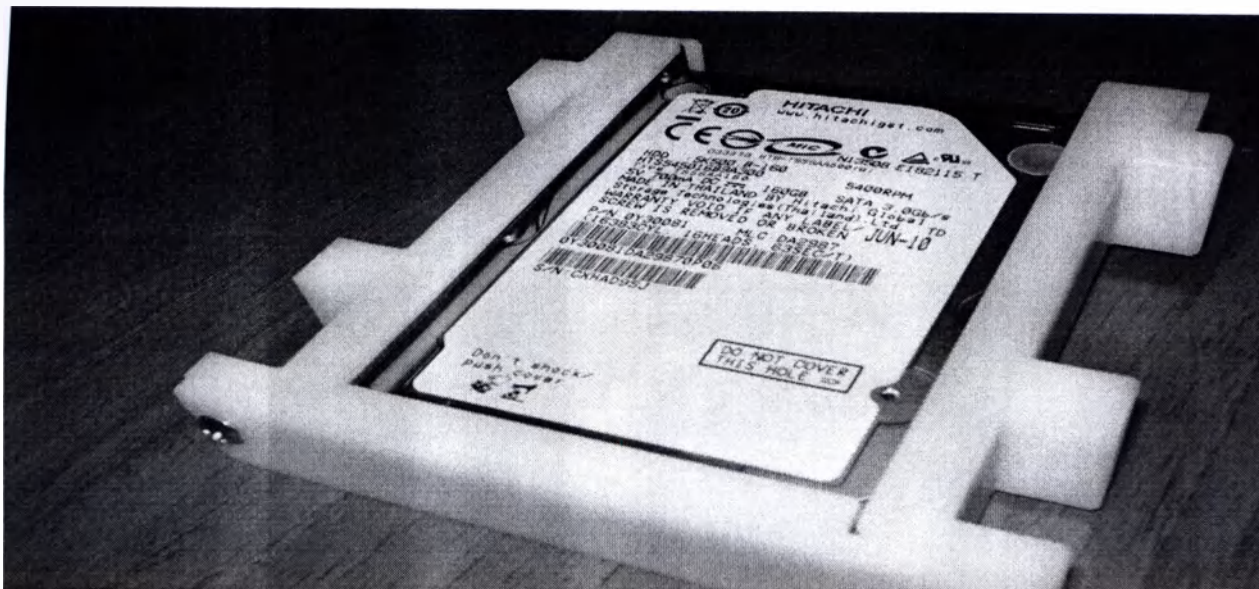

17. Конвексный датчик 2МГц-5МГц.

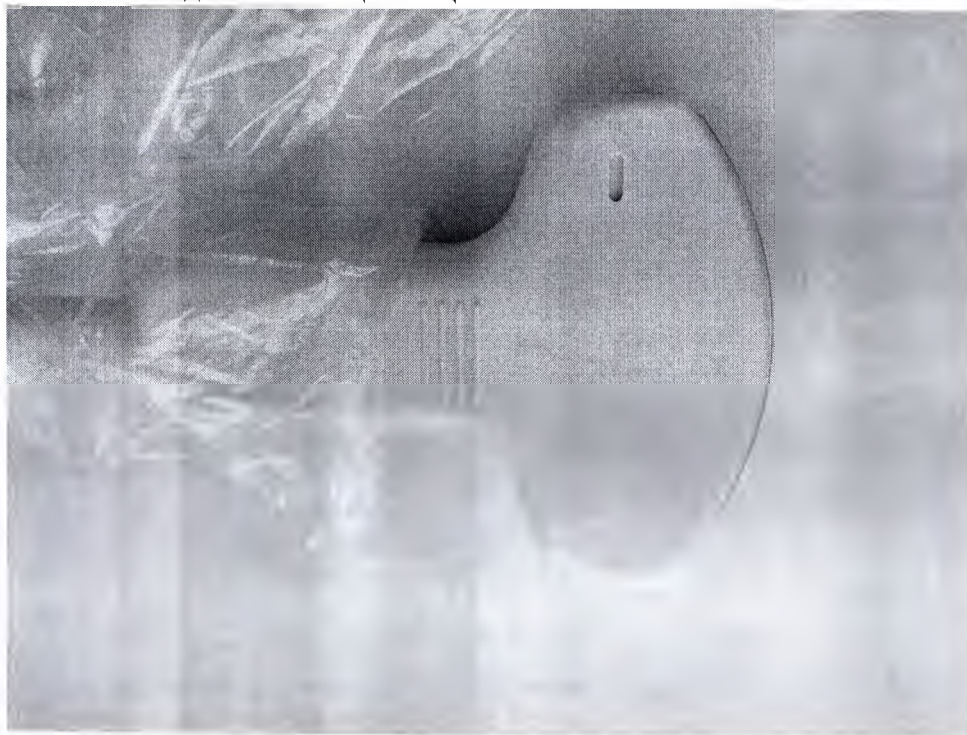

18. Конвексный датчик 2МГц-5МГц.

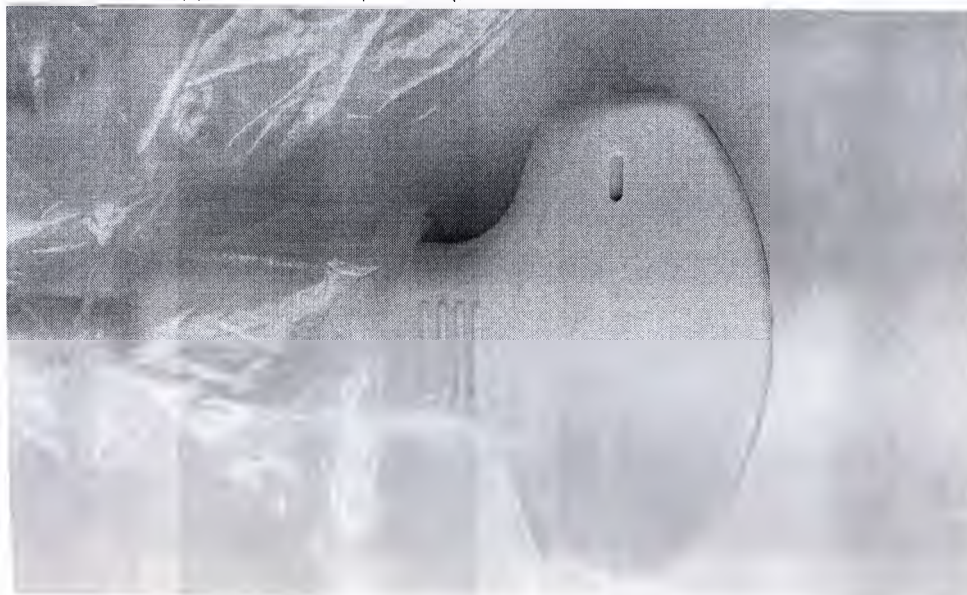

19. Конвексный датчик 4МГц-7МГц.



20. Линейный датчик 5МГц-12МГц.



21. Линейный датчик 5МГц-12МГц.



22. Линейный датчик 4МГц-9МГц.



23. Фазированный секторный датчик 2МГц-4МГц.




24. Фазированный секторный датчик 3МГц-6МГц.



25. Трансвагинальный датчик 4МГц-9МГц.



26. Ректальный датчик 4МГц-7МГц.

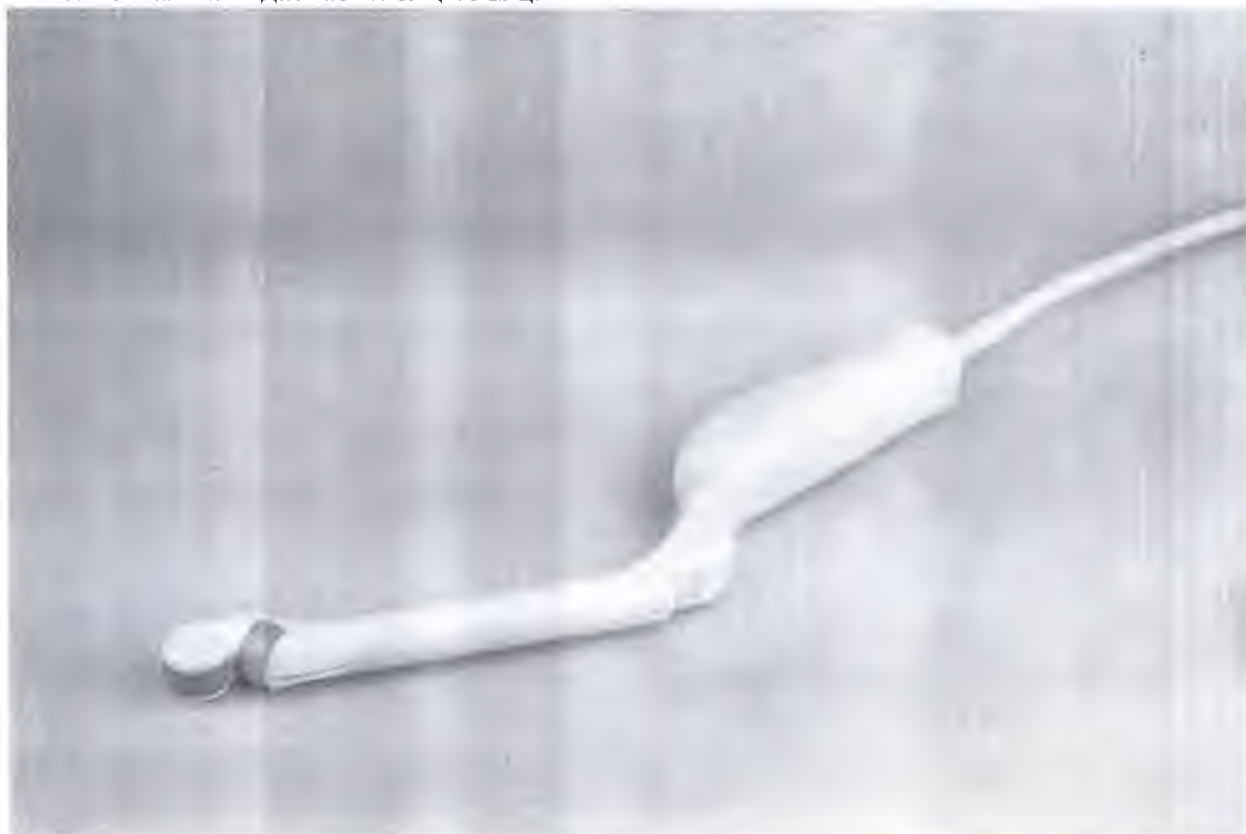


27. Мультипланарный ректальный датчик 4МГц-9МГц.




28. Биопсийная насадка для трансвагинального датчика.




29. Биопсийная насадка для линейного датчика 5МГц-12МГц.

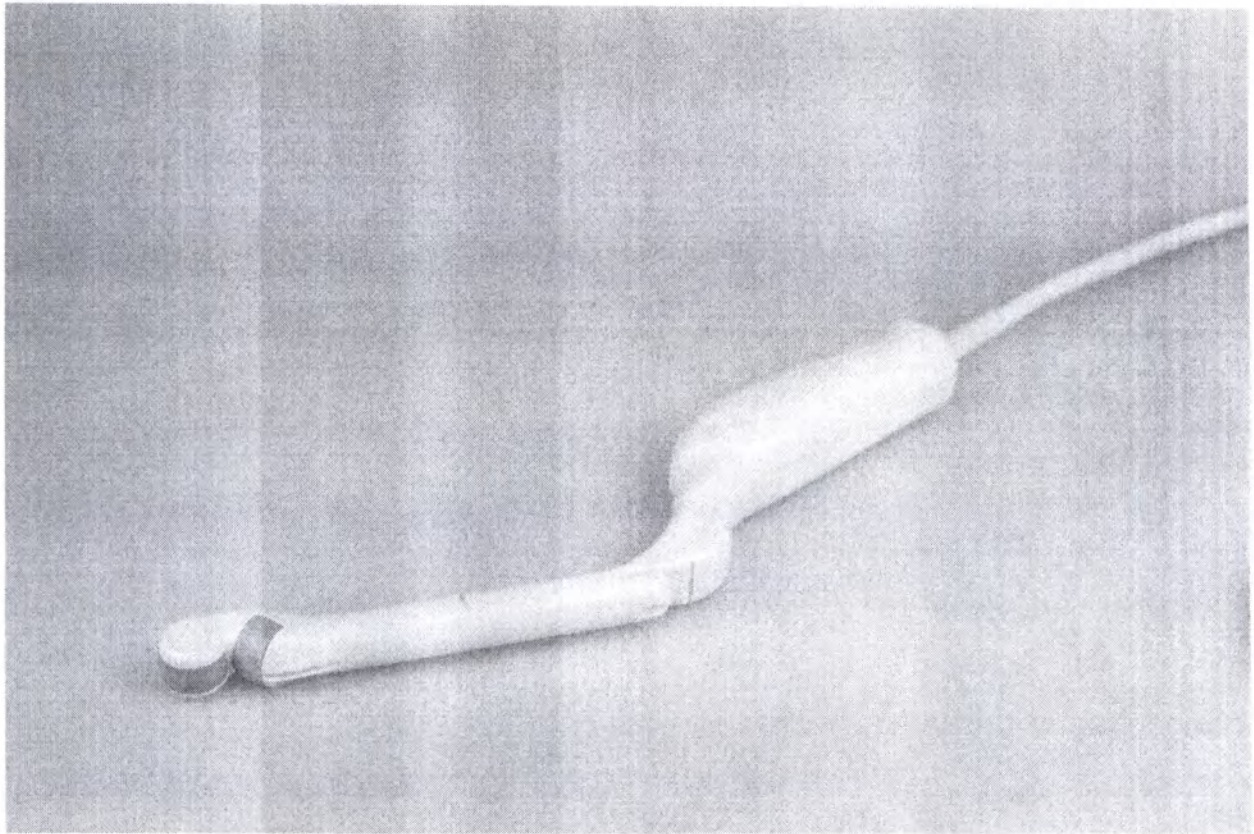

30. Биопсийная насадка для линейного датчика 5МГц-12МГц.

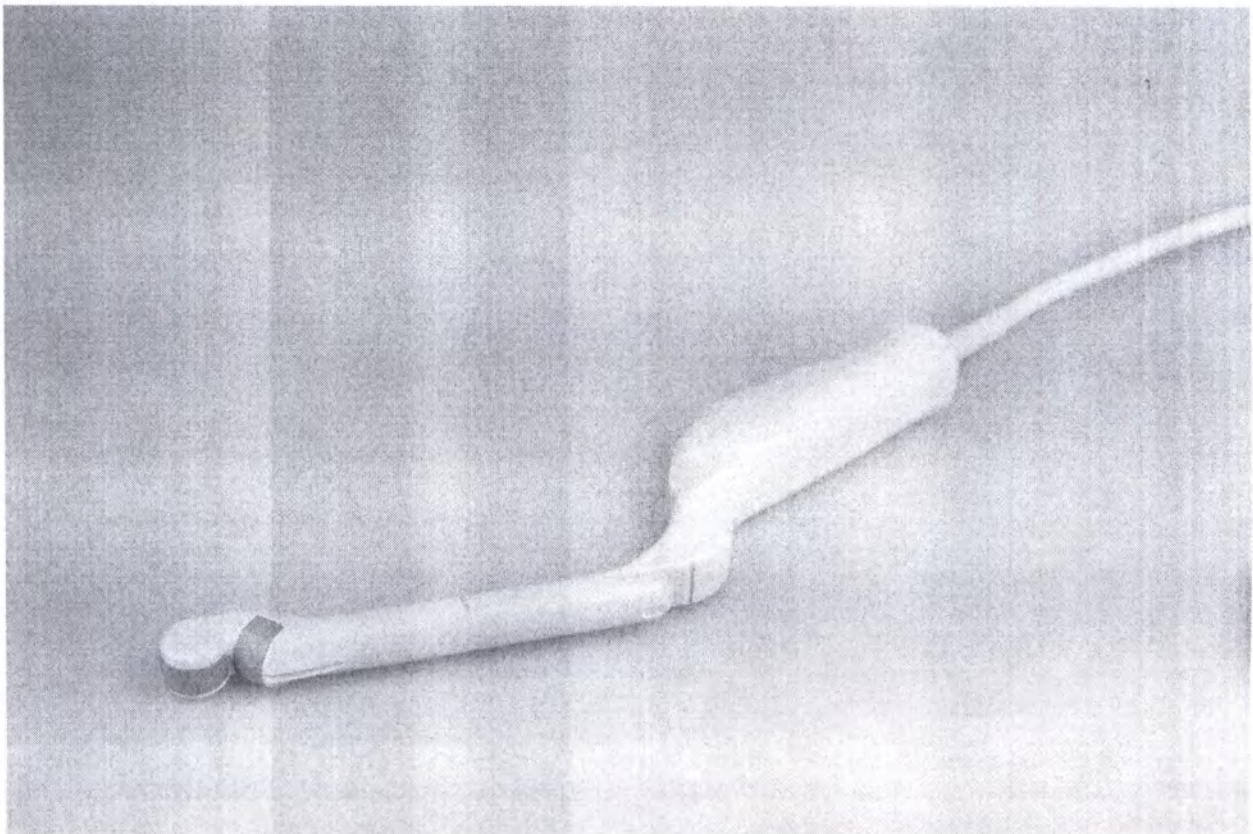


31. Биопсийная насадка для линейного датчика 4МГц-9МГц.

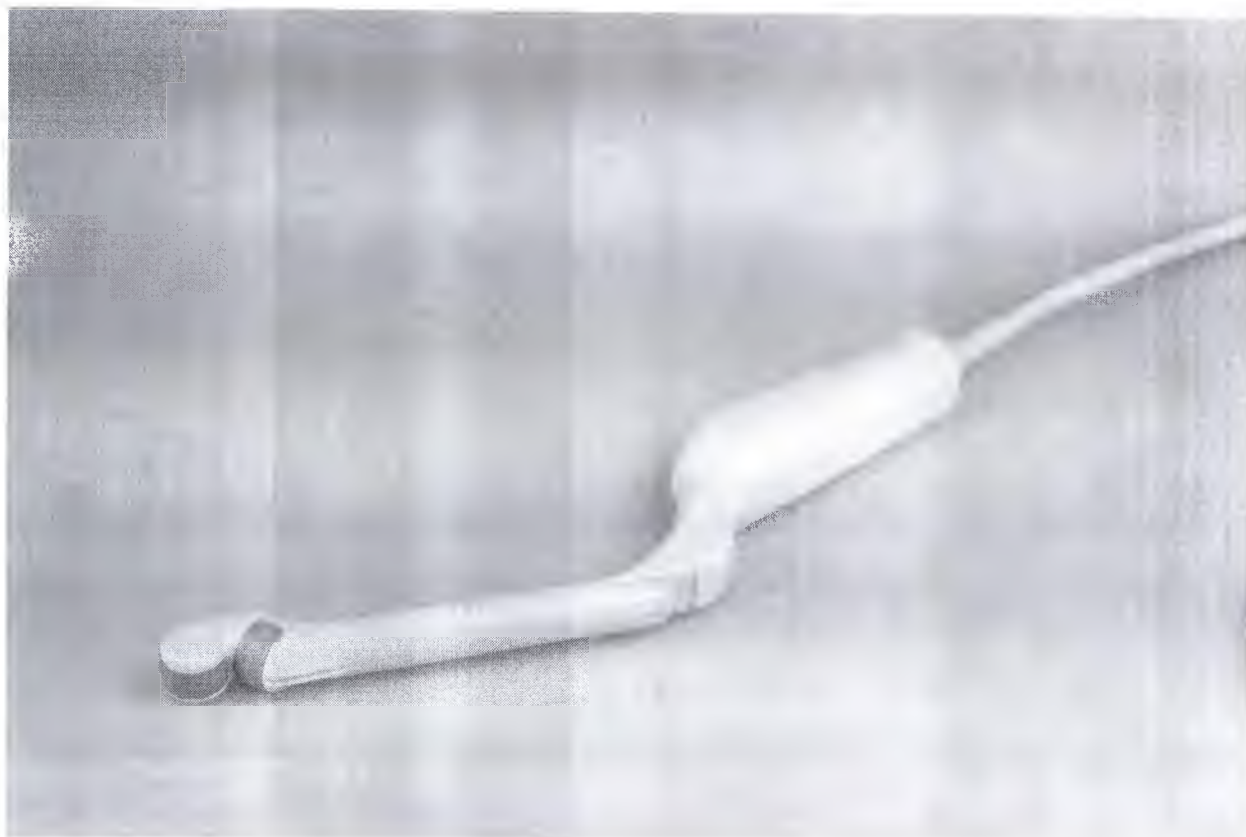


32. Биопсийная насадка для конвексного датчика 2МГц-5МГц.




33. Плата панорамного режима.

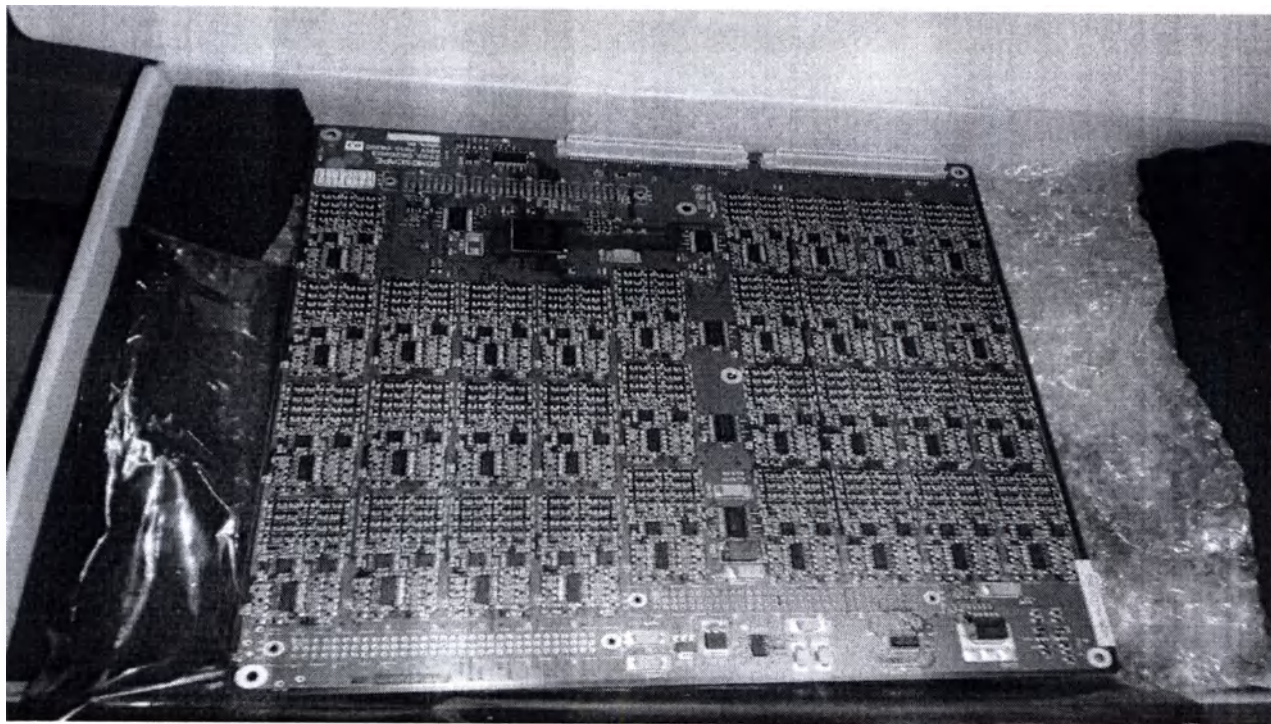


34. 3D режим.

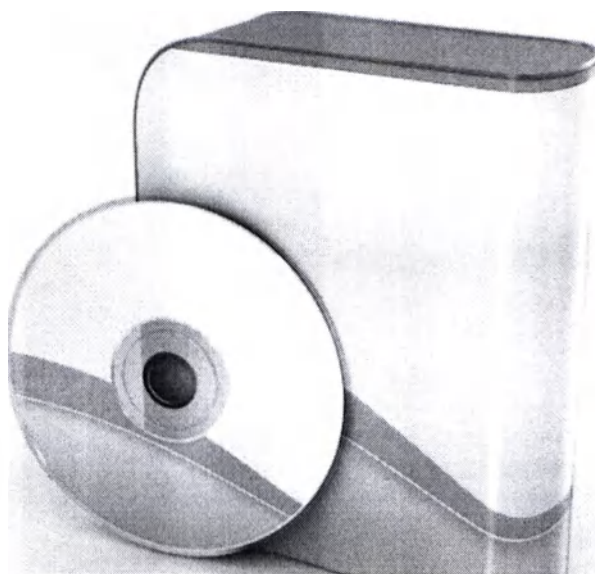


35. Фазовый детектор.
Входной ограничитель.

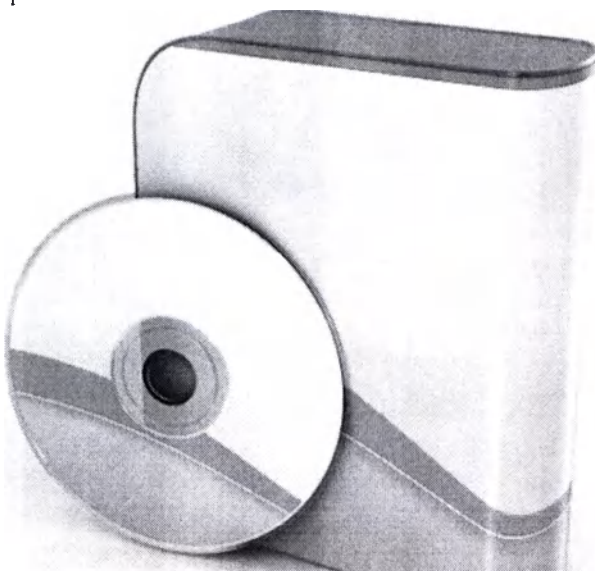


- 36. Приемник.
- 37. Офсетная задержка.
- 38. R-задержка.

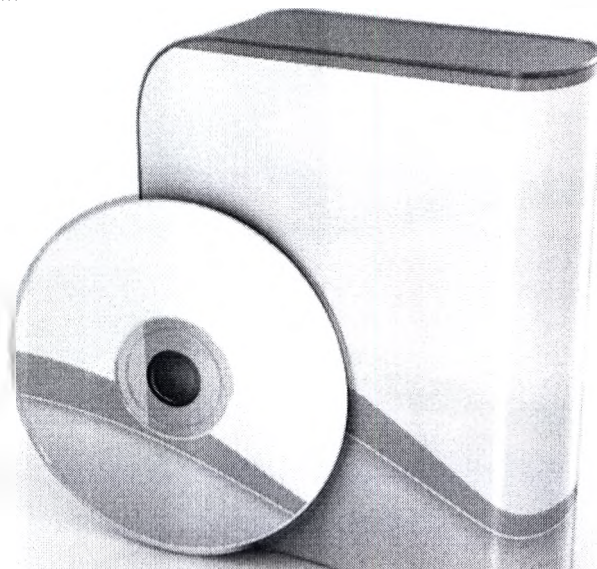

39. EX-генератор импульсов.

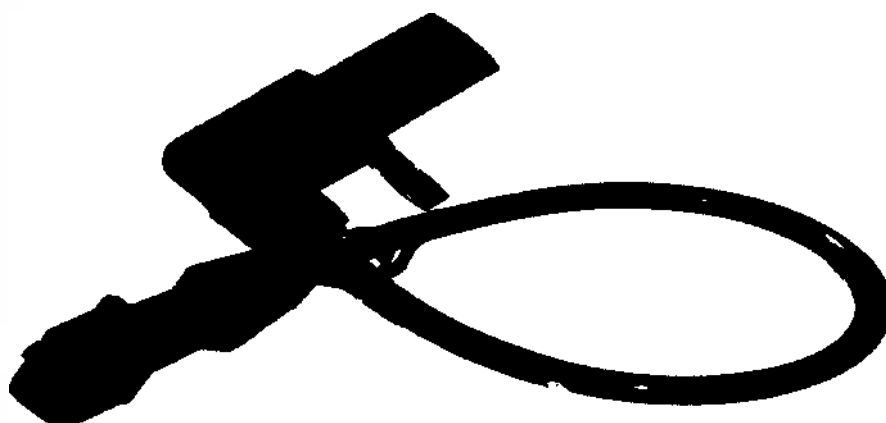


40. W-генератор импульсов.

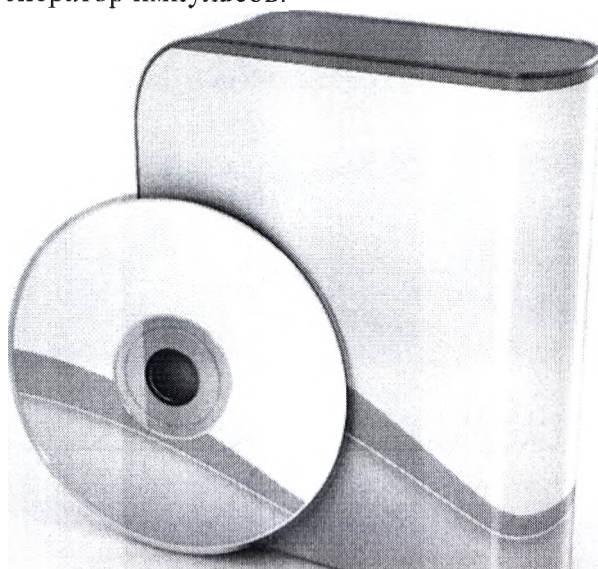





41. Селектор датчиков.
42. TR материнская.

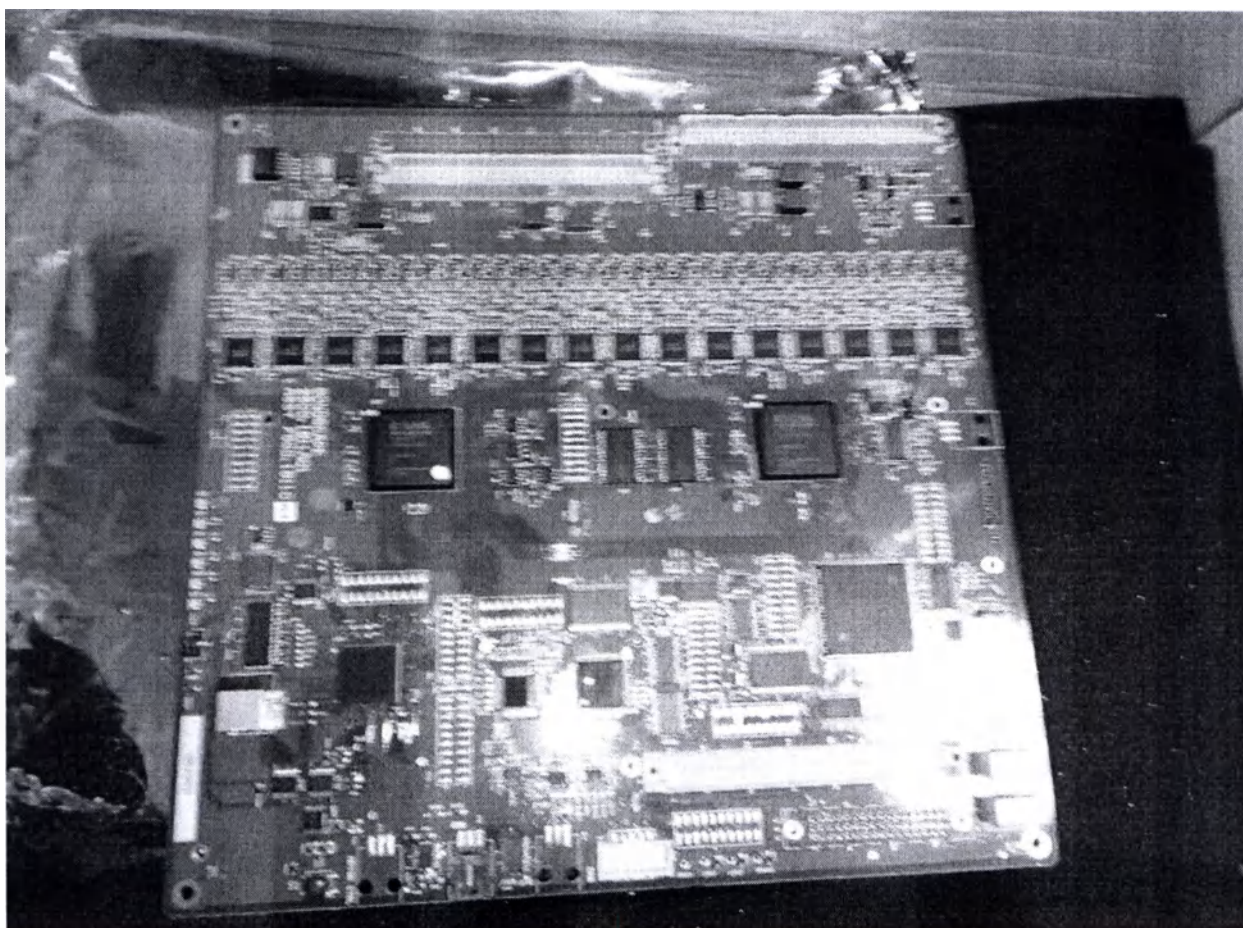


43. Панель IF.

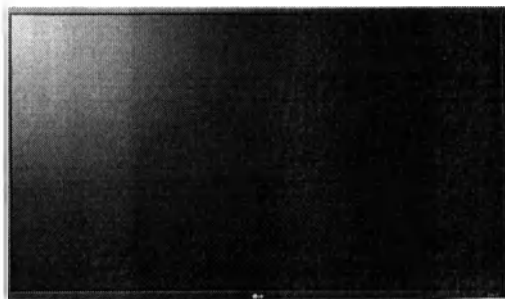


44. Цветное картографирование потока I/O.

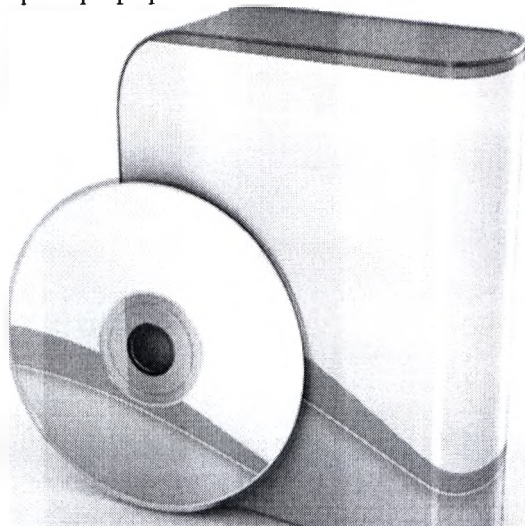


45. Цветное картографирование потока FM.

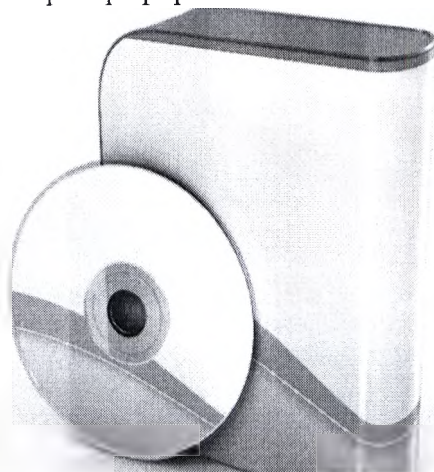


46. Цветное картографирование потока CONT

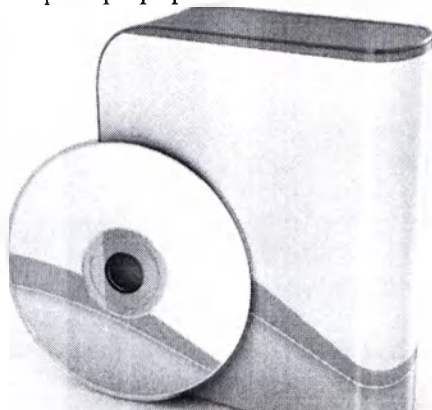


47. Цветной ENC/DEC.

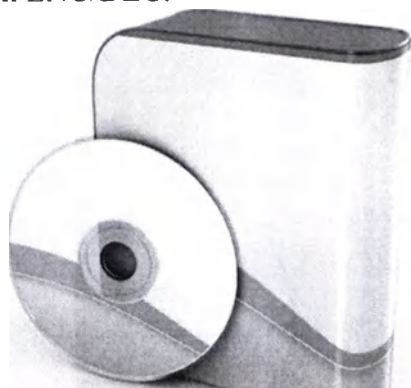


48. Быстрый преобразователь Фурье I/O.

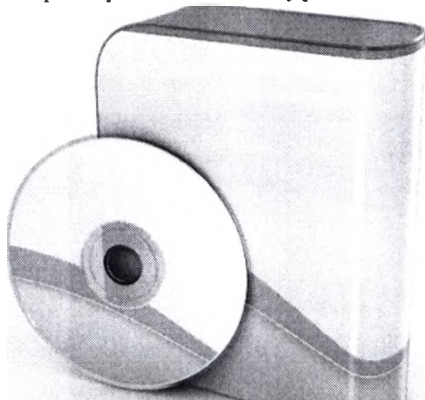


Быстрый преобразователь Фурье ADC.
Импульсно волновой LPF.
Непрерывноволновой HPF.

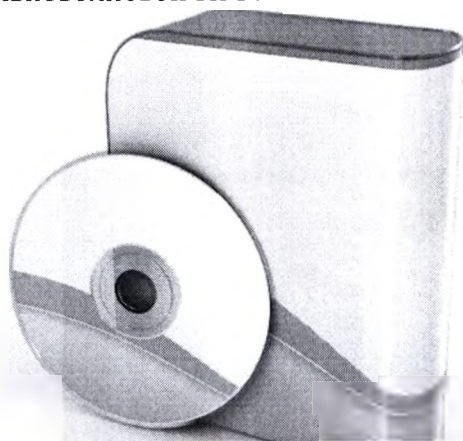


49. Быстрый преобразователь Фурье CONT.

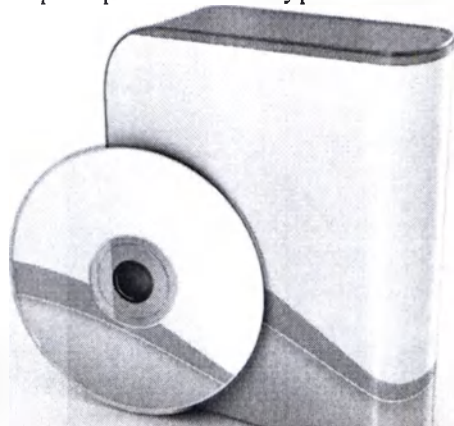


50. Быстрый преобразователь Фурье.

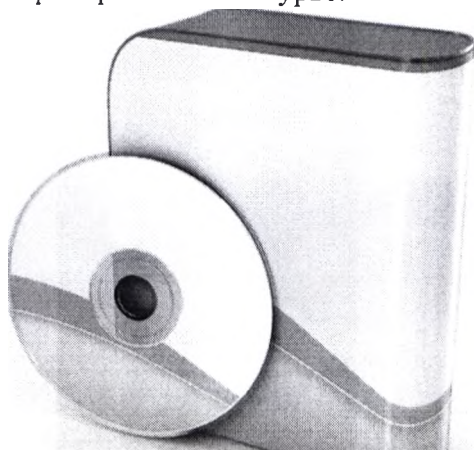


51. Быстрый преобразователь Фурье/CONT/Аудио.

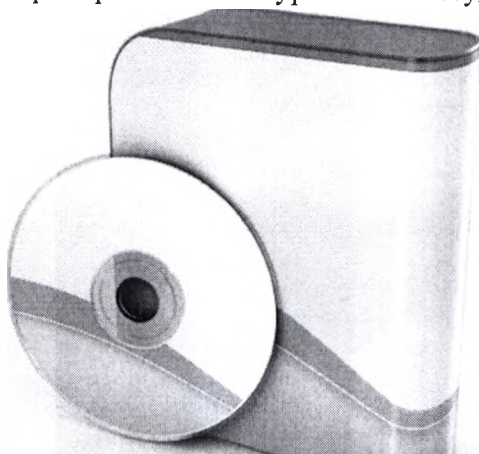


52. Параллельный принтер.

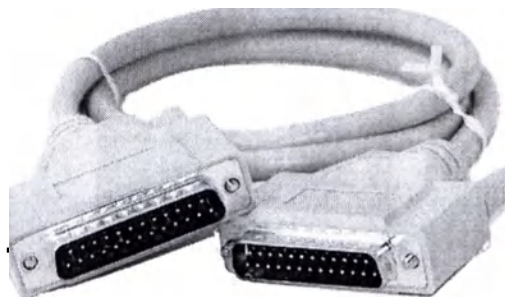

53. Видео принтер.

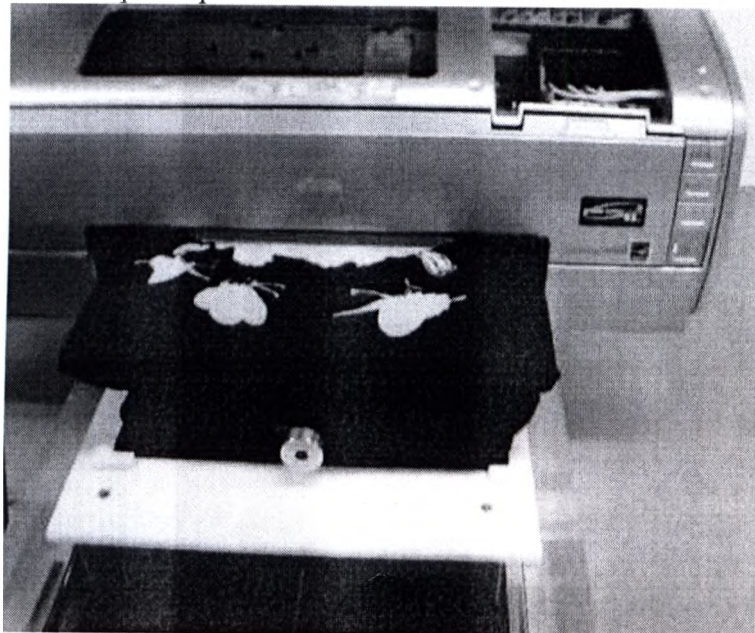

54. DICOM 3.0.

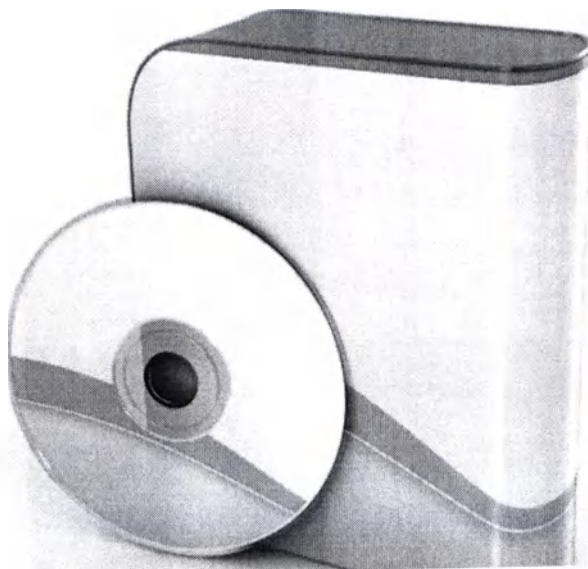

Генеральный директор

Е.Е.Жвакина



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 22 листов

