



**РЕГИСТРАТОР
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ВО ВРЕМЯ СНА
«АПНОКС»**

Фотографические изображения общего вида
вместе с принадлежностями, необходимыми для применения
по назначению

Технический директор

 Смирнов Б.Е.

« 19 » 09 2016 г.

Маркировка медицинского изделия Регистратора физиологических сигналов во время сна «АПНОКС» с учетом исполнений «АПНОКС-10», «АПНОКС-04» нанесена на тыльной стороне модуля базового (см. фото № 1).

Состав исполнений регистраторов, а также принадлежности приведены в таблице 1 с указанием номера фотографического изображения, следующего за таблицей.

Изделие	Фото №
I «АПНОКС-10», в составе:	
1 Модуль базовый – 1 шт.	2
2 Чехол модуля базового – 1 шт.	2
3 Ремень фиксирующий – 2 шт.	2
4 Датчик SpO ₂ многоцветный R-3227, производства «Envitec-Wismar GmbH», ФРГ – 1 шт.	3
5 Носовая канюля (пластиковая воздуховодная трубка), РУ № РЗН 2015/2294, производства «Ембла Системс», Канада – 5 шт.	4
6 Модуль беспроводной ПОЛИ-4 – 1 шт.	5
7 Чехол модуля беспроводного ПОЛИ-4 – 1 шт.	5
8 Датчик двигательной активности беспроводной – 2 шт.	5
9 Чехол датчика двигательной активности беспроводного – 2 шт.	5
10 Кабель ЭКГ – 1 шт.	6
11 Проводник нейтрального электрода – 1 шт.	6
12 Датчик рекурсии дыхания ДПГ-4М (тензорезистивный) – 2 шт.	7
13 Датчик рекурсии дыхания индуктивный «А» – 1 шт.	8
14 Датчик рекурсии дыхания индуктивный «Т» – 1 шт.	8
15 Пояс для датчика рекурсии дыхания индуктивного размер М – 2 шт.	8
16 Пояс для датчика рекурсии дыхания индуктивного размер LM – 2 шт.	8
17 Пояс для датчика рекурсии дыхания индуктивного размер L – 2 шт.	8
18 Кабель биполярного отведения ЭМГ (для одноразовых электродов) – 2 шт.	6
19 Датчик двигательной активности – 2 шт.	7
20 Датчик проводимости КПр – 1 шт.	6
21 Датчик потока дыхания термисторный ороназальный ДПДт-2 – 1 шт.	7
22 Датчик храпа – 1 шт.	7
23 Электрод для ЭКГ одноразовый, РУ № ФСЗ 2012/12612, производства «Ковидиен Ллс», США – 1 упак.	6
24 Сумка для транспортировки – 1 шт.	15
25 Аккумулятор Ni-MH AA – 4 шт.	2
26 Аккумулятор Ni-MH AAA – 4 шт.	5
27 Устройство зарядное для Ni-MH аккумуляторов – 1 шт.	9
28 Монитор оперативного контроля по спецификации А_3680 в составе: планшетный ПК с предустановленным ПО «АПНОКС-10», блок интерфейсный ИБ-4мк – 1 шт.	10
29 Станция анализа сигналов по спецификации А_3681 в составе: портативный компьютер с предустановленным ПО «АПНОКС-10», блок интерфейсный ИБ-4 – 1 шт.	11
30 Комплект видеоборудования по спецификации А_3682 в составе: видеорегистратор с кабелем, кронштейн, инжектор PoE с кабелем – 1 шт.	12
31 Станция обработки и архивного хранения данных по спецификации А_3683 в составе: системный блок с предустановленным ПО «АПНОКС-10», клавиатура, мышь, монитор, принтер, ключ ЭКПО-1М, кабель передачи данных – 1 шт.	13
32 Эксплуатационная документация в составе: Руководство по эксплуатации совмещенное с паспортом, руководство пользователя ПО «АПНОКС» – 1 шт.	–

Изделие	Фото №
II «АПНОКС-04», в составе:	
1 Модуль базовый –1 шт.	2
2 Чехол модуля базового –1 шт.	2
3 Ремень фиксирующий – 1 шт.	2
4 Датчик SpO2 многоцветный R-3227, производства «Envitec-Wismar GmbH», ФРГ – 1 шт.	3
5 Носовая канюля (пластиковая воздуховодная трубка), РУ № РЗН 2015/2294, производства «Ембла Системс», Канада – 5 шт.	4
6 Сумка для транспортировки –1 шт.	15
7 Аккумулятор Ni-MH AA – 2 шт.	2
8 Устройство зарядное для Ni-MH аккумуляторов – 1 шт.	9
9 Монитор оперативного контроля по спецификации А_3680 в составе: планшетный ПК с предустановленным ПО «АПНОКС-04», блок интерфейсный ИБ-4мк – 1 шт.	10
10 Станция анализа сигналов по спецификации А_3681 в составе: портативный компьютер с предустановленным ПО «АПНОКС-04», блок интерфейсный ИБ-4 – 1 шт.	11
11 Комплект видеоборудования по спецификации А_3682 в составе: видеорегистратор с кабелем, кронштейн, инжектор PoE с кабелем – 1 шт.	12
12 Станция обработки и архивного хранения данных по спецификации А_3683 в составе: системный блок с предустановленным ПО «АПНОКС-04», клавиатура, мышь, монитор, принтер, ключ ЭКПО-1М, кабель передачи данных – 1 шт.	13
13 Эксплуатационная документация в составе: Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом, руководство пользователя ПО «АПНОКС» – 1 шт.	–
III Принадлежности:	
1 Датчик SpO2 многоцветный Y-3227, производства «Envitec-Wismar GmbH», ФРГ – до 5 шт.	3
2 Датчик SpO2 многоцветный R-3227, производства «Envitec-Wismar GmbH», ФРГ – до 5 шт.	3
3 Датчик SpO2 многоцветный RM-3227, производства «Envitec-Wismar GmbH», ФРГ – до 5 шт.	3
4 Датчик SpO2 многоцветный RS-3227, производства «Envitec-Wismar GmbH», ФРГ – до 5 шт.	3
5 Канюля назальная, взрослая, РУ № ФСЗ 2011/10605, производства «Бребон Медикал Корпорейшн», Канада – до 5 упак.	4
6 Канюля назальная, детская, РУ № ФСЗ 2011/10605, производства «Бребон Медикал Корпорейшн», Канада – до 5 упак.	4
7 Канюля назальная с фильтром, взрослая, РУ № ФСЗ 2011/10605, производства «Бребон Медикал Корпорейшн», Канада – до 5 упак.	4
8 Канюля назальная с фильтром, детская, РУ № ФСЗ 2011/10605, производства «Бребон Медикал Корпорейшн», Канада – до 5 упак.	4
9 Канюля ротоносовая с фильтром, взрослая, РУ № ФСЗ 2011/10605, производства «Бребон Медикал Корпорейшн», Канада – до 5 упак.	4
10 Фильтр для канюли, РУ № ФСЗ 2011/10605, производства «Бребон Медикал Корпорейшн», Канада – до 5 упак.;	2
11 Носовая канюля (пластиковая воздуховодная трубка), РУ № РЗН 2015/2294, производства «Ембла Системс», Канада – до 30 шт.	4
12 Пояс для датчика рекурсии дыхания индуктивного размер S –до 20 шт.	8
13 Пояс для датчика рекурсии дыхания индуктивного размер SM – до 20 шт.	8
14 Пояс для датчика рекурсии дыхания индуктивного размер M – до 20 шт.	8
15 Пояс для датчика рекурсии дыхания индуктивного размер LM – до 20 шт.	8

Изделие	Фото №
16 Пояс для датчика рекурсии дыхания индуктивного размер L – до 20 шт.	8
17 Кабель ЭКГ – до 2 шт.	6
18 Кабель биполярного отведения ЭМГ (для одноразовых электродов) – до 4 шт.	6
19 Датчик двигательной активности – до 2 шт.	7
20 Датчик проводимости КПр – до 2 шт.	6
21 Датчик потока дыхания термисторный ороназальный ДПДт-2 – до 2 шт.	7
22 Датчик храпа – до 2 шт.	7
23 Переходник биполярный – до 4 шт.	7
24 Адаптер DC входа – до 4 шт.	7
25 Адаптер для присоединения СРАР, РУ № ФСЗ 2011/10605, производства «Бребон Медикал Корпорэйшн», Канада – до 10 шт.	4
26 Адаптер для «луеровского» соединения, РУ № ФСЗ 2011/10605, производства «Бребон Медикал Корпорэйшн», Канада – до 5 упак.	2
27 Модуль беспроводной ПОЛИ-4 – 1 шт.	5
28 Чехол модуля беспроводного ПОЛИ-4 – 1 шт.	5
29 Датчик двигательной активности беспроводной – до 2 шт.	5
30 Чехол датчика двигательной активности беспроводного – до 2 шт.	5
31 Блок интерфейсный ИБ-4 – до 2 шт.	14
32 Ключ электронный ЭКПО-1М – до 2 шт.	14
33 Кабель передачи данных – до 2 шт.	14
34 Заглушка-пробник датчика потока давления – 1 шт.	2
35 Имитатор сигналов (для модуля беспроводного ПОЛИ-4) – 1 шт.	5
36 Электрод для ЭКГ одноразовый, РУ № ФСЗ 2012/12612, производства «Ковидиен Ллс», США – до 10 упак.	6
37 Инсталляционный диск с пакетом программ «АПНОКС-10» – 1 шт.	14
38 Инсталляционный диск с пакетом программ «АПНОКС-04» – 1 шт.	14






Модуль базовый


Заглушка-пробник датчика потока дыхания




Чехол модуля базового

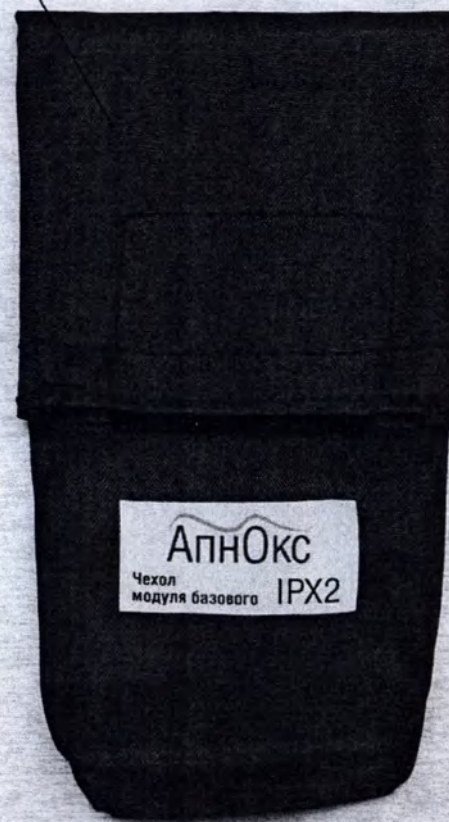

Ремень фиксирующий



Аккумулятор Ni-MH AA




Адаптер для «луеровского» соединения



Фильтр для канюли


Датчик SpO2
многоразовый RM-3227

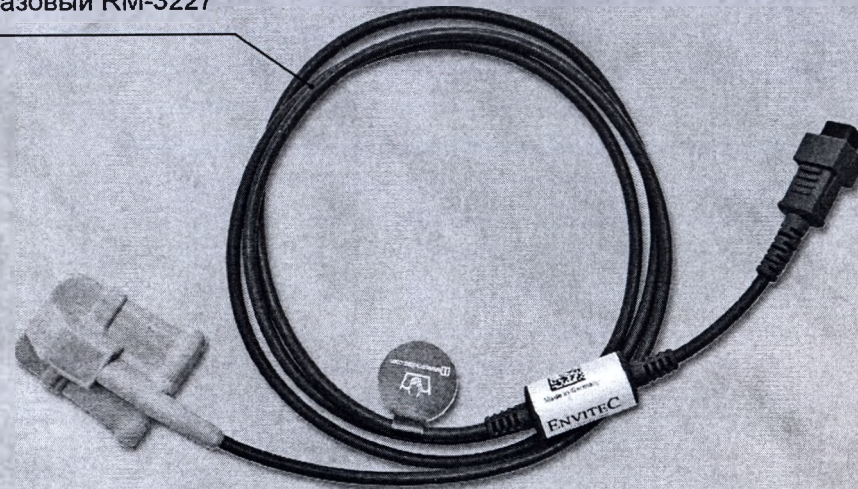


Датчик SpO2
многоразовый R-3227



Датчик SpO2
многоразовый Y-3227

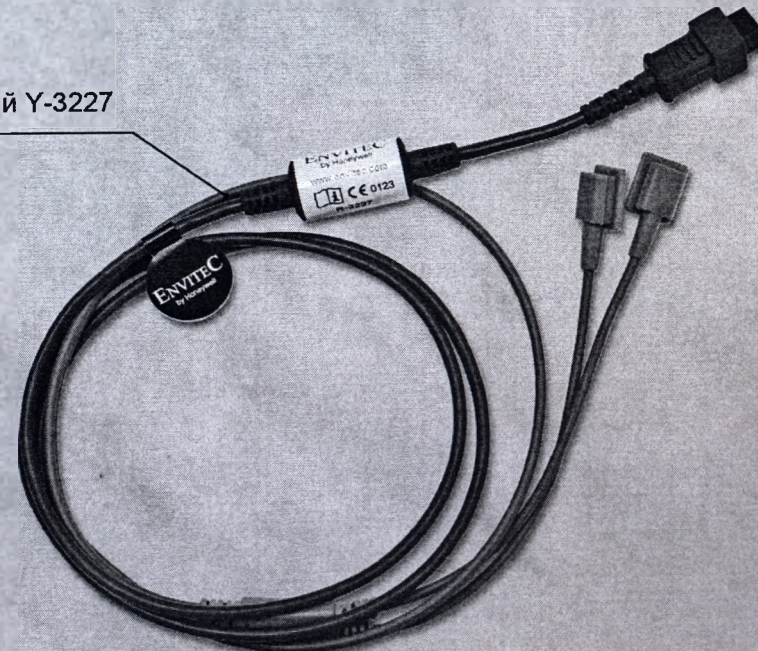

Датчик SpO2
многоразовый RS-3227

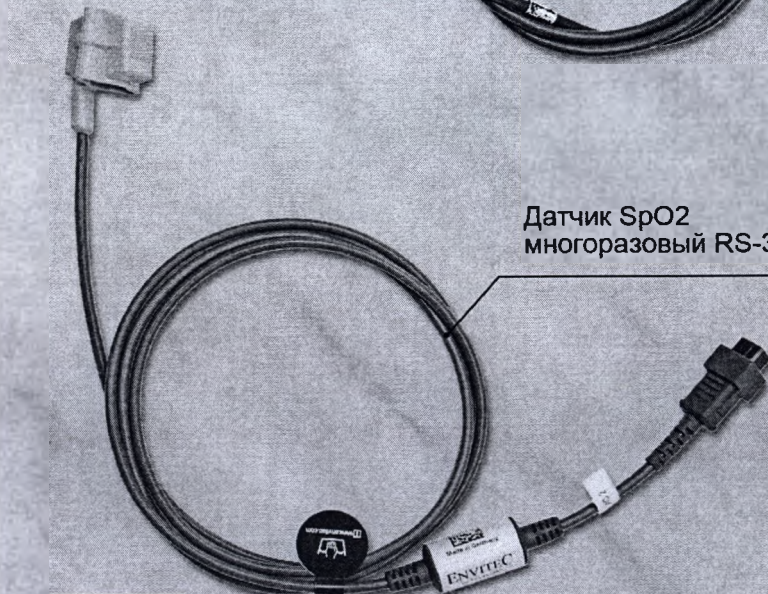

Носовая канюля
(пластиковая воздуховодная трубка)

Канюля назальная,
взрослая

Канюля назальная,
детская

Канюля назальная
с фильтром, детская

Канюля ротоносовая
с фильтром, взрослая


Канюля назальная
с фильтром, взрослая

Адаптер для присоединения CPAP

Чехол модуля
беспроводного
ПОЛИ-4




Модуль беспроводной
ПОЛИ-4

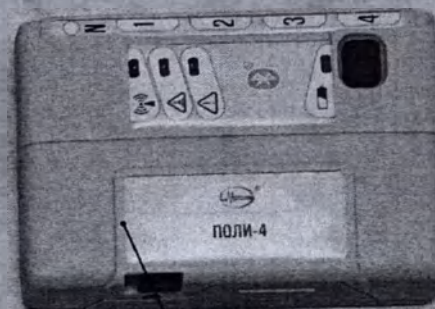


Аккумулятор
Ni-MH AAA



Датчик двигательной
активности беспроводной

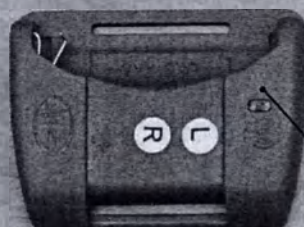


Имитатор сигналов
(для модуля беспроводного ПОЛИ-4)

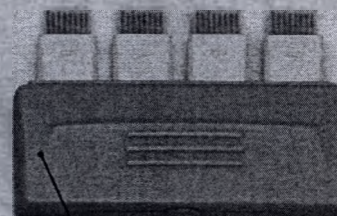


Чехол датчика двигательной
активности беспроводного




Проводник нейтрального электрода

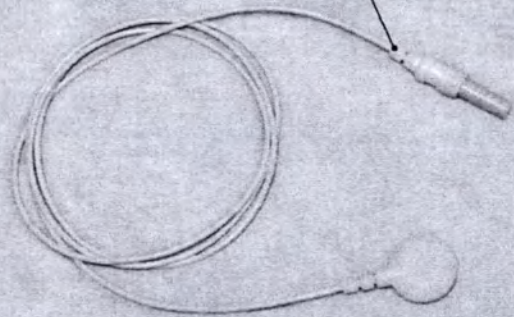


Электрод для ЭКГ одноразовый

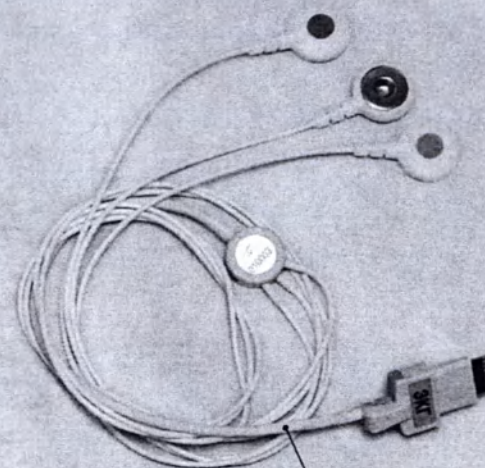

Кабель ЭКГ

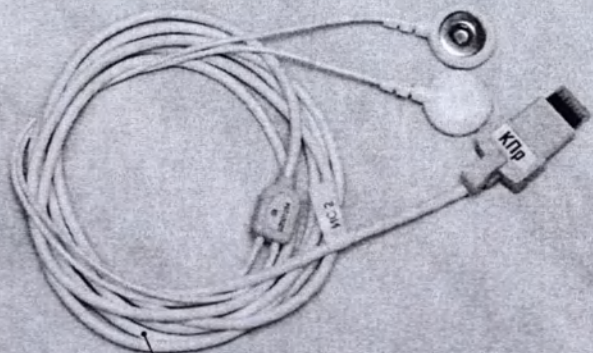

Датчик проводимости КПр

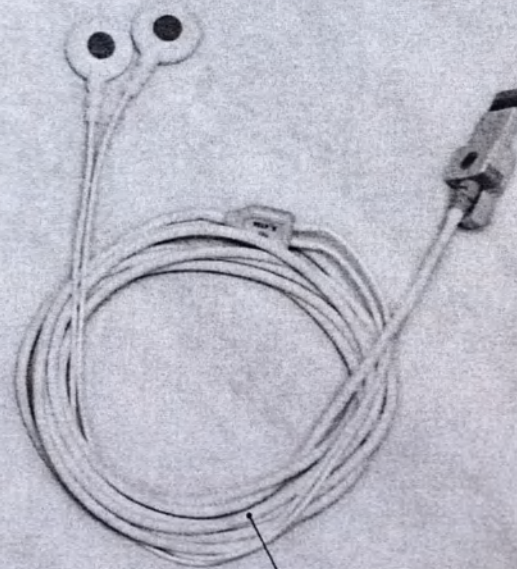

Кабель биполярного отведения ЭМГ
(для одноразовых электродов)

Фото №6

Датчик двигательной активности

Датчик рекурсии дыхания ДПГ-4М (тензорезистивный)

Переходник биполярный

Датчик храпа

Адаптер DC входа

Датчик потока дыхания термисторный ороназальный ДПДт-2

Фото №7

Пояс для датчика рекурсии дыхания индуктивного размер L

Пояс для датчика рекурсии дыхания индуктивного размер LM


Датчик рекурсии дыхания индуктивный «А»

Пояс для датчика рекурсии дыхания индуктивного размер M


Датчик рекурсии дыхания индуктивный «Т»

Пояс для датчика рекурсии дыхания индуктивного размер SM

Пояс для датчика рекурсии дыхания индуктивного размер S

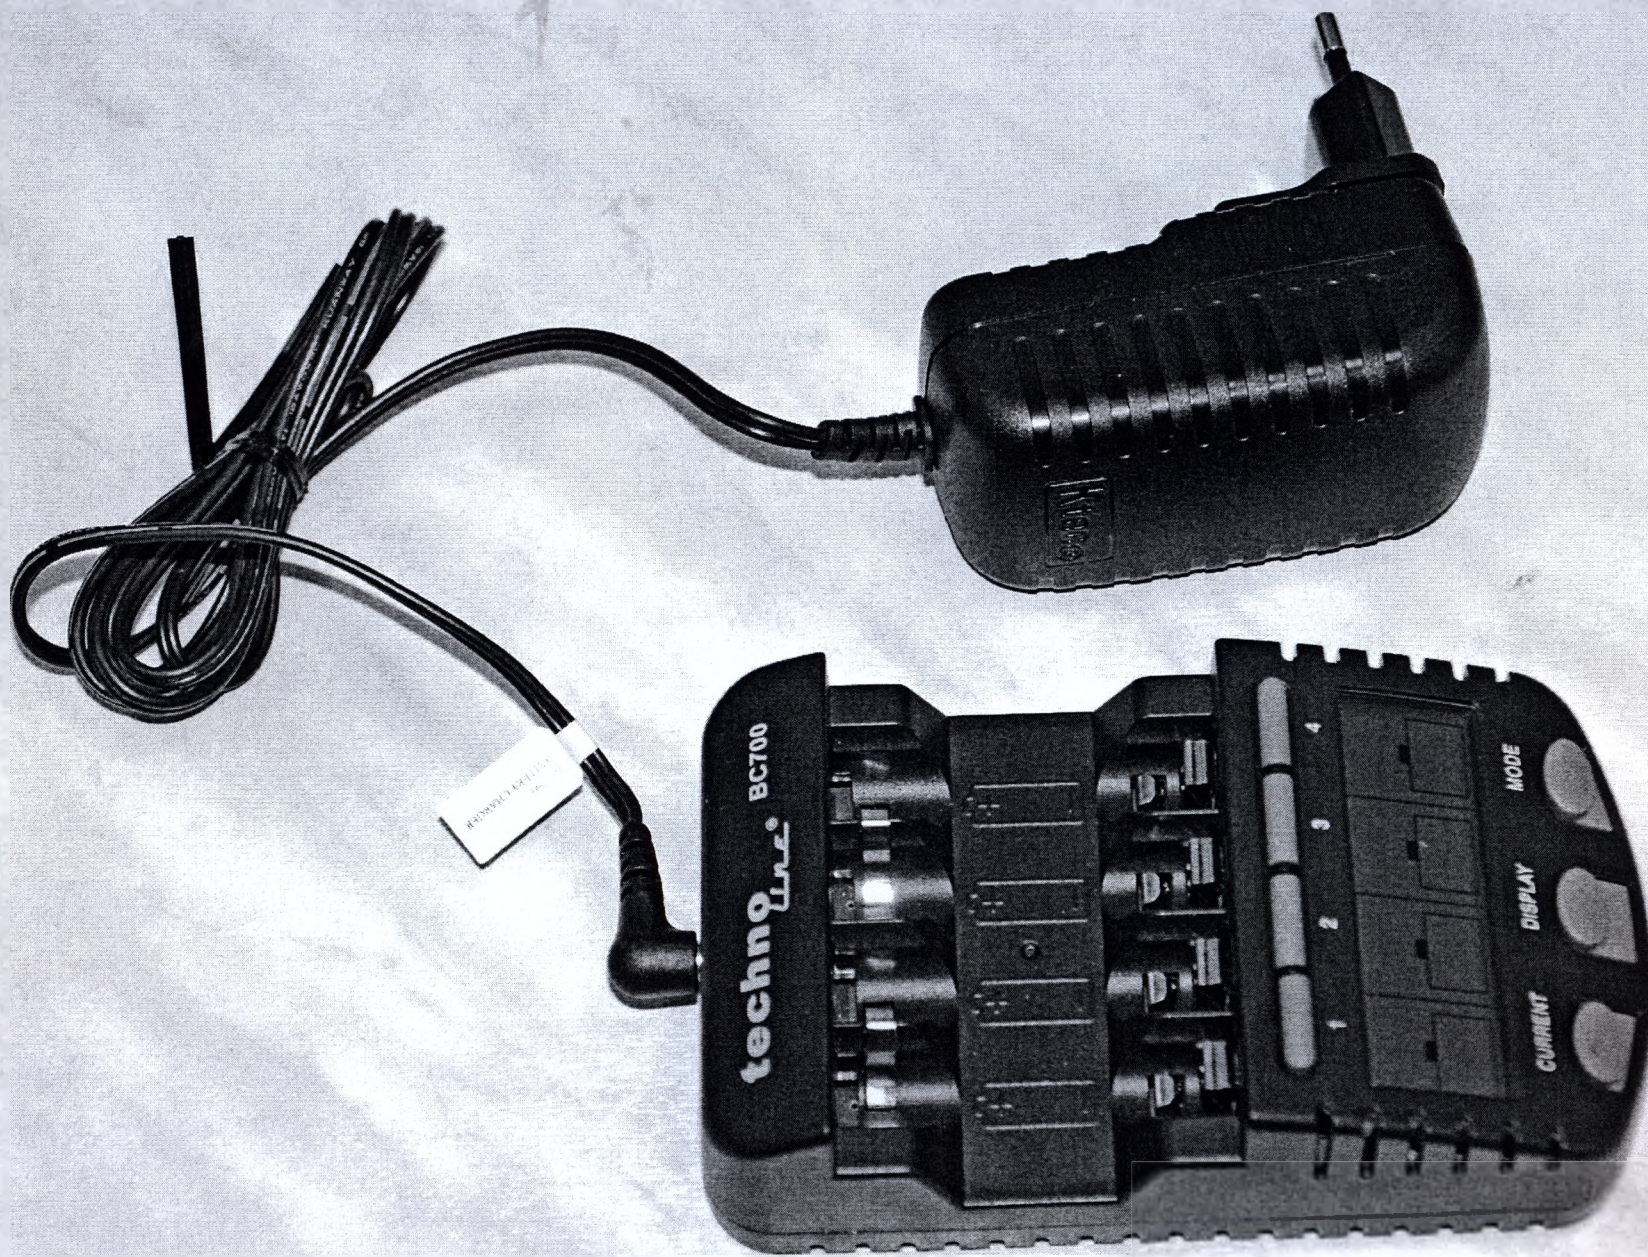

Монитор оперативного контроля по спецификации А_3680 в составе:
планшетный ПК с предустановленным ПО, блок интерфейсный ИБ-4мк

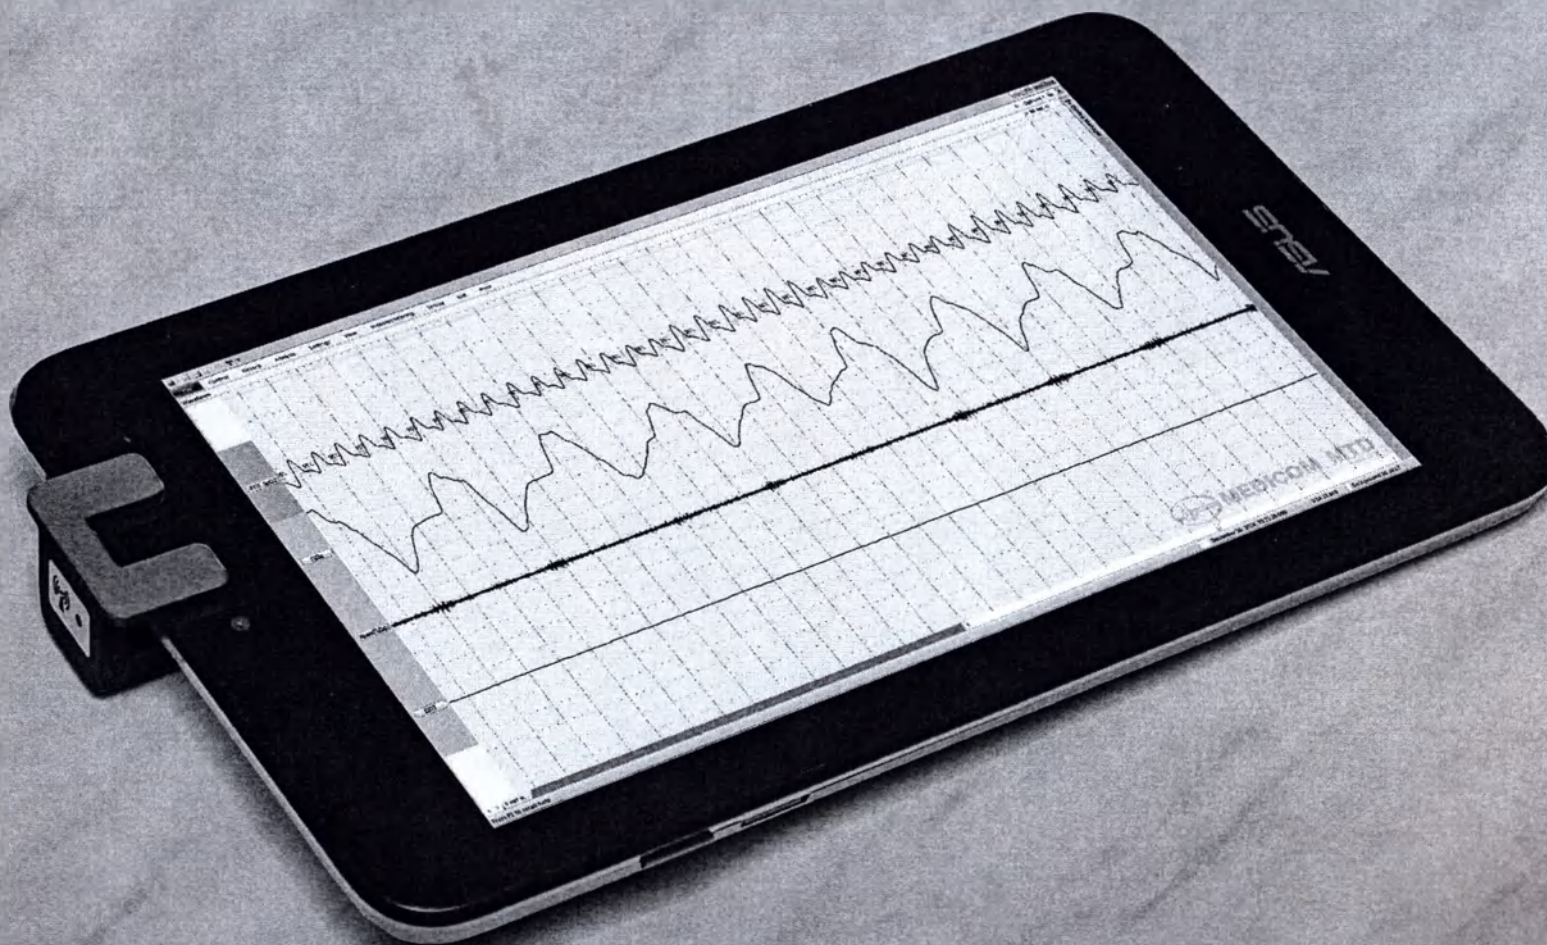

Станция
анализа сигналов
по спецификации
А_3681 в составе:
портативный
компьютер с
предустановленным ПО,
блок интерфейсный
ИБ-4



Комплект видеоборудования
по спецификации А_3682 в составе:
видеорегистратор с кабелем,
кронштейн, инжектор PoE с кабелем



Станция обработки и архивного хранения данных по спецификации А_3683 в составе:
системный блок с предустановленным ПО, клавиатура, мышь,
монитор, принтер, ключ ЭКПО-1М, кабель передачи данных.


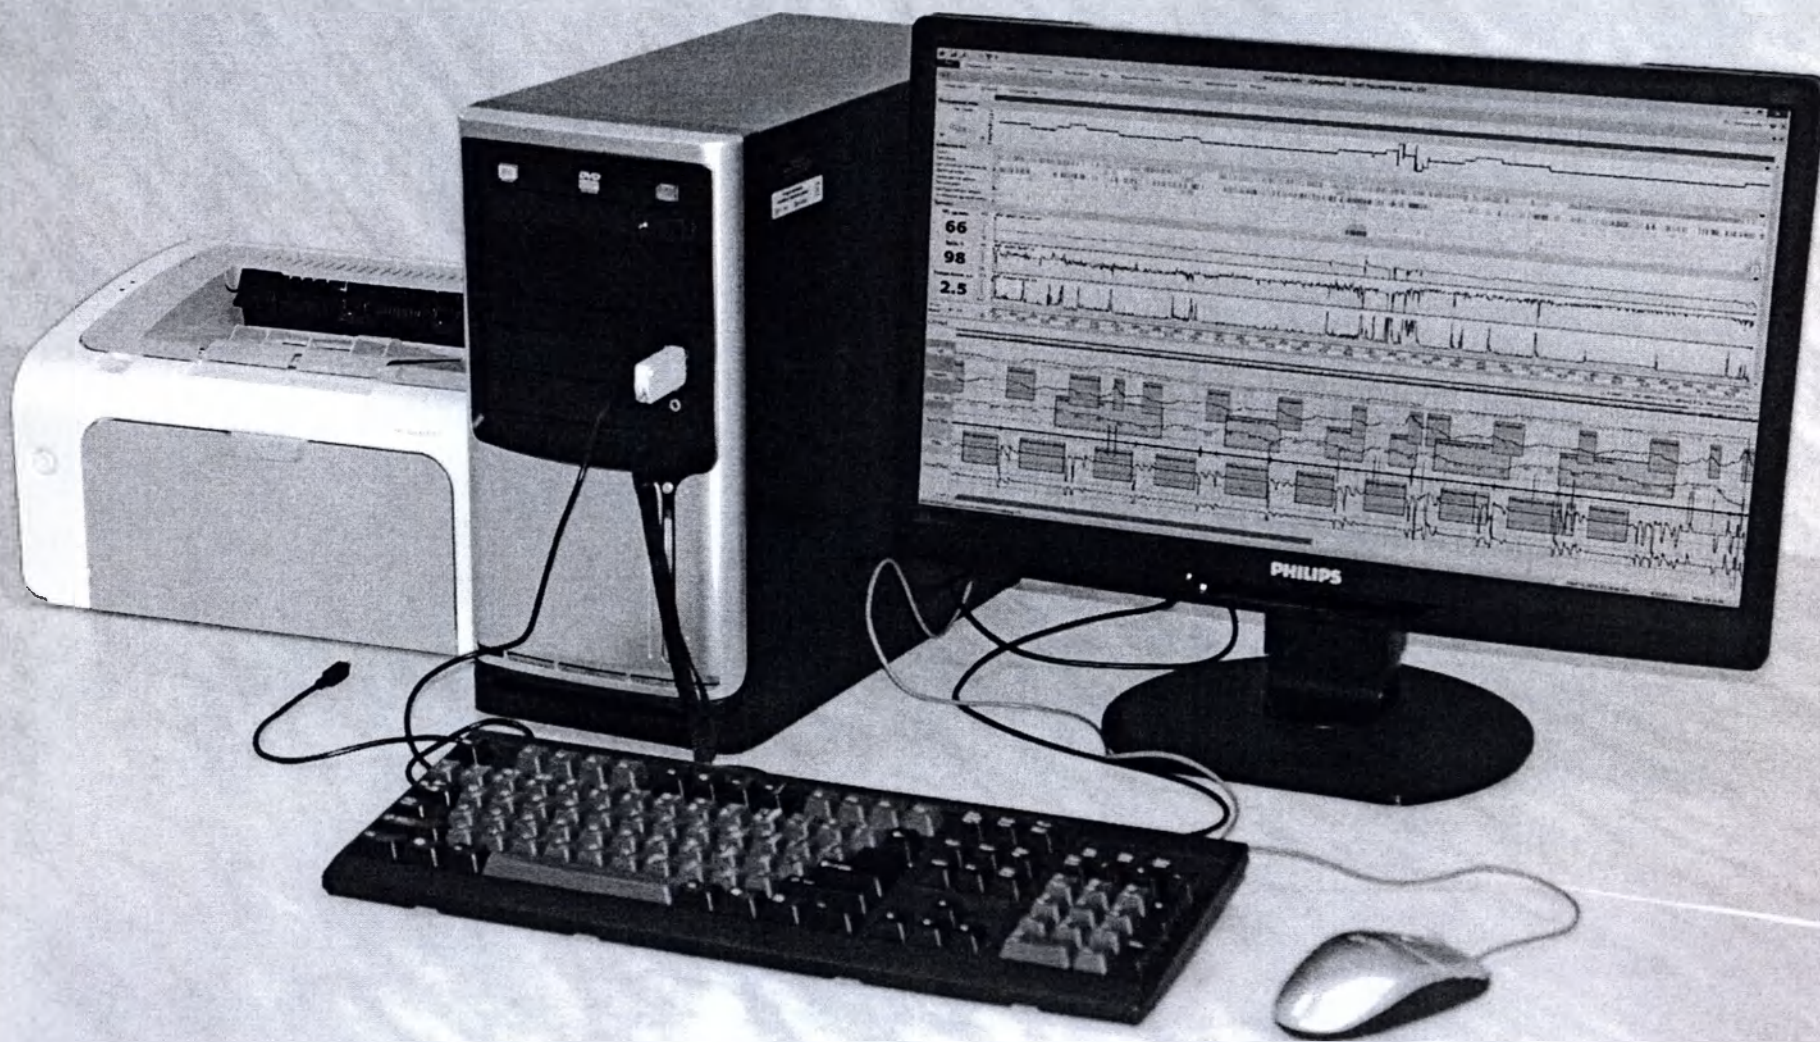


Фото №13


Блок интерфейсный ИБ-4



Кабель передачи данных

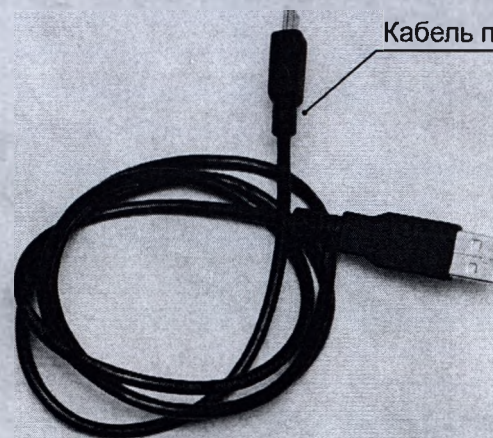

Ключ электронный ЭКПО-1М



Инсталяционный диск
с пакетом программ «АПНОКС-10»



Инсталяционный диск
с пакетом программ «АПНОКС-04»





ООО НПКФ
«Медиком МТД»

В данном шлве прошито,
пронумеровано и скреплено печатью

девятнадцать

19

листа(ов)

Генеральный
директор

Захаров С.М.

