

Подписи к фотографическим изображениям медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека кинетическим методом «АЛТ - UTS»

1. Вариант исполнения АЛТ-100
2. Вариант исполнения АЛТ-101-ЮЛ
3. Вариант исполнения АЛТ-101-ЮЛ (вид сбоку)
4. Вариант исполнения АЛТ-400
5. Вариант исполнения АЛТ-401-ЮЛ (в потребительской таре)
6. Вариант исполнения АЛТ-183-АЛ
7. Вариант исполнения АЛТ-723-АЛ.

ПАСПОРТ
Набор реагентов для определения
сыворо
«АЛТ

Сери

Наим

1. Вы

1.1. Р

1.2. Р

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора /
аланинаминотрансферазы в сыво
«АЛТ- UTS»

шен к производит
о на территории
стоверение № 4



БИОХИМИЯ

Только для диагностики **in vitro**

UTS

Набор реагентов для определения
активности аланинаминотрансферазы
в сыворотке и плазме крови человека
кинетиическим методом

«АЛТ- UTS»

Состав набора:

- Реагент 1 – 1 флакон « 80 мл
- Реагент 2 – 1 флакон « 20 мл
- Стандартная процедура, оттитровать в инструкции

Кат. № АЛТ- UTS
ТУ 6398-012-000/0015-2016
РФ ТН-ФСР 202005-004






ПАСПОРТ

Набор реагентов для определения

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора
аланинаминотрансферазы в сыворотке
методом «АЛТ-UTS»

шен к
о на те
стовер

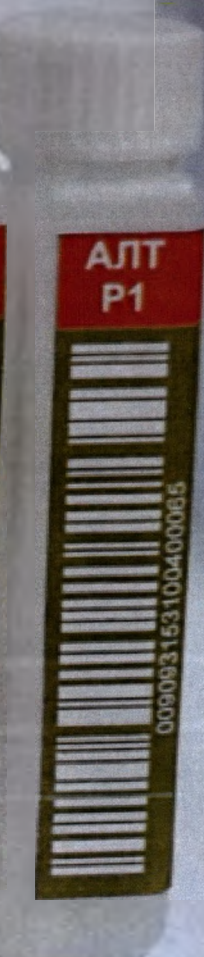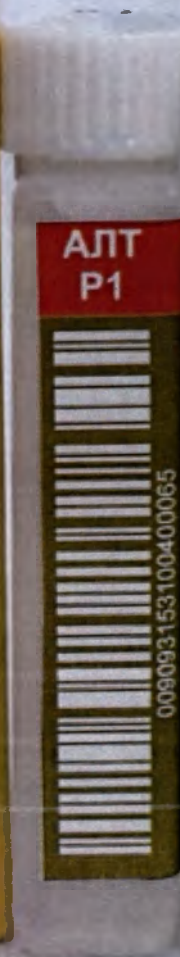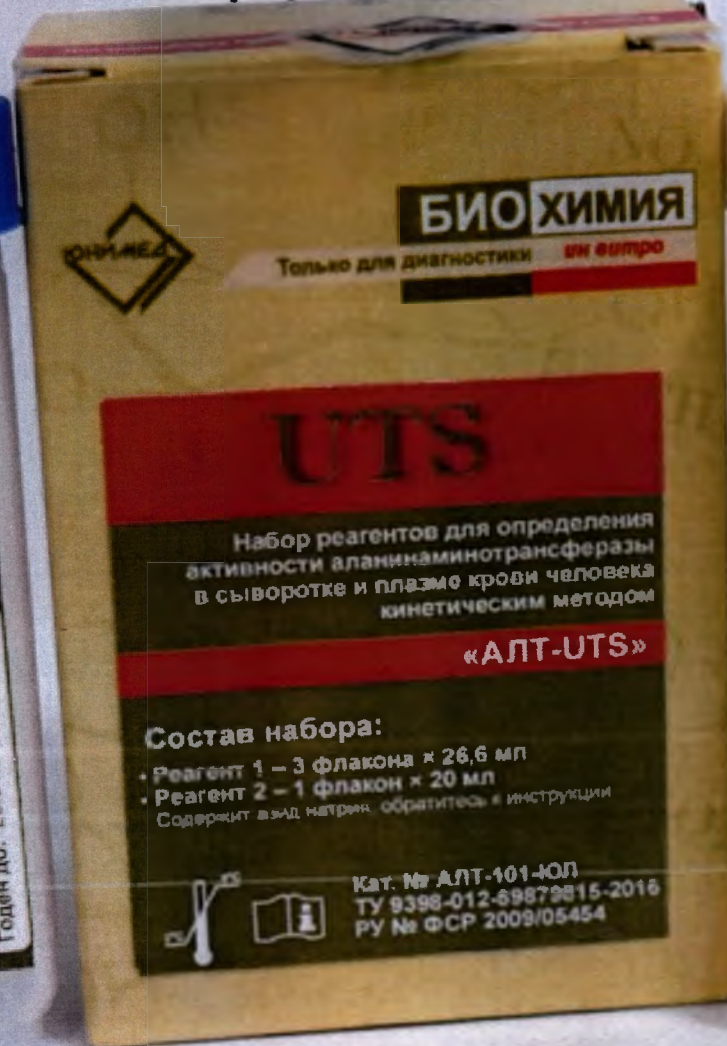

Изготовлено ООО «Эйлитон»
по заказу ЗАО «А/О Юнимед»

ЗАО «А/О Юнимед»

125201, Москва, ул. Касаткина, 2а

Тел.: (495) 734-91-31, 8-800-333-91-31

Факс: (495) 229-91-31

http://www.unimed.ru

E-mail: office@unimed.ru

Производитель ООО «Эйлитон»

141963, Московская обл., г. Дубна,

ул. Программистов, д. 4, стр. 2, пом. 20

E-mail: office@unimed.ru

АЛТ
P2



009093153100400065

«АЛТ-УТС»

АЛТ
P1



009093153100400065

«АЛТ-УТС»

«АЛТ-УТС»

Реагент 1, 26,6 мл

Дата изготовления: 26.04.2016
Серия: 010416

Гарант до: 26.04.2017

АЛТ
P1



009093153100400065

ПАСПОРТ

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека «АЛТ-УТ»

Серия 0194

Наименование

1. Внешний

Реаг

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека кинетическим методом

ов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом

ности аланинаминотранс

нагности

любог

сот





БИОХИМИЯ

Только для диагностики *in vitro*

Набор реагентов для определения
активности аланинаминотрансферазы
в сыворотке и плазме крови человека
кинетическим методом

«АЛТ-УТС»

Состав набора:

• Реагент 1 – 10 флаконов х 32 мл

• Реагент 2 – 4 флакона х 20 мл

Содержит 1 флакон ингибитора, обратитель и восстановитель



Кат. № АЛТ-401-ЮП
ТУ 9398-012-59879815-2016
РУ № ФСР 2009/05454

32
УП

ПАСПОРТ

Набор реагентов для определения
сыворотке и плазме крови человека
«АЛТ-УТС»

Серия 010416	Годен до
--------------	----------

Наименование показателей

1. Внешний вид

1.1. Реагент 1

1.2. Реагент 2

2. Т

2.1. Оптическая плотность
реагента при длине волны 340 нм
использовании кювет с
оптического пути 10 мм, ед. опт.
пределах

2.2. Чувствительность, Е/л, не бо

2.3. Изменение оптической п.
рабочего раствора реагентов п
(при длине волны 340 нм)

ИНСТРУК

по при
дл ам
ме ч к

Набор А Т
продаже м
Регистра
2009/05
ТУ 9398-012



ПАСПОРТ

Набор реагентов для определения активности аланина в сыворотке и плазме крови человека «АЛТ-UTS»

010416

Годен до

показателей

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для определения активности аланина в сыворотке и плазме крови человека к «АЛТ - UTS»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Набор реагентов для определения активности аланина в плазме крови человека кинетическим методом, определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом для *in vitro* диагностики. Область применения – клиническая лабораторная диагностика. Назначенный пользователь – сотрудник соответствующую профессиональную деятельность. Аланинаминотрансфераза (АЛТ) – внутриклеточный фермент, который содержится в печени и почках, а также в других тканях. Издается как показатель повреждения печени.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА

набора и их состав:



Только для д

Набор реагентов для определения активности аланина в сыворотке и плазме крови человека «АЛТ-UTS»

Состав набора:
- Реагент 1 – 12 флаконов
- Реагент 2 – 8 флаконов
Содержит азид натрия, опасен при нагревании.

Ка
ту
ру

«АЛТ-UTS»

Реагент 1, 48 мл

Дата изготовления: 28.08.2014
Серия: 310416
Годен до: 28.08.2017

ЗНИЛОН

АЛТ
P1

АЛТ
P2

АЛТ
P2

АЛТ
P2

«АЛТ-UTS»

Реагент 2, 18 мл

АЛТ
P2

АЛТ
P2

«АЛТ-UTS»

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью Лист
Генеральный директор УК
А.Н. Нибанов

