


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

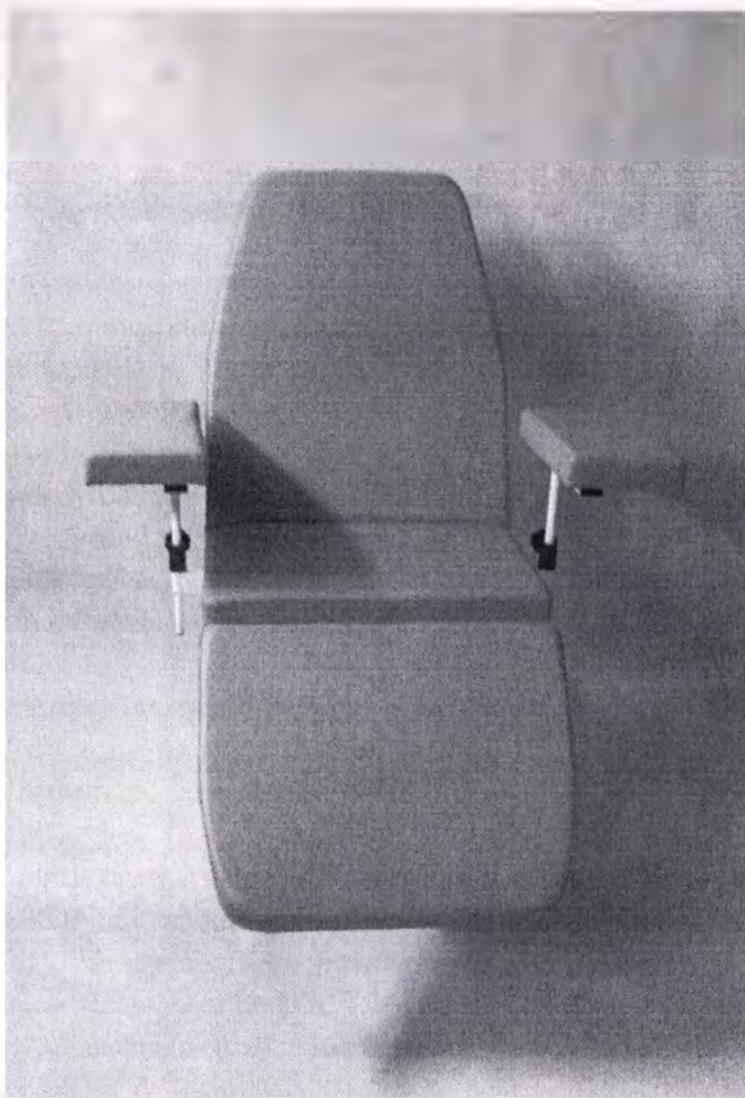

Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-1"

ООО «СТИЛЬМЕД»

Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-1"

1. Назначение:

Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-1" с принадлежностями, в составе предназначено для поддержания и расположения пациента в сидячем или наклонном положении с целью обеспечения его удобного положения и более легкого к нему доступа во время общедиagnostического обследования, консервативного лечения и/или хирургической процедуры. Имеет регулируемые по высоте, направлению и углу наклона части. Изменения производятся посредством механического привода в том числе и для более удобной работы медицинского персонала во время проведения осмотров и процедур в кабинетах и лабораториях клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений

2. Устройство и технические характеристики:

2.1. Для изготовления каркаса кресла, штатива для вливаний, полотенцедержателя, подлокотников, подголовника и подушки - валика применять следующие материалы:

- трубы квадратные сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8639, ГОСТ Р 54157 - 20x20x1.5 мм ; 15x15x1.5 мм.,
- трубы прямоугольные сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8645 - 40x20x2.0 мм, ГОСТ Р 54157 - 40x20x1.5 мм. ;
- труба черная круглая сталь марки СтЗсп по ГОСТ 10704-91 – d 16*1.5; d 20*1.5
- труба нержавеющая квадратная сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8639 - 20x20x1.5 мм ; 15x15x1.5 мм.;
- труба нержавеющая прямоугольная сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8645 - 40x20x2.0 мм;
- труба нержавеющая круглая сталь марки СтЗсп по ГОСТ 11068 - d 16*1.5; d 20*1.5
- лакокрасочные покрытия – краска порошковая эпоксидно – полиэфирная, белая марка «MICROPUL» производитель «MICROPUL BOYA KIMYA SUN. VE TIC LTD STI» (Турция), Экспертное заключение рег. Номер 12-04-613 от 10.04.2012;
- фанера ФСФ, Ш2 - 9 мм по ГОСТ 3916.1;
- пенополиуретан эластичный «Элаблук» марки ST 3040 производитель ООО «Европласт» (Россия) по ТУ 2254-001-70465083-2009;

При изготовлении кресла используется Клей мебельный Purtex Plus - изготовитель Universal Yapistirici Kimya, производства Турция (Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.06.01.008.Е.001253.03.13 от 27.03.2013 года).

Внешние поверхности обтягиваются материалом искусственной кожей марки SKADEN B353/AS, производства фабрики «SANWIL» Польша.

Материал изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (ДС ТР ТС 017/2011 Рег.номер RU Д-PL АУ 37.В.04123 выдано 30.01.15) и имеет следующие технологические характеристики:

- 1) масса, г/м² ≥ 450;
- 2) толщина, мм 0,9 ± 0,2
- 3) состав:
 - покрытие ПВХ 100%

- основа Полиэфир 100%

4) не содержит кадмия, не содержит азокрасителей, согласно директиве Комиссии 2004/21/ЕК от 24.02.2004 (в отношении ограничений допуска на рынок и применения азокрасителей)

Материал водонепроницаемый и устойчив к появлению царапин, устойчив к чистке и дезинфекции. Материал Skaden B353/AS благодаря тиснению и огнестойкости используют как обивку стоматологических и процедурных кресел, больничных коек, массажных столов.

- «барашек-фиксатор» - используется марка материала АБС-пластик 1030, цвет черный, краситель производства Компания Karl Finke GmbH & Co.KG, Германия (Финке Колорс) марка FIBAPLAST с впаянной резьбовой шпилькой.

- ступенчатый механизм «Multiflex» (производство franko Franke GmbH & Co.KG).

- ступенчатый механизм «Rostomat» (производство franko Franke GmbH & Co.KG

- при изготовлении Штатива используется - труба нержавеющей круглая сталь марки AISI 304 по ГОСТ 11068 - d 16*1.5; d 20*1.5

либо труба черная круглая сталь марки СтЗсп по ГОСТ 10704-91 – d 16*1.5; d 20*1.5;

- при изготовления полотенцедержателя используется труба нержавеющей круглая сталь марки AISI 304 по ГОСТ 11068 - d 16*1.5;

- колеса с тормозом – модель C-1700-MTB-100-A18, производство NGWAY, Китай

-регулируемые опоры (ножки) – используется марка материала АБС-пластик 1030, цвет черный, краситель производства Компания Karl Finke GmbH & Co.KG, Германия (Финке Колорс) марка FIBAPLAST с впаянной резьбовой шпилькой.

- при изготовлении подушки – валика используется резинка производства ООО «ФИ-ТЕКС», г. Москва, ул. Кусковская д.20А. Резинка (единичная латексная (Cariflex IR0307 KU) нить (0,8-1,0) мм в текстильной оплётке – нить 8,4 текс из полиамида марки (РА 6), черная) ширина 35 мм, по ТУ 8151-00159722763-2004

2.2 Регулировка подлокотников осуществляется за счет «барашка-фиксатора».

Технические характеристики:

Наименование	Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-1"
Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	180
Допустимая нагрузка на элементы трансформации	60
Секция спина, не более, кг	30
Секция ноги, не более, кг	
Габариты в стационарном положении:	
длина, не более, мм	1800
ширина, не более, мм	1200

ширина сидения, не более, мм	800
Высота сидения над полом, мм	600+-20
Высота фиксированная без подголовника, не более, мм	1400
угол наклона секции спина, в пределах, °	от 0 до 80
угол наклона секции ноги, в пределах, °	минус 40 до 10
вес изделия, не более, кг	40
Конструктивные геометрические параметры:	
Каркас кресла	- трубы квадратные сталь марки Ст3сп по ГОСТ 8639, ГОСТ Р 54157 - 20x20x1.5 мм ; 15x15x1.5 мм., - трубы прямоугольные сталь марки Ст3сп по ГОСТ 8645 - 40x20x2.0 мм, ГОСТ Р 54157 - 40x20x1.5 мм. ; - труба черная круглая сталь марки Ст3сп по ГОСТ 10704-91 – d 16*1.5; d 20*1.5 - труба нержавеющая квадратная сталь марки Ст3сп по ГОСТ 8639 - 20x20x1.5 мм ; 15x15x1.5 мм.; - труба нержавеющая прямоугольная сталь марки Ст3сп по ГОСТ 8645 - 40x20x2.0 мм; - труба нержавеющая круглая сталь марки Ст3сп по ГОСТ 11068 - d 16*1.5; d 20*1.5 - лакокрасочные покрытия – краска порошковая эпоксидно – полиэфирная, белая марка «MICROPUL» производитель «MICROPUL BOYA KIMYA SUN. VE TIC LTD STI» (Турция), Экспертное заключение рег. Номер 12-04-613 от 10.04.2012; - фанера ФСФ, Ш2 - 9 мм по ГОСТ 3916.1;
Температура поверхности кресла	Не превышает температуры окружающей среды
Состав кресла	
Подлокотник широкий	470*200 мм
Регулируемые опоры (ножки)	АБС пластик 1030 с резьбовой шпилькой
Барашки – фиксаторы	АБС пластик 1030 с резьбовой шпилькой

3. Вариант исполнения (комплектация).

Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-1" с принадлежностями, в составе:

1. кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС".
2. подлокотники широкие - 2 шт.
3. регулируемые опоры (ножки) - 4 шт.
4. барашки – фиксаторы – 2 шт.

Принадлежности:

1. инструкция по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.
2. упаковка – 1 шт.

4. Подготовка к работе

Перед использованием изделия необходимо:

- выдержать кресло при комнатной температуре не менее 6 часов, если кресло хранилось или транспортировалось при отрицательной температуре;
- установить кресло на место и убедиться в его устойчивости. Для этого с помощью регулируемых опор (ножек), расположенных в нижней части кресла, выкручивая их, выставить кресло в устойчивое положение. Регулируемые опоры помогают исправить неровности пола.

5. Инструкция по эксплуатации:

Регулировка секции спина осуществляется за счет ступенчатого механизма «Multiflex» или «Rastomat» для более удобного положения пациента и работы врача, при проведении медицинских процедур. Регулировка происходит вручную в диапазоне угла наклона (от 0° до 80°).

Для того чтобы отрегулировать угол наклона спинной секции необходимо, поднимая вручную спинку от горизонтального положения в вертикальное, зафиксировать ее в нужном положении. Каждое положение сопровождается характерным щелчком, который означает, что механизм занял следующее положение. Если необходимо вернуть спинку в положение, ниже установленного, или в горизонтальное, нужно поднять ее до максимума и затем опустить до горизонта, после чего выставить нужное положение.


Регулировка секции ноги осуществляется за счет ступенчатого механизма «Rastomat» или «Multiflex» для более удобного положения пациента. Регулировка происходит вручную в диапазоне угла наклона (от минус 40° до плюс 10°).

Для того чтобы отрегулировать угол наклона ножной секции необходимо, поднимая секцию вручную зафиксировать ее в нужном положении. Каждое положение сопровождается характерным щелчком, который означает, что механизм занял следующее положение. Если необходимо вернуть ножную секцию в положение, ниже установленного, нужно поднять ее до максимума и затем опустить, после чего выставить нужное положение.

Регулировка подлокотников осуществляется за счет «барашка-фиксатора» для более удобного положения рук пациента. Регулировка происходит вручную.

Для того чтобы отрегулировать положение подлокотников необходимо, повернуть «барашек-фиксатор», находящийся с двух сторон на боковой части кресла, против часовой стрелки и выдвинуть подлокотник вверх на необходимую высоту, после чего повернуть «барашек-фиксатор» по часовой стрелке и зафиксировать подлокотник. Вращаются подлокотники и в зафиксированном положении. Для последующего изменения положения подлокотников по высоте проделать те же операции.

Принципиальная схема (рисунок) работы кресла в сборе

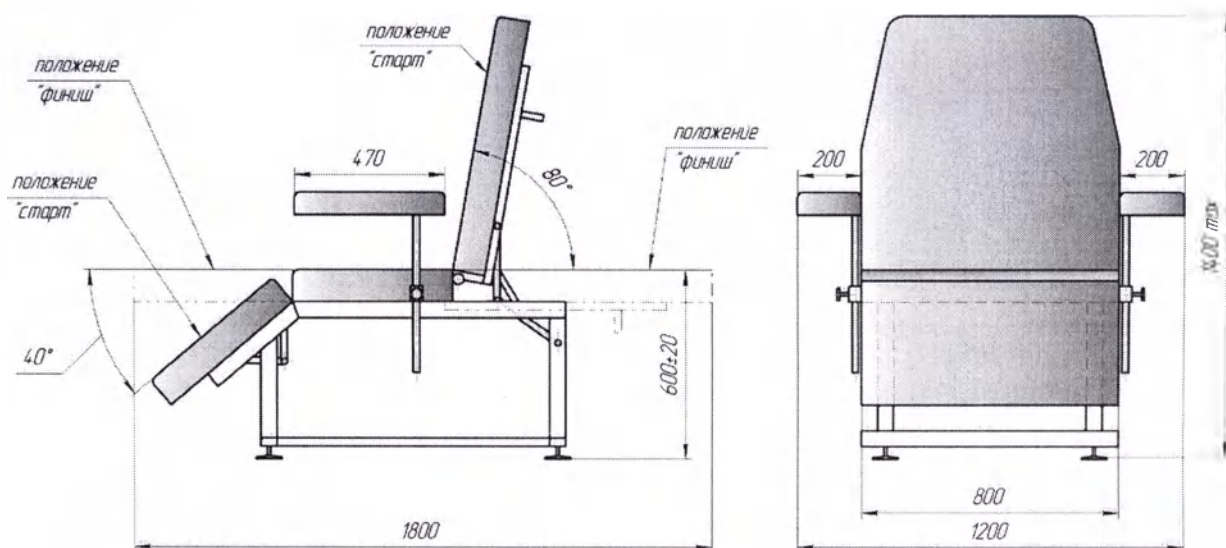

6. Меры предосторожности при работе с креслом

6.1 Перед использованием кресла необходимо убедиться в его устойчивости.

6.2 Запрещается использовать неисправное изделие и вносить изменения в конструкцию изделия.

При несоблюдении вышеперечисленных требований производитель не несет ответственности за возможные последствия.

7. Дезинфекция кресла

7.1. Дезинфекцию кресла проводить средством «Биоцидол-экспресс» представляющим собой готовую к применению прозрачную бесцветную жидкость. Содержание в составе в качестве действующих веществ: пропан-2-ол – 30 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) – 0,25%, полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид — 0,25%, неионогенный ПАВ, ингибитор коррозии, ароматизатор, pH средства – 7,0.

Применяется для обеззараживания способами орошения и протирания небольших по площади, а также труднодоступных для обработки поверхностей из различных материалов, за исключением портящихся от воздействия спиртов (органическое стекло, поверхности, окрашенные спирторастворимым лаком).

Свидетельство о государственной регистрации № RU 77.99.88.002.Е002097.03.14 от 27.03.2014 выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Возможно применение аналогичных дезинфицирующих средств.

7.2 Не использовать абразивные средства и растворители.

8. Противопоказания

Отсутствуют при использовании в соответствии с назначением к применению

9. Побочные действия.

Изделие не используется как лечебное медицинское изделие. Побочные эффекты не выявлены.

10. Техническое обслуживание

Не реже чем 1 раз в месяц необходимо проверять надежность затяжки резьбовых соединений.

11. Условия хранения, транспортирования и эксплуатации

11.1. Кресло хранят и транспортируют в собранном виде в недоступном для детей чистом, сухом, месте в упаковке производителя при температуре окружающего воздуха от -50°C до +50°C и относительной влажности 80%. Допускается перевозить кресла любым видом транспорта при соблюдении правил транспортирования.

11.2 Кресло эксплуатируется при температуре окружающей среды + 10°C до + 35°C при относительной влажности до 80% при 25°C.

11.3 Изделие не должно подвергаться ударным воздействиям, а также воздействию атмосферных осадков и агрессивных сред.

11.4 Нагрузка на трансформируемые элементы изделия не должна превышать 50 кг.

12. Гарантийные обязательства

12.1. Предприятие изготовитель ООО «Стильмед» 115580, Москва, ул. Кустанайская, д. 6, к. 2, кв. 59, гарантирует надежную работу Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-1" заявленным свойствам в течение 12 месяцев с даты продажи, при условии соблюдения правил хранения, применения, обслуживания и транспортирования.

Срок службы – 6 лет с даты изготовления, указанной на упаковке, или даты продажи.

12.2 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при наличии механических повреждений изделия;
- при не соблюдении правил, установленных разделами 6, 7, 9 настоящего паспорта;
- при отсутствии паспорта изделия или при его неправильном заполнении.

12.3 Техническое обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт кресла осуществляет предприятие изготовитель ООО «Стильмед».

Претензии на качество изделия принимает ООО «Стильмед» - почтовый адрес: 115580, Москва, ул. Кустанайская, д. 6, к. 2, кв. 59. Претензии и предложения принимаются по тел. (499) 703-03-80; E-mail: stylemed@mail.

www.meddizain.ru

13. Утилизация изделия:

Упаковку утилизируют в места сбора бытового мусора.

По истечении срока службы кресло подлежит утилизации в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», как отходы класса А.

Дата выпуска

Дата продажи

М.П.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 1 листов
Подпись Александр



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)



Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-2"

ООО «СТИЛЬМЕД»

Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-2"

1. Назначение:

Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-2" с принадлежностями, в составе предназначено для поддержания и расположения пациента в сидячем или наклонном положении с целью обеспечения его удобного положения и более легкого к нему доступа во время общедиagnostического обследования, консервативного лечения и/или хирургической процедуры. Имеет регулируемые по высоте, направлению и углу наклона части. Изменения производятся посредством механического привода в том числе и для более удобной работы медицинского персонала во время проведения осмотров и процедур в кабинетах и лабораториях клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений

2. Устройство и технические характеристики:

2.1. Для изготовления каркаса кресла, штатива для вливаний, полотенцедержателя, подлокотников, подголовника и подушки - валика применять следующие материалы:

- трубы квадратные сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8639, ГОСТ Р 54157 - 20x20x1.5 мм ; 15x15x1.5 мм.,
- трубы прямоугольные сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8645 - 40x20x2.0 мм, ГОСТ Р 54157 - 40x20x1.5 мм. ;
- труба черная круглая сталь марки СтЗсп по ГОСТ 10704-91 – d 16*1.5; d 20*1.5
- труба нержавеющая квадратная сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8639 - 20x20x1.5 мм ; 15x15x1.5 мм.;
- труба нержавеющая прямоугольная сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8645 - 40x20x2.0 мм;
- труба нержавеющая круглая сталь марки СтЗсп по ГОСТ 11068 - d 16*1.5; d 20*1.5
- лакокрасочные покрытия – краска порошковая эпоксидно – полиэфирная, белая марка «MICROPUL» производитель «MICROPUL BOYA KIMYA SUN. VE TIC LTD STI» (Турция), Экспертное заключение рег. Номер 12-04-613 от 10.04.2012;
- фанера ФСФ, Ш2 - 9 мм по ГОСТ 3916.1;
- пенополиуретан эластичный «Элаблок» марки ST 3040 производитель ООО «Европласт» (Россия) по ТУ 2254-001-70465083-2009;

При изготовлении кресла используется Клей мебельный Purtex Plus - изготовитель Universal Yapistirici Kimya, производства Турция (Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.06.01.008.Е.001253.03.13 от 27.03.2013 года).

Внешние поверхности обтягиваются материалом искусственной кожей марки SKADEN B353/AS, производства фабрики «SANWIL» Польша.

Материал изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (ДС ТР ТС 017/2011 Рег.номер RU Д-PL АУ 37.В.04123 выдано 30.01.15) и имеет следующие технологические характеристики:

- 1) масса, г/м² ≥ 450 ;
- 2) толщина, мм $0,9 \pm 0,2$
- 3) состав:
 - покрытие ПВХ 100%
 - основа Полиэфир 100%

4) не содержит кадмия, не содержит азокрасителей, согласно директиве Комиссии 2004/21/ЕК от 24.02.2004 (в отношении ограничений допуска на рынок и применения азокрасителей)

Материал водонепроницаемый и устойчив к появлению царапин, устойчив к чистке и дезинфекции. Материал Skaden B353/AS благодаря тиснению и огнестойкости используют как обивку стоматологических и процедурных кресел, больничных коек, массажных столов.

- «барашек-фиксатор» - используется марка материала АБС-пластик 1030, цвет черный, краситель производства Компания Karl Finke GmbH & Co.KG, Германия (Финке Колорс) марка FIBAPLAST с впаянной резьбовой шпилькой.

- ступенчатый механизм «Multiflex» (производство franko Franke GmbH & Co.KG).

- ступенчатый механизм «Rostomat» (производство franko Franke GmbH & Co.KG

- при изготовлении Штатива используется - труба нержавеющей круглая сталь марки AISI 304 по ГОСТ 11068 - d 16*1.5; d 20*1.5

либо труба черная круглая сталь марки СтЗсп по ГОСТ 10704-91 – d 16*1.5; d 20*1.5;

- при изготовлении полотенцедержателя используется труба нержавеющей круглая сталь марки AISI 304 по ГОСТ 11068 - d 16*1.5;

- колеса с тормозом – модель C-1700-MTB-100-A18, производство NGWAY, Китай

-регулируемые опоры (ножки) – используется марка материала АБС-пластик 1030, цвет черный, краситель производства Компания Karl Finke GmbH & Co.KG, Германия (Финке Колорс) марка FIBAPLAST с впаянной резьбовой шпилькой.

- при изготовлении подушки – валика используется резинка производства ООО «ФИ-ТЕКС», г. Москва, ул. Кусковская д.20А. Резинка (единичная латексная (Cariflex IR0307 KU) нить (0,8-1,0) мм в текстильной оплётке – нить 8,4 текс из полиамида марки (РА 6), черная) ширина 35 мм, по ТУ 8151-00159722763-2004

2.2 Регулировка подлокотников осуществляется за счет «барашка-фиксатора».

2.3 Положение подушки – валика относительно положения головы пациента регулируется при помощи фиксирующей резинки.

Технические характеристики:

Наименование	Кресло пациента процедурно-моторное "МД-КПС-2"
Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	180
Допустимая нагрузка на элементы трансформации	60
Секция спина, не более, кг	30
Секция ноги, не более, кг	
Габариты в стационарном положении:	
длина, не более, мм	1800

ширина, не более, мм	1200
ширина сидения, не более, мм	800
Высота сидения над полом, мм	600+-20
Высота фиксированная без подголовника, не более, мм	1400
угол наклона секции спина, в пределах, °	от 0 до 80
угол наклона секции ноги, в пределах, °	от минус 40 до 10
вес изделия, не более, кг	40
Конструктивные геометрические параметры:	
Каркас кресла	- трубы квадратные сталь марки Ст3сп по ГОСТ 8639, ГОСТ Р 54157 - 20x20x1.5 мм ; 15x15x1.5 мм., - трубы прямоугольные сталь марки Ст3сп по ГОСТ 8645 - 40x20x2.0 мм, ГОСТ Р 54157 - 40x20x1.5 мм. ; - труба черная круглая сталь марки Ст3сп по ГОСТ 10704-91 – d 16*1.5; d 20*1.5 - труба нержавеющая квадратная сталь марки Ст3сп по ГОСТ 8639 - 20x20x1.5 мм ; 15x15x1.5 мм.; - труба нержавеющая прямоугольная сталь марки Ст3сп по ГОСТ 8645 - 40x20x2.0 мм; - труба нержавеющая круглая сталь марки Ст3сп по ГОСТ 11068 - d 16*1.5; d 20*1.5 - лакокрасочные покрытия – краска порошковая эпоксидно – полиэфирная, белая марка «MICROPUL» производитель «MICROPUL BOYA KIMYA SUN. VE TIC LTD STI» (Турция), Экспертное заключение рег. Номер 12-04-613 от 10.04.2012; - фанера ФСФ, Ш2 - 9 мм по ГОСТ 3916.1;
Температура поверхности кресла	Не превышает температуры окружающей среды
Состав кресла	
Подлокотники широкие	470*200 мм
Регулируемые опоры (ножки)	АБС пластик 1030 с резьбовой шпилькой
Барашки – фиксаторы	АБС пластик 1030 с резьбовой шпилькой
Подушка-валик под голову	28 см. X 10 см. D 20 см

3. Вариант исполнения (комплектация)

Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-2" с принадлежностями, в составе:

1. кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС".
2. подлокотники широкие - 2 шт.
3. регулируемые опоры (ножки) - 4 шт.
4. барашки – фиксаторы – 2 шт.
5. подушка-валик под голову - 1 шт.

Принадлежности:

1. инструкция по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.
2. упаковка – 1 шт.

4. Подготовка к работе

Перед использованием изделия необходимо:

- выдержать кресло при комнатной температуре не менее 6 часов, если кресло хранилось или транспортировалось при отрицательной температуре;
- установить кресло на место и убедиться в его устойчивости. Для этого с помощью регулируемых опор (ножек), расположенных в нижней части кресла, выкручивая их, выставить кресло в устойчивое положение. Регулируемые опоры помогают исправить неровности пола.

5. Инструкция по эксплуатации:

Регулировка секции спина осуществляется за счет ступенчатого механизма «Multiflex» или «Rastomat» для более удобного положения пациента и работы врача, при проведении медицинских процедур. Регулировка происходит вручную в диапазоне угла наклона (от 0° до 80°).

Для того чтобы отрегулировать угол наклона спинной секции необходимо, поднимая ручную спинку от горизонтального положения в вертикальное, зафиксировать ее в нужном положении. Каждое положение сопровождается характерным щелчком, который означает, что механизм занял следующее положение. Если необходимо вернуть спинку в положение, ниже установленного, или в горизонтальное, нужно поднять ее до максимума и затем опустить до горизонта, после чего выставить нужное положение.

Регулировка секции ноги осуществляется за счет ступенчатого механизма «Rastomat» или «Multiflex» для более удобного положения пациента. Регулировка происходит вручную в диапазоне угла наклона (от минус 40° до плюс 10°).


Для того чтобы отрегулировать угол наклона ножной секции необходимо, поднимая секцию вручную зафиксировать ее в нужном положении. Каждое положение сопровождается характерным щелчком, который означает, что механизм занял следующее положение. Если необходимо вернуть ножную секцию в положение, ниже установленного, нужно поднять ее до максимума и затем опустить, после чего выставить нужное положение.

Регулировка подлокотников осуществляется за счет «барашка-фиксатора» для более удобного положения рук пациента. Регулировка происходит вручную.

Для того чтобы отрегулировать положение подлокотников необходимо, повернуть «барашек-фиксатор», находящийся с двух сторон на боковой части кресла, против часовой стрелки и выдвинуть подлокотник вверх на необходимую высоту, после чего повернуть «барашек-фиксатор» по часовой стрелке и зафиксировать подлокотник.

Вращаются подлокотники и в зафиксированном положении. Для последующего изменения положения подлокотников по высоте проделать те же операции.

Принципиальная схема (рисунок) работы кресла в сборе

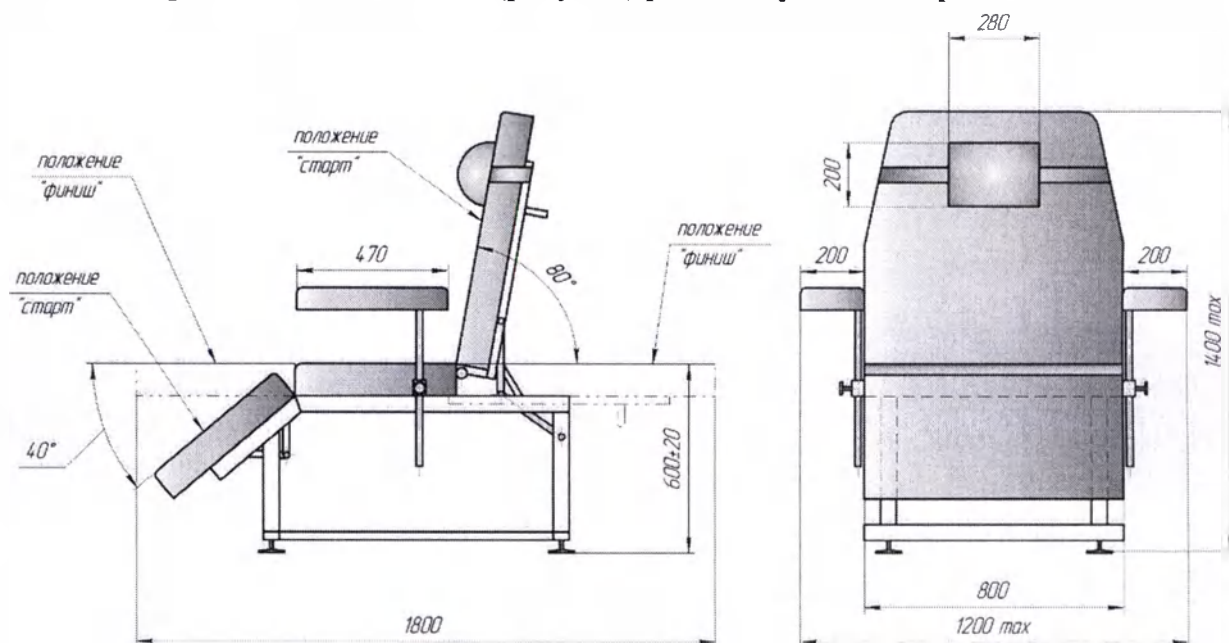

6. Меры предосторожности при работе с креслом

6.1 Перед использованием кресла необходимо убедиться в его устойчивости.

6.2 Запрещается использовать неисправное изделие и вносить изменения в конструкцию изделия.

При несоблюдении вышеперечисленных требований производитель не несет ответственности за возможные последствия.

7. Дезинфекция кресла

7.1. Дезинфекцию кресла проводить средством «Биоцидол-экспресс» представляющим собой готовую к применению прозрачную бесцветную жидкость. Содержание в составе в качестве действующих веществ: пропан-2-ол – 30 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) – 0,25%, полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид — 0,25%, неионогенный ПАВ, ингибитор коррозии, ароматизатор, pH средства – 7,0.

Применяется для обеззараживания способами орошения и протирания небольших по площади, а также труднодоступных для обработки поверхностей из различных материалов, за исключением портящихся от воздействия спиртов (органическое стекло, поверхности, окрашенные спирторастворимым лаком).

Свидетельство о государственной регистрации № RU 77.99.88.002.E002097.03.14 от 27.03.2014 выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Возможно применение аналогичных дезинфицирующих средств.

7.2 Не использовать абразивные средства и растворители.

8. Противопоказания

Отсутствуют при использовании в соответствии с назначением к применению

9. Побочные действия.

Изделие не используется как лечебное медицинское изделие. Побочные эффекты не выявлены.

10. Техническое обслуживание

Не реже чем 1 раз в месяц необходимо проверять надежность затяжки резьбовых соединений.

11. Условия хранения, транспортирования и эксплуатации

11.1. Кресло хранят и транспортируют в собранном виде в недоступном для детей чистом, сухом, месте в упаковке производителя при температуре окружающего воздуха от -50°C до +50°C и относительной влажности 80%. Допускается перевозить кресла любым видом транспорта при соблюдении правил транспортирования.

11.2 Кресло эксплуатируется при температуре окружающей среды + 10°C до + 35°C при относительной влажности до 80% при 25°C.

11.3 Изделие не должно подвергаться ударным воздействиям, а также воздействию атмосферных осадков и агрессивных сред.

11.4 Нагрузка на трансформируемые элементы изделия не должна превышать 50 кг.

12. Гарантийные обязательства

12.1. Предприятие изготовитель ООО «Стильмед» 115580, Москва, ул. Кустанайская, д. 6, к. 2, кв. 59, гарантирует надежную работу Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС" заявленным свойствам в течение 12 месяцев с даты продажи, при условии соблюдения правил хранения, применения, обслуживания и транспортирования.

Срок службы – 6 лет с даты изготовления, указанной на упаковке, или даты продажи.

12.2 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при наличии механических повреждений изделия;
- при не соблюдении правил, установленных разделами 6, 7, 9 настоящего паспорта;
- при отсутствии паспорта изделия или при его неправильном заполнении.

12.3 Техническое обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт кресла осуществляет предприятие изготовитель ООО «Стильмед».

Претензии на качество изделия принимает ООО «Стильмед» - почтовый адрес: 115580, Москва, ул. Кустанайская, д. 6, к. 2, кв. 59. Претензии и предложения принимаются по тел. (499) 703-03-80; E-mail: stylemed@mail.

www.meddizain.ru

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отображенные в информационных носителях, но не ухудшающие надежность и качество изделия.

13. Утилизация изделия:

Упаковку утилизируют в места сбора бытового мусора.

По истечении срока службы кресло подлежит утилизации в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», как отходы класса А.

Дата выпуска

Дата продажи

М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)



Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-3"

ООО «СТИЛЬМЕД»

Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-3"

1. Назначение:

Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-3" с принадлежностями, в составе предназначено для поддержания и расположения пациента в сидячем или наклонном положении с целью обеспечения его удобного положения и более легкого к нему доступа во время общедиagnostического обследования, консервативного лечения и/или хирургической процедуры. Имеет регулируемые по высоте, направлению и углу наклона части. Изменения производятся посредством механического привода в том числе и для более удобной работы медицинского персонала во время проведения осмотров и процедур в кабинетах и лабораториях клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений

2. Устройство и технические характеристики:

2.1. Для изготовления каркаса кресла, штатива для вливаний, полотенцедержателя, подлокотников, подголовника и подушки - валика применять следующие материалы:

- трубы квадратные сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8639, ГОСТ Р 54157 - 20x20x1.5 мм ; 15x15x1.5 мм.,
- трубы прямоугольные сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8645 - 40x20x2.0 мм, ГОСТ Р 54157 - 40x20x1.5 мм. ;
- труба черная круглая сталь марки СтЗсп по ГОСТ 10704-91 – d 16*1.5; d 20*1.5
- труба нержавеющая квадратная сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8639 - 20x20x1.5 мм ; 15x15x1.5 мм.;
- труба нержавеющая прямоугольная сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8645 - 40x20x2.0 мм;
- труба нержавеющая круглая сталь марки СтЗсп по ГОСТ 11068 - d 16*1.5; d 20*1.5
- лакокрасочные покрытия – краска порошковая эпоксидно – полиэфирная, белая марка «MICROPUL» производитель «MICROPUL BOYA KIMYA SUN. VE TIC LTD STI» (Турция), Экспертное заключение рег. Номер 12-04-613 от 10.04.2012;
- фанера ФСФ, Ш2 - 9 мм по ГОСТ 3916.1;
- пенополиуретан эластичный «Элаблок» марки ST 3040 производитель ООО «Европласт» (Россия) по ТУ 2254-001-70465083-2009;

При изготовлении кресла используется Клей мебельный Purtex Plus - изготовитель Universal Yapistirici Kimya, производства Турция (Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.06.01.008.Е.001253.03.13 от 27.03.2013 года).

Внешние поверхности обтягиваются материалом искусственной кожей марки SKADEN B353/AS, производства фабрики «SANWIL» Польша.

Материал изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (ДС ТР ТС 017/2011 Рег.номер RU Д-PL АУ 37.В.04123 выдано 30.01.15) и имеет следующие технологические характеристики:

- 1) масса, г/м² ≥ 450 ;
- 2) толщина, мм $0,9 \pm 0,2$
- 3) состав:
 - покрытие ПВХ 100%

- основа Полиэфир 100%

4) не содержит кадмия, не содержит азокрасителей, согласно директиве Комиссии 2004/21/ЕК от 24.02.2004 (в отношении ограничений допуска на рынок и применения азокрасителей)

Материал водонепроницаемый и устойчив к появлению царапин, устойчив к чистке и дезинфекции. Материал Skaden B353/AS благодаря тиснению и огнестойкости используют как обивку стоматологических и процедурных кресел, больничных коек, массажных столов.

- «барашек-фиксатор» - используется марка материала АБС-пластик 1030, цвет черный, краситель производства Компания Karl Finke GmbH & Co.KG, Германия (Финке Колорс) марка FIBAPLAST с впаянной резьбовой шпилькой.

- ступенчатый механизм «Multiflex» (производство franko Franke GmbH & Co.KG).

- ступенчатый механизм «Rostomat» (производство franko Franke GmbH & Co.KG

- при изготовлении Штатива используется - труба нержавеющей круглая сталь марки AISI 304 по ГОСТ 11068 - d 16*1.5; d 20*1.5

либо труба черная круглая сталь марки Ст3сп по ГОСТ 10704-91 – d 16*1.5; d 20*1.5;

- при изготовлении полотенцедержателя используется труба нержавеющей круглая сталь марки AISI 304 по ГОСТ 11068 - d 16*1.5;

- колеса с тормозом – модель C-1700-MTB-100-A18, производство NGWAY, Китай

-регулируемые опоры (ножки) – используется марка материала АБС-пластик 1030, цвет черный, краситель производства Компания Karl Finke GmbH & Co.KG, Германия (Финке Колорс) марка FIBAPLAST с впаянной резьбовой шпилькой.

- при изготовлении подушки – валика используется резинка производства ООО «ФИ-ТЕКС», г. Москва, ул. Кусковская д.20А. Резинка (единичная латексная (Cariflex IR0307 KU) нить (0,8-1,0) мм в текстильной оплётке – нить 8,4 текс из полиамида марки (РА 6), черная) ширина 35 мм, по ТУ 8151-00159722763-2004

2.2 Регулировка подлокотников осуществляется за счет «барашка-фиксатора».

2.3 Положение подушки – валика относительно положения головы пациента регулируется при помощи фиксирующей резинки.

Технические характеристики:

Наименование	Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-3"
Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	180
Допустимая нагрузка на элементы трансформации	60
Секция спина, не более, кг	30
Секция ноги, не более, кг	
Габариты в стационарном положении:	
длина, не более, мм	1800

ширина, не более, мм	1200
ширина сидения, не более, мм	800
Высота сидения над полом, мм	600+-20
Высота фиксированная без подголовника, не более, мм	1400
Высота фиксированная с опущенным подголовником, не более, мм	1450
Высота фиксированная с выдвинутым подголовником, не более, мм	1600
угол наклона секции спина, в пределах, °	от 0 до 80
угол наклона секции ноги, в пределах, °	минус 40 до 10
вес изделия, не более, кг	40
Конструктивные геометрические параметры:	
Каркас кресла	- трубы квадратные по ГОСТ 8639, ГОСТ Р 54157 - 20x20x1.5 мм ; 15x15x1.5 мм., - трубы прямоугольные по ГОСТ 8645 - 40x20x2.0 мм, ГОСТ Р 54157 - 40x20x1.5 мм. ; - труба черная круглая по ГОСТ 10704-91 – d 16*1.5; d 20*1.5 - труба нержавеющая квадратная по ГОСТ 8639 - 20x20x1.5 мм ; 15x15x1.5 мм.; - труба нержавеющая прямоугольная по ГОСТ 8645 - 40x20x2.0 мм; - труба нержавеющая круглая по ГОСТ 11068 - d 16*1.5; d 20*1.5 - фанера ФСФ, Ш2 - 9 мм по ГОСТ 3916.1;
Температура поверхности кресла	Не превышает температуры окружающей среды
Состав кресла	
Подлокотник широкий	470*200 мм
Колеса с тормозом	Диаметр 100 мм
Подушка-валик под голову	28 см. X 10 см. D 20 см
Барашки – фиксаторы	АБС пластик 1030 с резьбовой шпилькой

3. Вариант исполнения (комплектация).

Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-3" с принадлежностями, в составе:

1. кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС".
2. подлокотники широкие - 2 шт.
3. колеса с тормозом - 4 шт.

4. барашки – фиксаторы – 2 шт.
5. подушка-валик под голову - 1 шт.

Принадлежности:

1. инструкция по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.
2. упаковка – 1 шт.

4. Подготовка к работе

Перед использованием изделия необходимо:

- выдержать кресло при комнатной температуре не менее 6 часов, если кресло хранилось или транспортировалось при отрицательной температуре;
- установить кресло на место и убедиться в его устойчивости. Для этого с помощью регулируемых опор (ножек), расположенных в нижней части кресла, выкручивая их, выставить кресло в устойчивое положение. Регулируемые опоры помогают исправить неровности пола.

5. Инструкция по эксплуатации:

Регулировка секции спина осуществляется за счет ступенчатого механизма «Multiflex» или «Rastomat» для более удобного положения пациента и работы врача, при проведении медицинских процедур. Регулировка происходит вручную в диапазоне угла наклона (от 0° до 80 °).

Для того чтобы отрегулировать угол наклона спинной секции необходимо, поднимая вручную спинку от горизонтального положения в вертикальное, зафиксировать ее в нужном положении. Каждое положение сопровождается характерным щелчком, который означает, что механизм занял следующее положение. Если необходимо вернуть спинку в положение, ниже установленного, или в горизонтальное, нужно поднять ее до максимума и затем опустить до горизонта, после чего выставить нужное положение.


Регулировка секции ноги осуществляется за счет ступенчатого механизма «Rastomat» или «Multiflex» для более удобного положения пациента. Регулировка происходит вручную в диапазоне угла наклона (от минус 40° до 10°).

Для того чтобы отрегулировать угол наклона ножной секции необходимо, поднимая секцию вручную зафиксировать ее в нужном положении. Каждое положение сопровождается характерным щелчком, который означает, что механизм занял следующее положение. Если необходимо вернуть ножную секцию в положение, ниже установленного, нужно поднять ее до максимума и затем опустить, после чего выставить нужное положение.

Регулировка подлокотников осуществляется за счет «барашка-фиксатора» для более удобного положения рук пациента. Регулировка происходит вручную.

Для того чтобы отрегулировать положение подлокотников необходимо, повернуть «барашек-фиксатор», находящийся с двух сторон на боковой части кресла, против часовой стрелки и выдвинуть подлокотник вверх на необходимую высоту, после чего повернуть «барашек-фиксатор» по часовой стрелке и зафиксировать подлокотник. Вращаются подлокотники и в зафиксированном положении. Для последующего изменения положения подлокотников по высоте проделать те же операции.

Принципиальная схема (рисунок) работы кресла в сборе

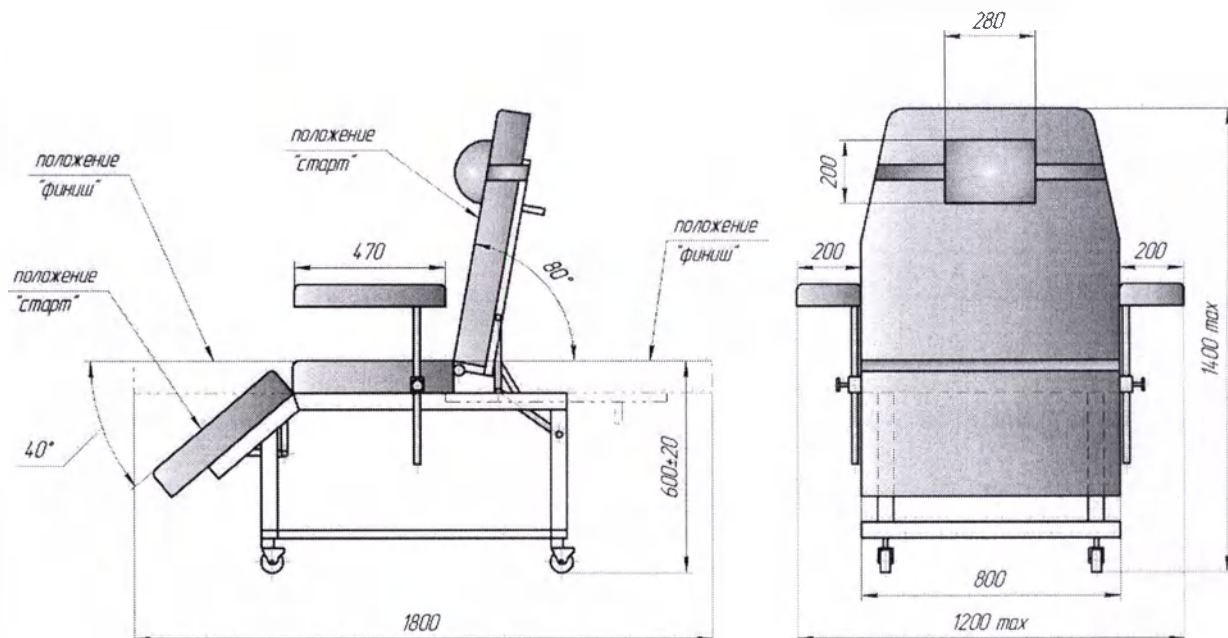

6. Меры предосторожности при работе с креслом

6.1 Перед использованием кресла необходимо убедиться в его устойчивости.

6.2 Запрещается использовать неисправное изделие и вносить изменения в конструкцию изделия.

При несоблюдении вышеперечисленных требований производитель не несет ответственности за возможные последствия.

7. Дезинфекция кресла

7.1 Дезинфекцию кресла проводить средством «Биоцидол-экспресс» представляющим собой готовую к применению прозрачную бесцветную жидкость. Содержание в составе в качестве действующих веществ: пропан-2-ол – 30 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) – 0,25%, полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид — 0,25%, неионогенный ПАВ, ингибитор коррозии, ароматизатор, pH средства – 7,0.

Применяется для обеззараживания способами орошения и протирания небольших по площади, а также труднодоступных для обработки поверхностей из различных материалов, за исключением портящихся от воздействия спиртов (органическое стекло, поверхности, окрашенные спирторастворимым лаком).

Свидетельство о государственной регистрации № RU 77.99.88.002.E002097.03.14 от 27.03.2014 выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Возможно применение аналогичных дезинфицирующих средств.

7.2 Не использовать абразивные средства и растворители.

8. Противопоказания

Отсутствуют при использовании в соответствии с назначением к применению

9. Побочные действия.

Изделие не используется как лечебное медицинское изделие. Побочные эффекты не выявлены.

10. Техническое обслуживание

Не реже чем 1 раз в месяц необходимо проверять надежность затяжки резьбовых соединений.

11. Условия хранения, транспортирования и эксплуатации

11.1. Кресло хранят и транспортируют в собранном виде в недоступном для детей чистом, сухом, месте в упаковке производителя при температуре окружающего воздуха от -50°C до +50°C и относительной влажности 80%. Допускается перевозить кресла любым видом транспорта при соблюдении правил транспортирования.

11.2 Кресло эксплуатируется при температуре окружающей среды + 10°C до + 35°C при относительной влажности до 80% при 25°C.

11.3 Изделие не должно подвергаться ударным воздействиям, а также воздействию атмосферных осадков и агрессивных сред.

11.4 Нагрузка на трансформируемые элементы изделия не должна превышать 50 кг.

12. Гарантийные обязательства

12.1. Предприятие изготовитель ООО «Стильмед» 115580, Москва, ул. Кустанайская, д. 6, к. 2, кв. 59, гарантирует надежную работу Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-3" заявленным свойствам в течение 12 месяцев с даты продажи, при условии соблюдения правил хранения, применения, обслуживания и транспортирования.

Срок службы – 6 лет с даты изготовления, указанной на упаковке, или даты продажи.

12.2 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при наличии механических повреждений изделия;
- при не соблюдении правил, установленных разделами 6, 7, 9 настоящего паспорта;
- при отсутствии паспорта изделия или при его неправильном заполнении.

12.3 Техническое обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт кресла осуществляет предприятие изготовитель ООО «Стильмед».

Претензии на качество изделия принимает ООО «Стильмед» - почтовый адрес: 115580, Москва, ул. Кустанайская, д. 6, к. 2, кв. 59. Претензии и предложения принимаются по тел. (499) 703-03-80; E-mail: stylemed@mail.

www.meddizain.ru

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отображенные в информационных носителях, но не ухудшающие надежность и качество изделия.

13. Утилизация изделия:

Упаковку утилизируют в места сбора бытового мусора.

По истечении срока службы кресло подлежит утилизации в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», как отходы класса А.

Дата выпуска

Дата продажи

М.П.

Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью 7 листов

Подпись *Александр*



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)



Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-4"

ООО «СТИЛЬМЕД»

Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-4"

1. Назначение:

Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-4" с принадлежностями, в составе предназначено для поддержания и расположения пациента в сидячем или наклонном положении с целью обеспечения его удобного положения и более легкого к нему доступа во время обще диагностического обследования, консервативного лечения и/или хирургической процедуры. Имеет регулируемые по высоте, направлению и углу наклона части. Изменения производятся посредством механического привода в том числе и для более удобной работы медицинского персонала во время проведения осмотров и процедур в кабинетах и лабораториях клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений

2. Устройство и технические характеристики:

2.1. Для изготовления каркаса кресла, штатива для вливаний, полотенцедержателя, подлокотников, подголовника и подушки - валика применять следующие материалы:

- трубы квадратные сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8639, ГОСТ Р 54157 - 20x20x1.5 мм ; 15x15x1.5 мм.,
- трубы прямоугольные сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8645 - 40x20x2.0 мм, ГОСТ Р 54157 - 40x20x1.5 мм. ;
- труба черная круглая сталь марки СтЗсп по ГОСТ 10704-91 – d 16*1.5; d 20*1.5
- труба нержавеющая квадратная сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8639 - 20x20x1.5 мм ; 15x15x1.5 мм.;
- труба нержавеющая прямоугольная сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8645 - 40x20x2.0 мм;
- труба нержавеющая круглая сталь марки СтЗсп по ГОСТ 11068 - d 16*1.5; d 20*1.5
- лакокрасочные покрытия – краска порошковая эпоксидно – полиэфирная, белая марка «MICROPUL» производитель «MICROPUL BOYA KIMYA SUN. VE TIC LTD STI» (Турция), Экспертное заключение рег. Номер 12-04-613 от 10.04.2012;
- фанера ФСФ, Ш2 - 9 мм по ГОСТ 3916.1;
- пенополиуретан эластичный «Элаблок» марки ST 3040 производитель ООО «Европласт» (Россия) по ТУ 2254-001-70465083-2009;

При изготовлении кресла используется Клей мебельный Purtex Plus - изготовитель Universal Yapistirici Kimya, производства Турция (Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.06.01.008.Е.001253.03.13 от 27.03.2013 года).

Внешние поверхности обтягиваются материалом искусственной кожей марки SKADEN B353/AS, производства фабрики «SANWIL» Польша.

Материал изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (ДС ТР ТС 017/2011 Рег.номер RU Д-PL АУ 37.В.04123 выдано 30.01.15) и имеет следующие технологические характеристики:

- 1) масса, г/м² ≥ 450 ;
- 2) толщина, мм $0,9 \pm 0,2$
- 3) состав:
 - покрытие ПВХ 100%

- основа Полиэфир 100%

4) не содержит кадмия, не содержит азокрасителей, согласно директиве Комиссии 2004/21/ЕК от 24.02.2004 (в отношении ограничений допуска на рынок и применения азокрасителей)

Материал водонепроницаемый и устойчив к появлению царапин, устойчив к чистке и дезинфекции. Материал Skaden B353/AS благодаря тиснению и огнестойкости используют как обивку стоматологических и процедурных кресел, больничных коек, массажных столов.

- «барашек-фиксатор» - используется марка материала АБС-пластик 1030, цвет черный, краситель производства Компания Karl Finke GmbH & Co.KG, Германия (Финке Колорс) марка FIBAPLAST с впаянной резьбовой шпилькой.

- ступенчатый механизм «Multiflex» (производство franko Franke GmbH & Co.KG).

- ступенчатый механизм «Rostomat» (производство franko Franke GmbH & Co.KG

- при изготовлении Штатива используется - труба нержавеющей круглая сталь марки AISI 304 по ГОСТ 11068 - d 16*1.5; d 20*1.5

либо труба черная круглая сталь марки СтЗсп по ГОСТ 10704-91 – d 16*1.5; d 20*1.5;

- при изготовлении полотенцедержателя используется труба нержавеющей круглая сталь марки AISI 304 по ГОСТ 11068 - d 16*1.5;

- колеса с тормозом – модель C-1700-MTB-100-A18, производство NGWAY, Китай

-регулируемые опоры (ножки) – используется марка материала АБС-пластик 1030, цвет черный, краситель производства Компания Karl Finke GmbH & Co.KG, Германия (Финке Колорс) марка FIBAPLAST с впаянной резьбовой шпилькой.

- при изготовлении подушки – валика используется резинка производства ООО «ФИ-ТЕКС», г. Москва, ул. Кусковская д.20А. Резинка (единичная латексная (Cariflex IR0307 KU) нить (0,8-1,0) мм в текстильной оплётке – нить 8,4 текс из полиамида марки (РА 6), черная) ширина 35 мм, по ТУ 8151-00159722763-2004

2.2 Регулировка подлокотников осуществляется за счет «барашка-фиксатора».

2.3 Положение подушки – валика относительно положения головы пациента регулируется при помощи фиксирующей резинки.

Технические характеристики:

Наименование	Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-4"
Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	180
Допустимая нагрузка на элементы трансформации	
Секция спина, не более, кг	60
Секция ноги, не более, кг	30
Габариты в стационарном положении:	
длина, не более, мм	1800

ширина, не более, мм	1200
ширина сидения, не более, мм	800
Высота сидения над полом, мм	600+-20
Высота фиксированная без подголовника, не более, мм	1400
угол наклона секции спина, в пределах, °	от 0 до 80
угол наклона секции ноги, в пределах, °	от минус 40 до 10
вес изделия, не более, кг	40
Конструктивные геометрические параметры:	
Каркас кресла	- трубы квадратные сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8639, ГОСТ Р 54157 - 20x20x1.5 мм ; 15x15x1.5 мм., - трубы прямоугольные сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8645 - 40x20x2.0 мм, ГОСТ Р 54157 - 40x20x1.5 мм. ; - труба черная круглая сталь марки СтЗсп по ГОСТ 10704-91 – d 16*1.5; d 20*1.5 - труба нержавеющая квадратная сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8639 - 20x20x1.5 мм ; 15x15x1.5 мм.; - труба нержавеющая прямоугольная сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8645 - 40x20x2.0 мм; - труба нержавеющая круглая сталь марки СтЗсп по ГОСТ 11068 - d 16*1.5; d 20*1.5 - лакокрасочные покрытия – краска порошковая эпоксидно – полиэфирная, белая марка «MICROPUL» производитель «MICROPUL BOYA KIMYA SUN. VE TIC LTD STI» (Турция), Экспертное заключение рег. Номер 12-04-613 от 10.04.2012; - фанера ФСФ, Ш2 - 9 мм по ГОСТ 3916.1;
Температура поверхности кресла	Не превышает температуры окружающей среды
Состав кресла	
Подлокотники широкие	470*200 мм
Колеса с тормозом	Диаметр 100 мм
Штатив для вливаний	Высота 1800 мм
Полотенцедержатель	320 мм
Барашки – фиксаторы	АБС пластик 1030 с резьбовой шпилькой
Подушка-валик под голову	28 см. X 10 см. D 20 см

3. Вариант исполнения (комплектация).

Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-4" с принадлежностями, в составе:

1. кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС".
2. подлокотники широкие- 2 шт.
3. колеса с тормозом - 4 шт.
4. барашки – фиксаторы – 4 шт.
5. штатив для вливаний – 1 шт.
6. полотенцедержатель -1 шт.
7. подушка – валик под голову – 1 шт.

Принадлежности:

1. инструкция по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.
2. упаковка – 1 шт.

4. Подготовка к работе

Перед использованием изделия необходимо:

- выдержать кресло при комнатной температуре не менее 6 часов, если кресло хранилось или транспортировалось при отрицательной температуре;
- установить кресло на место и убедиться в его устойчивости. Для этого с помощью регулируемых опор (ножек), расположенных в нижней части кресла, выкручивая их, выставить кресло в устойчивое положение. Регулируемые опоры помогают исправить неровности пола.

5. Инструкция по эксплуатации:

Регулировка секции спина осуществляется за счет ступенчатого механизма «Multiflex» или «Rastomat» для более удобного положения пациента и работы врача, при проведении медицинских процедур. Регулировка происходит вручную в диапазоне угла наклона (от 0° до 80°).

Для того чтобы отрегулировать угол наклона спинной секции необходимо, поднимая ручную спинку от горизонтального положения в вертикальное, зафиксировать ее в нужном положении. Каждое положение сопровождается характерным щелчком, который означает, что механизм занял следующее положение. Если необходимо вернуть спинку в положение, ниже установленного, или в горизонтальное, нужно поднять ее до максимума и затем опустить до горизонта, после чего выставить нужное положение.

Регулировка секции ноги осуществляется за счет ступенчатого механизма «Rastomat» или «Multiflex» для более удобного положения пациента. Регулировка происходит вручную в диапазоне угла наклона (от минус 40° до 10°).

Для того чтобы отрегулировать угол наклона ножной секции необходимо, поднимая секцию вручную зафиксировать ее в нужном положении. Каждое положение сопровождается характерным щелчком, который означает, что механизм занял следующее положение. Если необходимо вернуть ножную секцию в положение, ниже установленного, нужно поднять ее до максимума и затем опустить, после чего выставить нужное положение.


Регулировка подлокотников осуществляется за счет «барашка-фиксатора» для более удобного положения рук пациента. Регулировка происходит вручную.

Для того чтобы отрегулировать положение подлокотников необходимо, повернуть «барашек-фиксатор», находящийся с двух сторон на боковой части кресла, против часовой стрелки и выдвинуть подлокотник вверх на необходимую высоту, после чего повернуть «барашек-фиксатор» по часовой стрелке и зафиксировать подлокотник. Вращаются подлокотники и в зафиксированном положении. Для последующего изменения положения подлокотников по высоте проделать те же операции.

Для установки штатива для вливаний необходимо установить штатив в отверстие для штатива за спинкой кресла на необходимую высоту и закрепить «барашком-фиксатором».

Полотенцедержатель монтируется на заводе по дополнительной заявке заказчика и является неотъемлемой частью кресла.

Принципиальная схема (рисунок) работы кресла в сборе

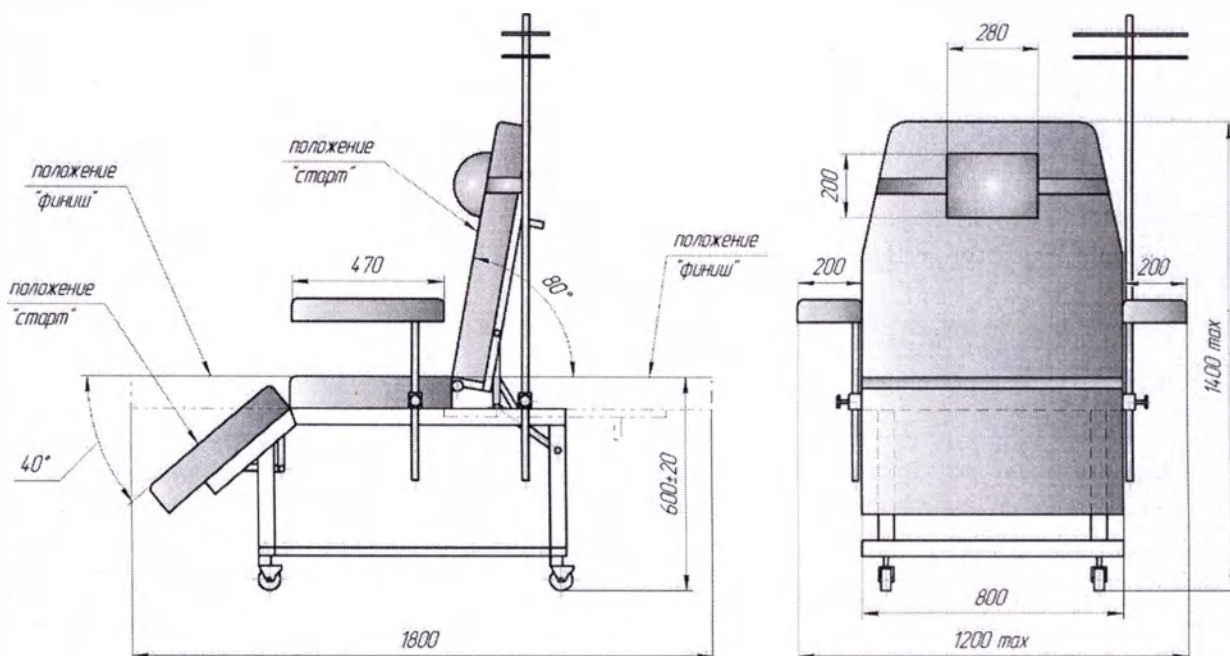

6. Меры предосторожности при работе с креслом

6.1 Перед использованием кресла необходимо убедиться в его устойчивости.

6.2 Запрещается использовать неисправное изделие и вносить изменения в конструкцию изделия.

При несоблюдении вышеперечисленных требований производитель не несет ответственности за возможные последствия.

7. Дезинфекция кресла

7.1. Дезинфекцию кресла проводить средством «Биоцидол-экспресс» представляющим собой готовую к применению прозрачную бесцветную жидкость. Содержание в составе в качестве действующих веществ: пропан-2-ол – 30 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) – 0,25%, полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид — 0,25%, неионогенный ПАВ, ингибитор коррозии, ароматизатор, pH средства – 7,0.

Применяется для обеззараживания способами орошения и протираания небольших по площади, а также труднодоступных для обработки поверхностей из различных материалов, за исключением портящихся от воздействия спиртов (органическое стекло, поверхности, окрашенные спирторастворимым лаком).

Свидетельство о государственной регистрации № RU 77.99.88.002.E002097.03.14 от 27.03.2014 выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Возможно применение аналогичных дезинфицирующих средств.

7.2 Не использовать абразивные средства и растворители.

8. Противопоказания

Отсутствуют при использовании в соответствии с назначением к применению

9. Побочные действия.

Изделие не используется как лечебное медицинское изделие. Побочные эффекты не выявлены.

10. Техническое обслуживание

Не реже чем 1 раз в месяц необходимо проверять надежность затяжки резьбовых соединений.

11. Условия хранения, транспортирования и эксплуатации

11.1. Кресло хранят и транспортируют в собранном виде в недоступном для детей чистом, сухом, месте в упаковке производителя при температуре окружающего воздуха от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 80%. Допускается перевозить кресла любым видом транспорта при соблюдении правил транспортирования.

11.2 Кресло эксплуатируется при температуре окружающей среды $+10^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности до 80% при 25°C .

11.3 Изделие не должно подвергаться ударным воздействиям, а также воздействию атмосферных осадков и агрессивных сред.

11.4 Нагрузка на трансформируемые элементы изделия не должна превышать 50 кг.

12. Гарантийные обязательства

12.1. Предприятие изготовитель ООО «Стильмед» 115580, Москва, ул. Кустанайская, д. 6, к. 2, кв. 59, гарантирует надежную работу Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-4" заявленным свойствам в течение 12 месяцев с даты продажи, при условии соблюдения правил хранения, применения, обслуживания и транспортирования.

Срок службы – 6 лет с даты изготовления, указанной на упаковке, или даты продажи.

12.2 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при наличии механических повреждений изделия;
- при не соблюдении правил, установленных разделами 6, 7, 9 настоящего паспорта;
- при отсутствии паспорта изделия или при его неправильном заполнении.

12.3 Техническое обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт кресла осуществляет предприятие изготовитель ООО «Стильмед».

Претензии на качество изделия принимает ООО «Стильмед» - почтовый адрес: 115580, Москва, ул. Кустанайская, д. 6, к. 2, кв. 59. Претензии и предложения принимаются по тел. (499) 703-03-80; E-mail: stylemed@mail.
www.meddizain.ru

13. Утилизация изделия:

Упаковку утилизируют в места сбора бытового мусора.

По истечении срока службы кресло подлежит утилизации в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», как отходы класса А.

Дата выпуска

Дата продажи

М.П.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 8 листов
Подпись: Александр



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)



Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-5"

ООО «СТИЛЬМЕД»

Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-5"

1. Назначение:

Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-5" с принадлежностями, в составе предназначено для поддержания и расположения пациента в сидячем или наклонном положении с целью обеспечения его удобного положения и более легкого к нему доступа во время обще диагностического обследования, консервативного лечения и/или хирургической процедуры. Имеет регулируемые по высоте, направлению и углу наклона части. Изменения производятся посредством механического привода в том числе и для более удобной работы медицинского персонала во время проведения осмотров и процедур в кабинетах и лабораториях клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений

2. Устройство и технические характеристики:

Для изготовления каркаса кресла, штатива для вливаний, полотенцедержателя, подлокотников, подголовника и подушки - валика применять следующие материалы:

- трубы квадратные по ГОСТ 8639, ГОСТ Р 54157 - 20x20x1.5 мм ; 15x15x1.5 мм.,
- трубы прямоугольные по ГОСТ 8645 - 40x20x2.0 мм, ГОСТ Р 54157 - 40x20x1.5 мм. ;
- труба черная круглая по ГОСТ 10704-91 – d 16*1.5; d 20*1.5
- труба нержавеющая квадратная по ГОСТ 8639 - 20x20x1.5 мм ; 15x15x1.5 мм.;
- труба нержавеющая прямоугольная по ГОСТ 8645 - 40x20x2.0 мм;
- труба нержавеющая круглая по ГОСТ 11068 - d 16*1.5; d 20*1.5
- лакокрасочные покрытия – краска порошковая эпоксидно – полиэфирная, белая марка «MICROPUL» производитель «MICROPUL BOYA KIMYA SUN. VE TIC LTD STI» (Турция), Экспертное заключение рег. Номер 12-04-613 от 10.04.2012;
- фанера ФСФ, Ш2 - 9 мм по ГОСТ 3916.1;
- пенополиуретан эластичный «Элаблок» марки ST 3040 производитель ООО «Европласт» (Россия) по ТУ 2254-001-70465083-2009;

При изготовлении кресла используется Клей мебельный Purtex Plus - изготовитель Universal Yapistirici Kimya, производства Турция (Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.06.01.008.Е.001253.03.13 от 27.03.2013 года).

Внешние поверхности обтягиваются материалом искусственной кожей марки SKADEN B353/AS, производства фабрики «SANWIL» Польша.

Материал изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (ДС ТР ТС 017/2011 Рег.номер RU Д-PL АУ 37.В.04123 выдано 30.01.15) и имеет следующие технологические характеристики:

- 1) масса, г/м² ≥ 450 ;
- 2) толщина, мм $0,9 \pm 0,2$
- 3) состав:
 - покрытие ПВХ 100%
 - основа Полиэфир 100%
- 4) не содержит кадмия, не содержит азокрасителей, согласно директиве Комиссии 2004/21/ЕК от 24.02.2004 (в отношении ограничений допуска на рынок и применения азокрасителей)

Материал водонепроницаемый и устойчив к появлению царапин, устойчив к чистке и дезинфекции. Материал Skaden B353/AS2.1. Для изготовления каркаса кресла, штатива для вливаний, полотенцедержателя, подлокотников, подголовника и подушки - валика применять следующие материалы:

- трубы квадратные сталь марки Ст3сп по ГОСТ 8639, ГОСТ Р 54157 - 20x20x1.5 мм ; 15x15x1.5 мм.,
- трубы прямоугольные сталь марки Ст3сп по ГОСТ 8645 - 40x20x2.0 мм, ГОСТ Р 54157 - 40x20x1.5 мм. ;
- труба черная круглая сталь марки Ст3сп по ГОСТ 10704-91 – d 16*1.5; d 20*1.5
- труба нержавеющая квадратная сталь марки Ст3сп по ГОСТ 8639 - 20x20x1.5 мм ; 15x15x1.5 мм.;
- труба нержавеющая прямоугольная сталь марки Ст3сп по ГОСТ 8645 - 40x20x2.0 мм;
- труба нержавеющая круглая сталь марки Ст3сп по ГОСТ 11068 - d 16*1.5; d 20*1.5
- лакокрасочные покрытия – краска порошковая эпоксидно – полиэфирная, белая марка «MICROPUL» производитель «MICROPUL BOYA KIMYA SUN. VE TIC LTD STI» (Турция), Экспертное заключение рег. Номер 12-04-613 от 10.04.2012;
- фанера ФСФ, Ш2 - 9 мм по ГОСТ 3916.1;
- пенополиуретан эластичный «Элаблок» марки ST 3040 производитель ООО «Европласт» (Россия) по ТУ 2254-001-70465083-2009;

При изготовлении кресла используется Клей мебельный Purtex Plus - изготовитель Universal Yapistirici Kimya, производства Турция (Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.06.01.008.Е.001253.03.13 от 27.03.2013 года).

Внешние поверхности обтягиваются материалом искусственной кожей марки SKADEN B353/AS, производства фабрики «SANWIL» Польша.

Материал изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (ДС ТР ТС 017/2011 Рег.номер RU Д-PL АУ 37.В.04123 выдано 30.01.15) и имеет следующие технологические характеристики:

- 1) масса, г/м² ≥ 450 ;
- 2) толщина, мм $0,9 \pm 0,2$
- 3) состав:
 - покрытие ПВХ 100%
 - основа Полиэфир 100%
- 4) не содержит кадмия , не содержит азокрасителей, согласно директиве Комиссии 2004/21/ЕК от 24.02.2004 (в отношении ограничений допуска на рынок и применения азокрасителей)

Материал водонепроницаемый и устойчив к появлению царапин, устойчив к чистке и дезинфекции. Материал Skaden B353/AS благодаря тиснению и огнестойкости используют как обивку стоматологических и процедурных кресел, больничных коек, массажных столов.

- «барашек-фиксатор» - используется марка материала АБС-пластик 1030, цвет черный, краситель производства Компания Karl Finke GmbH & Co.KG, Германия (Финке Колорс) марка FIBAPLAST с впаянной резьбовой шпилькой.

- ступенчатый механизм «Multiflex» (производство franko Franke GmbH & Co.KG).
- ступенчатый механизм «Rostomat» (производство franko Franke GmbH & Co.KG
- при изготовлении Штатива используется - труба нержавеющая круглая сталь марки AISI 304 по ГОСТ 11068 - d 16*1.5; d 20*1.5
либо труба черная круглая сталь марки Ст3сп по ГОСТ 10704-91 – d 16*1.5; d 20*1.5;
- при изготовления полотенцедержателя используется труба нержавеющая круглая сталь марки AISI 304 по ГОСТ 11068 - d 16*1.5;
- колеса с тормозом – модель C-1700-MTB-100-A18, производство NGWAY, Китай
- регулируемые опоры (ножки) – используется марка материала АБС-пластик 1030, цвет черный, краситель производства Компания Karl Finke GmbH & Co.KG, Германия (Финке Колорс) марка FIBAPLAST с впаянной резьбовой шпилькой.
- при изготовлении подушки – валика используется резинка производства ООО «ФИ-ТЕКС», г. Москва, ул. Кусковская д.20А. Резинка (единичная латексная (Cariflex IR0307 KU) нить (0,8-1,0) мм в текстильной оплётке – нить 8,4 текс из полиамида марки (РА 6) , черная) ширина 35 мм, по ТУ 8151-00159722763-2004

2.2 Регулировка подлокотников осуществляется за счет «барашка-фиксатора».

Технические характеристики:

Наименование	Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-5"
Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	180
Допустимая нагрузка на элементы трансформации	60
Секция спина, не более, кг	30
Секция ноги, не более, кг	
Габариты в стационарном положении:	
длина, не более, мм	1800
ширина, не более, мм	1200
ширина сидения, не более, мм	800
Высота сидения над полом, мм	600+-20
Высота фиксированная без подголовника, не более, мм	1400
Высота фиксированная с опущенным подголовником, не более, мм	1450
Высота фиксированная с выдвинутым подголовником, не более, мм	1600
угол наклона секции спина, в пределах, °	от 0 до 80
угол наклона секции ноги, в пределах, °	от минус 90 до 0

вес изделия, не более, кг	40
Конструктивные геометрические параметры:	
Каркас кресла	- трубы квадратные сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8639, ГОСТ Р 54157 - 20х20х1.5 мм ; 15х15х1.5 мм., - трубы прямоугольные сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8645 - 40х20х2.0 мм, ГОСТ Р 54157 - 40х20х1.5 мм. ; - труба черная круглая сталь марки СтЗсп по ГОСТ 10704-91 – d 16*1.5; d 20*1.5 - труба нержавеющая квадратная сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8639 - 20х20х1.5 мм ; 15х15х1.5 мм.; - труба нержавеющая прямоугольная сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8645 - 40х20х2.0 мм; - труба нержавеющая круглая сталь марки СтЗсп по ГОСТ 11068 - d 16*1.5; d 20*1.5 - лакокрасочные покрытия – краска порошковая эпоксидно – полиэфирная, белая марка «MICROPUL» производитель «MICROPUL BOYA KIMYA SUN. VE TIC LTD STI» (Турция), Экспертное заключение рег. Номер 12-04-613 от 10.04.2012; - фанера ФСФ, Ш2 - 9 мм по ГОСТ 3916.1;
Температура поверхности кресла	Не превышает температуры окружающей среды
Состав кресла	
Подлокотник узкий	370*120 мм
Колеса с тормозом*	Диаметр 100 мм
Регулируемые опоры (ножки)*	АБС пластик 1030 с резьбовой шпилькой
Барашки – фиксаторы	АБС пластик 1030 с резьбовой шпилькой

*комплектуется по желанию заказчика

3. Вариант исполнения (комплектация).

Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-5" с принадлежностями, в составе:

1. кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС".
2. подлокотники узкие 2 шт.
3. регулируемые опоры (ножки) или колеса с тормозом - 4 шт.*
4. барашки – фиксаторы – 2 шт.

Принадлежности:

1. инструкция по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.
2. упаковка – 1 шт.

*комплектуется по желанию заказчика

4. Подготовка к работе

Перед использованием изделия необходимо:

- выдержать кресло при комнатной температуре не менее 6 часов, если кресло хранилось или транспортировалось при отрицательной температуре;
- установить кресло на место и убедиться в его устойчивости. Для этого с помощью регулируемых опор (ножек), расположенных в нижней части кресла, выкручивая их, выставить кресло в устойчивое положение. Регулируемые опоры помогают исправить неровности пола.

5. Инструкция по эксплуатации:

Регулировка секции спина осуществляется за счет ступенчатого механизма «Multiflex» или «Rastomat» для более удобного положения пациента и работы врача, при проведении медицинских процедур. Регулировка происходит вручную в диапазоне угла наклона (от 0° до 80 °).

Для того чтобы отрегулировать угол наклона спинной секции необходимо, поднимая ручную спинку от горизонтального положения в вертикальное, зафиксировать ее в нужном положении. Каждое положение сопровождается характерным щелчком, который означает, что механизм занял следующее положение. Если необходимо вернуть спинку в положение, ниже установленного, или в горизонтальное, нужно поднять ее до максимума и затем опустить до горизонта, после чего выставить нужное положение.

Регулировка секции ноги осуществляется за счет ступенчатого механизма «Rastomat» или «Multiflex» для более удобного положения пациента. Регулировка происходит вручную в диапазоне угла наклона (от минус 90° до 0°).


Для того чтобы отрегулировать угол наклона ножной секции необходимо, поднимая секцию вручную зафиксировать ее в нужном положении. Каждое положение сопровождается характерным щелчком, который означает, что механизм занял следующее положение. Если необходимо вернуть ножную секцию в положение, ниже установленного, нужно поднять ее до максимума и затем опустить, после чего выставить нужное положение.

Регулировка подлокотников осуществляется за счет «барашка-фиксатора» для более удобного положения рук пациента. Регулировка происходит вручную.

Для того чтобы отрегулировать положение подлокотников необходимо, повернуть «барашек-фиксатор», находящийся с двух сторон на боковой части кресла, против

часовой стрелки и выдвинуть подлокотник вверх на необходимую высоту, после чего повернуть «барашек-фиксатор» по часовой стрелке и зафиксировать подлокотник. Вращаются подлокотники и в зафиксированном положении. Для последующего изменения положения подлокотников по высоте проделать те же операции.

Принципиальная схема (рисунок) работы кресла в сборе

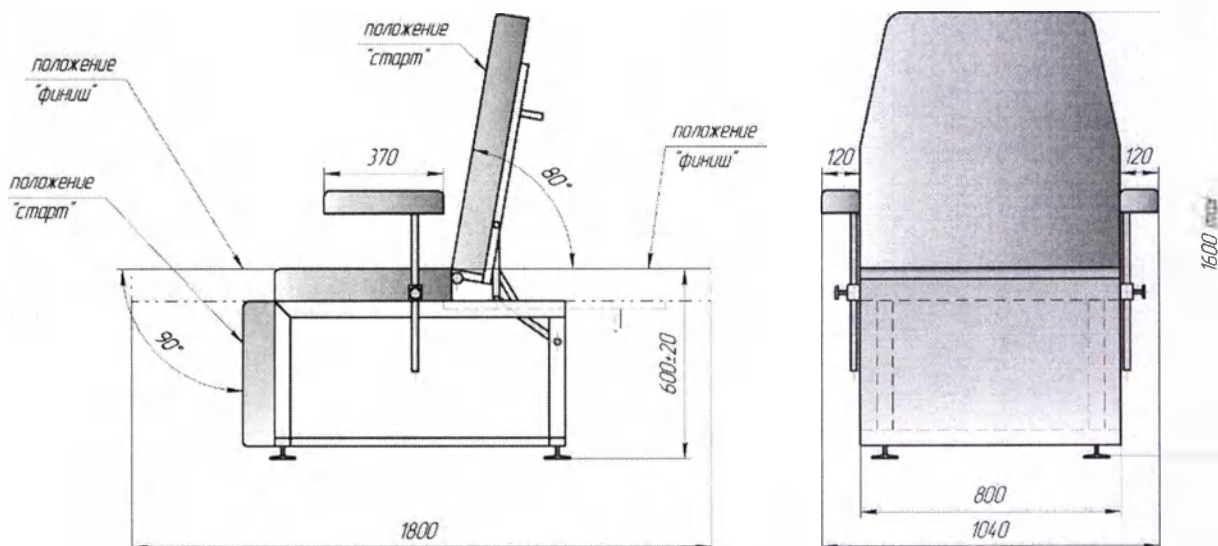

6. Меры предосторожности при работе с креслом

6.1 Перед использованием кресла необходимо убедиться в его устойчивости.

6.2 Запрещается использовать неисправное изделие и вносить изменения в конструкцию изделия.

При несоблюдении вышеперечисленных требований производитель не несет ответственности за возможные последствия.

7. Дезинфекция кресла

7.1 Дезинфекцию кресла проводить средством «Биоцидол-экспресс» представляющим собой готовую к применению прозрачную бесцветную жидкость. Содержание в составе в качестве действующих веществ: пропан-2-ол – 30 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) – 0,25%, полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид — 0,25%, неионогенный ПАВ, ингибитор коррозии, ароматизатор, pH средства – 7,0.

Применяется для обеззараживания способами орошения и протирания небольших по площади, а также труднодоступных для обработки поверхностей из различных материалов, за исключением портящихся от воздействия спиртов (органическое стекло, поверхности, окрашенные спирторастворимым лаком).

Свидетельство о государственной регистрации № RU 77.99.88.002.E002097.03.14 от 27.03.2014 выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Возможно применение аналогичных дезинфицирующих средств.

7.2 Не использовать абразивные средства и растворители.

8. Противопоказания

Отсутствуют при использовании в соответствии с назначением к применению

9. Побочные действия.

Изделие не используется как лечебное медицинское изделие. Побочные эффекты не выявлены.

10. Техническое обслуживание

Не реже чем 1 раз в месяц необходимо проверять надежность затяжки резьбовых соединений.

11. Условия хранения, транспортирования и эксплуатации

11.1. Кресло хранят и транспортируют в собранном виде в недоступном для детей чистом, сухом, месте в упаковке производителя при температуре окружающего воздуха от -50°C до +50°C и относительной влажности 80%. Допускается перевозить кресла любым видом транспорта при соблюдении правил транспортирования.

11.2 Кресло эксплуатируется при температуре окружающей среды + 10°C до + 35°C при относительной влажности до 80% при 25°C.

11.3 Изделие не должно подвергаться ударным воздействиям, а также воздействию атмосферных осадков и агрессивных сред.

11.4 Нагрузка на трансформируемые элементы изделия не должна превышать 50 кг.

12. Гарантийные обязательства

12.1. Предприятие изготовитель ООО «Стильмед» 115580, Москва, ул. Кустанайская, д. 6, к. 2, кв. 59, гарантирует надежную работу Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-5" заявленным свойствам в течение 12 месяцев с даты продажи, при условии соблюдения правил хранения, применения, обслуживания и транспортирования.

Срок службы – 6 лет с даты изготовления, указанной на упаковке, или даты продажи.

12.2 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при наличии механических повреждений изделия;
- при не соблюдении правил, установленных разделами 6, 7, 9 настоящего паспорта;
- при отсутствии паспорта изделия или при его неправильном заполнении.

12.3 Техническое обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт кресла осуществляет предприятие изготовитель ООО «Стильмед».

Претензии на качество изделия принимает ООО «Стильмед» - почтовый адрес: 115580, Москва, ул. Кустанайская, д. 6, к. 2, кв. 59. Претензии и предложения принимаются по тел. (499) 703-03-80; E-mail: stylemed@mail.

www.meddizain.ru

13. Утилизация изделия:

Упаковку утилизируют в места сбора бытового мусора.

По истечении срока службы кресло подлежит утилизации в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», как отходы класса А.

Дата выпуска

Дата продажи

М.П.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью _____ листов
Подпись _____



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)



Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-6"

ООО «СТИЛЬМЕД»

Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-6"

1. Назначение:

Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-6" с принадлежностями, в составе предназначено для поддержания и расположения пациента в сидячем или наклонном положении с целью обеспечения его удобного положения и более легкого к нему доступа во время общедиagnostического обследования, консервативного лечения и/или хирургической процедуры. Имеет регулируемые по высоте, направлению и углу наклона части. Изменения производятся посредством механического привода в том числе и для более удобной работы медицинского персонала во время проведения осмотров и процедур в кабинетах и лабораториях клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений

2. Устройство и технические характеристики:

Для изготовления каркаса кресла, штатива для вливаний, полотенцедержателя, подлокотников, подголовника и подушки - валика применять следующие материалы:

- трубы квадратные по ГОСТ 8639, ГОСТ Р 54157 - 20x20x1.5 мм; 15x15x1.5 мм.,
- трубы прямоугольные по ГОСТ 8645 - 40x20x2.0 мм, ГОСТ Р 54157 - 40x20x1.5 мм.;
- труба черная круглая по ГОСТ 10704-91 – d 16*1.5; d 20*1.5
- труба нержавеющая квадратная по ГОСТ 8639 - 20x20x1.5 мм; 15x15x1.5 мм.;
- труба нержавеющая прямоугольная по ГОСТ 8645 - 40x20x2.0 мм;
- труба нержавеющая круглая по ГОСТ 11068 - d 16*1.5; d 20*1.5
- лакокрасочные покрытия – краска порошковая эпоксидно – полиэфирная, белая марка «MICROPUL» производитель «MICROPUL BOYA KIMYA SUN. VE TIC LTD STI» (Турция), Экспертное заключение рег. Номер 12-04-613 от 10.04.2012;
- фанера ФСФ, Ш2 - 9 мм по ГОСТ 3916.1;
- пенополиуретан эластичный «Элаблок» марки ST 3040 производитель ООО «Европласт» (Россия) по ТУ 2254-001-70465083-2009;

При изготовлении кресла используется Клей мебельный Purtex Plus - изготовитель Universal Yapistirici Kimya, производства Турция (Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.06.01.008.Е.001253.03.13 от 27.03.2013 года).

Внешние поверхности обтягиваются материалом искусственной кожей марки SKADEN B353/AS, производства фабрики «SANWIL» Польша.

Материал изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (ДС ТР ТС 017/2011 Рег.номер RU Д-PL АУ 37.В.04123 выдано 30.01.15) и имеет следующие технологические характеристики:

1) масса, г/м² ≥ 450;

2) толщина, мм 0,9 ± 0,2

3) состав:

- покрытие ПВХ 100%

- основа Полиэфир 100%

4) не содержит кадмия, не содержит азокрасителей, согласно директиве Комиссии 2004/21/ЕК от 24.02.2004 (в отношении ограничений допуска на рынок и применения азокрасителей)

Материал водонепроницаемый и устойчив к появлению царапин, устойчив к чистке и дезинфекции. Материал Skaden 2.1. Для изготовления каркаса кресла, штатива для вливаний, полотенецдержателя, подлокотников, подголовника и подушки - валика применять следующие материалы:

- трубы квадратные сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8639, ГОСТ Р 54157 - 20x20x1.5 мм ; 15x15x1.5 мм.,
- трубы прямоугольные сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8645 - 40x20x2.0 мм, ГОСТ Р 54157 - 40x20x1.5 мм. ;
- труба черная круглая сталь марки СтЗсп по ГОСТ 10704-91 – d 16*1.5; d 20*1.5
- труба нержавеющая квадратная сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8639 - 20x20x1.5 мм ; 15x15x1.5 мм.;
- труба нержавеющая прямоугольная сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8645 - 40x20x2.0 мм;
- труба нержавеющая круглая сталь марки СтЗсп по ГОСТ 11068 - d 16*1.5; d 20*1.5
- лакокрасочные покрытия – краска порошковая эпоксидно – полиэфирная, белая марка «MICROPUL» производитель «MICROPUL BOYA KIMYA SUN. VE TIC LTD STI» (Турция), Экспертное заключение рег. Номер 12-04-613 от 10.04.2012;
- фанера ФСФ, Ш2 - 9 мм по ГОСТ 3916.1;
- пенополиуретан эластичный «Элаблок» марки ST 3040 производитель ООО «Европласт» (Россия) по ТУ 2254-001-70465083-2009;

При изготовлении кресла используется Клей мебельный Purtex Plus - изготовитель Universal Yapistirici Kimya, производства Турция (Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.06.01.008.Е.001253.03.13 от 27.03.2013 года).

Внешние поверхности обтягиваются материалом искусственной кожей марки SKADEN B353/AS, производства фабрики «SANWIL» Польша.

Материал изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (ДС ТР ТС 017/2011 Рег.номер RU Д-PL АУ 37.В.04123 выдано 30.01.15) и имеет следующие технологические характеристики:

1) масса, г/м² ≥ 450 ;

2) толщина, мм $0,9 \pm 0,2$

3) состав:

- покрытие ПВХ 100%

- основа Полиэфир 100%

4) не содержит кадмия , не содержит азокрасителей, согласно директиве Комиссии 2004/21/ЕК от 24.02.2004 (в отношении ограничений допуска на рынок и применения азокрасителей)

Материал водонепроницаемый и устойчив к появлению царапин, устойчив к чистке и дезинфекции. Материал Skaden B353/AS благодаря тиснению и огнестойкости используют как обивку стоматологических и процедурных кресел, больничных коек, массажных столов.

- «барашек-фиксатор» - используется марка материала АБС-пластик 1030, цвет черный, краситель производства Компания Karl Finke GmbH & Co.KG, Германия (Финке Колорс) марка FIBAPLAST с впаянной резьбовой шпилькой.

- ступенчатый механизм «Multiflex» (производство franko Franke GmbH & Co.KG).
- ступенчатый механизм «Rostomat» (производство franko Franke GmbH & Co.KG
- при изготовлении Штатива используется - труба нержавеющей круглая сталь марки AISI 304 по ГОСТ 11068 - d 16*1.5; d 20*1.5
- либо труба черная круглая сталь марки СтЗсп по ГОСТ 10704-91 – d 16*1.5; d 20*1.5;
- при изготовлении полотенцедержателя используется труба нержавеющей круглая сталь марки AISI 304 по ГОСТ 11068 - d 16*1.5;
- колеса с тормозом – модель C-1700-MTB-100-A18, производство NGWAY, Китай
- регулируемые опоры (ножки) – используется марка материала АБС-пластик 1030, цвет черный, краситель производства Компания Karl Finke GmbH & Co.KG, Германия (Финке Колорс) марка FIBAPLAST с впаянной резьбовой шпилькой.
- при изготовлении подушки – валика используется резинка производства ООО «ФИ-ТЕКС», г. Москва, ул. Кусковская д.20А. Резинка (единичная латексная (Cariflex IR0307 KU) нить (0,8-1,0) мм в текстильной оплётке – нить 8,4 текс из полиамида марки (РА 6) , черная) ширина 35 мм, по ТУ 8151-00159722763-2004

2.2 Регулировка подлокотников и подголовника осуществляется за счет «барашка-фиксатора».

Технические характеристики:

Наименование	Кресло пациента смотровое "МД-КПС-6"	процедурно-
Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	180	
Допустимая нагрузка на элементы трансформации	60	
Секция спина, не более, кг	30	
Секция ноги, не более, кг		
Габариты в стационарном положении:		
длина, не более, мм	1800	
ширина, не более, мм	1200	
ширина сидения, не более, мм	800	
Высота сидения над полом, мм	600+-20	
Высота фиксированная без подголовника, не более, мм	1400	
Высота фиксированная с опущенным подголовником, не более, мм	1450	
Высота фиксированная с выдвинутым подголовником, не более, мм	1600	
угол наклона секции спина, в пределах, °	от 0 до 80	
угол наклона секции ноги, в пределах, °	от минус 90 до 0	
вес изделия, не более, кг	40	

Конструктивные геометрические параметры:	
Каркас кресла	- трубы квадратные сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8639, ГОСТ Р 54157 - 20х20х1.5 мм ; 15х15х1.5 мм., - трубы прямоугольные сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8645 - 40х20х2.0 мм, ГОСТ Р 54157 - 40х20х1.5 мм. ; - труба черная круглая сталь марки СтЗсп по ГОСТ 10704-91 – d 16*1.5; d 20*1.5 - труба нержавеющая квадратная сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8639 - 20х20х1.5 мм ; 15х15х1.5 мм.; - труба нержавеющая прямоугольная сталь марки СтЗсп по ГОСТ 8645 - 40х20х2.0 мм; - труба нержавеющая круглая сталь марки СтЗсп по ГОСТ 11068 - d 16*1.5; d 20*1.5 - лакокрасочные покрытия – краска порошковая эпоксидно – полиэфирная, белая марка «MICROPUL» производитель «MICROPUL BOYA KIMYA SUN. VE TIC LTD STI» (Турция), Экспертное заключение рег. Номер 12-04-613 от 10.04.2012; - фанера ФСФ, Ш2 - 9 мм по ГОСТ 3916.1;
Температура поверхности кресла	Не превышает температуры окружающей среды
Состав кресла	
Подголовник	270*260 мм
Подлокотник узкий	370*120 мм
Колеса с тормозом*	Диаметр 100 мм
Регулируемые опоры (ножки)*	АБС пластик 1030 с резьбовой шпилькой
Барашки – фиксаторы	АБС пластик 1030 с резьбовой шпилькой

*комплектуется по желанию заказчика

3. Вариант исполнения (комплектация).

Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-6" с принадлежностями, в составе:

1. кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС".
2. подголовник – 1 шт.
3. подлокотники узкие 2 шт.
4. регулируемые опоры (ножки) или колеса с тормозом - 4 шт.*
5. барашки – фиксаторы – 3 шт.

Принадлежности:

1. инструкция по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.
2. упаковка – 1 шт.

*комплектуется по желанию заказчика

4. Подготовка к работе

Перед использованием изделия необходимо:

- выдержать кресло при комнатной температуре не менее 6 часов, если кресло хранилось или транспортировалось при отрицательной температуре;
- установить кресло на место и убедиться в его устойчивости. Для этого с помощью регулируемых опор (ножек), расположенных в нижней части кресла, выкручивая их, выставить кресло в устойчивое положение. Регулируемые опоры помогают исправить неровности пола.

5. Инструкция по эксплуатации:

Регулировка секции спина осуществляется за счет ступенчатого механизма «Multiflex» или «Rastomat» для более удобного положения пациента и работы врача, при проведении медицинских процедур. Регулировка происходит вручную в диапазоне угла наклона (от 0° до 80°).

Для того чтобы отрегулировать угол наклона спинной секции необходимо, поднимая ручную спинку от горизонтального положения в вертикальное, зафиксировать ее в нужном положении. Каждое положение сопровождается характерным щелчком, который означает, что механизм занял следующее положение. Если необходимо вернуть спинку в положение, ниже установленного, или в горизонтальное, нужно поднять ее до максимума и затем опустить до горизонта, после чего выставить нужное положение.

Регулировка секции ноги осуществляется за счет ступенчатого механизма «Rastomat» или «Multiflex» для более удобного положения пациента. Регулировка происходит вручную в диапазоне угла наклона (от минус 90° до 0°).

Для того чтобы отрегулировать угол наклона ножной секции необходимо, поднимая секцию вручную зафиксировать ее в нужном положении. Каждое положение сопровождается характерным щелчком, который означает, что механизм занял следующее положение. Если необходимо вернуть ножную секцию в положение, ниже установленного, нужно поднять ее до максимума и затем опустить, после чего выставить нужное положение.

Регулировка подлокотников осуществляется за счет «барашка-фиксатора» для более удобного положения рук пациента. Регулировка происходит вручную.


Для того чтобы отрегулировать положение подлокотников необходимо, повернуть «барашек-фиксатор», находящийся с двух сторон на боковой части кресла, против часовой стрелки и выдвинуть подлокотник вверх на необходимую высоту, после чего повернуть «барашек-фиксатор» по часовой стрелке и зафиксировать подлокотник.

Вращаются подлокотники и в зафиксированном положении. Для последующего изменения положения подлокотников по высоте проделать те же операции.

Регулировка подголовника осуществляется за счет «барашка-фиксатора» для более удобного положения головы пациента.

Для того чтобы отрегулировать положение подголовника необходимо, повернуть «барашек-фиксатор», находящийся позади подголовника против часовой стрелки и выдвинуть подголовник вверх на необходимую высоту, после чего повернуть «барашек-фиксатор» по часовой стрелке и зафиксировать подголовник. Для последующего изменения положения подголовника по высоте проделать те же операции.

Принципиальная схема (рисунок) работы кресла в сборе

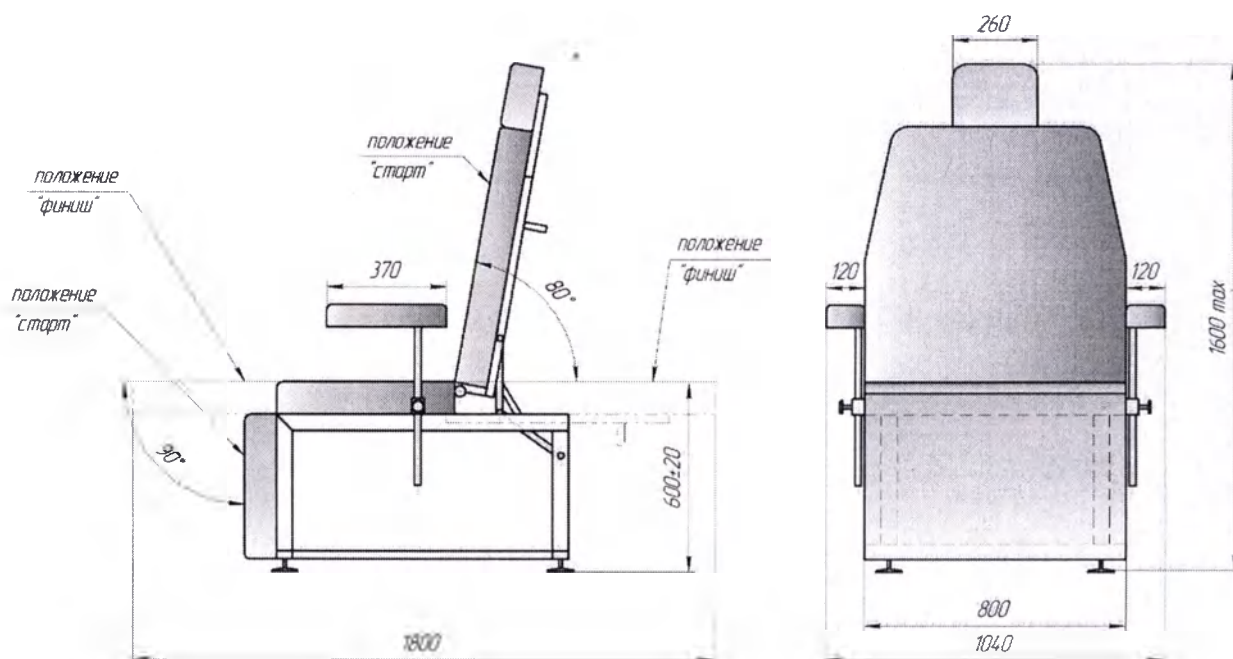

6. Меры предосторожности при работе с креслом

6.1 Перед использованием кресла необходимо убедиться в его устойчивости.

6.2 Запрещается использовать неисправное изделие и вносить изменения в конструкцию изделия.

При несоблюдении вышеперечисленных требований производитель не несет ответственности за возможные последствия.

7. Дезинфекция кресла

7.1. Дезинфекцию кресла проводить средством «Биоцидол-экспресс» представляющим собой готовую к применению прозрачную бесцветную жидкость. Содержание в составе в качестве действующих веществ: пропан-2-ол – 30 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) – 0,25%, полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид — 0,25%, неионогенный ПАВ, ингибитор коррозии, ароматизатор, pH средства – 7,0.

Применяется для обеззараживания способами орошения и протирания небольших по площади, а также труднодоступных для обработки поверхностей из

различных материалов, за исключением портящихся от воздействия спиртов (органическое стекло, поверхности, окрашенные спирторастворимым лаком).

Свидетельство о государственной регистрации № RU 77.99.88.002.E002097.03.14 от 27.03.2014 выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Возможно применение аналогичных дезинфицирующих средств.

7.2 Не использовать абразивные средства и растворители.

8. Противопоказания

Отсутствуют при использовании в соответствии с назначением к применению

9. Побочные действия.

Изделие не используется как лечебное медицинское изделие. Побочные эффекты не выявлены.

10. Техническое обслуживание

Не реже чем 1 раз в месяц необходимо проверять надежность затяжки резьбовых соединений.

11. Условия хранения, транспортирования и эксплуатации

11.1. Кресло хранят и транспортируют в собранном виде в недоступном для детей чистом, сухом, месте в упаковке производителя при температуре окружающего воздуха от -50°C до +50°C и относительной влажности 80%. Допускается перевозить кресла любым видом транспорта при соблюдении правил транспортирования.

11.2 Кресло эксплуатируется при температуре окружающей среды + 10°C до + 35°C при относительной влажности до 80% при 25°C.

11.3 Изделие не должно подвергаться ударным воздействиям, а также воздействию атмосферных осадков и агрессивных сред.

11.4 Нагрузка на трансформируемые элементы изделия не должна превышать 50 кг.

12. Гарантийные обязательства

12.1. Предприятие изготовитель ООО «Стильмед» 115580, Москва, ул. Кустанайская, д. 6, к. 2, кв. 59, гарантирует надежную работу Кресло пациента процедурно-смотровое "МД-КПС-6" заявленным свойствам в течение 12 месяцев с даты продажи, при условии соблюдения правил хранения, применения, обслуживания и транспортирования.

Срок службы – 6 лет с даты изготовления, указанной на упаковке, или даты продажи.

12.2 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при наличии механических повреждений изделия;
- при не соблюдении правил, установленных разделами 6, 7, 9 настоящего паспорта;
- при отсутствии паспорта изделия или при его неправильном заполнении.

12.3 Техническое обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт кресла осуществляет предприятие изготовитель ООО «Стильмед».

Претензии на качество изделия принимает ООО «Стильмед» - почтовый адрес: 115580, Москва, ул. Кустанайская, д. 6, к. 2, кв. 59. Претензии и предложения принимаются по тел. (499) 703-03-80; E-mail: stylemed@mail.

www.meddizain.ru

13. Утилизация изделия:

Упаковку утилизируют в места сбора бытового мусора.

По истечении срока службы кресло подлежит утилизации в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», как отходы класса А.

Дата выпуска

Дата продажи

М.П.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 9 листов
Подпись Александр

