





Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный «Акку-Чек Перформа Коннект» (Accu-Chek Performa Connect)



Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный «Акку-Чек Перформа Коннект» (Accu-Chek Performa Connect)





Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный «Акку-Чек Перформа Коннект» (Accu-Chek Performa Connect)

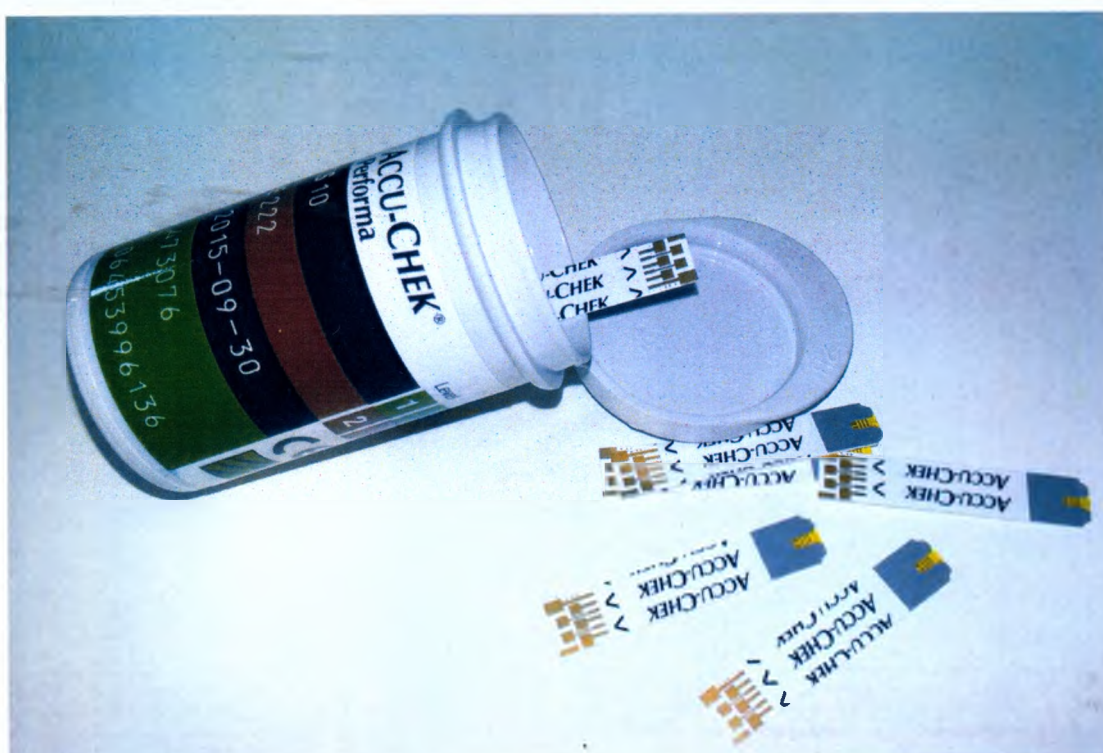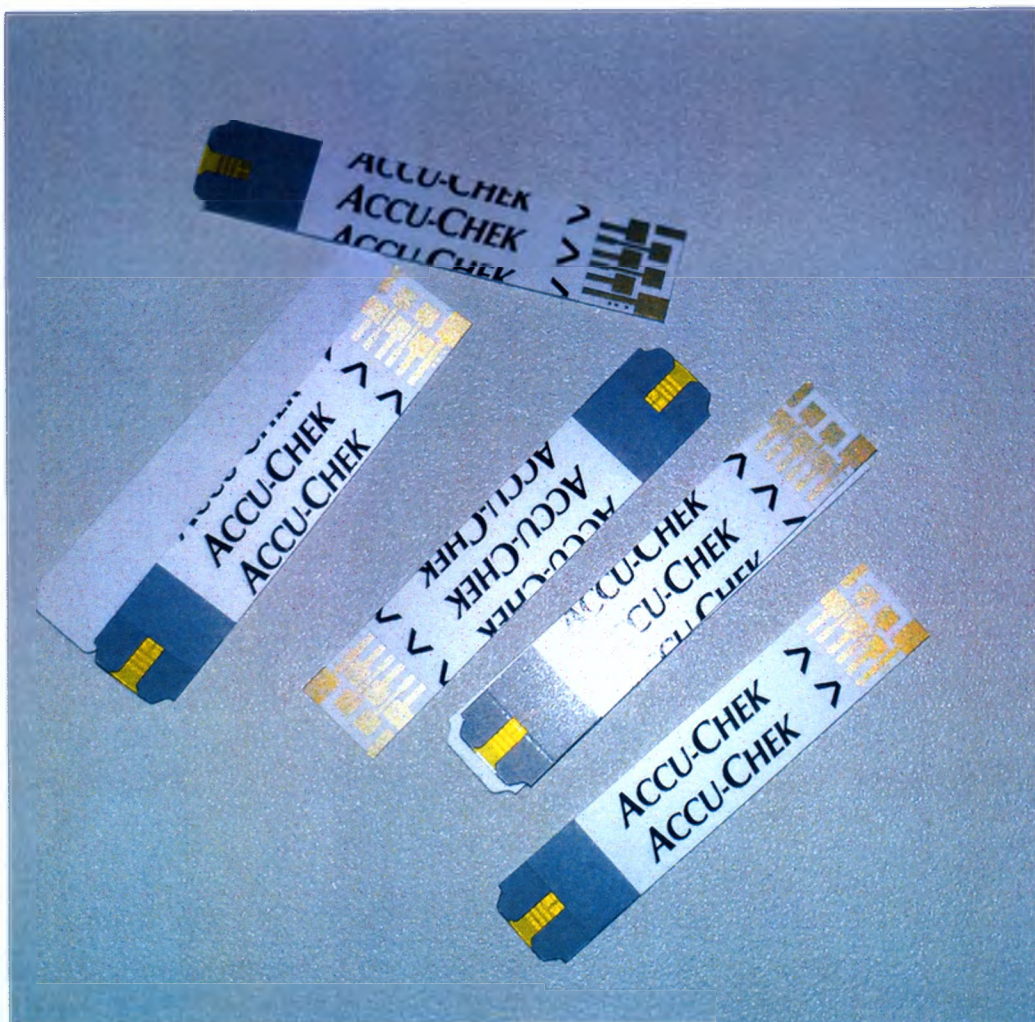

Тест-полоски Акку-Чек Перформа, 10 шт. (Accu-Chek Performa Test Strips 10)




Устройство для прокалывания кожи Акку-Чек Софткликс (Accu-Chek Softclix Lancing Device)

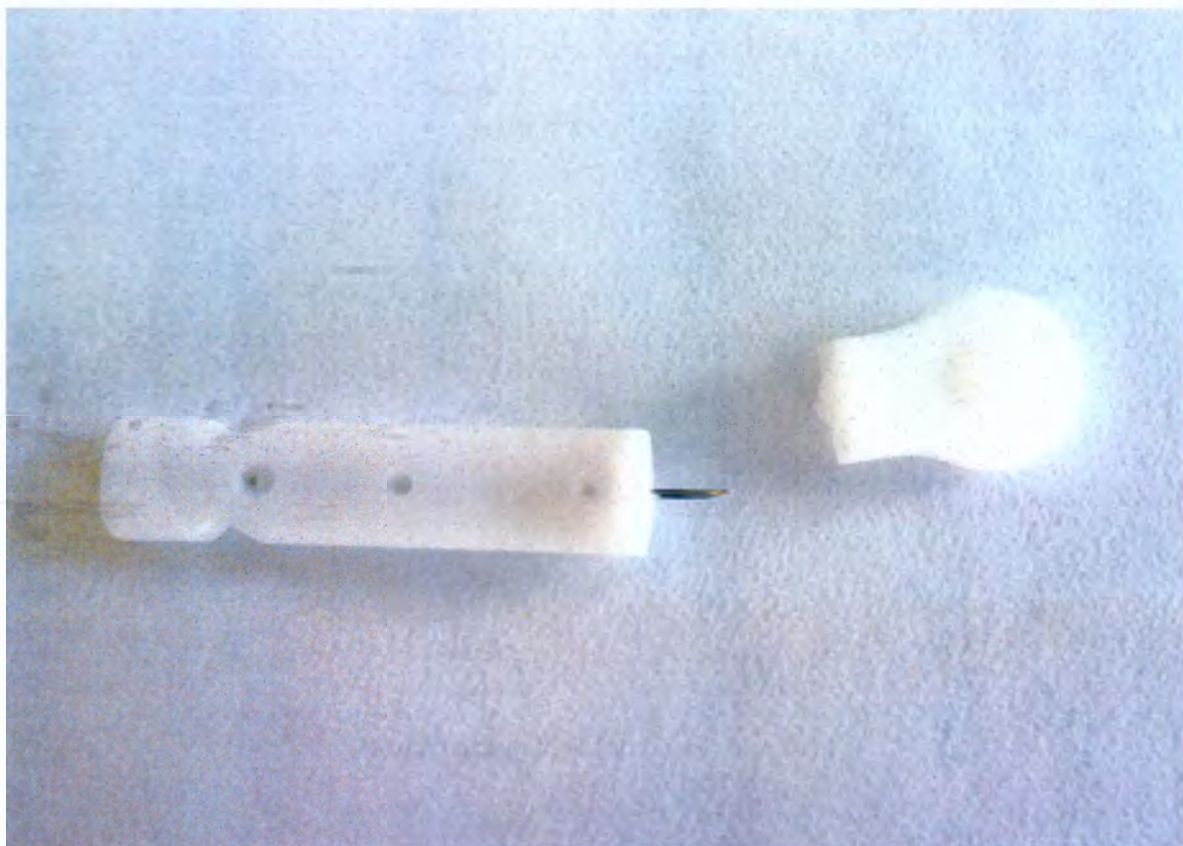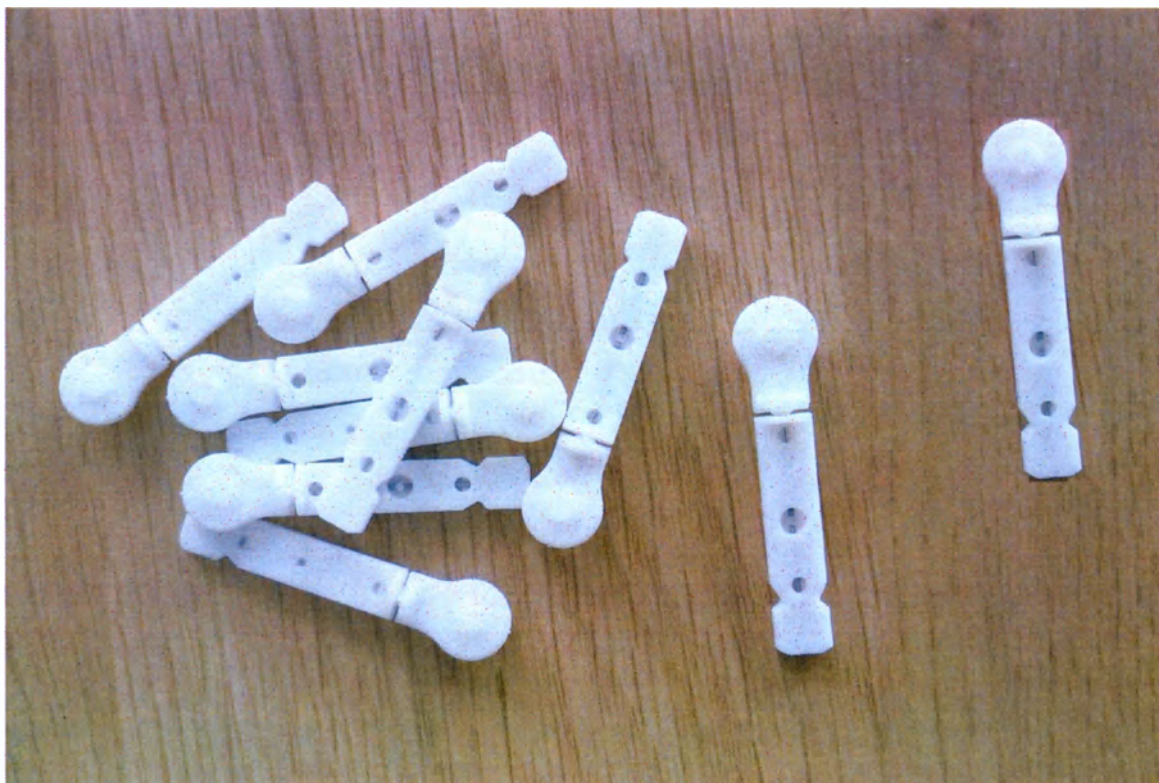

Ланцеты Акку-Чек Софткликс, 10 шт. (Accu-Chek Softclix Lancet 10)




Чехол (Accu-Chek Intl Carry Case 2014)

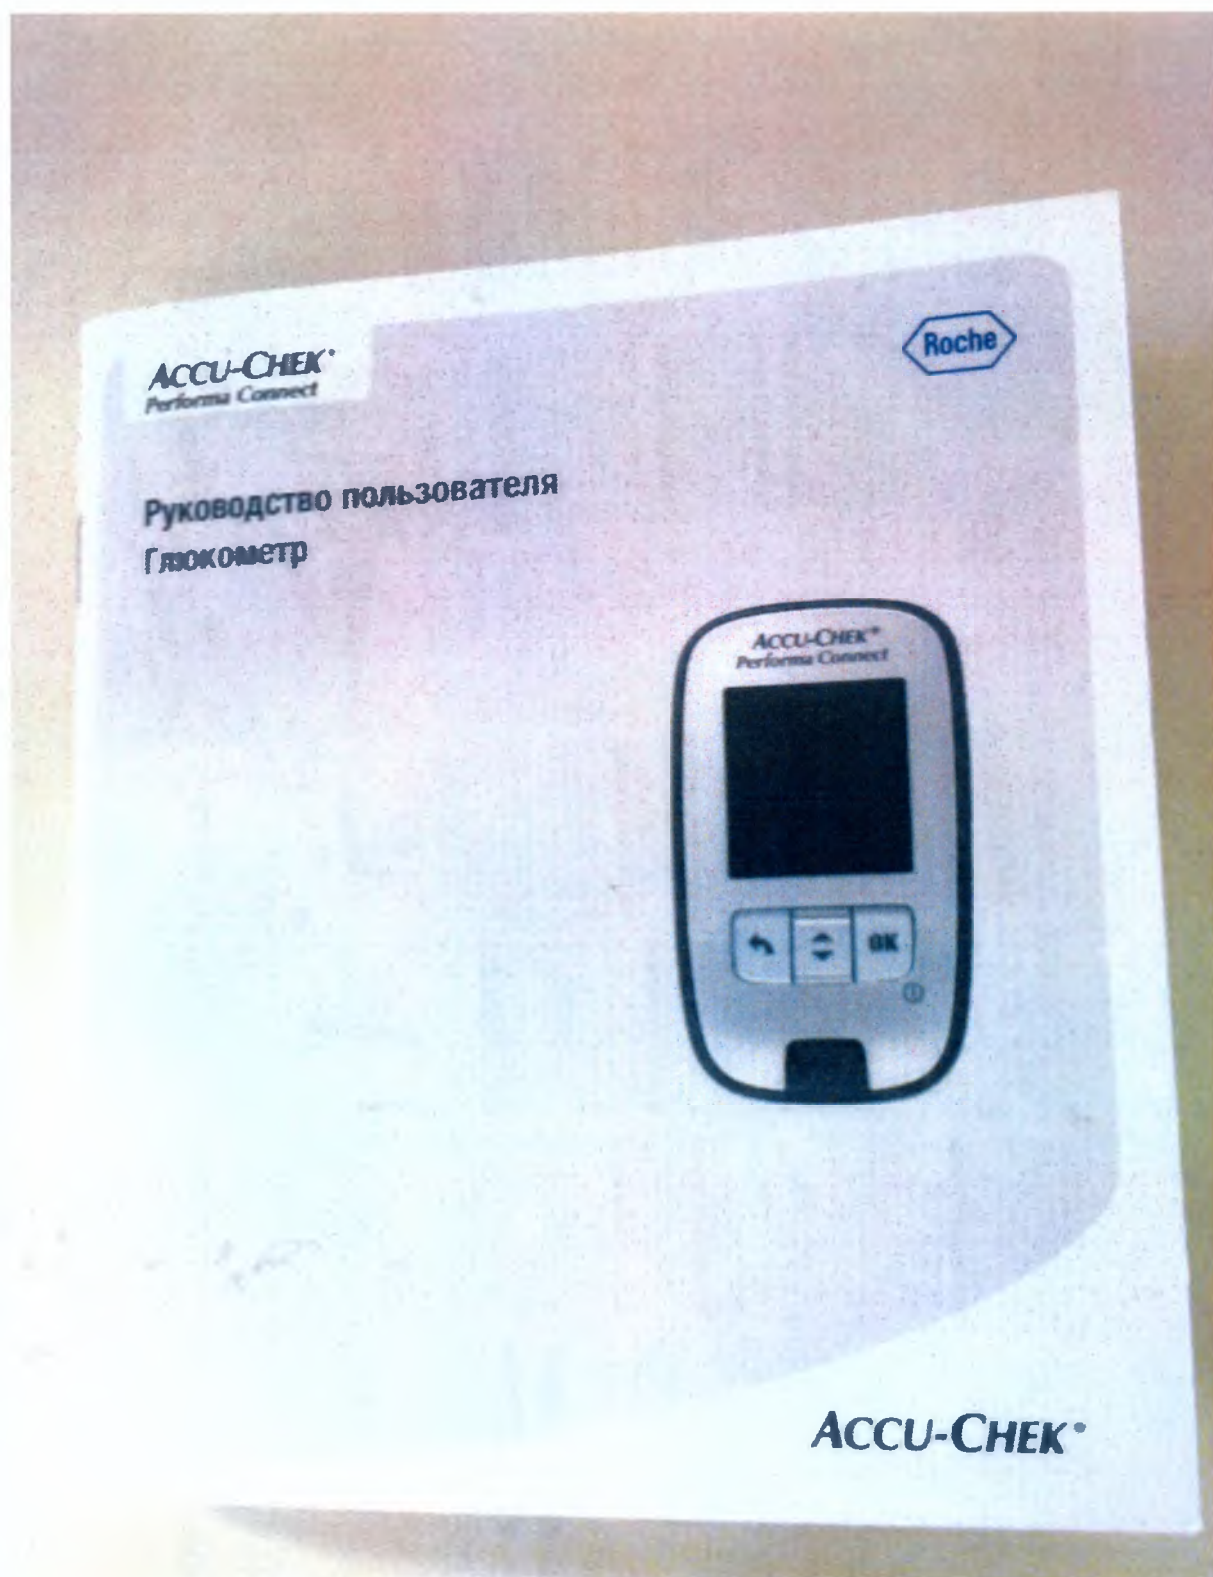

Руководство пользователя на глюкометр (User's Manual Accu-Chek Performa Connect)

Accu-Chek® Softclix
Устройство для прокалывания кожи

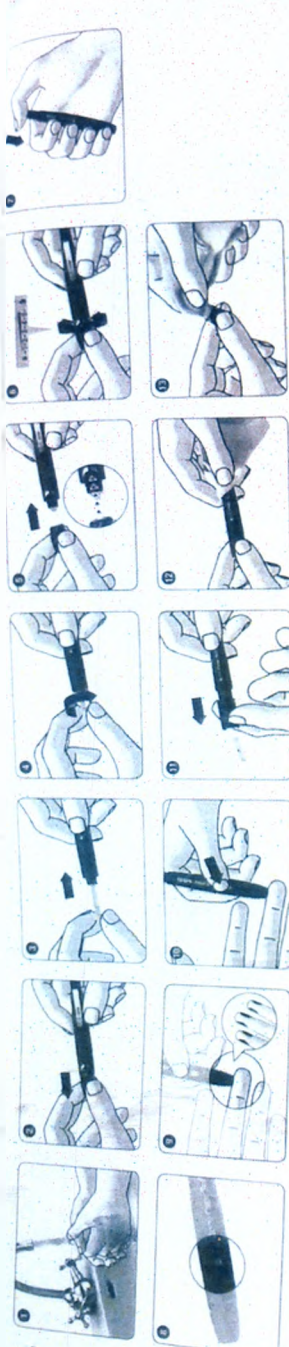

Рисунки-схемы
на рисунках показаны
последовательные этапы
использования устройства.
Они имеют
следующие значения:

- 1. Подготовка устройства к использованию.
- 2. Вставка иглы.
- 3. Прижимание устройства к коже.
- 4. Извлечение иглы.
- 5. Протирание капли крови.
- 6. Нанесение капли крови на тест-полоску.
- 7. Вставка тест-полоски в анализатор.
- 8. Чтение результата.
- 9. Извлечение тест-полоски.
- 10. Утилизация иглы.
- 11. Хранение устройства.
- 12. Проверка устройства.

Инструкция по использованию

Устройство для прокалывания кожи Акку-Чек Софтклик предназначено для получения крови из пальца руки. Это устройство можно использовать для прокалывания кожи в том месте, где вы обычно делаете прокол. Устройство для прокалывания кожи имеет 11 позиций для прокалывания кожи. Выберите позицию, соответствующую вашему типу кожи.

Данная инструкция по использованию устройства 2-го поколения предназначена для пользователей, которые уже использовали устройство 1-го поколения. Если вы используете устройство впервые, пожалуйста, прочтите инструкцию по использованию устройства 1-го поколения.

Данное устройство предназначено для использования в домашних условиях. Оно не предназначено для использования в медицинских учреждениях.

Устройство для прокалывания кожи Акку-Чек Софтклик имеет следующие характеристики:

- Устройство для прокалывания кожи имеет 11 позиций для прокалывания кожи.
- Устройство для прокалывания кожи имеет встроенный механизм, который автоматически извлекает иглу после прокалывания.
- Устройство для прокалывания кожи имеет встроенный механизм, который автоматически протирает каплю крови.
- Устройство для прокалывания кожи имеет встроенный механизм, который автоматически наносит каплю крови на тест-полоску.
- Устройство для прокалывания кожи имеет встроенный механизм, который автоматически вставляет тест-полоску в анализатор.
- Устройство для прокалывания кожи имеет встроенный механизм, который автоматически читает результат.
- Устройство для прокалывания кожи имеет встроенный механизм, который автоматически извлекает тест-полоску.
- Устройство для прокалывания кожи имеет встроенный механизм, который автоматически утилизирует иглу.
- Устройство для прокалывания кожи имеет встроенный механизм, который автоматически хранит устройство.
- Устройство для прокалывания кожи имеет встроенный механизм, который автоматически проверяет устройство.

Информация для заказа

Если вы желаете заказать устройство для прокалывания кожи Акку-Чек Софтклик, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 100-1011 или по электронной почте info@accu-chek.ru.

Информация о гарантии

Устройство для прокалывания кожи Акку-Чек Софтклик имеет гарантию на 2 года. Гарантия распространяется на все компоненты устройства, кроме иглы. Игла является расходным материалом и не подлежит гарантии.

Информация о безопасности

Устройство для прокалывания кожи Акку-Чек Софтклик является безопасным устройством. Оно имеет встроенный механизм, который автоматически извлекает иглу после прокалывания. Это предотвращает риск заражения и травмы.

Информация о сертификации

Устройство для прокалывания кожи Акку-Чек Софтклик имеет сертификаты CE, ISO 13485 и ISO 9001.

Информация о контактах

Компания Акку-Чек Софтклик
ООО Акку-Чек Софтклик
г. Москва, Россия, 101031
Телефон: 8 (800) 100-1011
E-mail: info@accu-chek.ru
Адрес в Интернете: www.accu-chek.ru


Информация о производителе

Устройство для прокалывания кожи Акку-Чек Софтклик производится в Германии. Оно имеет все необходимые сертификаты и разрешения для использования в России.

Информация о дистрибьюторе

Устройство для прокалывания кожи Акку-Чек Софтклик продается в России по адресу: г. Москва, Россия, 101031. Контактная информация: 8 (800) 100-1011.

Руководство пользователя на устройство для прокалывания кожи Акку-Чек Софтклик (User's Manual Accu-Chek Softclix Lancing Device)

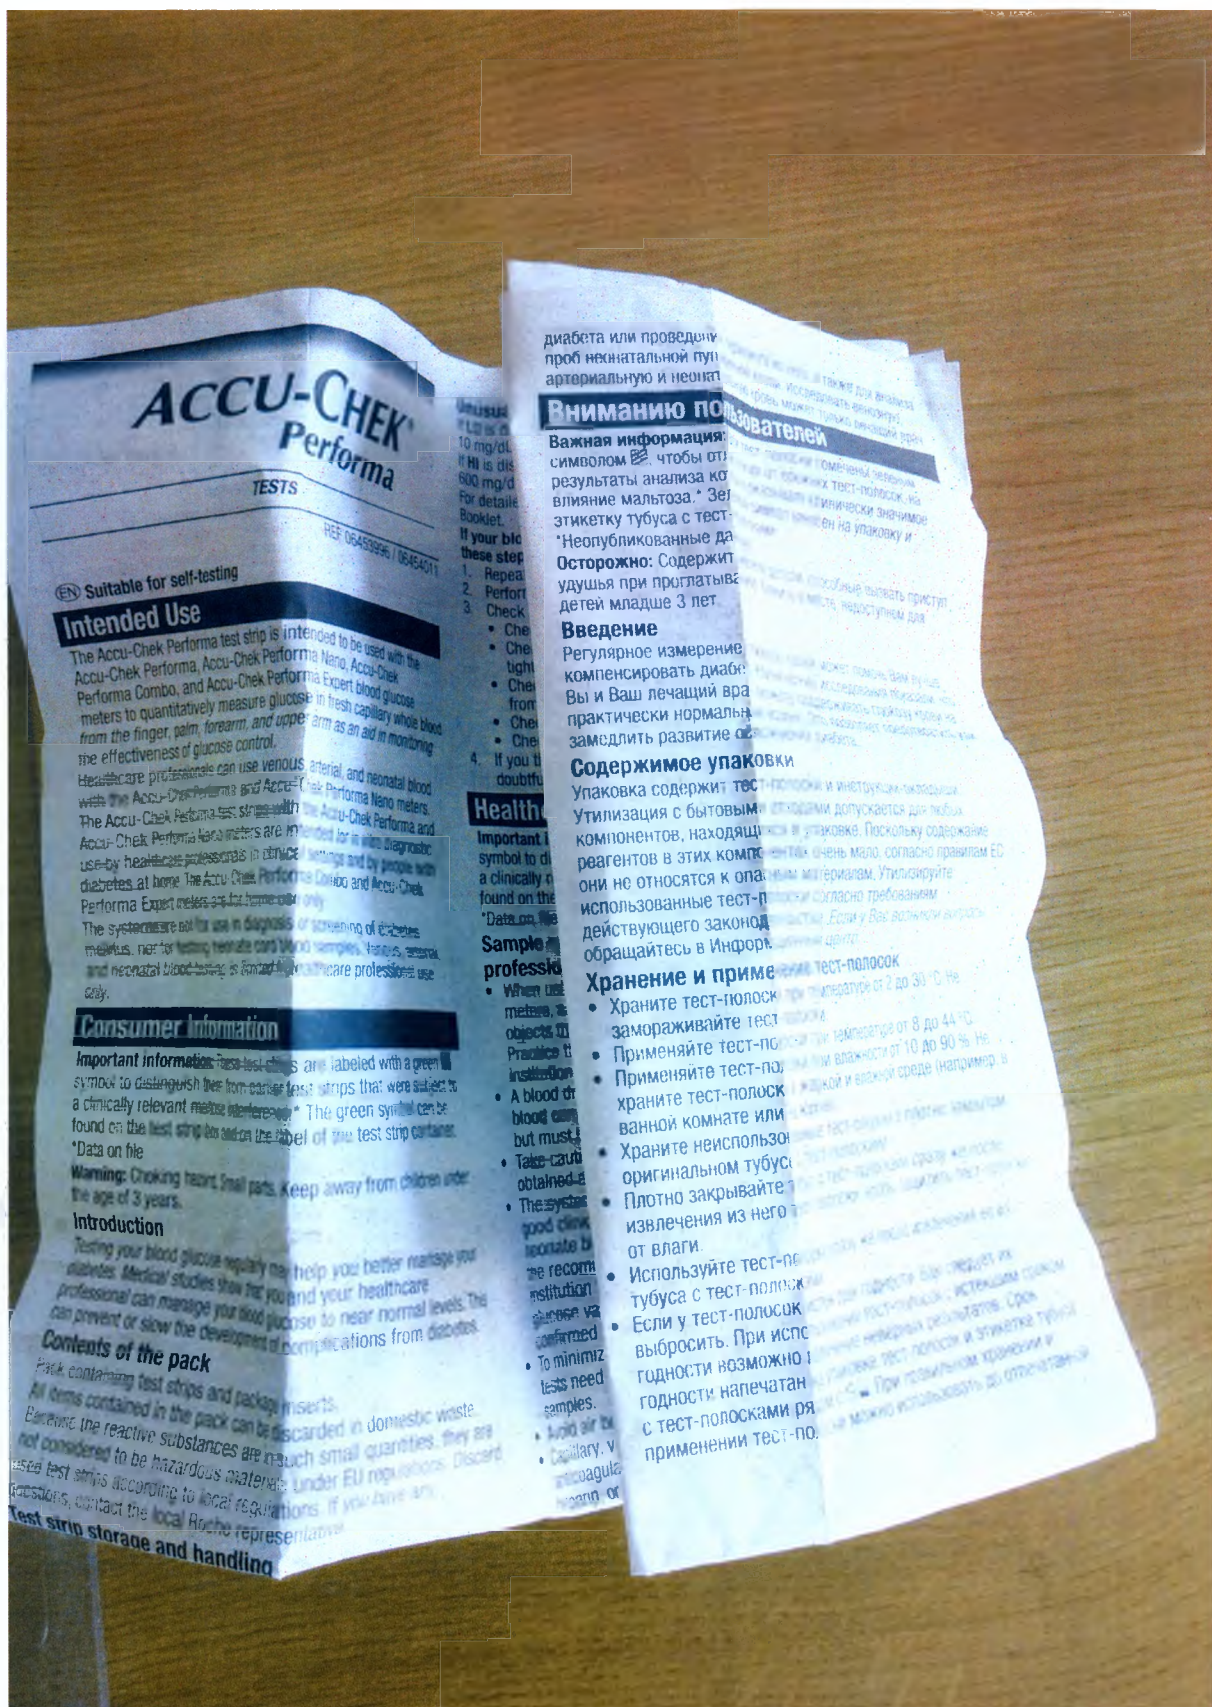

Руководство пользователя на тест-полоски Акку-Чек Перформа (User's Manual Accu-Chek Performa Test Strips)



Краткая инструкция «Начните здесь» (Quick Start Guide Start Here)



Краткая инструкция по подключению «Настройка подключения» (Quick connection guide)

ACCU-CHEK® Performa Connect

Клинически подтвержденные инструменты
для управления диабетом^{1,2}

- Точные данные о питании, образе жизни и лечении
помогут контролировать уровень глюкозы крови
- Ручной глюкометр Accu-Chek Performa Connect
- Поддержка устройств компьютерной системы для
получения данных с помощью беспроводной связи

ACCU-CHEK®
Connect



ACCU-CHEK® Performa Connect

Беспроводная система контроля уровня
глюкозы крови

Содержание:

- Глюкометр Акку-Чек Перформа Коннект
с батареями
- Тест-полоски Акку-Чек Перформа
- Устройство для прокалывания кожи
Акку-Чек Софткликс
- Ланцеты Акку-Чек Софткликс
- Чехол
- Инструкция по использованию

Возможно использовать для
проведения самоконтроля

ACCU-CHEK®

Performa Connect

Смотри. Анализируй. Решай - дистанционно

Беспроводная связь с мобильным устройством*

- Автоматическое отправление результатов измерения в дневник приложения Акку-Чек Коннект
- Просмотр закономерностей глюкозы крови на мобильном устройстве

*Необходимо приложение Акку-Чек Коннект.
Для получения списка совместимых мобильных устройств сканируйте QR-код на верхней части упаковки.



Experience what's possible.

Roche

ACCU-CHEK®

Performa Connect

¹ Полонски ВХ, и др. Структурированный самоконтроль глюкозы крови существенно снижает уровень HbA1c у плохо контролируемых пациентов с диабетом 2 типа, не использующих инсулинотерапию: Результаты исследования Программы Структурированного Тестирования. Журнал «Diabetes Care». 2011; 34(2): 262-267.

² Зиглер Р, и др. Использование расчета болюса улучшает контроль глюкозы у пациентов, использующих многократные инъекции инсулина с субоптимальным контролем глюкозы: Первые результаты исследования АБАКУС. Журнал «Diabetes Care». 2013; 36: 3613-3619.

Контактная информация
ООО «Рош Диагностика Рус»
Бизнес-центр «Негловая Плаза»
Трубная площадь, д.2
Москва, Россия, 107031
Информационный центр:
8-800-200-88-99 (звонок бесплатный для всех
регионов России)
E-mail: info@accu-check.ru
Адрес в Интернете: www.accu-check.ru

2 °C 30 °C



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

www.accu-check.com

Изготовлено в США

Bluetooth® текстовый символ и логотип являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих знаков фирмой Roche осуществляется по лицензии.

Все остальные торговые марки и фирменные наименования являются собственностью их владельцев.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK PERFORMA, PERFORMA CONNECT, SOFTCLIX и ARKU-CHEK — торговые марки фирмы Roche.



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
15 листа (ов)

