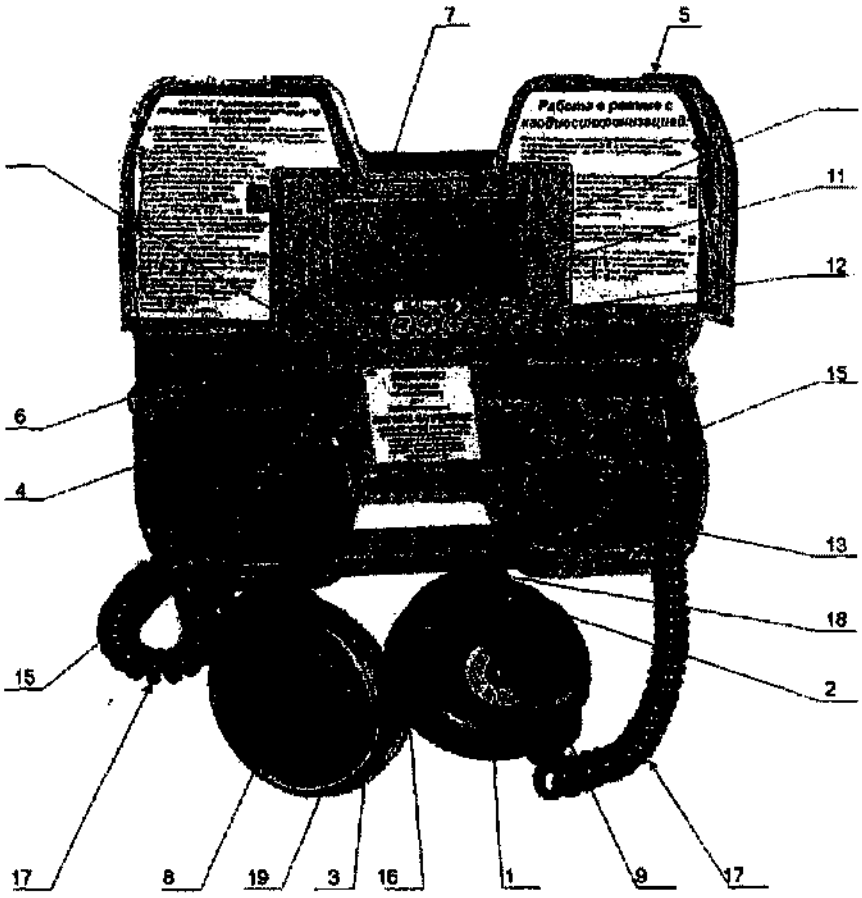

1- переключатель установленных токов
2 кнопка 2 (заряд конденсатора)
3 кнопка 4 (заряд конденсатора)
4 Корпус
5 Откидная панель(крышка)
6 Выключатель питания
7Экран монитора
8 Экран монитора
9 Электрод дозатор
10 переключатель «ЭКГ/ВН-ВНЕШ»
11 Выключатель кардиосинхронизации
12 кнопка включения режима
13 Ниша с кабелем ЭКГ- отведений и разъемом для подключения ПЭВМ
14 Крышка ниши
15 Контактные площадки проверки работоспособности
16. Кнопка «УСИЛЕНИЕ»
17 Высоковольтный привод электродов для дефибриляции
18 Индикатор «Готов»
19 Индикатор наличия цепи Пациента – «ЦЕПЬ ПАЦИЕНТА»

Рисунок 3. Общий вид аппарата

На "левом электроде" расположены:

3 - кнопка [3] **«РАЗРЯД»,** выполняющая функцию разряд совместно с кнопкой [2];

16 - кнопка **«УСИЛЕНИЕ»,** выполняющая функцию переключения уровня чувствительности усилителей ЭКС с условным уровнем усилителя от 1 до 4.

19 - индикатор наличия цепи пациента **«ЦЕПЬ ПАЦИЕНТА».**

На рисунке 4 показан экран кардиомонитора с основными символами режимов работы и параметров дефибриллирующего воздействия. Поле экрана условно разбито на зоны, обозначенные буквами от «а» до «к», в которых индицируются:

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ