COVIDIEN
Общество с ограниченной ответственностью
«Ковидиен Евразия»
105120, Россия, г.Москва, переулок Сыромятнический 2-Й, дом 1 Тел.: (495) 9336469 Факс: (495) 9336468
ИНН 7710385950, КПП 770901001, ОГРН 1027739579284, ОКПО 17163858

Фотографические изображения медицинского изделия:

Аппарат искусственной вентиляции легких Newport E360, с принадлежностями

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ




Основной блок аппарата

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Датчик потока (2 шт.)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

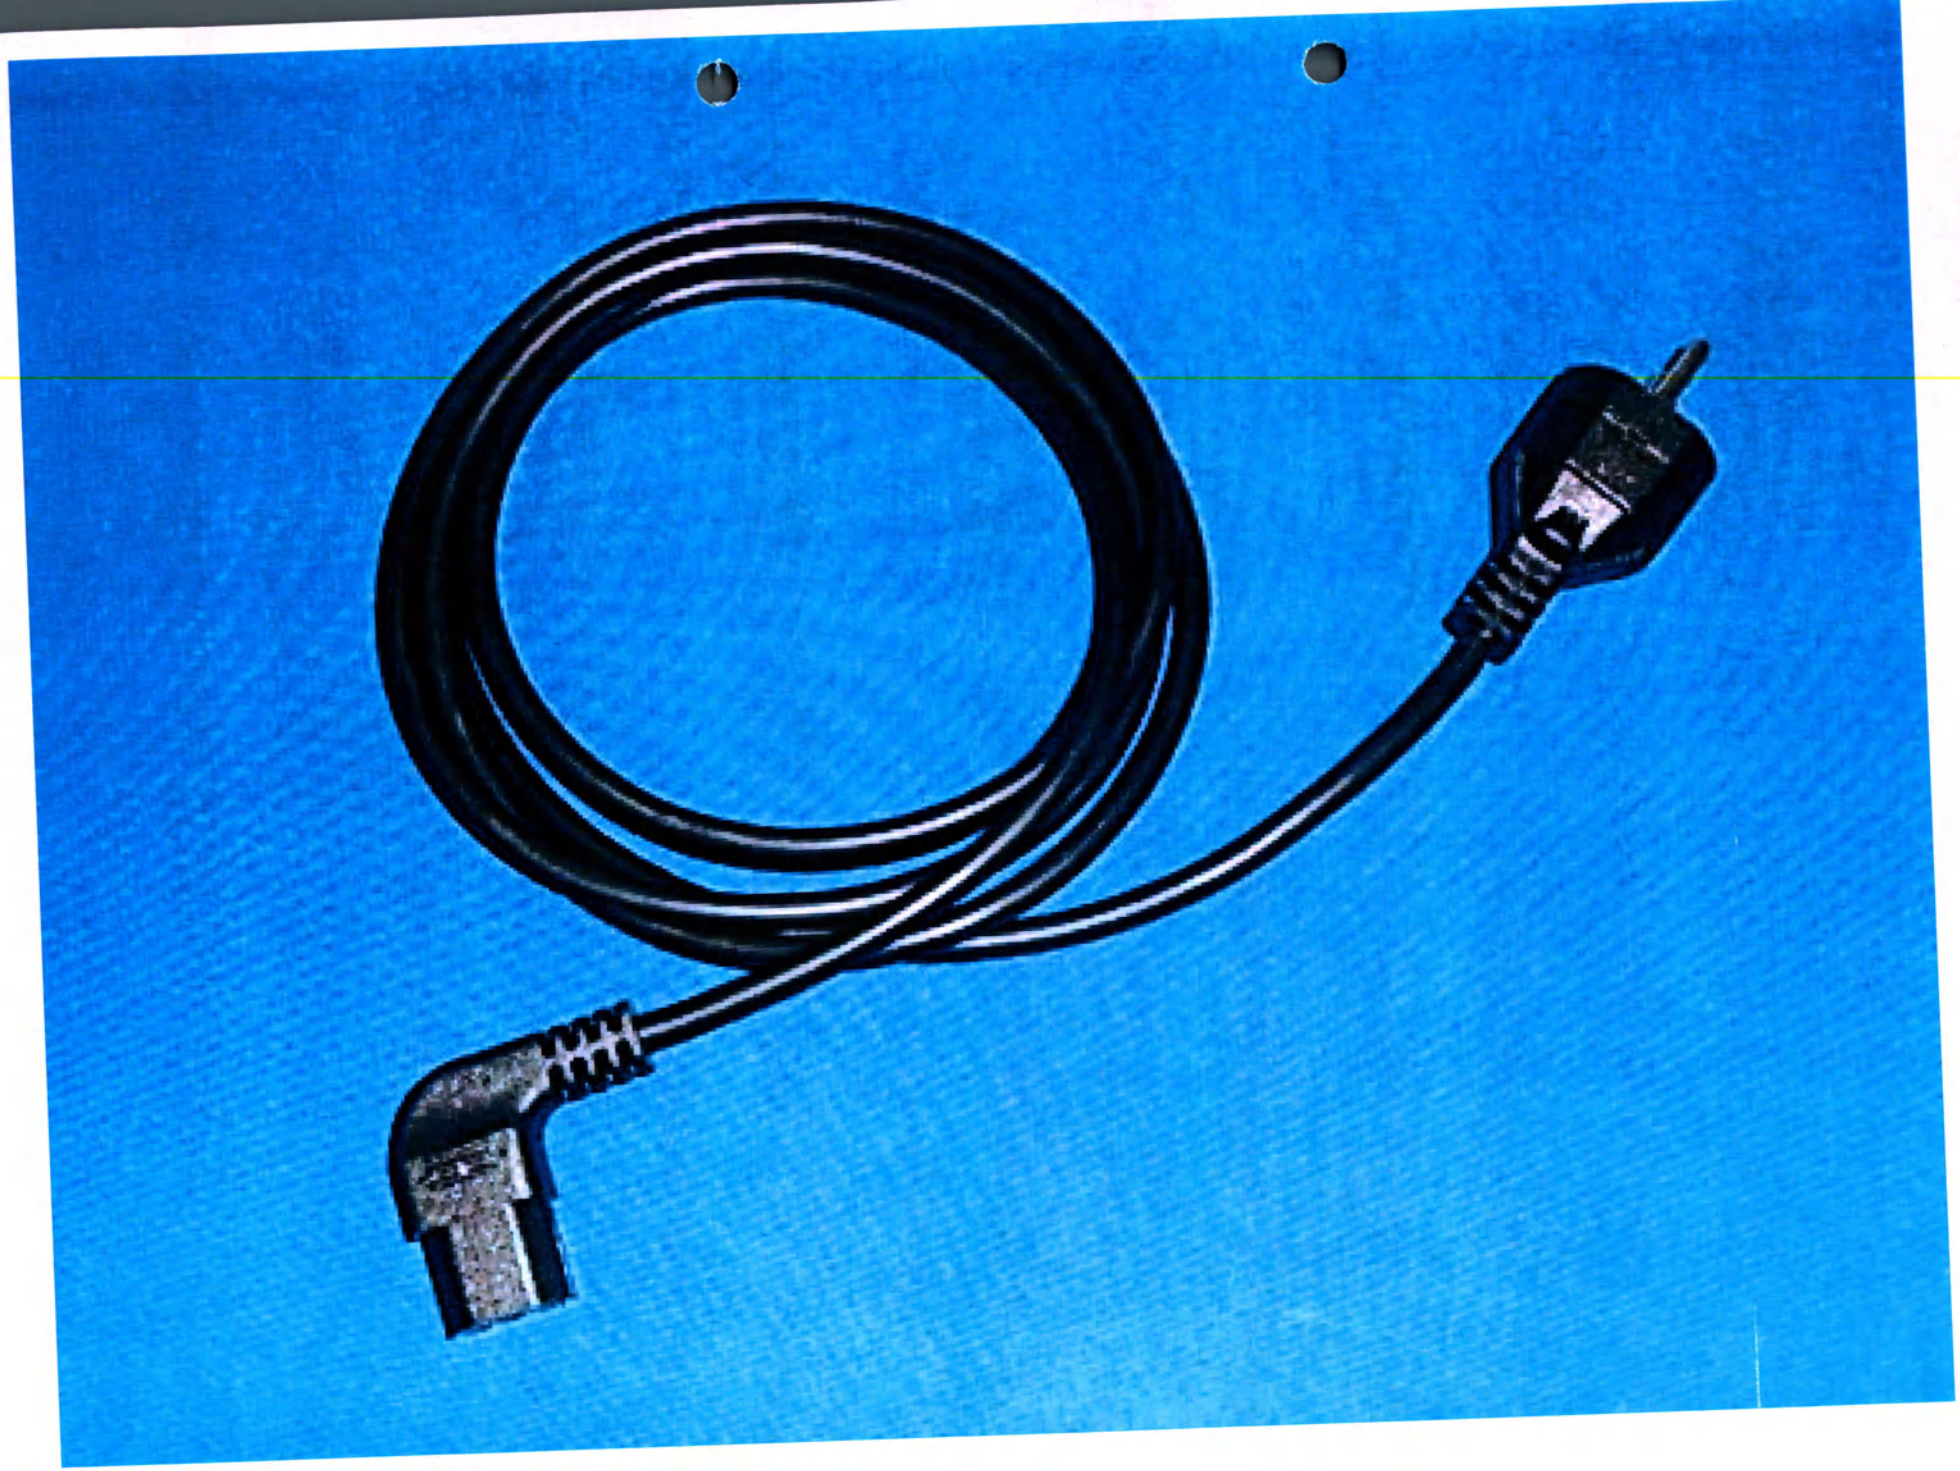

Кабель питания

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

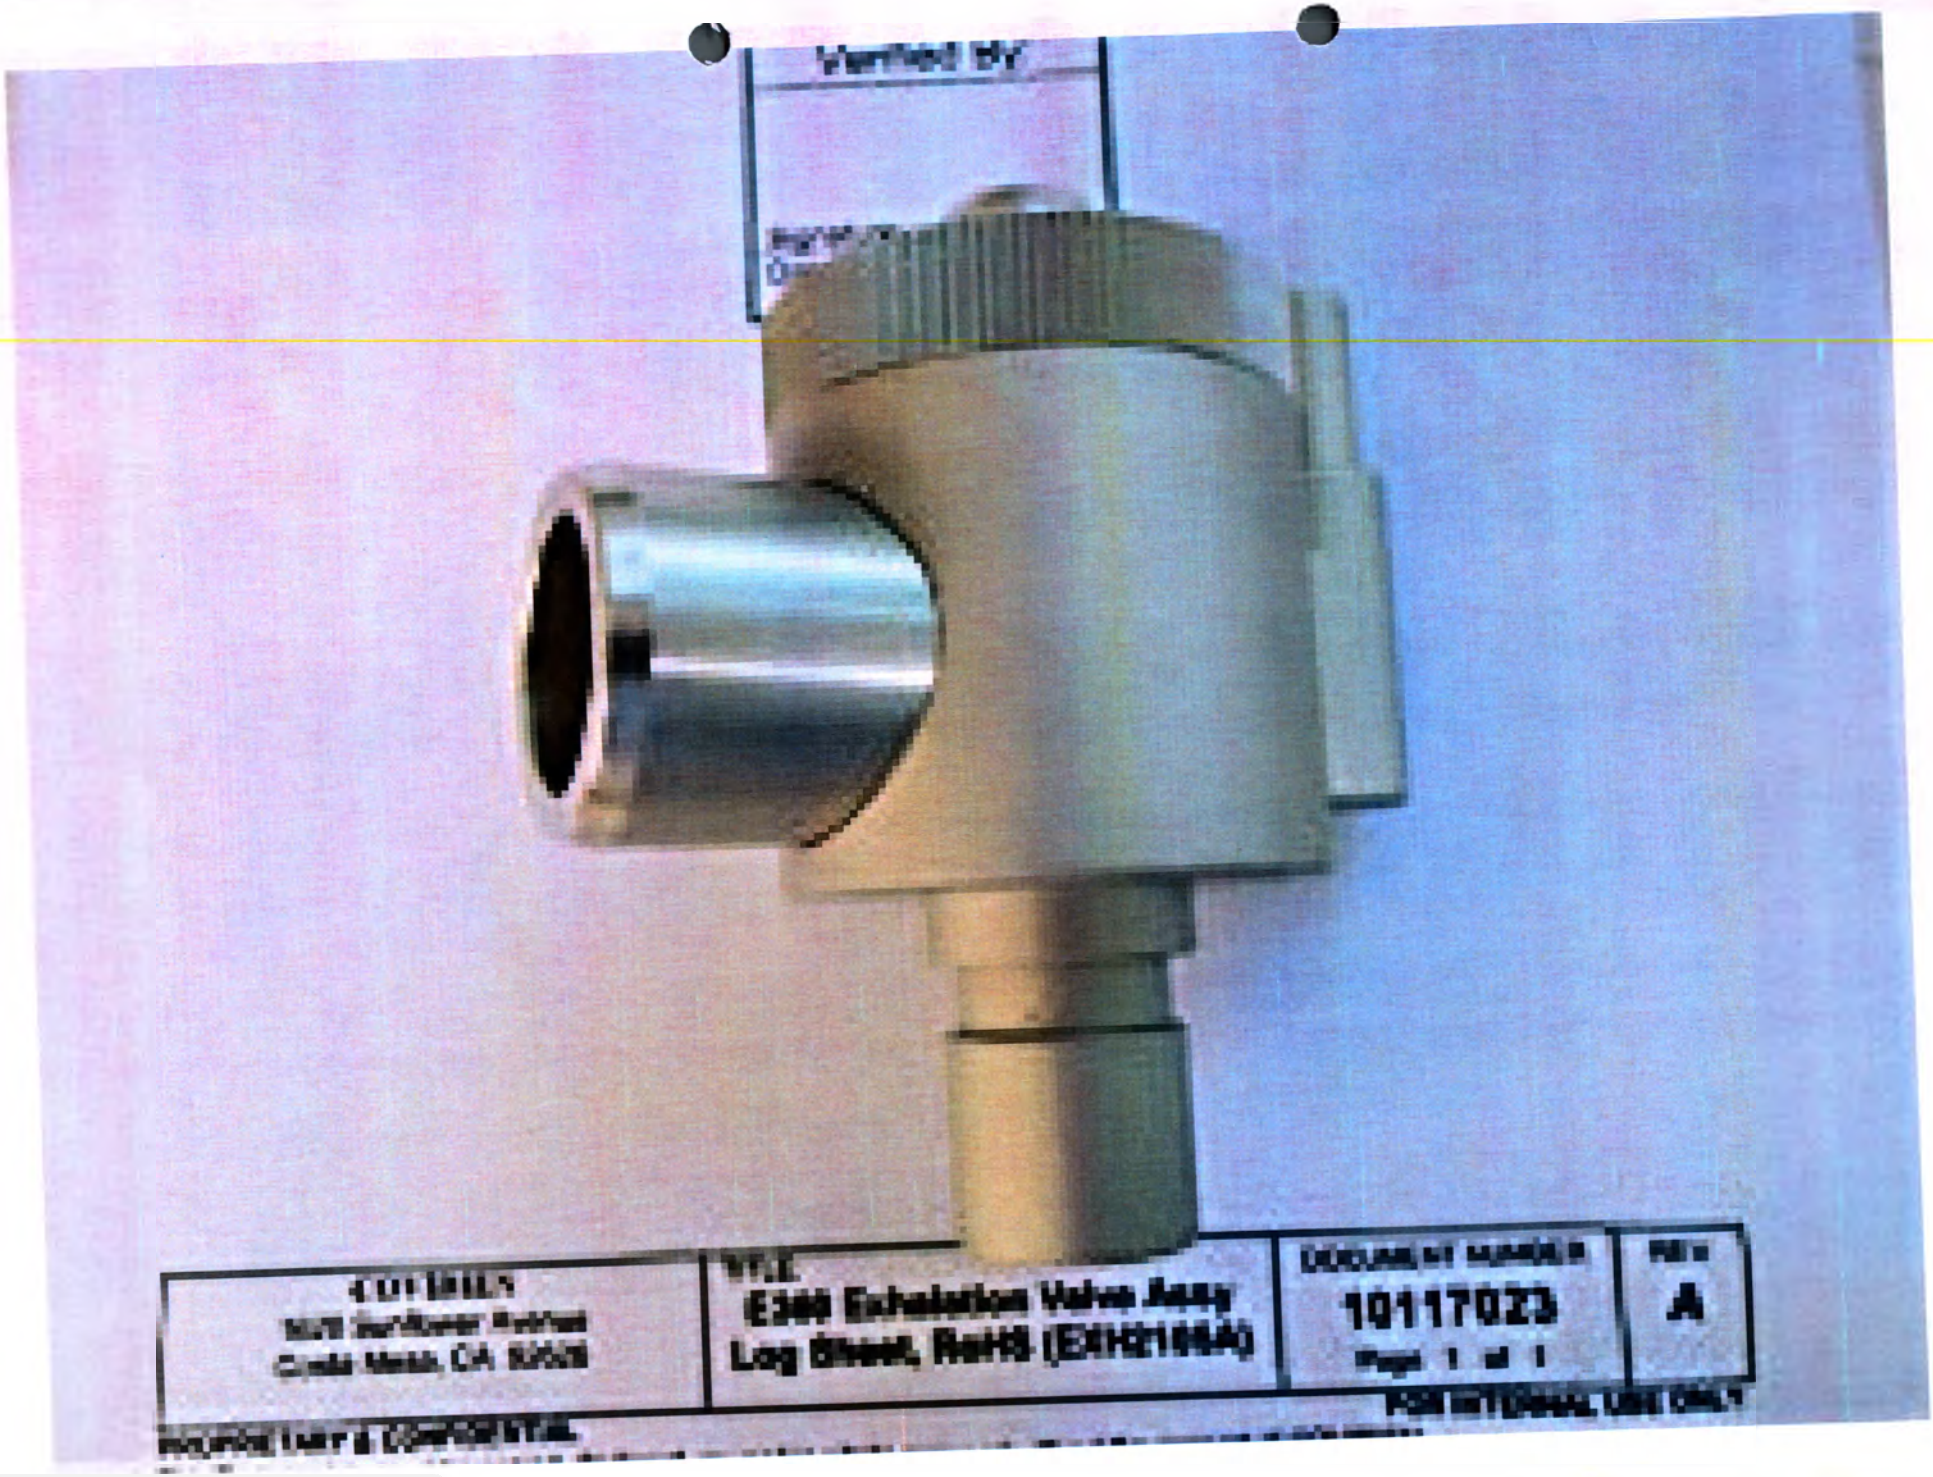

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Клапан выдоха многоразовый

Newport Medical Instruments, Inc.

АППАРАТ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ NEWPORT e360

Инструкция по эксплуатации

Модели e360E

OPR360E-RU Rev. A

01/08

Newport MEDICAL

NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS, INC.
1620 Sunflower Avenue Costa
Mesa, CA 92626 USA
Tel: 1.714.427.5811
Tel: 1.800.451.3111 (только из США)
Fax: 1.714.427.0489
доб. Клинического отдела 282

www.Ventilator.com

email: Info@ventilator.com


CE 0344

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Комплект фильтра дыхательного контура ACC2100, ACC2102, ACC2100, ACC2104J, ACC2106, ACC2105

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

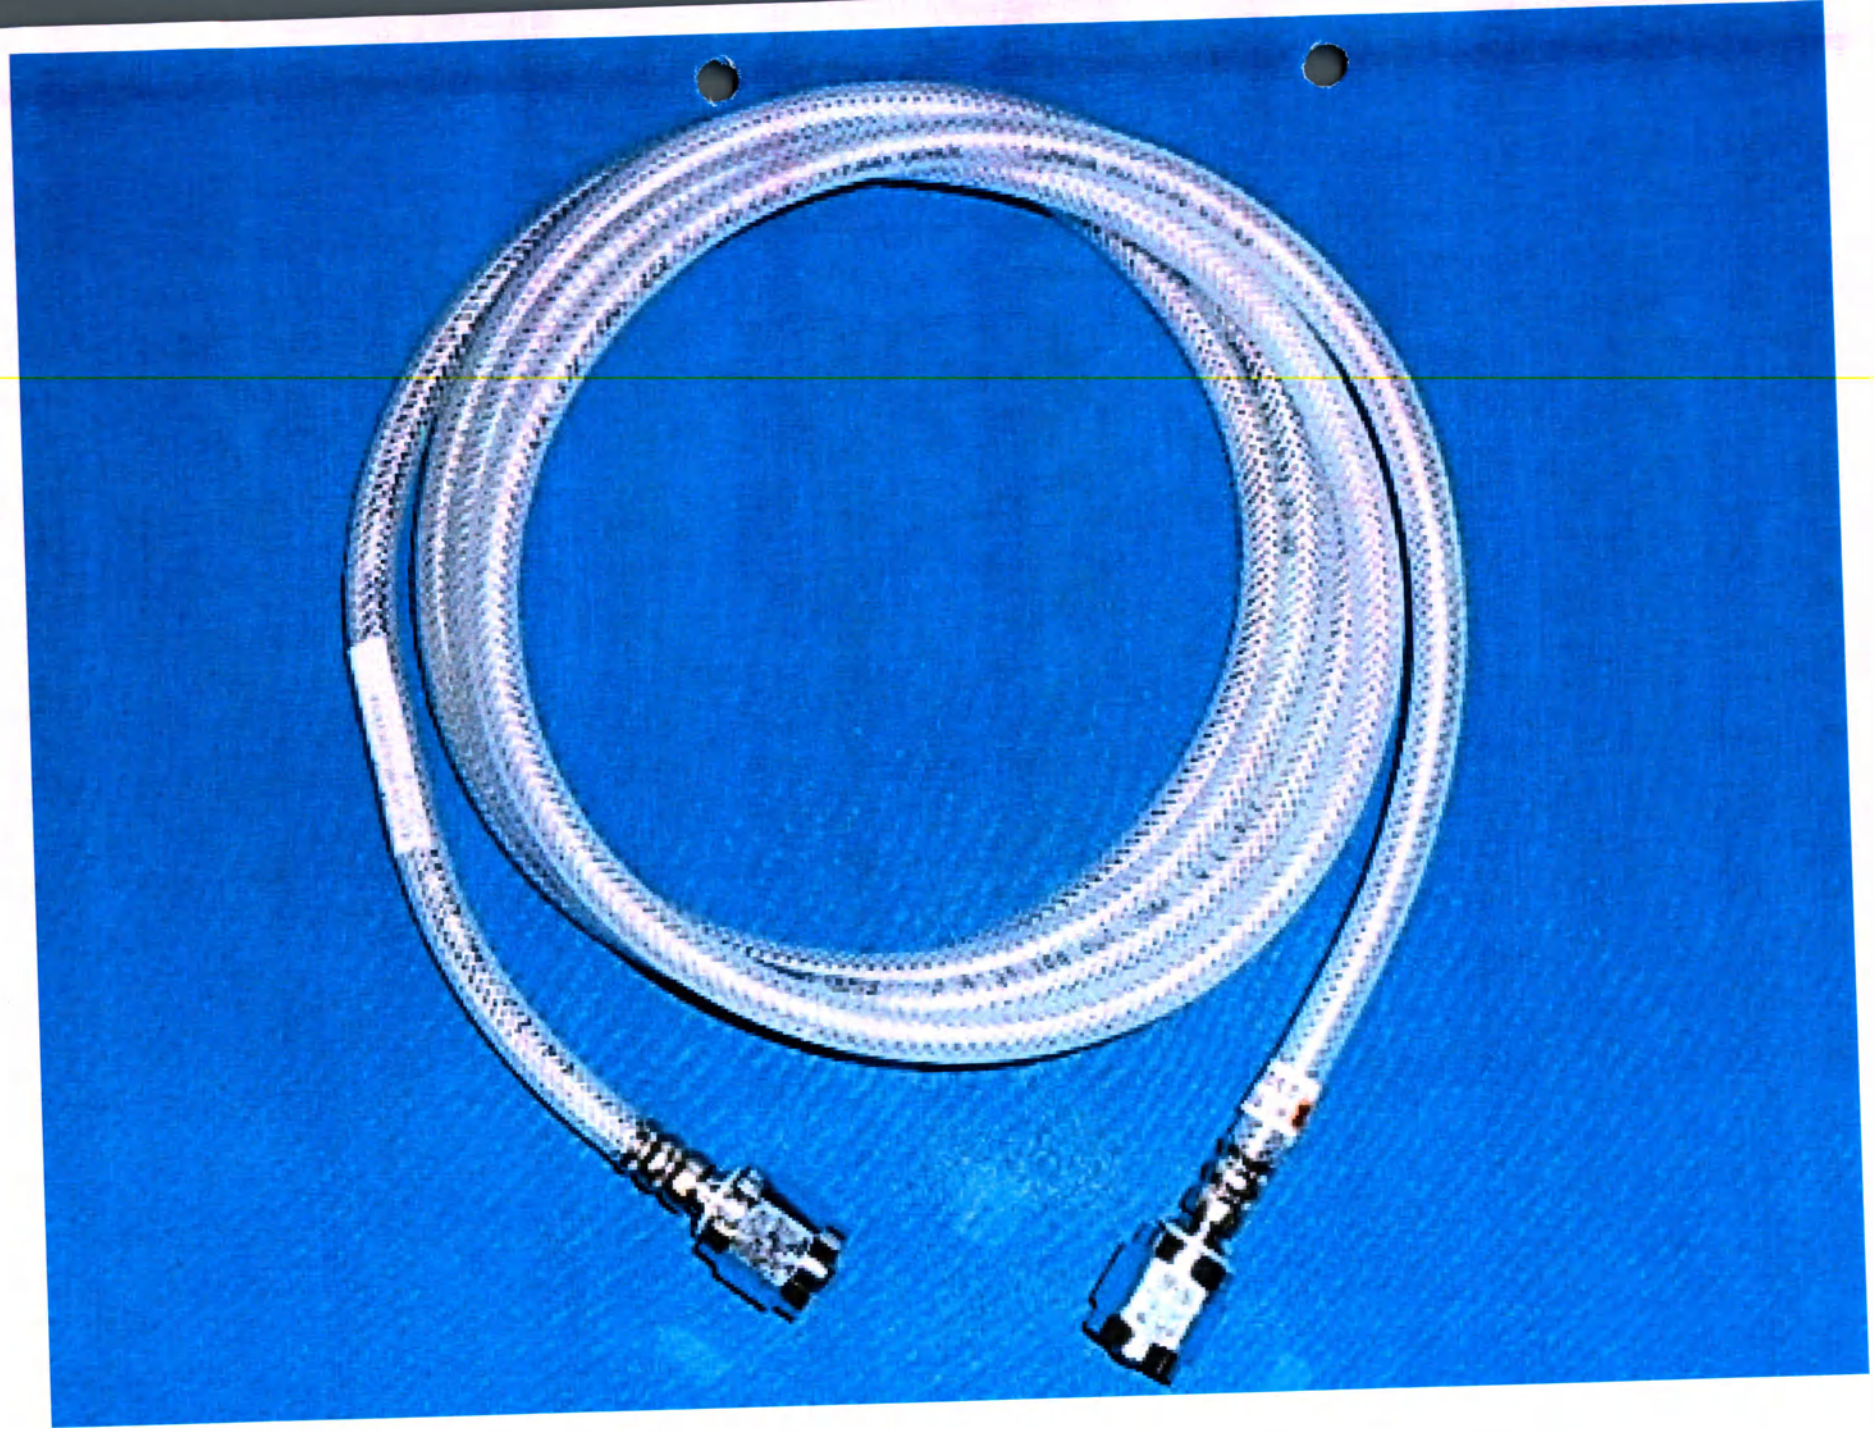


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Шланг кислородный HOS802P, HOS804P, HOS806P, HOS807P, HOS810P, HOS813P

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

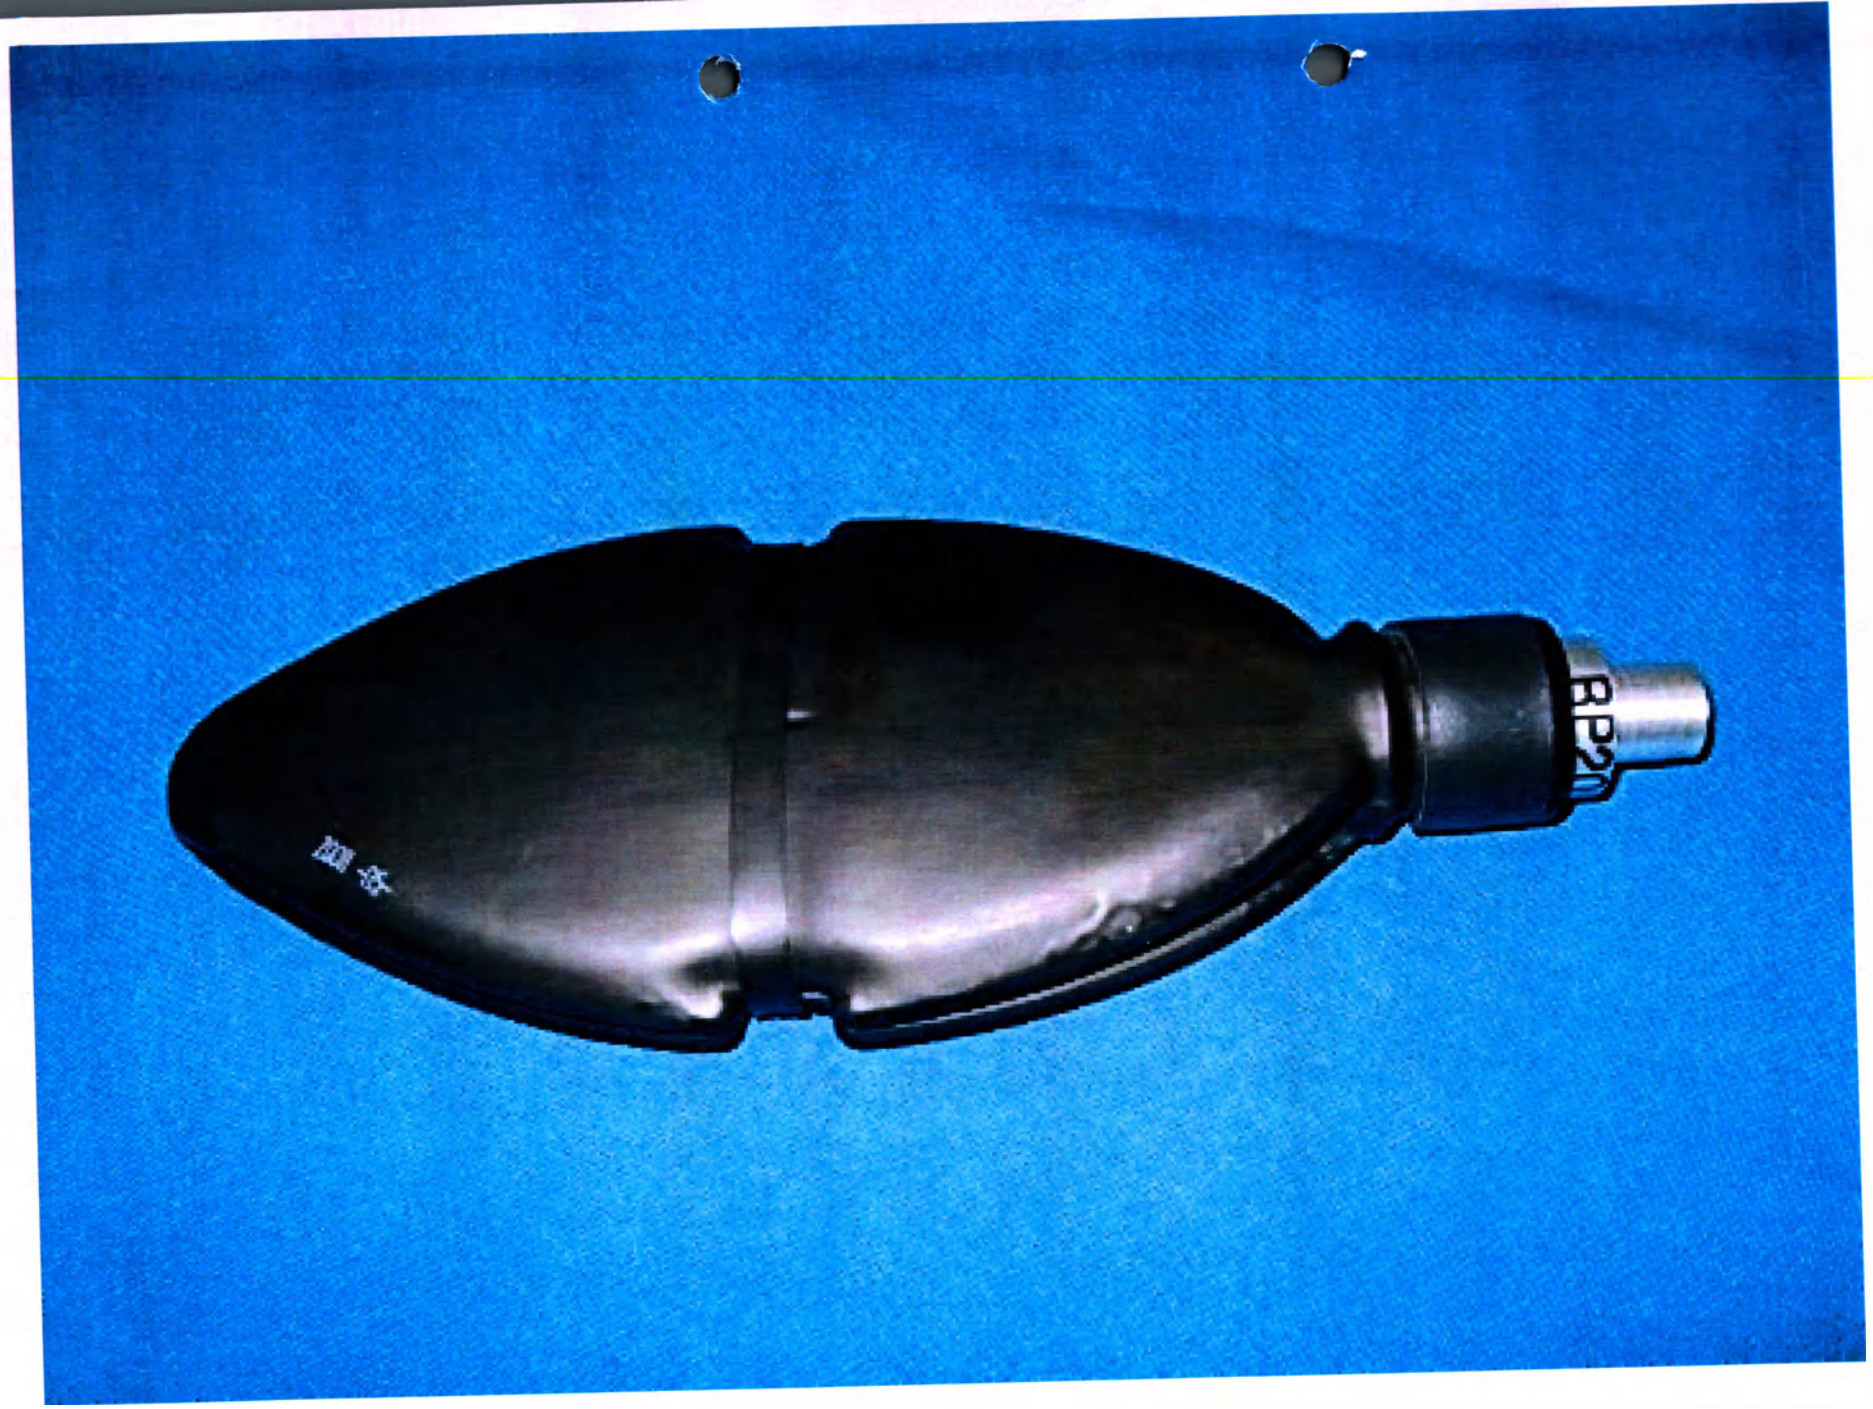


Тестовое лёгкое с ограничителем/заслонкой LNG500A (500 мл).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

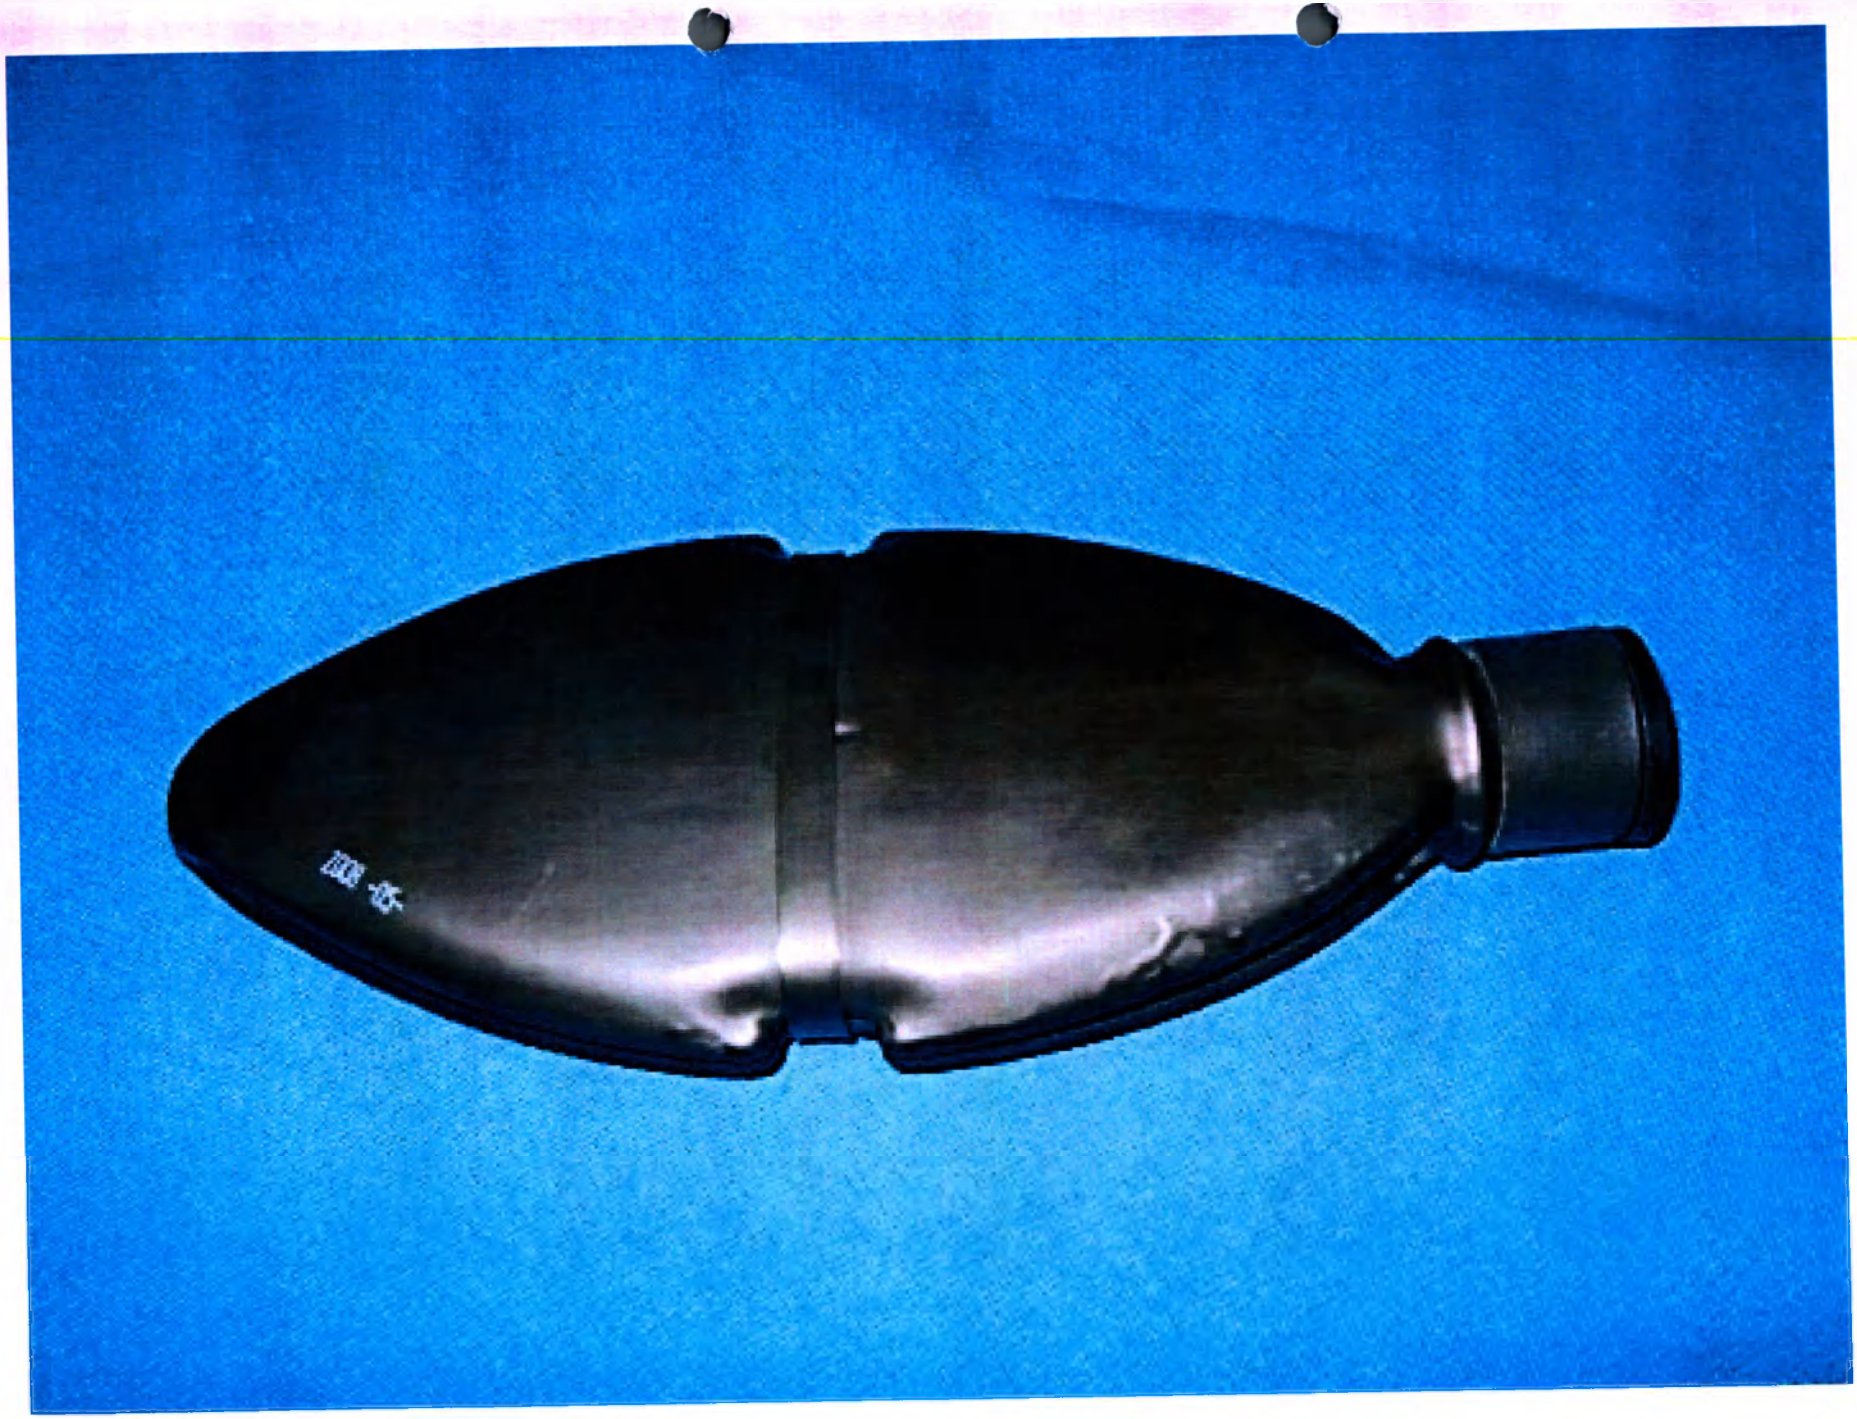


Тестовое лёгкое LNG600P (500 мл).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

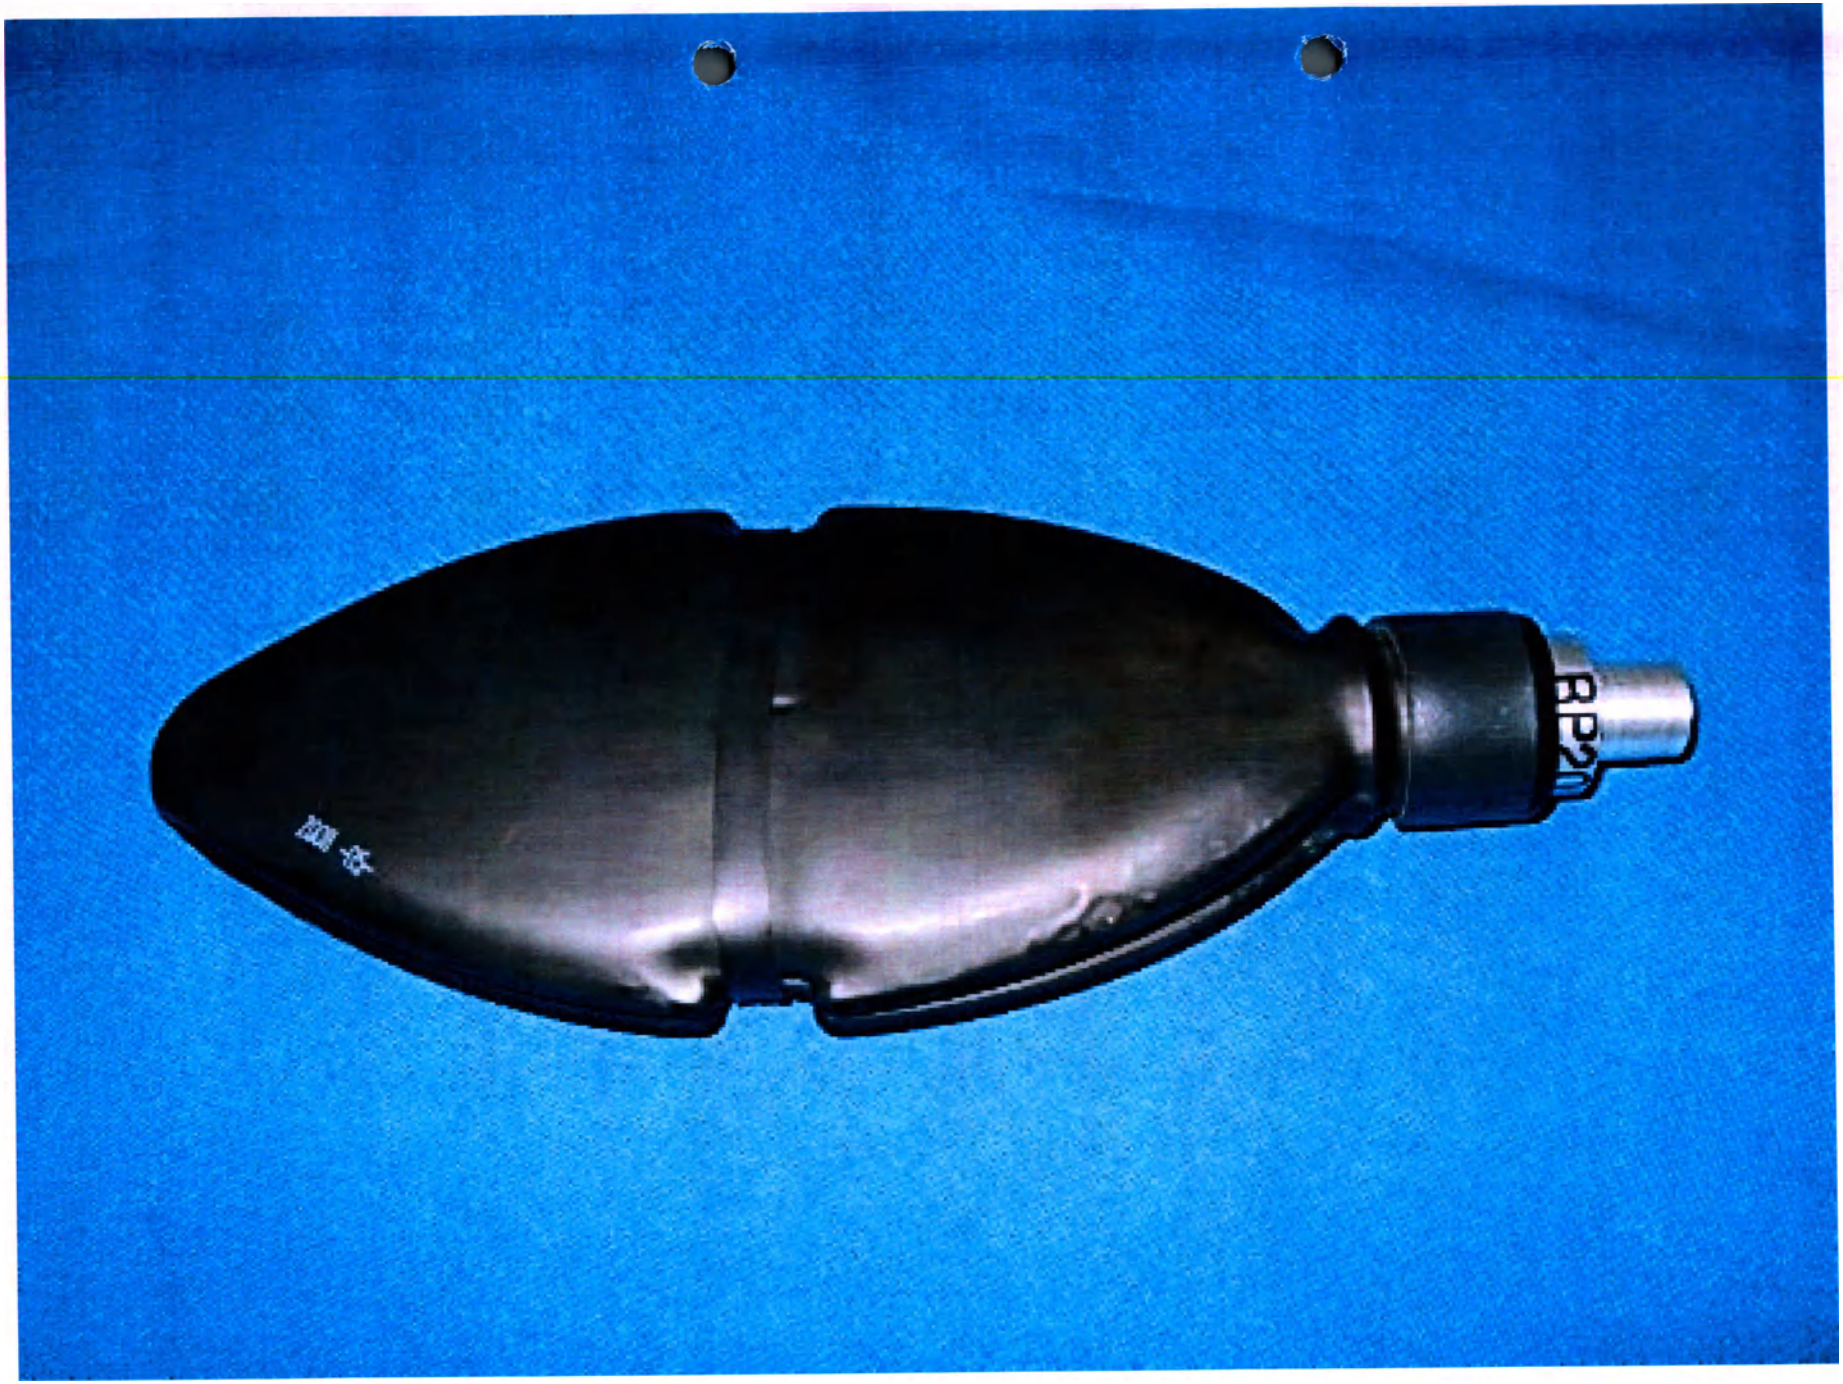


Тестовое лёгкое с чехлом и ограничителем/заслонкой LNG800P (1000 мл).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

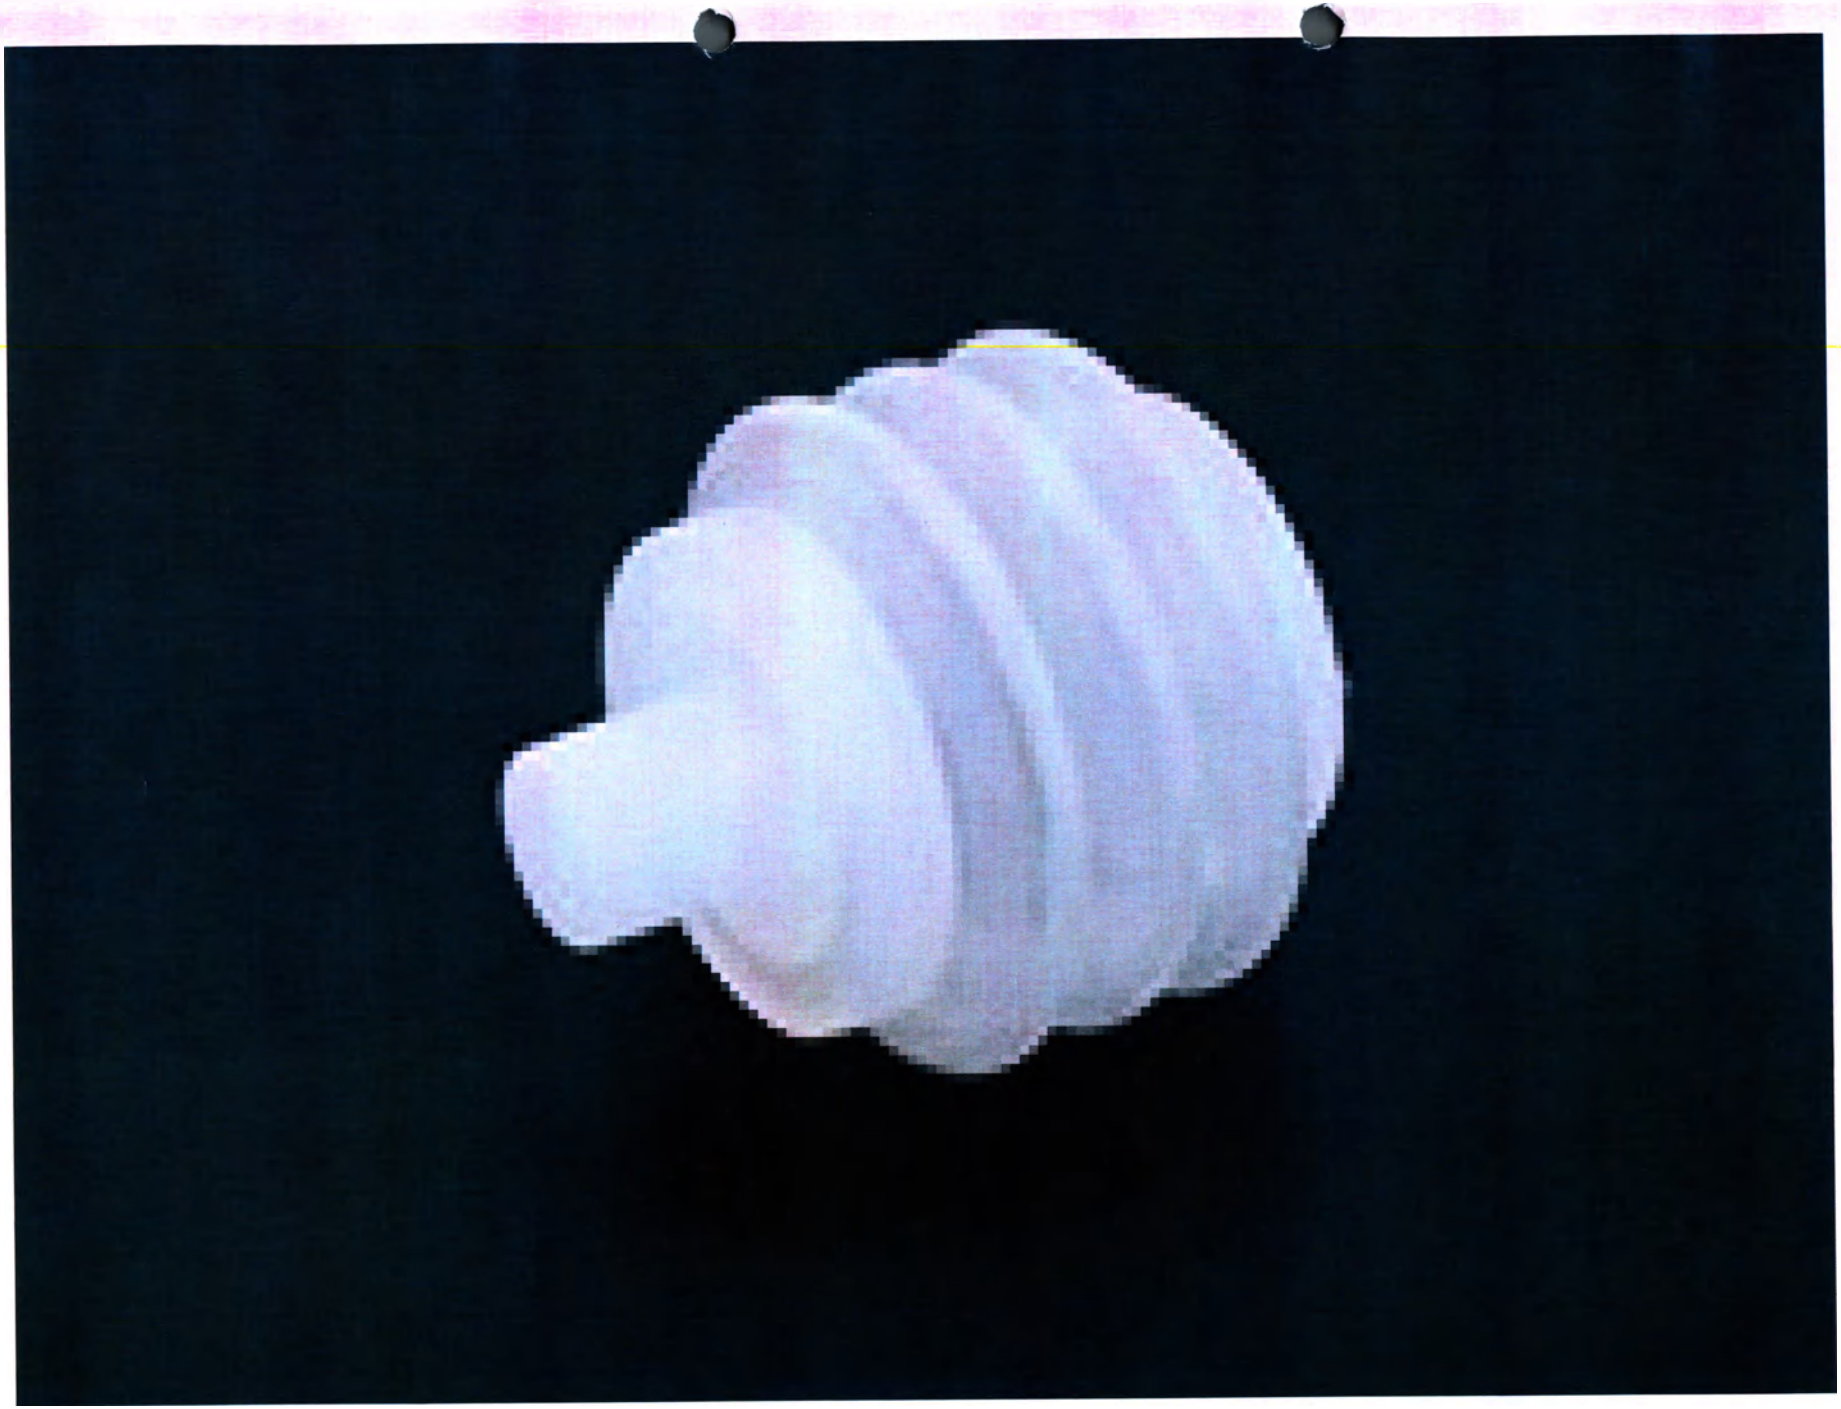

Тестовое лёгкое неонатальное G-118000-0.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

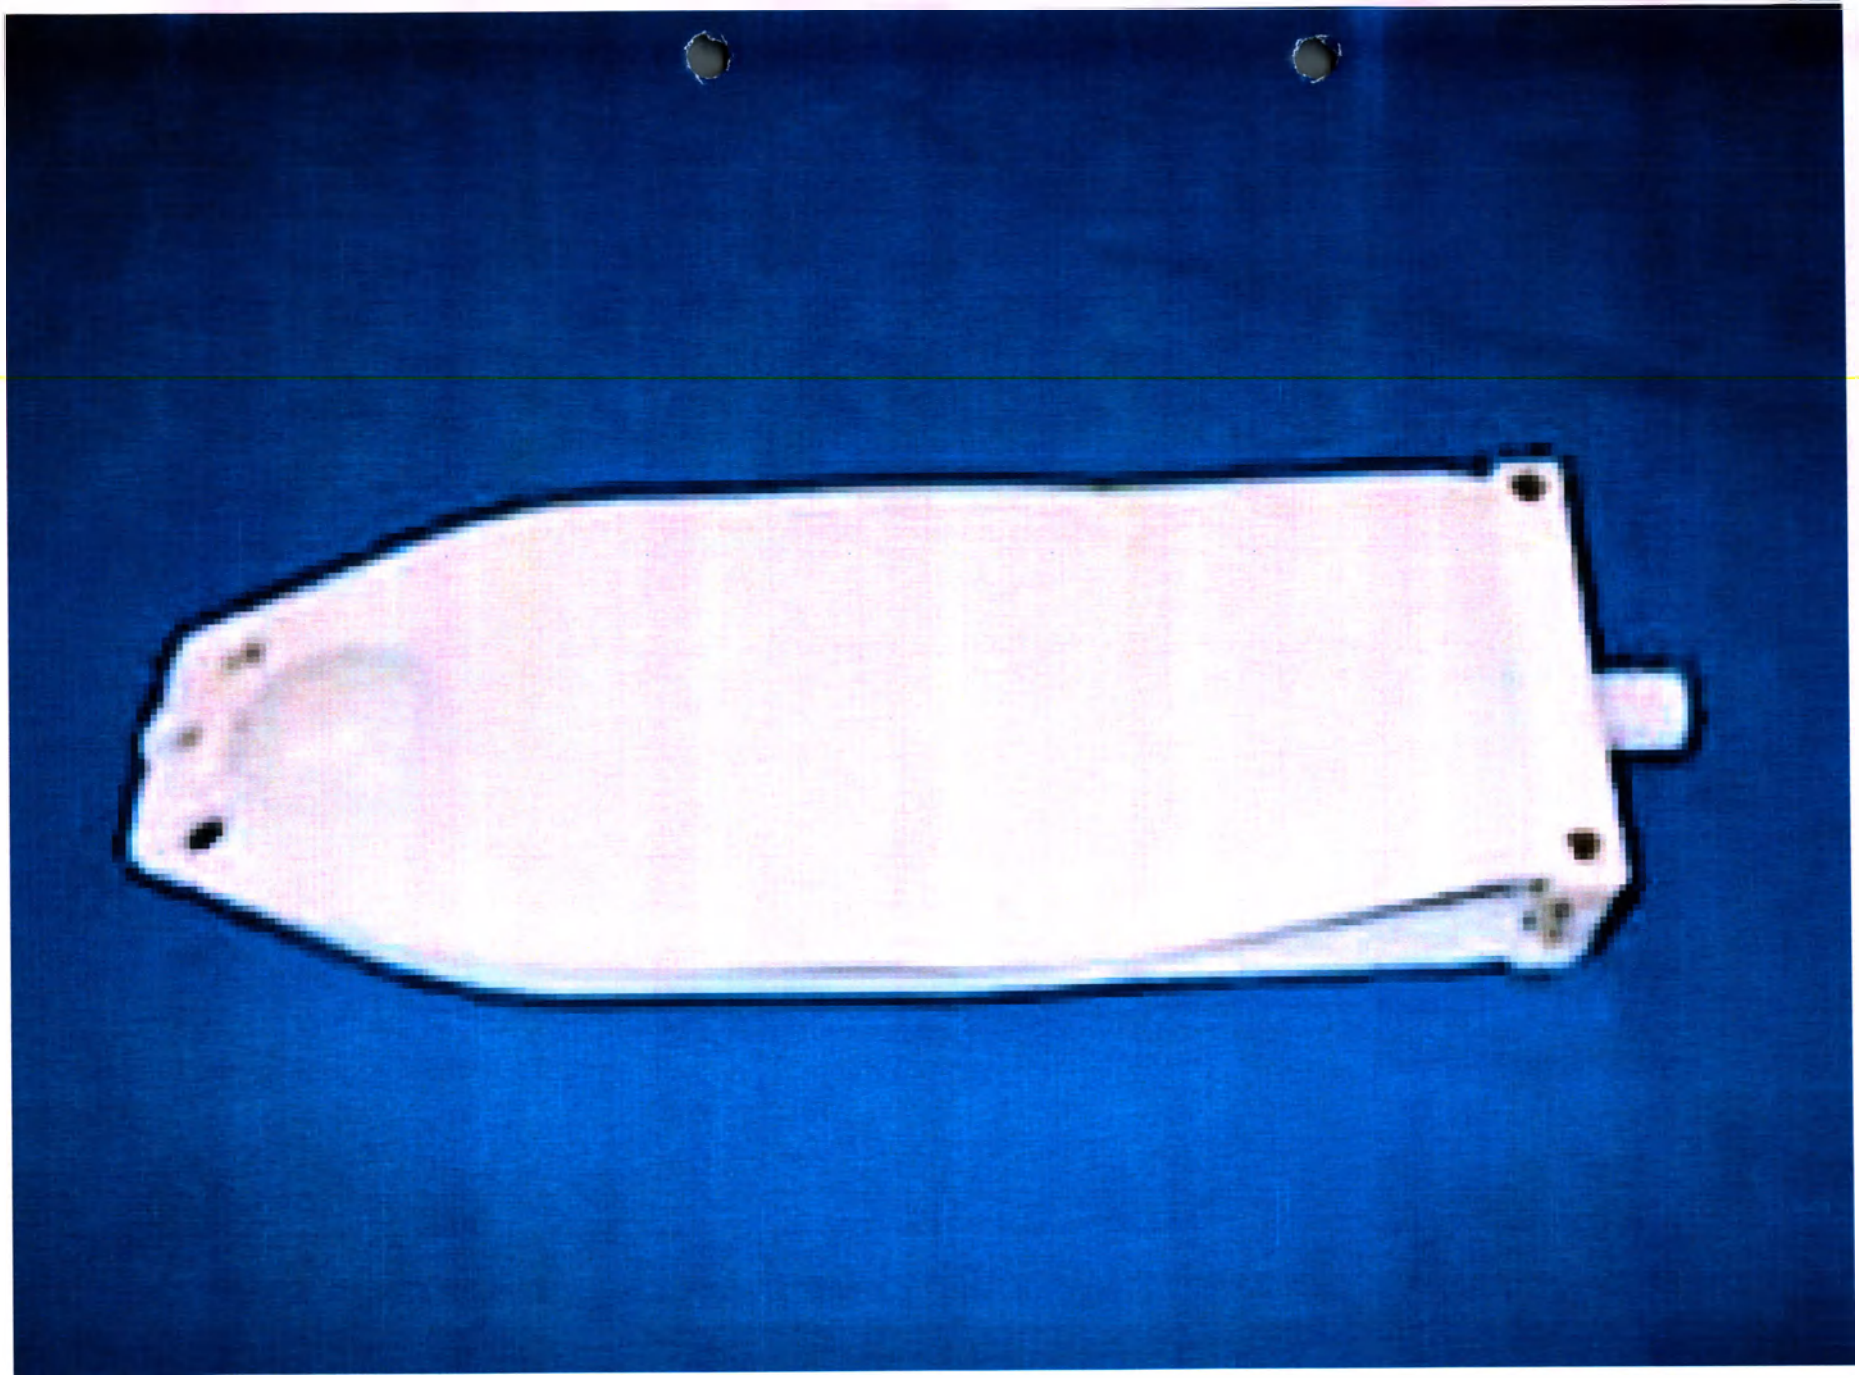


Мешок для тестового лёгкого LNG810P.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Монитор FPD2120A-IN, FPD2125A-IN, FPD2126A-IN

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

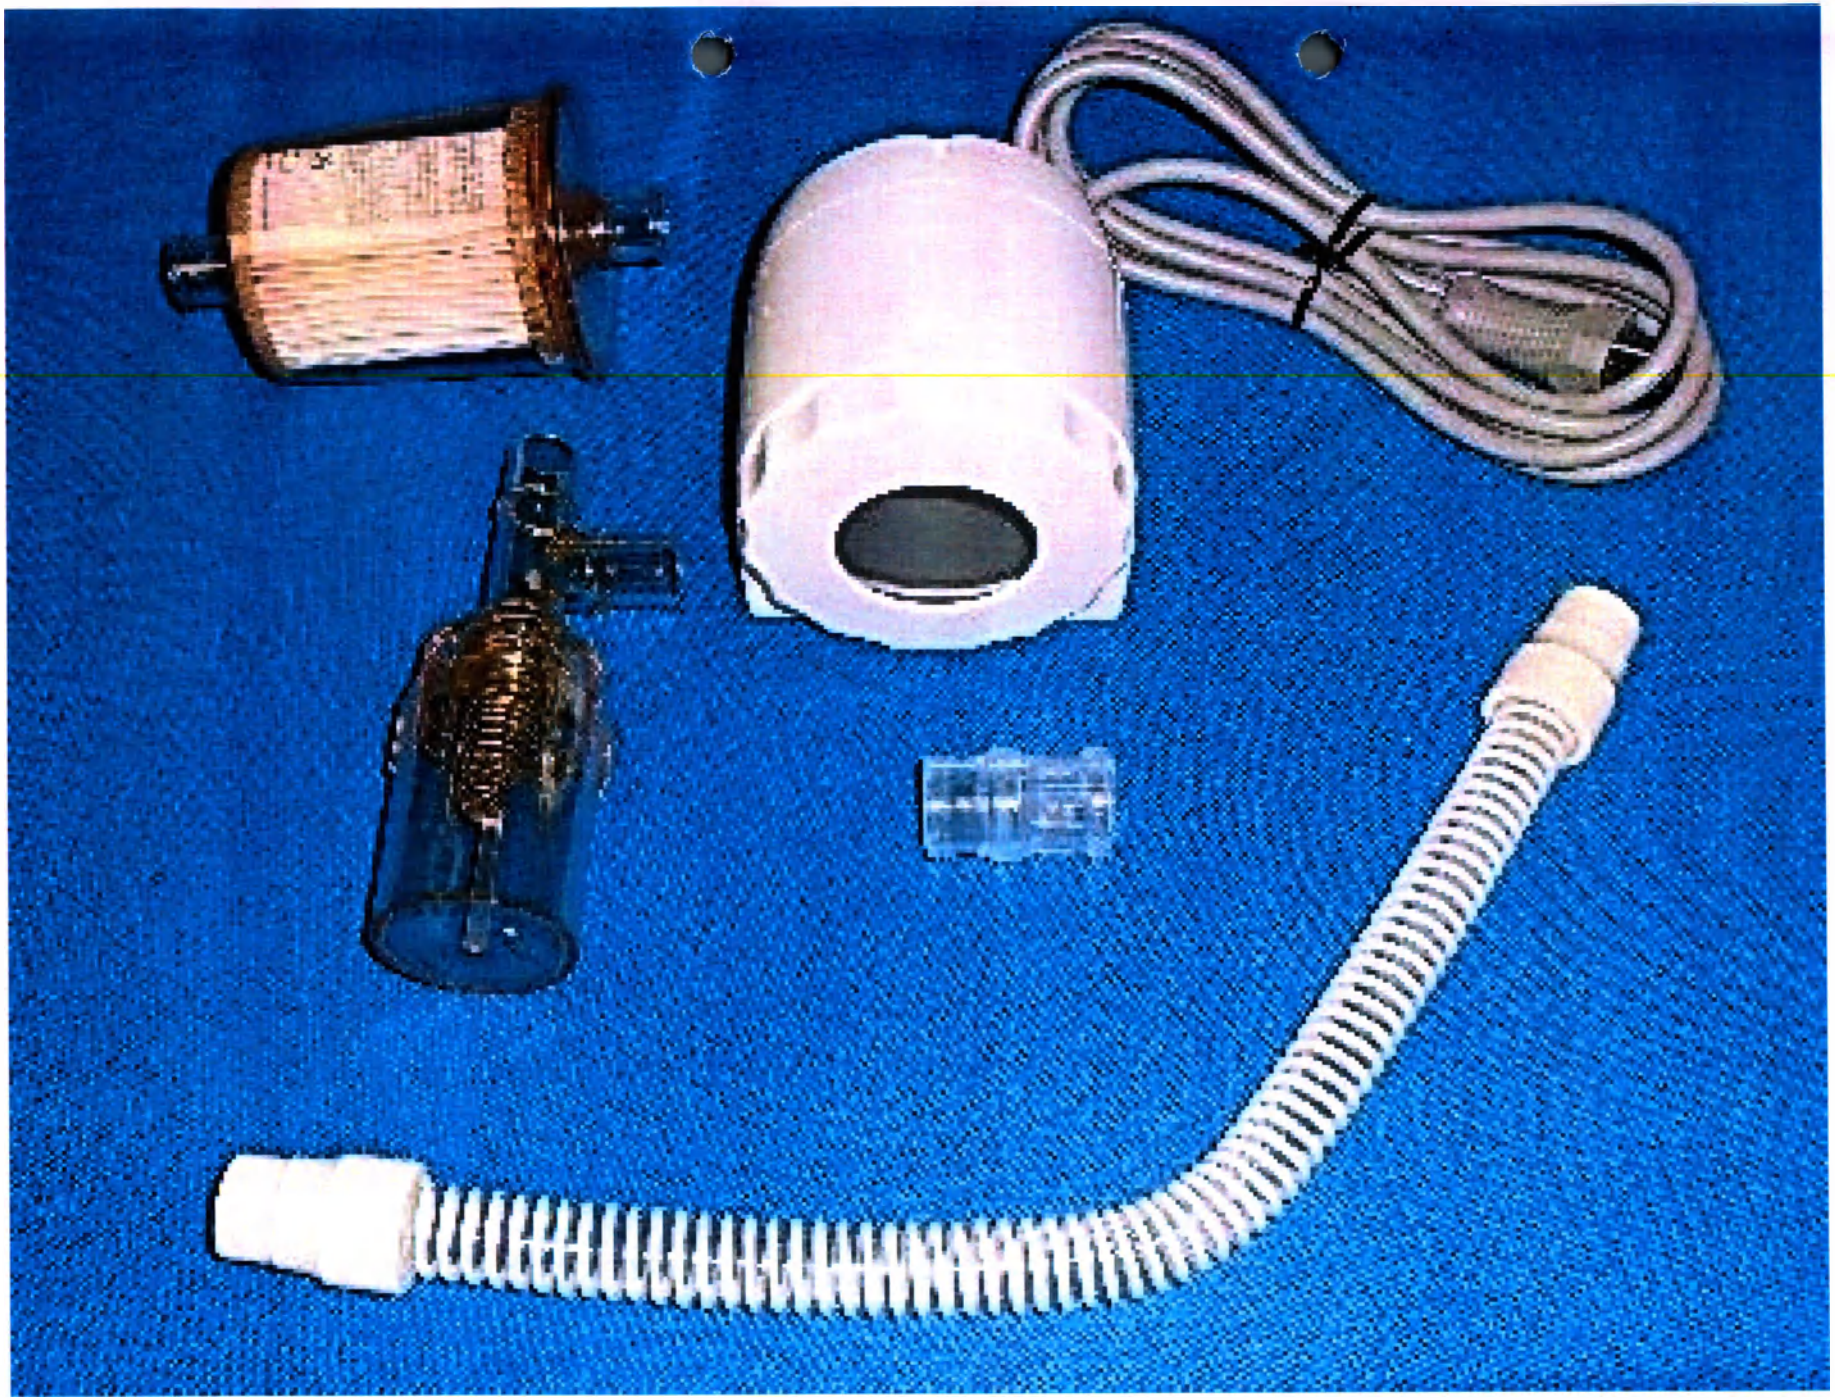


Комплект для подогрева фильтра KIT2220A

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Нагреватель фильтра выдоха 800-22202

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

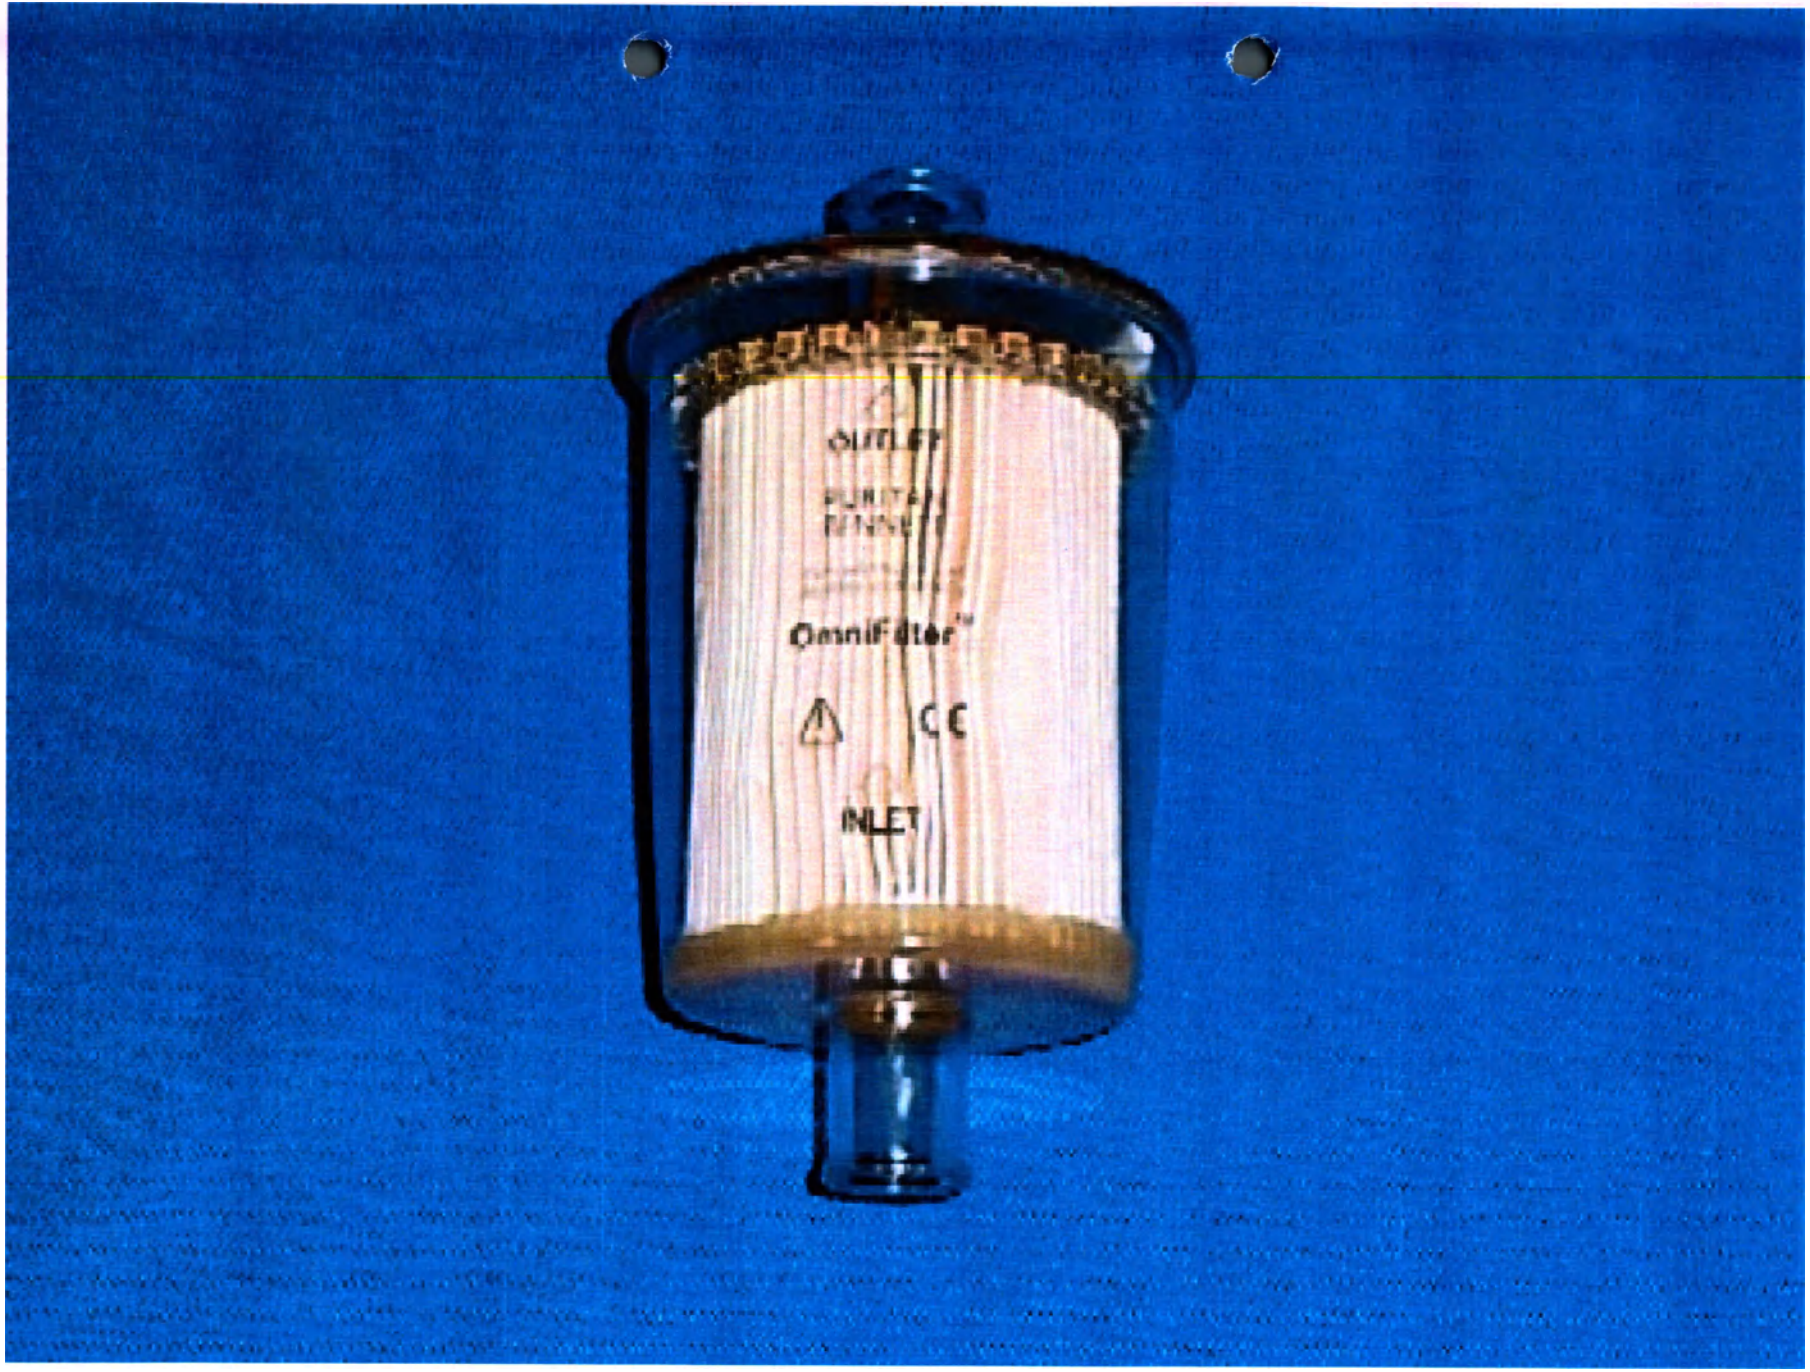


Фильтр выдоха многоразовый FLT1200P

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

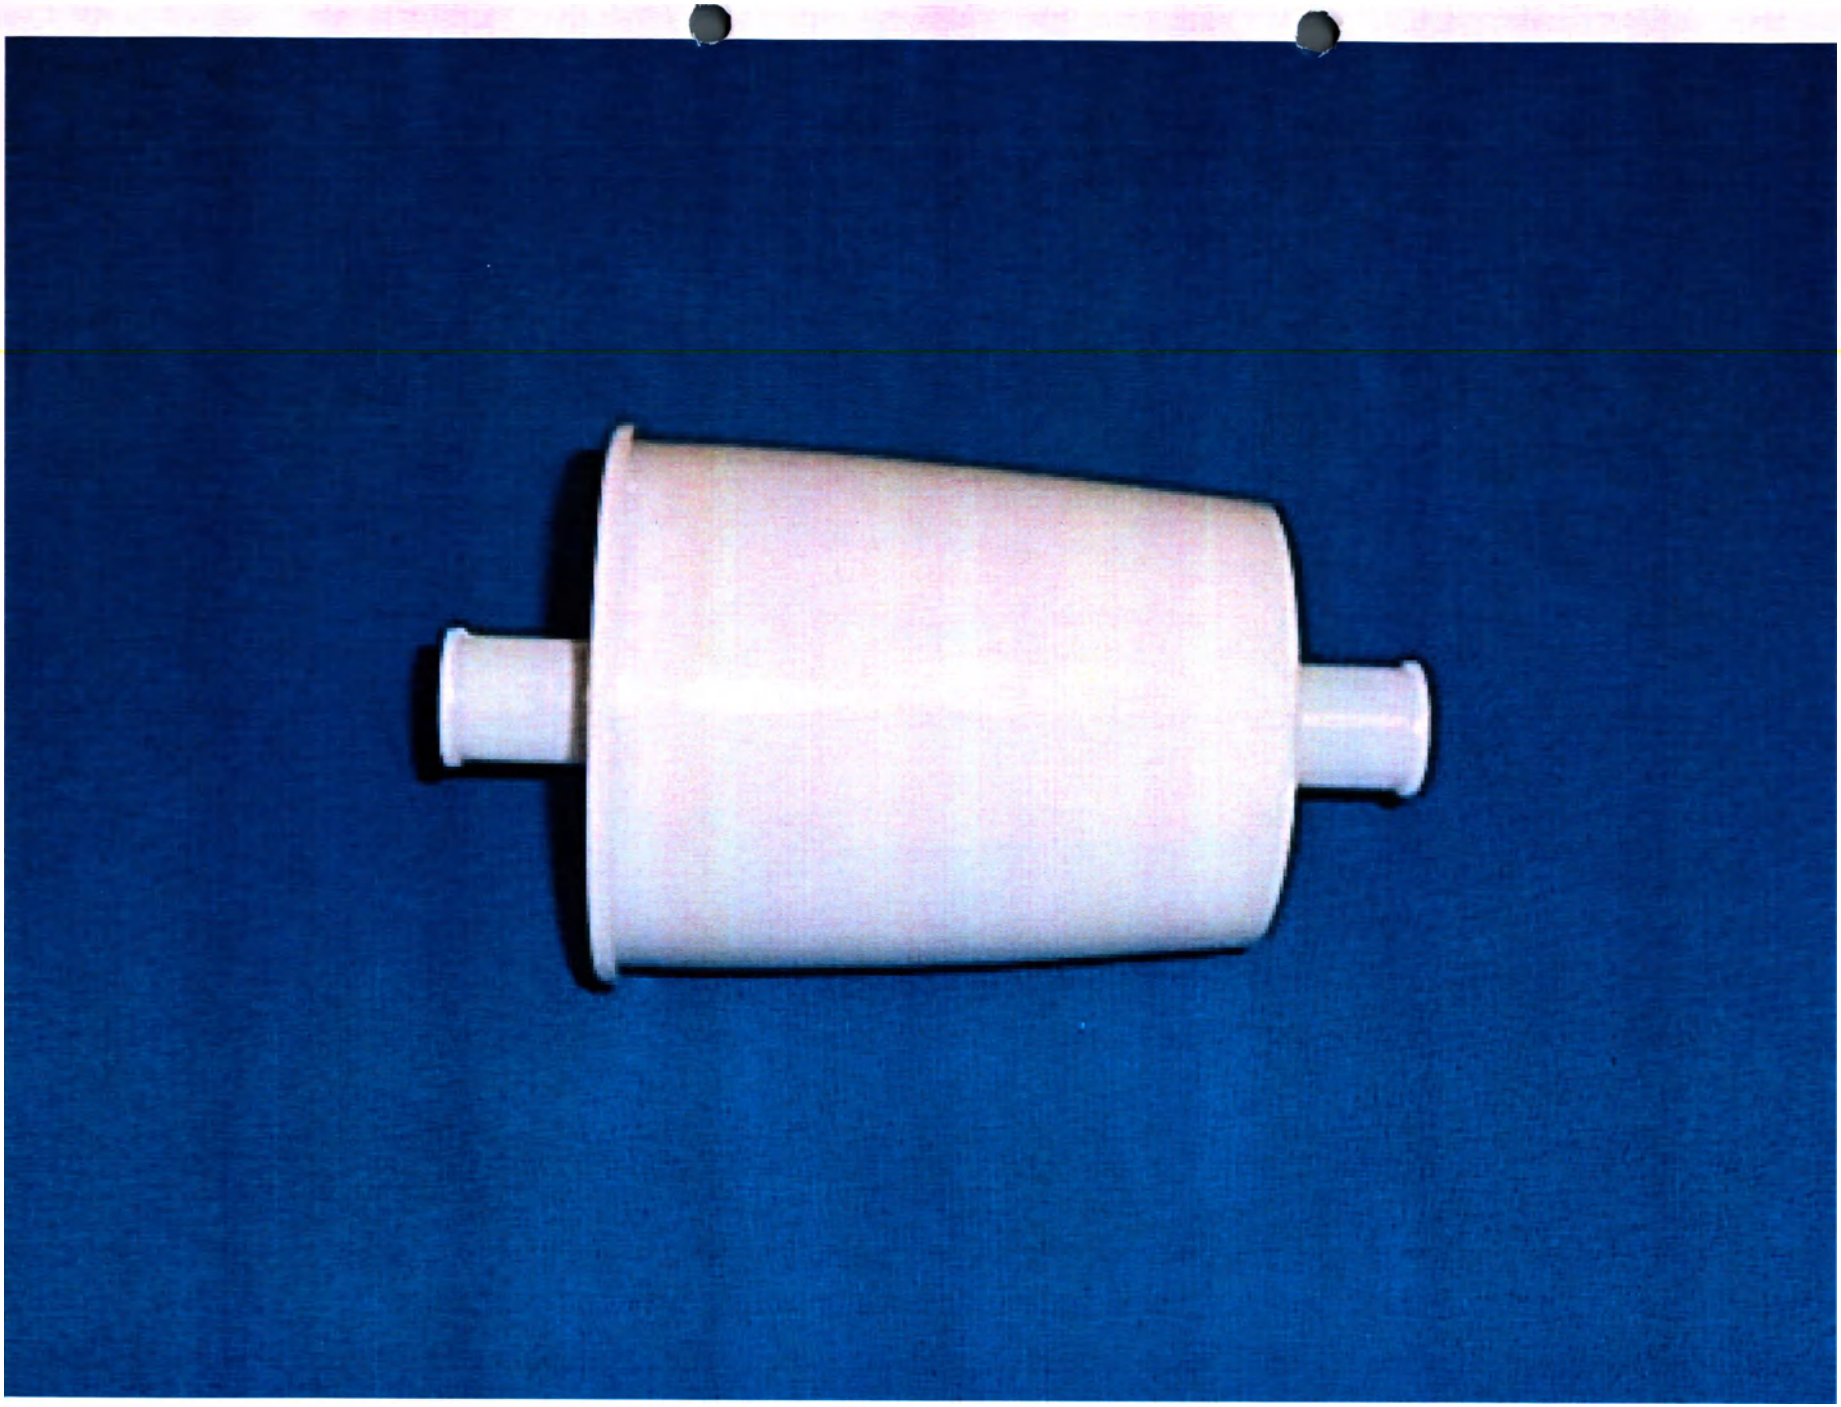


Фильтр выдоха одноразовый 3000/03-С, 12 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

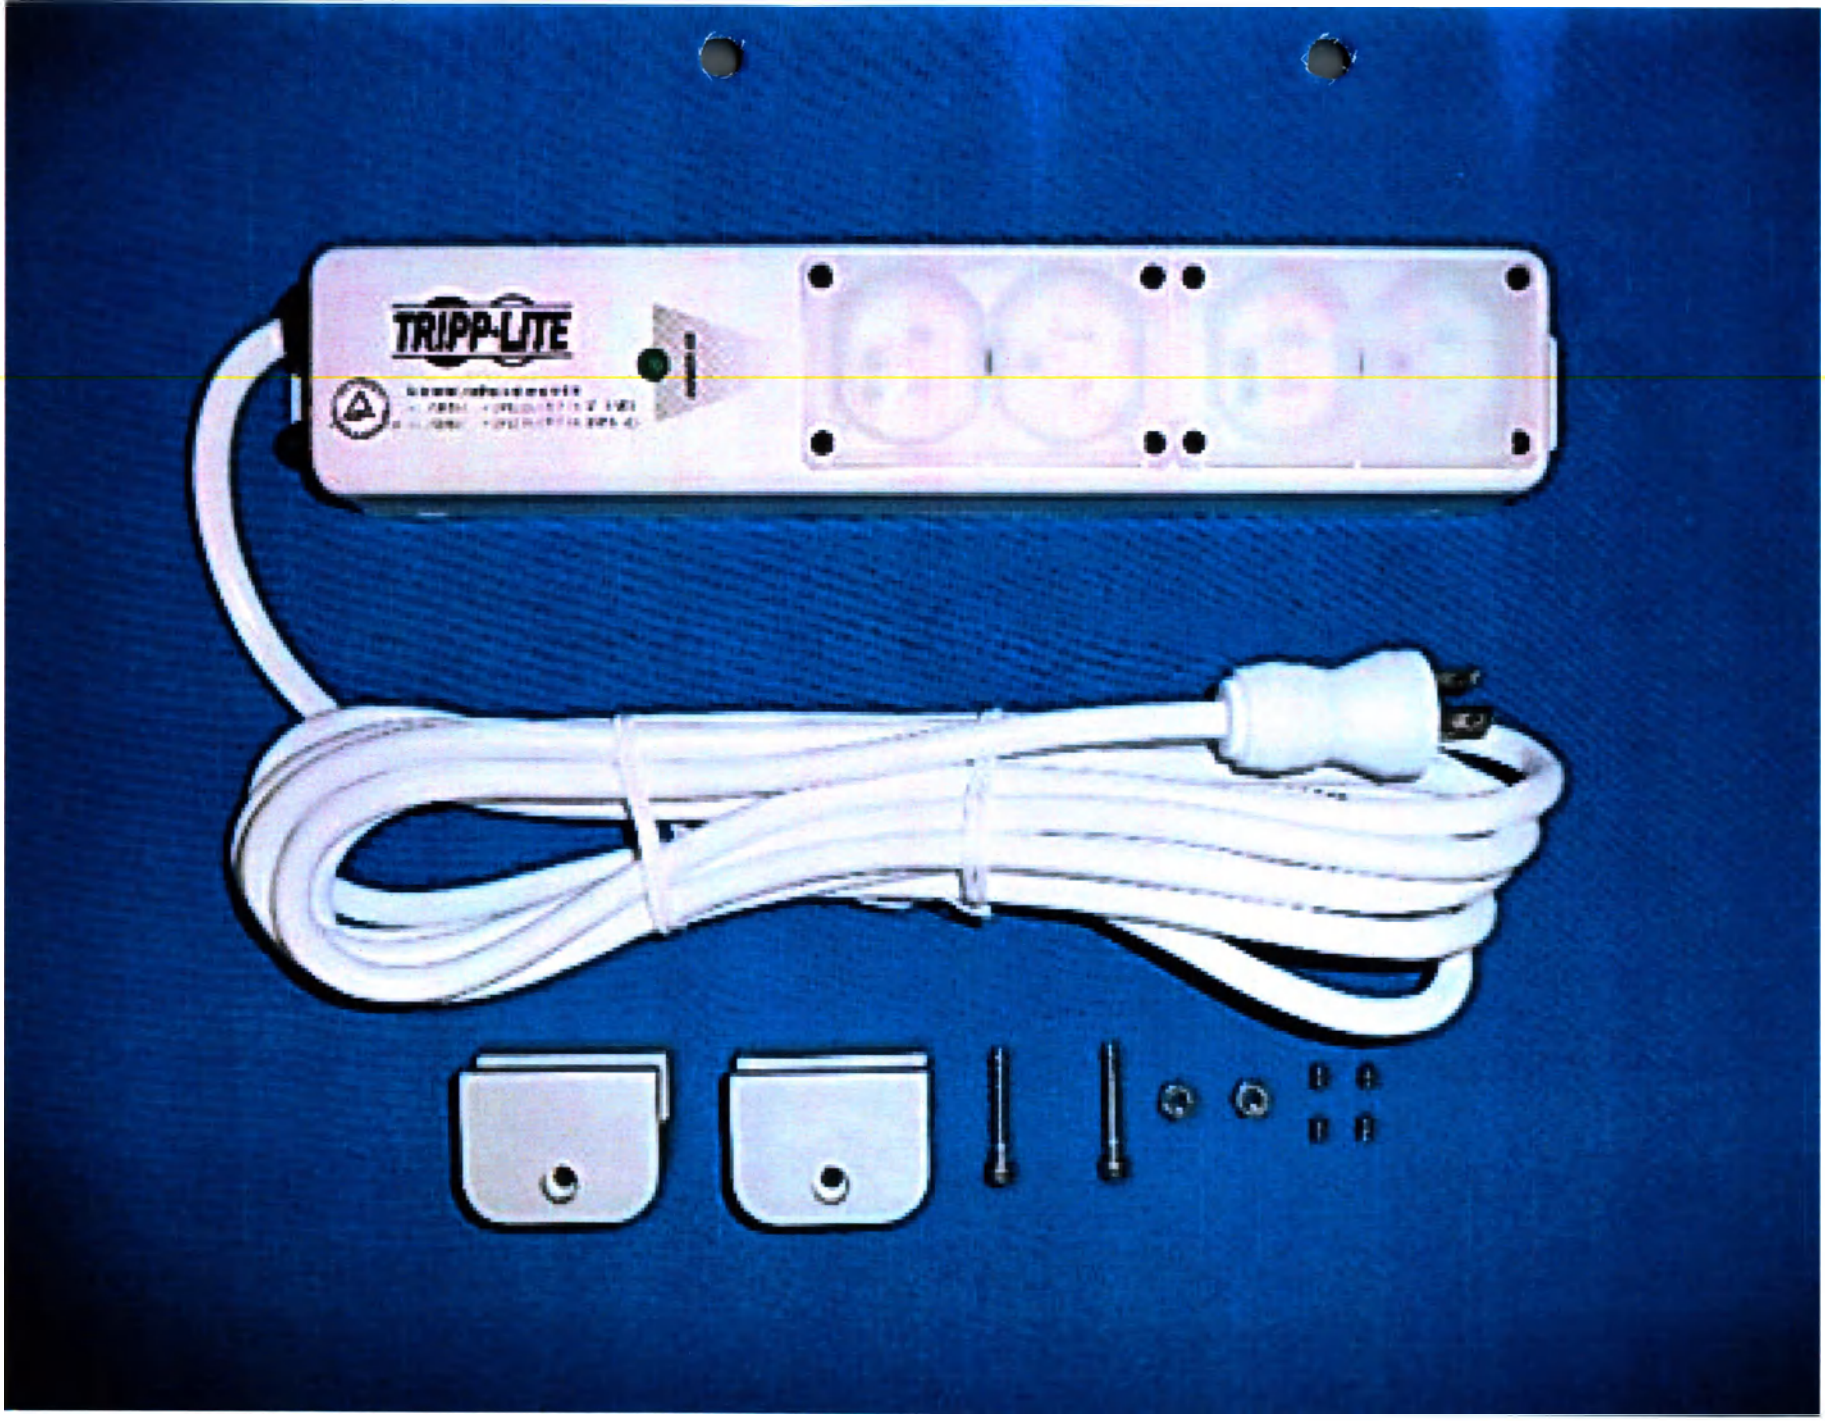


Сетевой удлинитель PST3600A

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

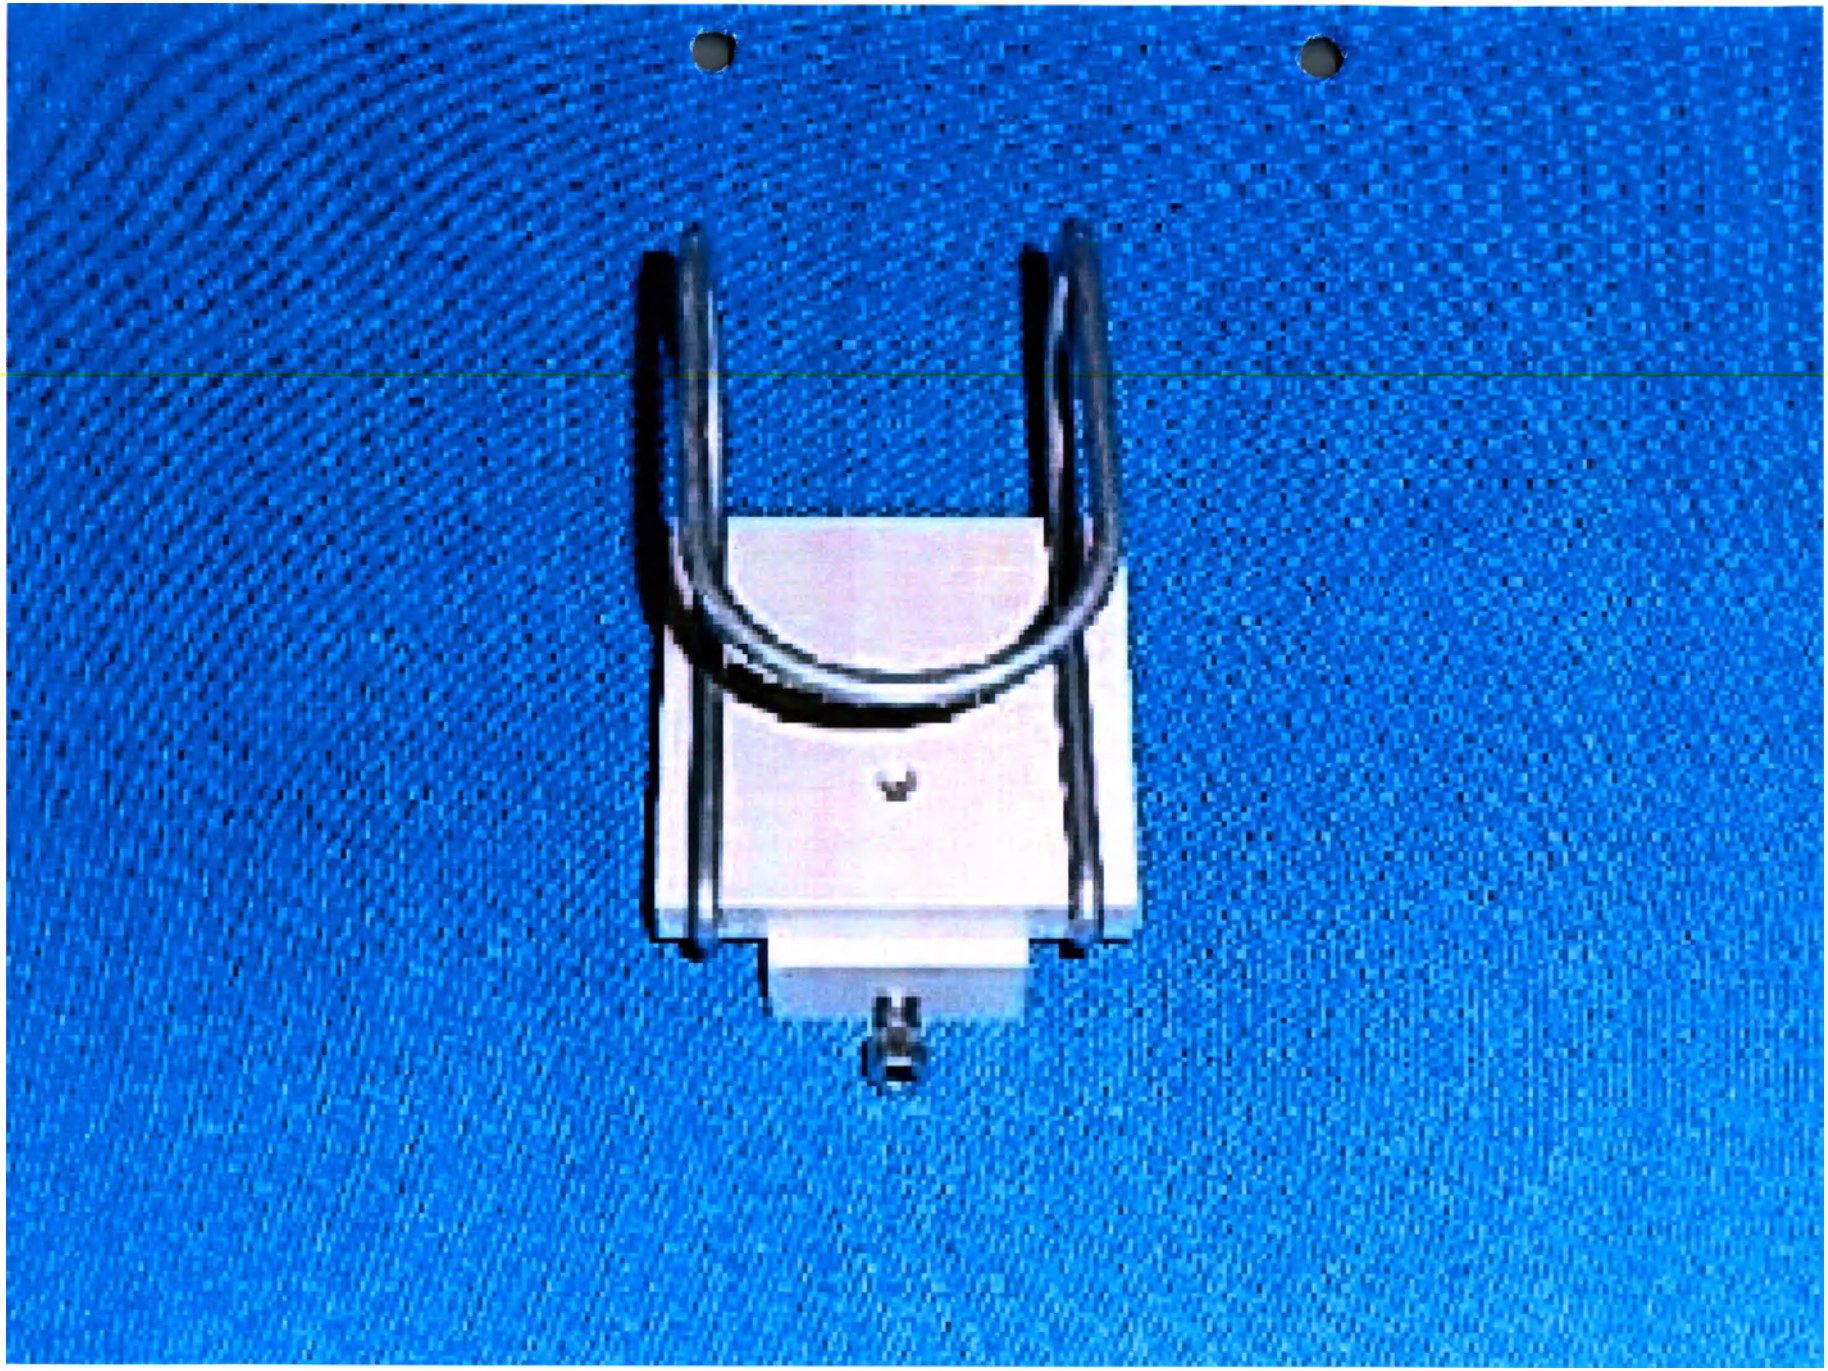


Держатель шланга HGR360A.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

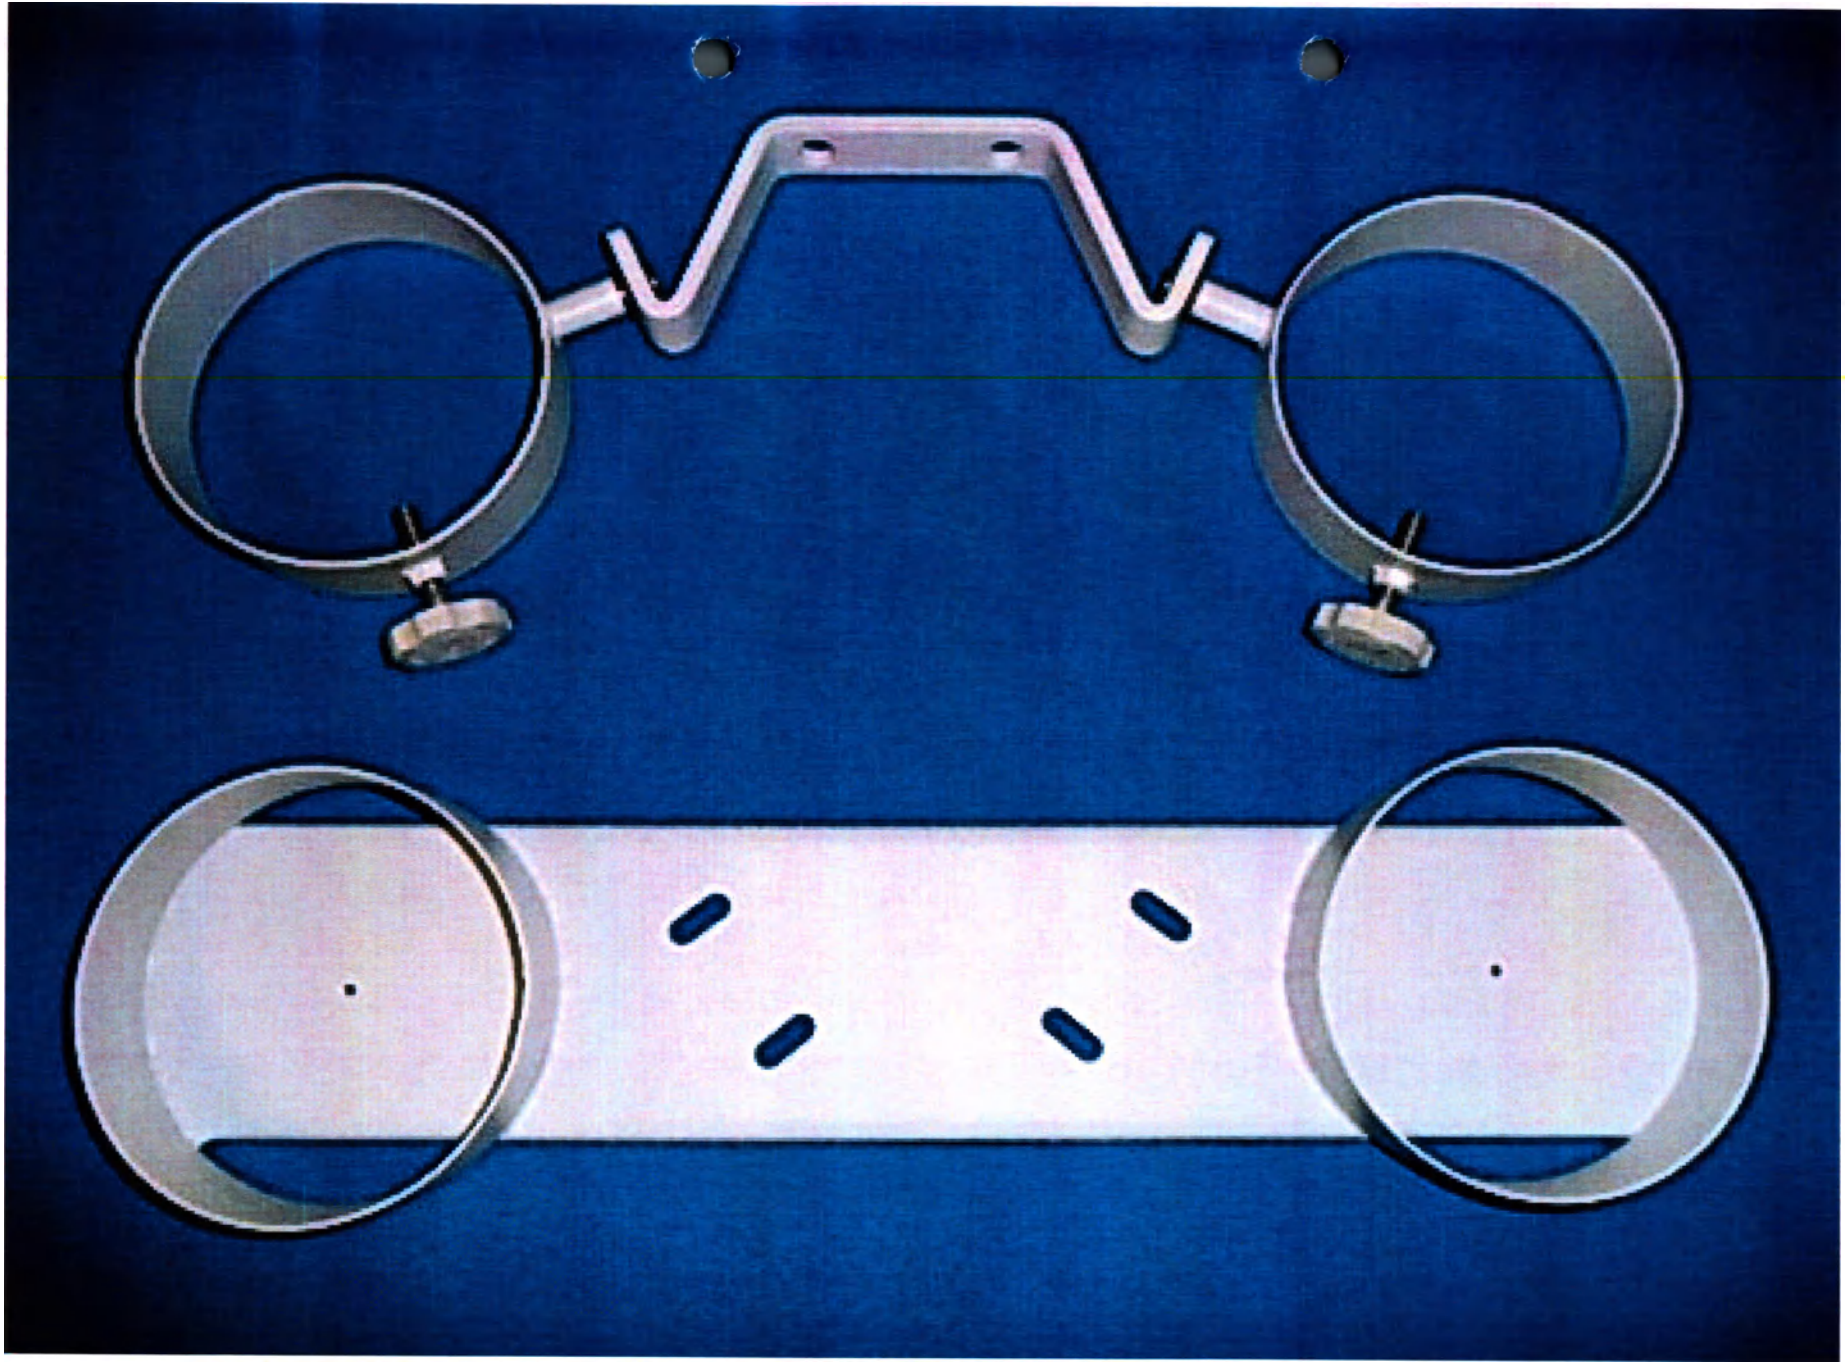


Держатель для баллонов KIT2122A.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

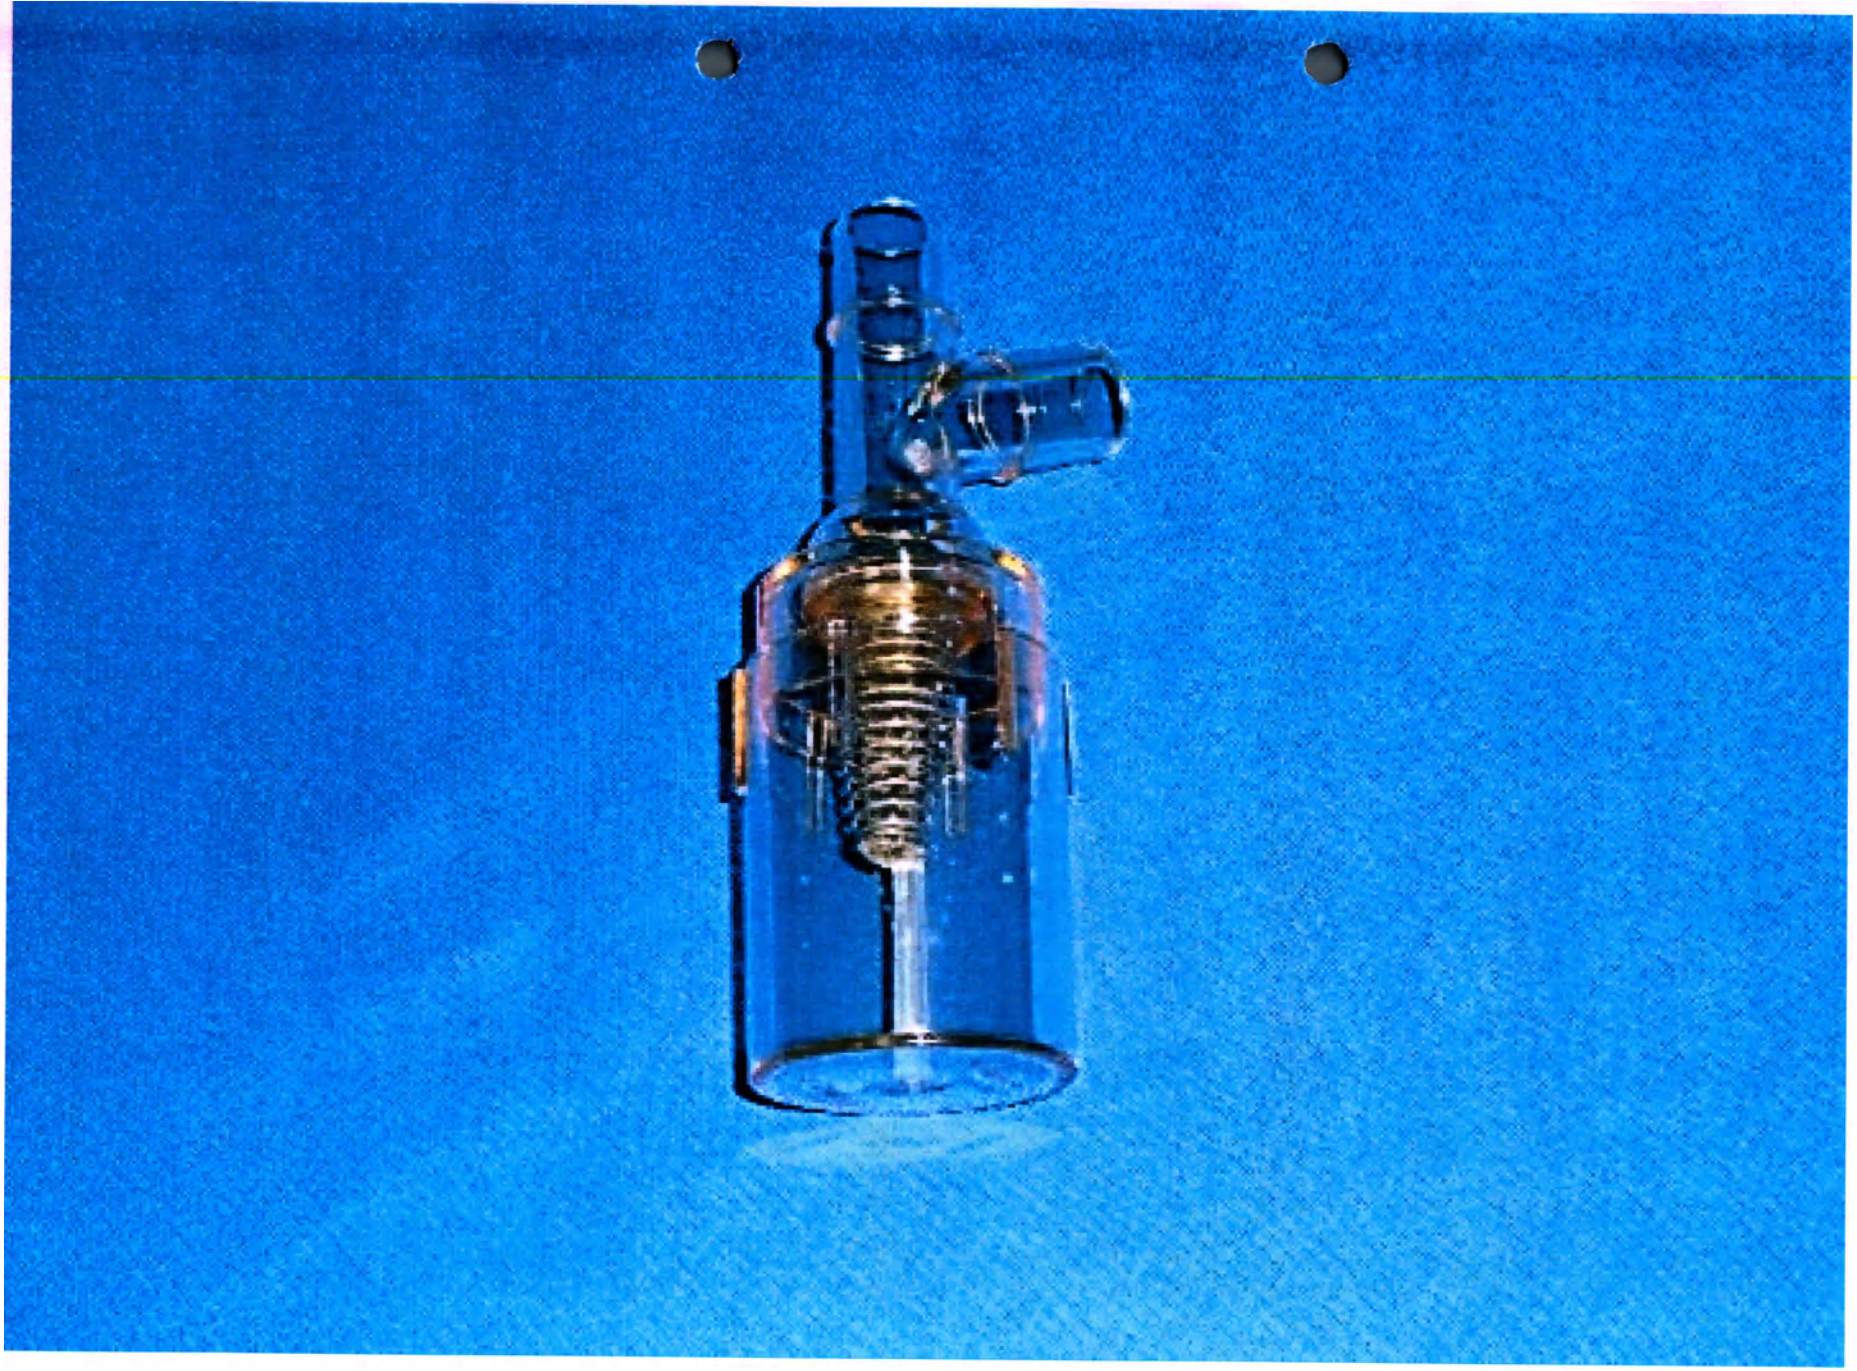

Влагосборник многоразовый G-313003-1 (75 мл).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

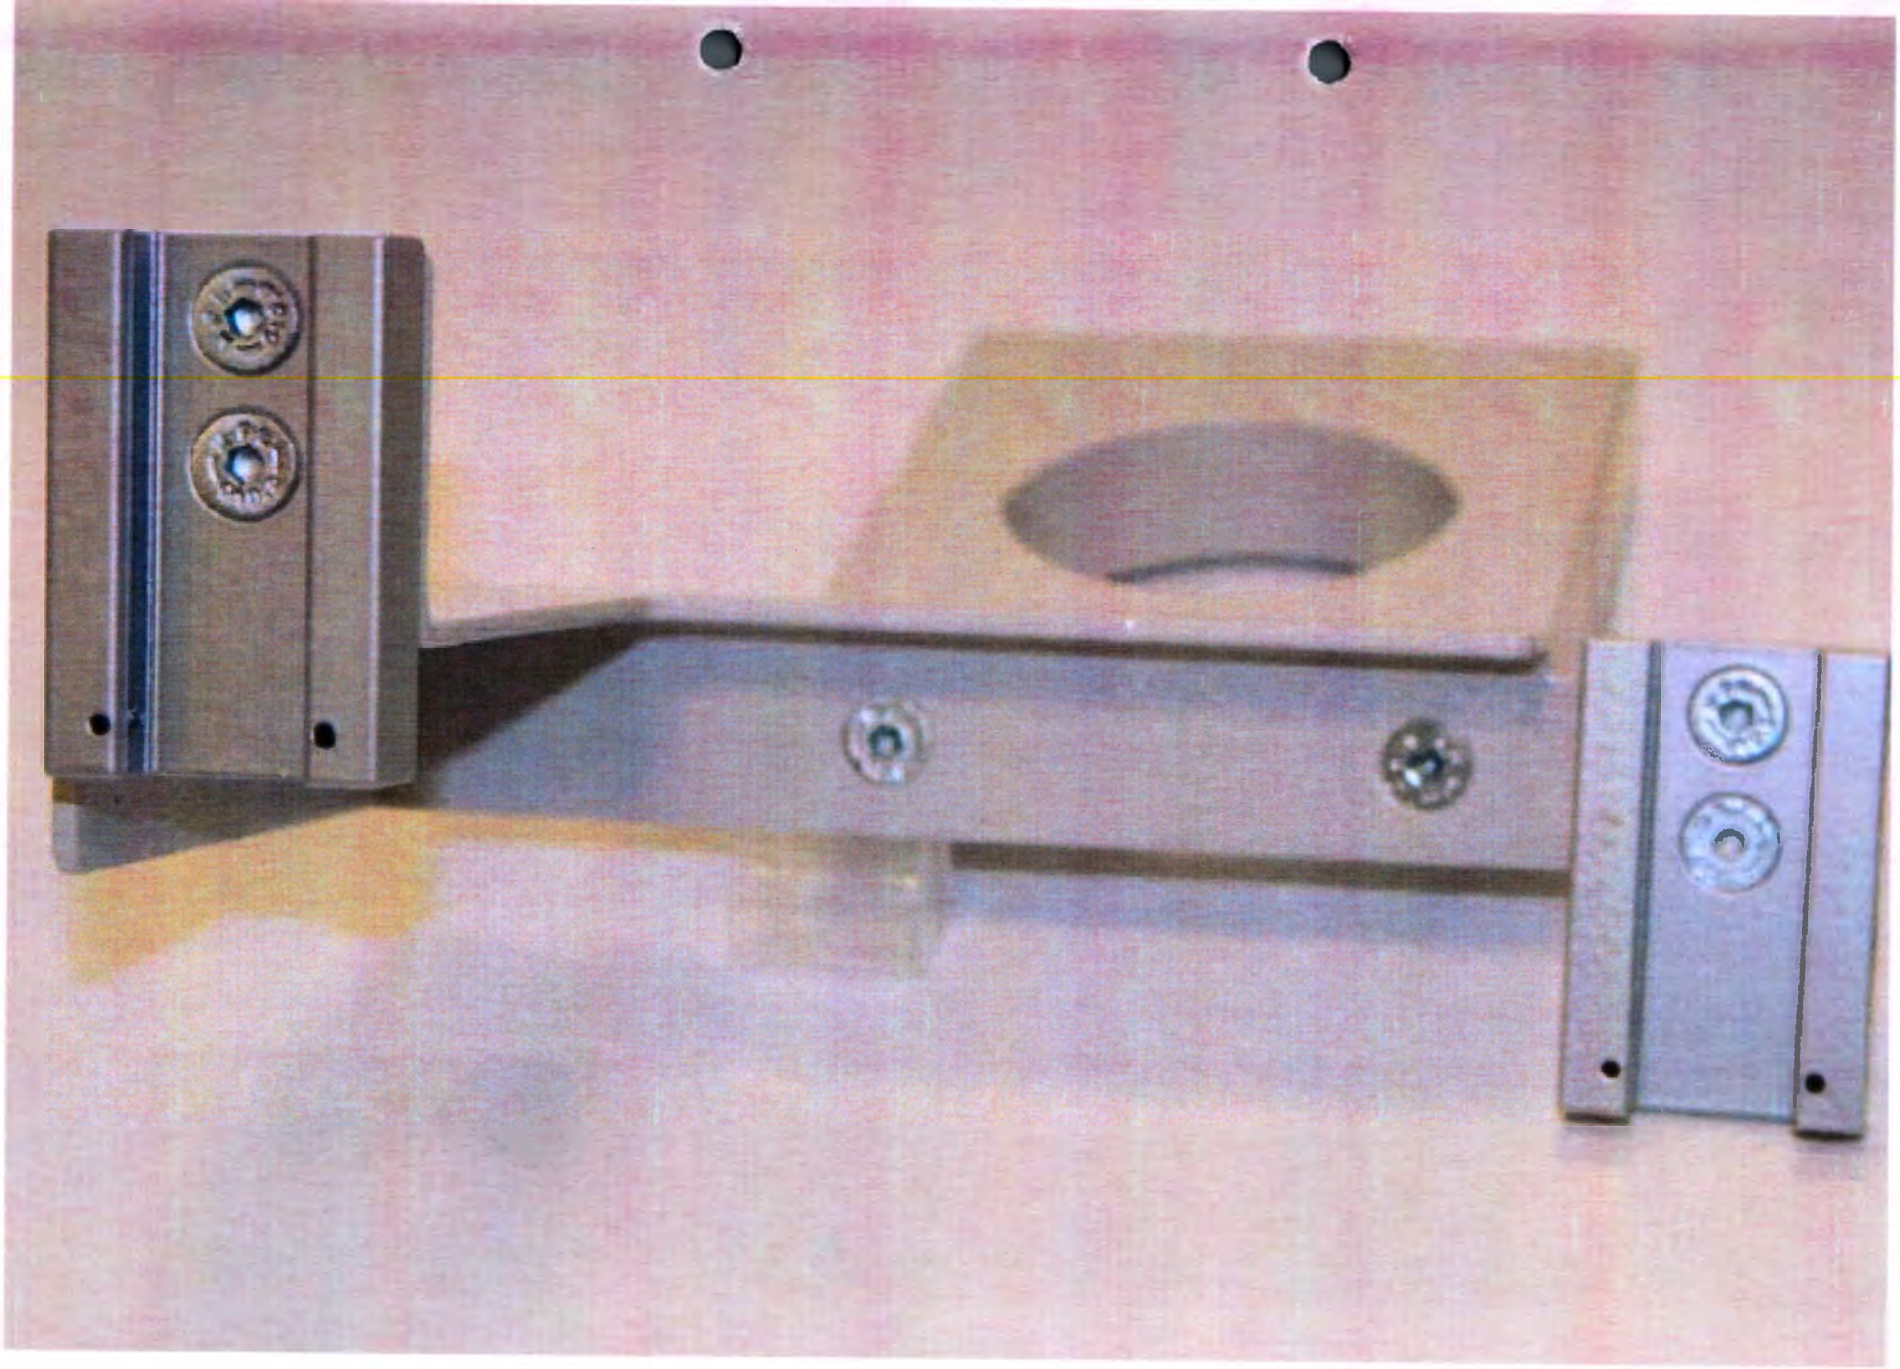

Крепление для увлажнителя и фильтра выдоха с подогревом 604041083-000.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Датчик потока (не более 5 шт.)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Кислородный датчик Sen2103P

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

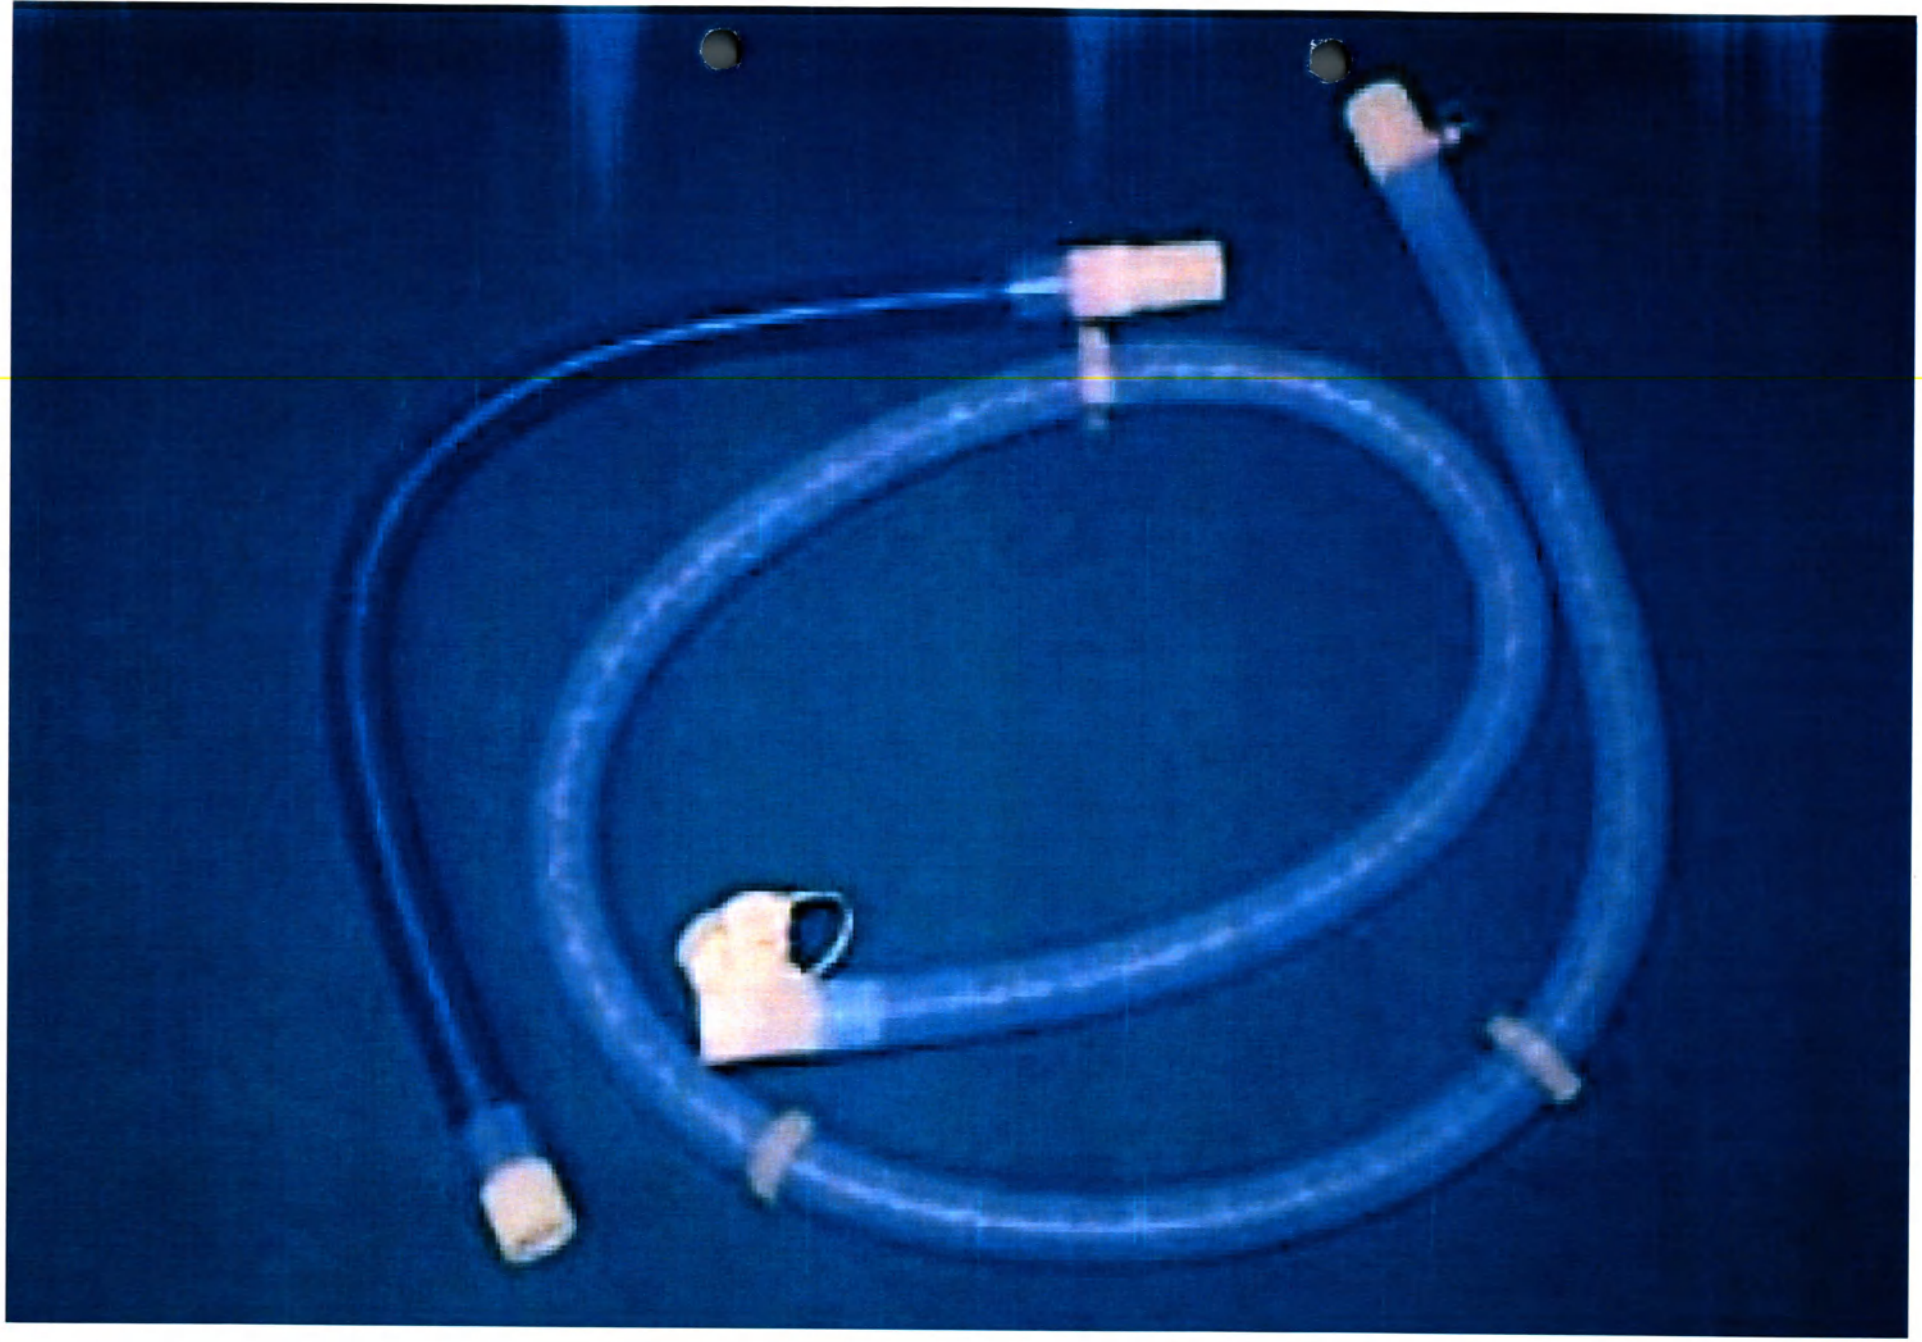


Контур дыхательный 900MR742, BCD22820P, BCD23811P, BCD32820P, BCD40801P, BCD43801P, BCD43811P, BCS12810P, BCS12820P, BCS22810P, BCS22820P, BCS32810P, BCS32820P, PBC335J, PBC340A, PBC345A, PBC410A, PBC410J, PBC450A, PBC450J, PBC460A, PBC465A, PCB412S, RT111, RT114, SBC001A (не более 20 шт.)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Воздушный компрессор со стойкой на колёсах C235-230V-50-1, C235-230M-60-1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

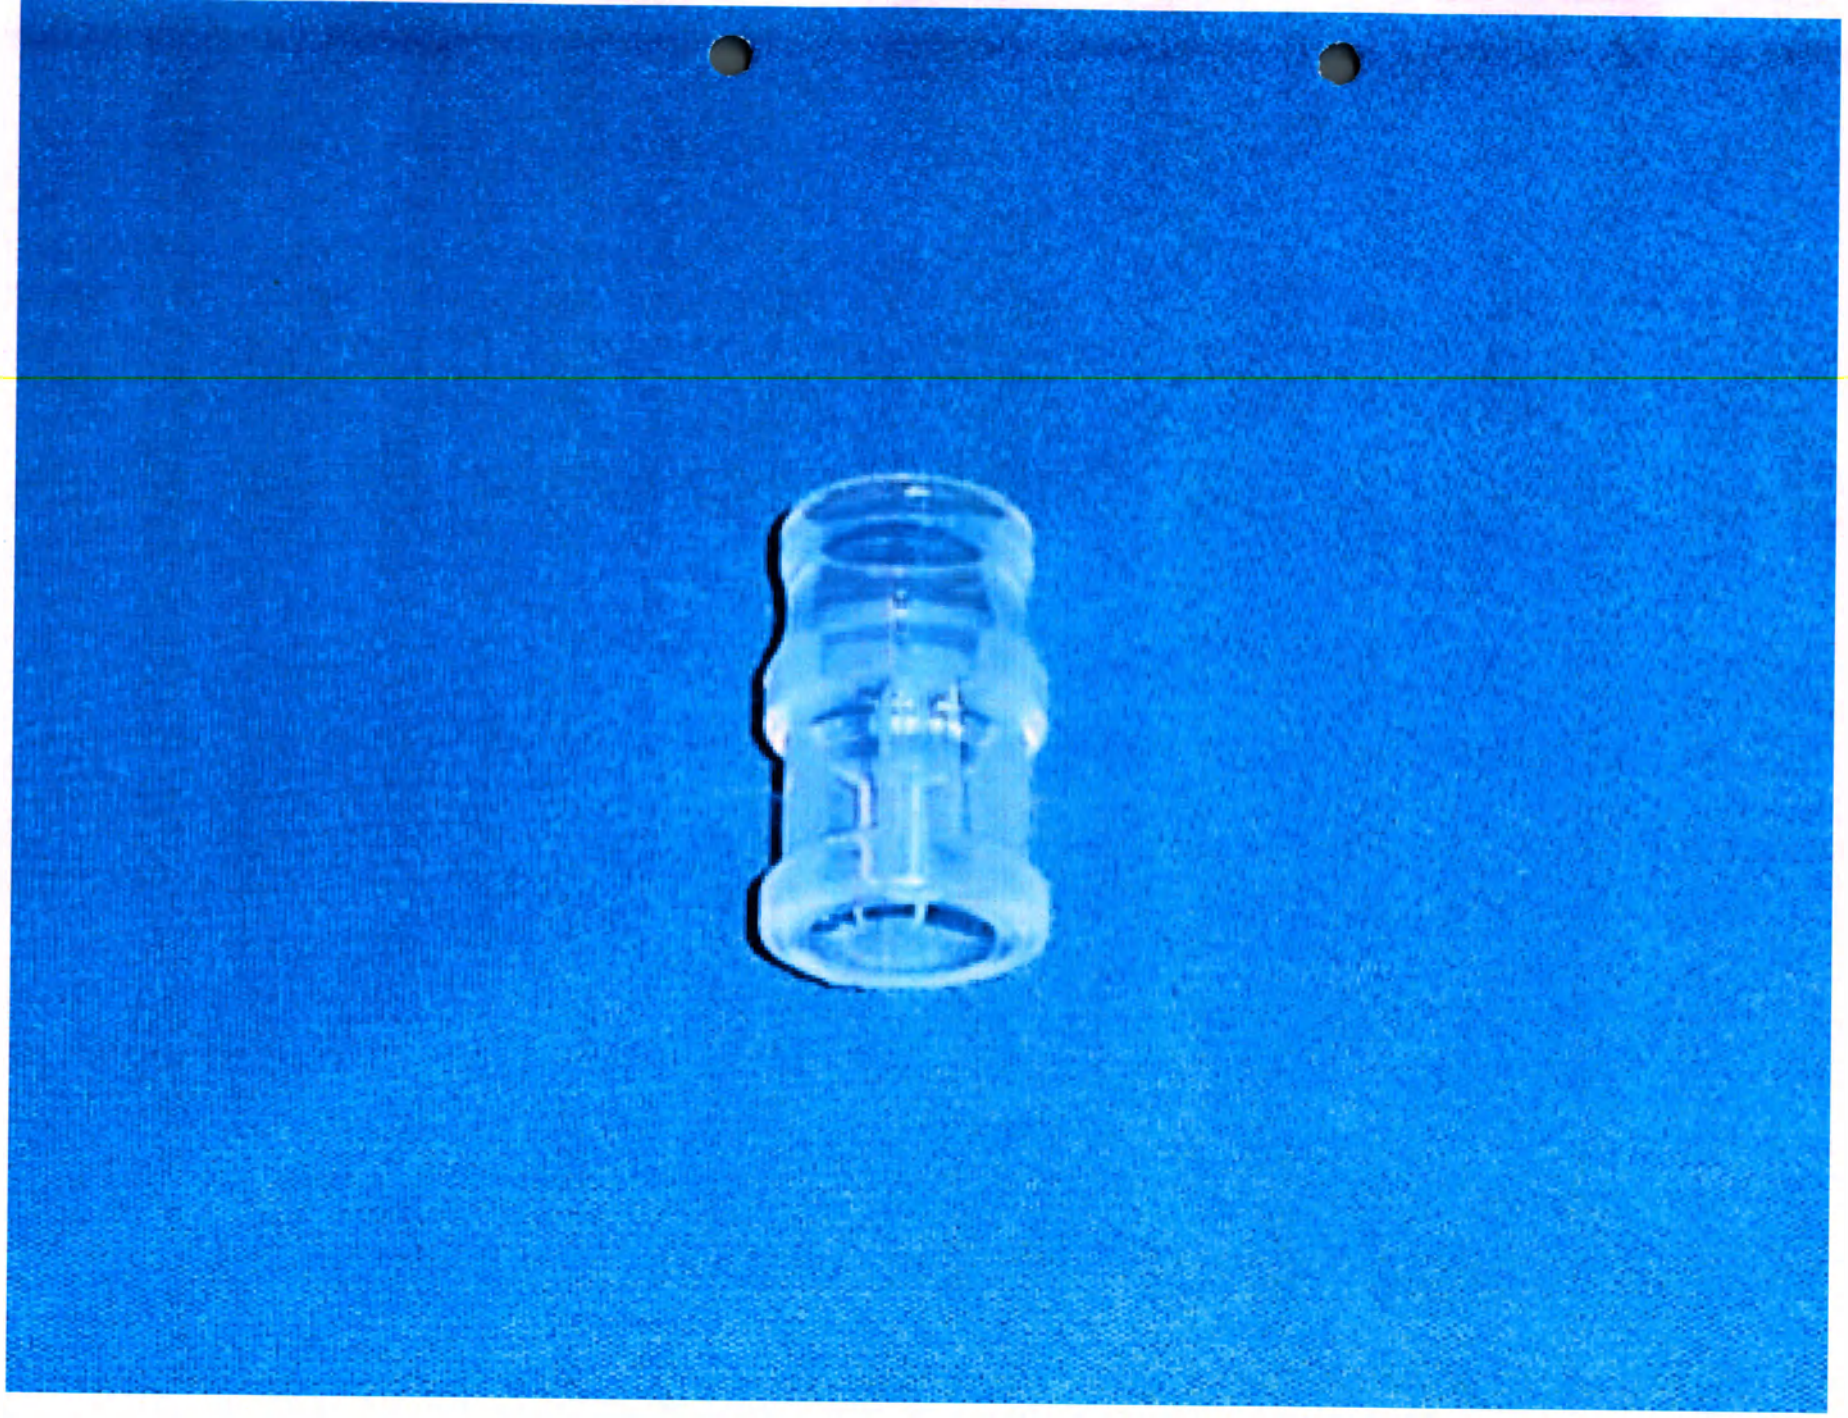

Коннектор многоразовый ADP1802P.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

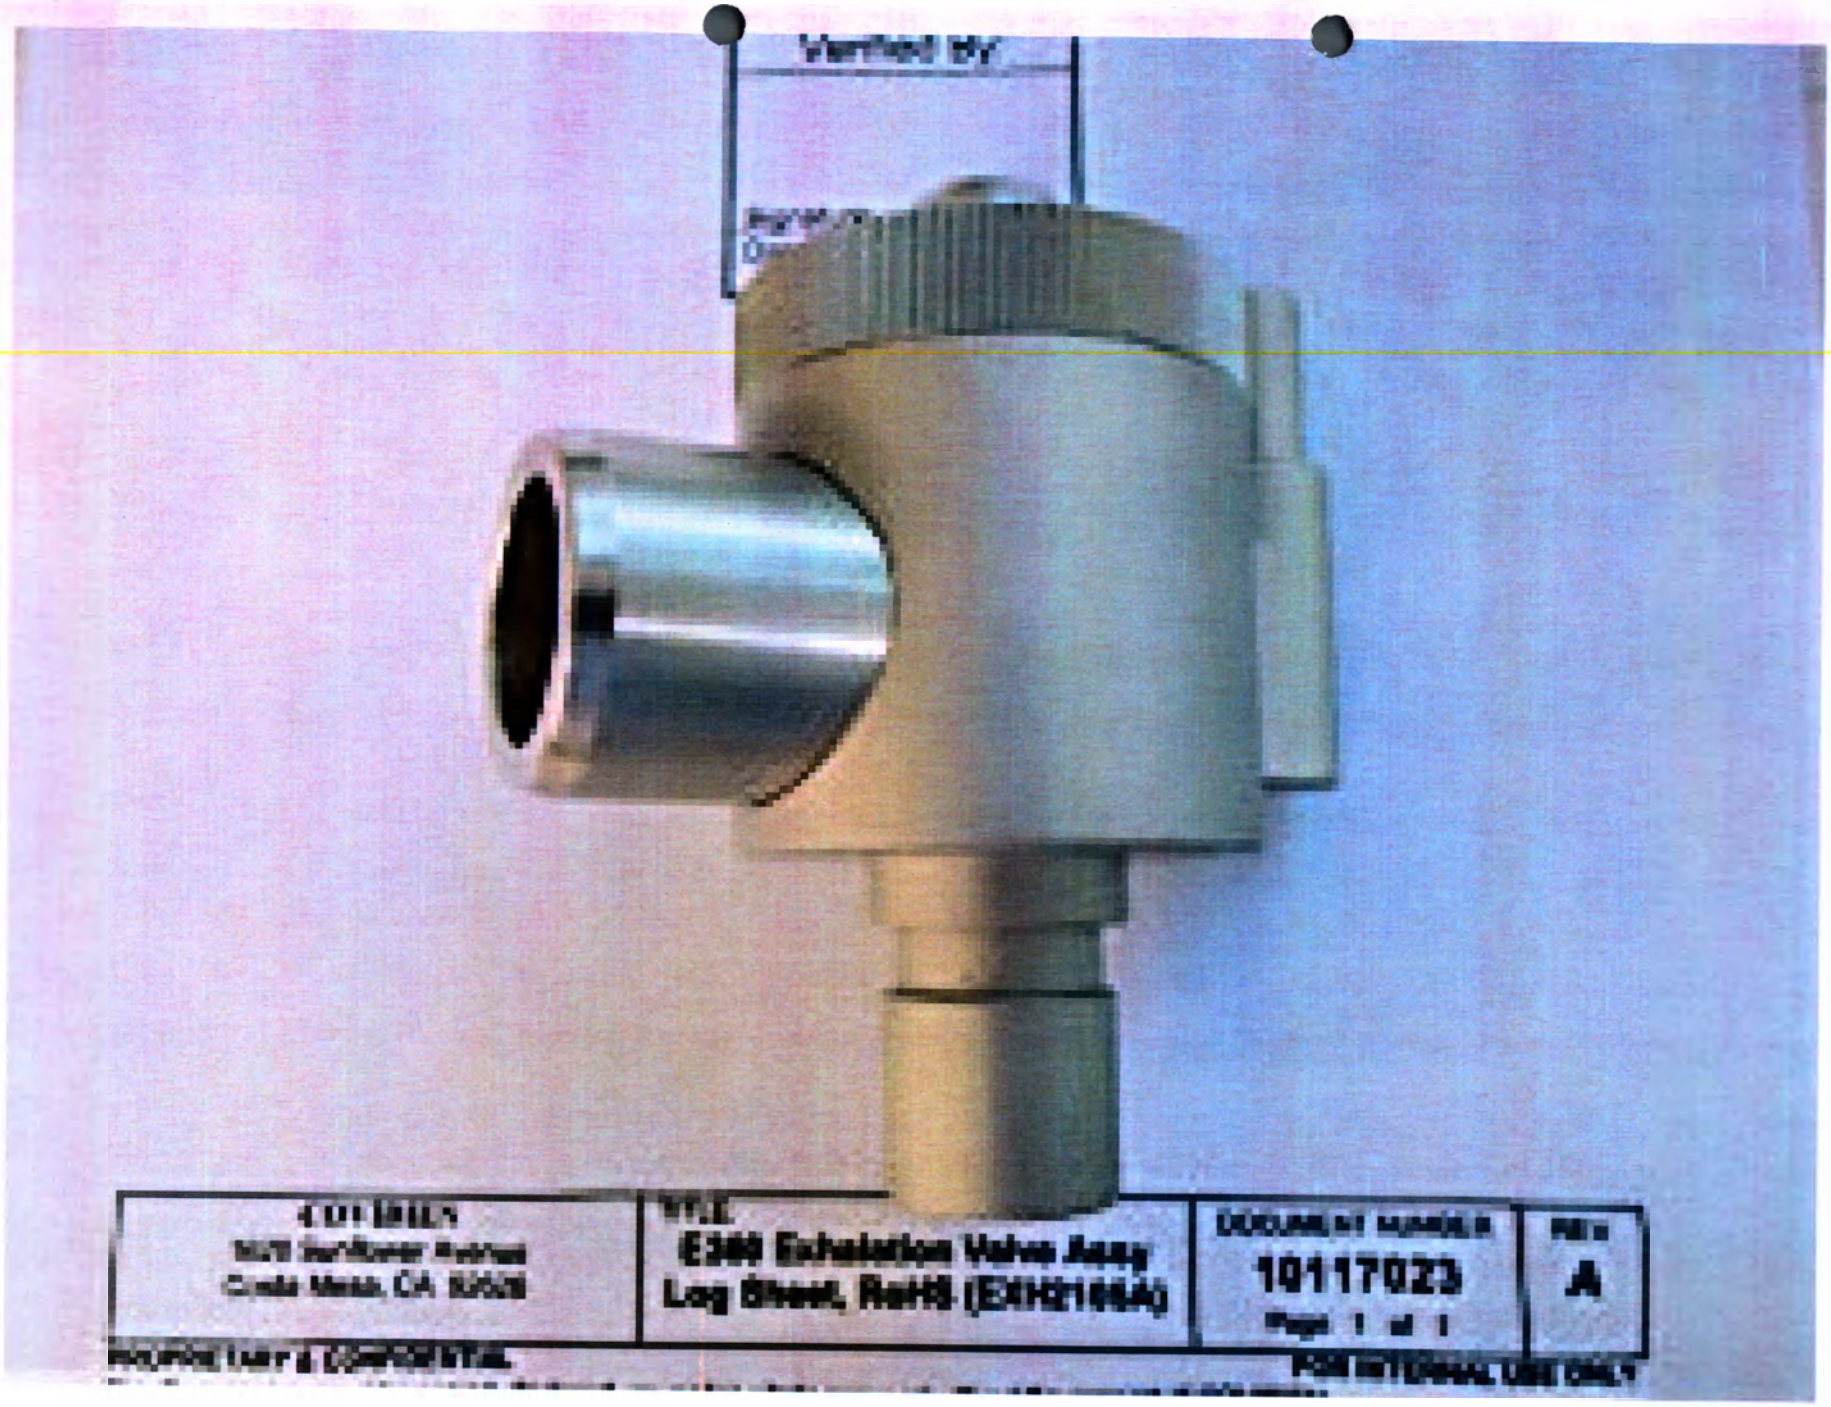


Клапан выдоха многоразовый

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Температурный датчик в комплекте с адаптером и креплением к стойке на колёсах ACC850AD.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

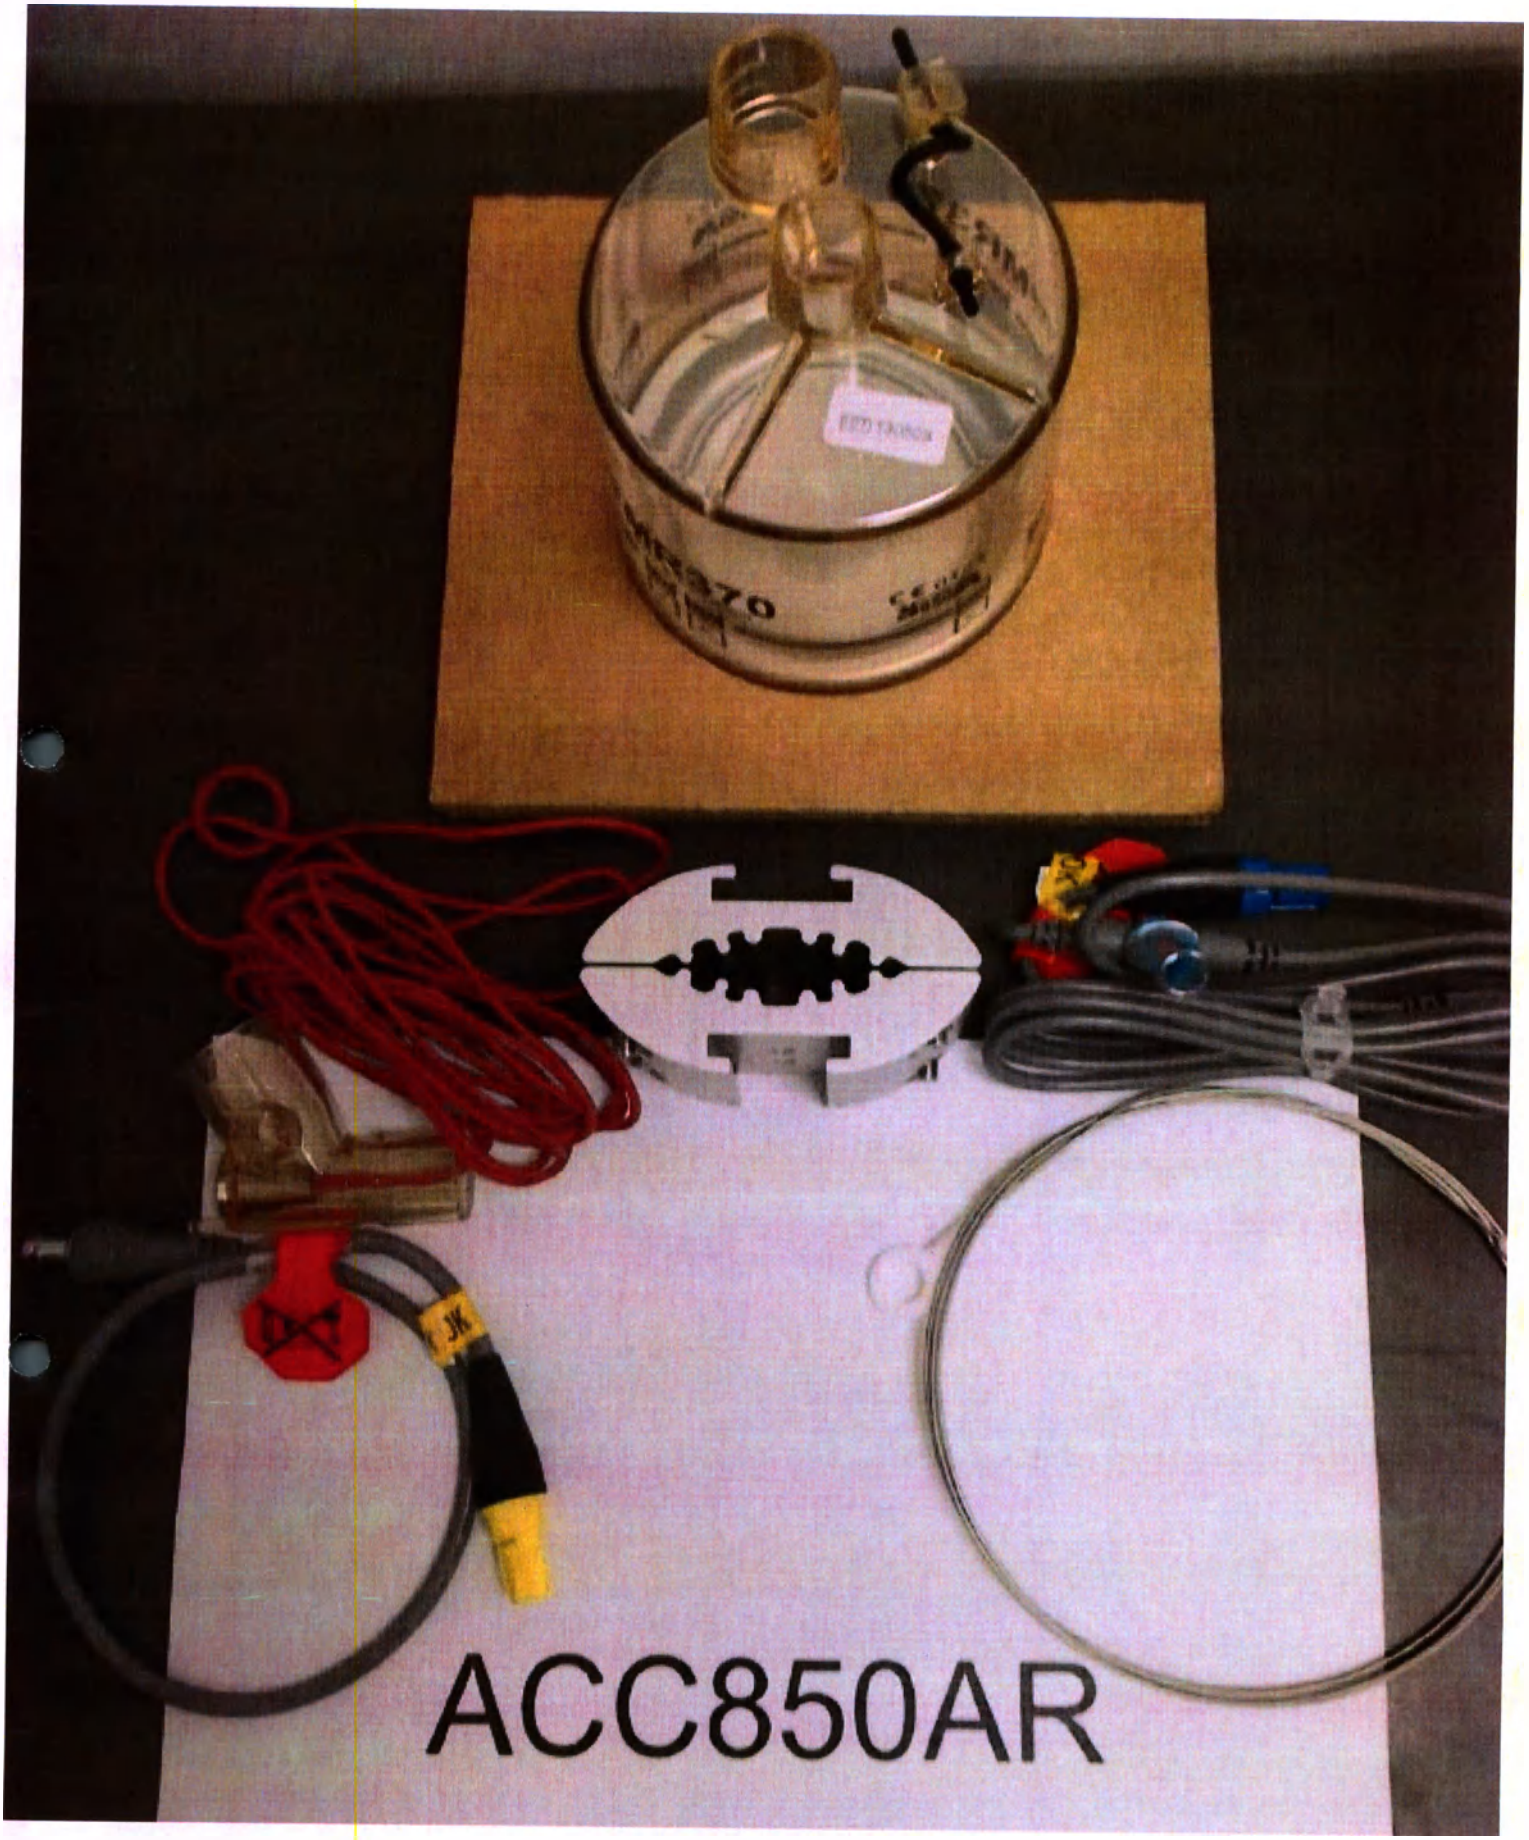

Комплекты температурных датчиков ACC850AR, ACC850PR, ACC850IR, ACC850IS

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Крепление к стойке на колёсах 900MR030-1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Адаптер для нагревательного провода 900MR805, 900MR858

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Температурный датчик 900MR860, 900MR868, 900MR869

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Резервуар MR340, MR370.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Нагревательный провод 900MR510, 900MR751, 900MR754

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Проводник для введения нагревательного провода 900MR070


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

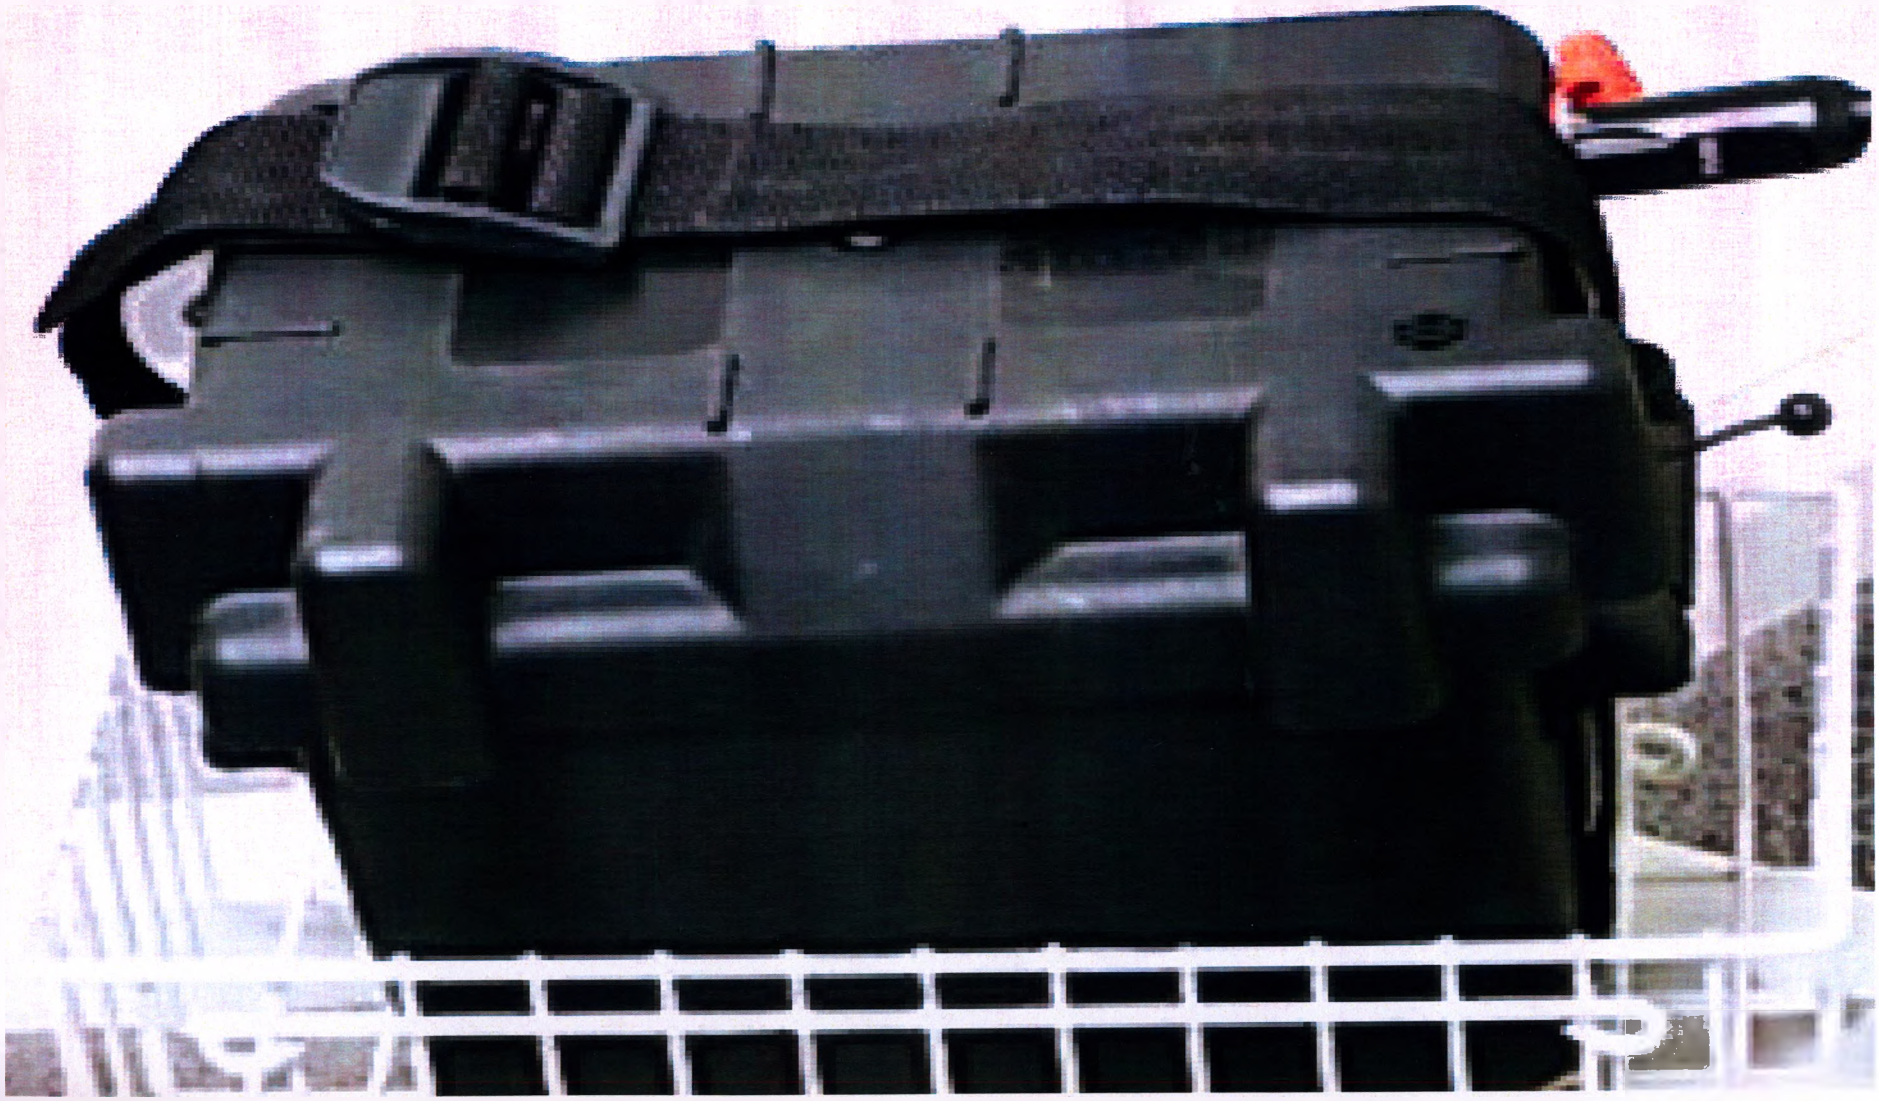

Аккумулятор внешний BAT2100S

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
39(тридцать девять) листов

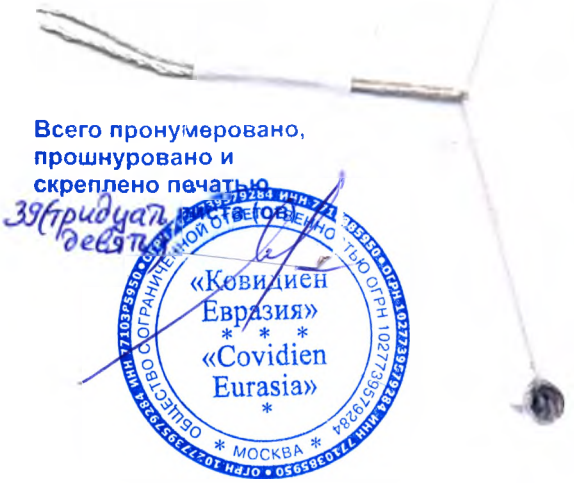

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU