


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**



ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

REF B 17.01

Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов
в сыворотке (плазме) крови
энзиматическим колориметрическим методом



Реагент №1: 1 x 50 мл
Калибратор: 1 x 1 мл

ТУ 9398-053-94568735-2016
РЗН 2017/6152 от 23.08.2017

LOT

Серия:
xxxx



Дата выпуска:
гггг.мм



Годен до:
гггг.мм

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 5Б, литера А

EC REP

ENERGIE EUROPE
P. 1000000000 00 000 000
The Energy The Netherlands




1701123300001007

ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

REF B 17.11

Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов
в сыворотке (плазме) крови
энзиматическим колориметрическим методом



Реагент №1. 2 x 50 мл
Калибратор: 1 x 1 мл

ТУ 9398-053-94568735-2016
РЗН 2017/6152 от 23.08.2017

LOT

Серия:
xxxx



Дата выпуска:
ggg.мм



Годен до:
ggg.мм

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194368 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 55, литер А

EC REP

Содержит опасные
химические вещества. Не
использовать для
питания. Не вдыхать пары.




17 11 2017 053 94568735

ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

REF

B 17.21

Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов
в сыворотке (плазме) крови
энзиматическим колориметрическим методом



Реагент №1: 2 x 100 мл
Калибратор: 2 x 1 мл

ТУ 9398-053-94568735-2016
РЗН 2017/6152 от 23.08.2017

LOT

Серия:
xxxx



Дата выпуска:
гггг.мм



Годен до:
гггг.мм

только для in vitro диагностики






АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194366 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 56, литера А

IEC REP

ВНИМАНИЕ!
После вскрытия упаковки
использовать в течение 30 дней



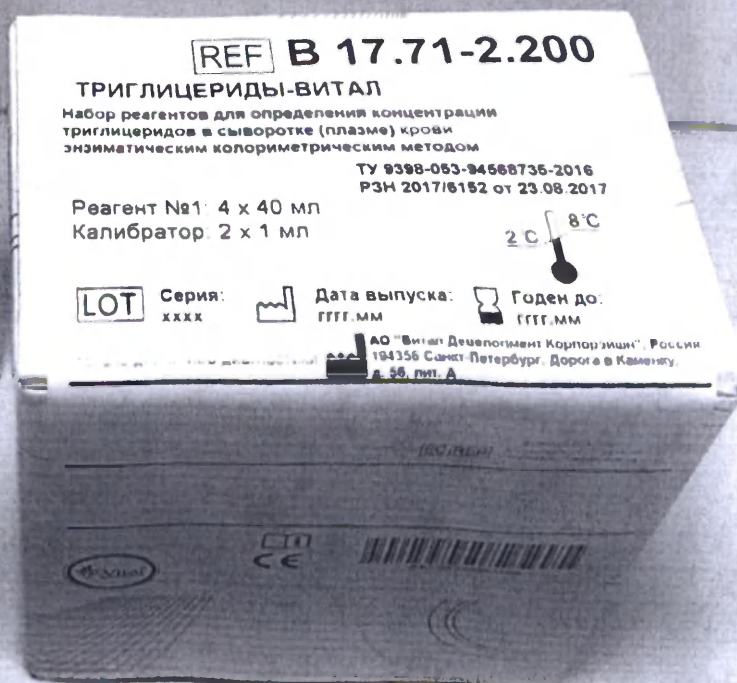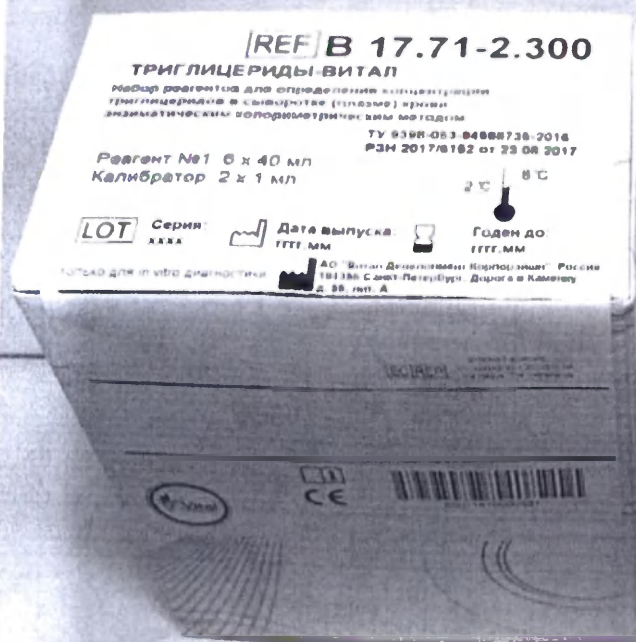

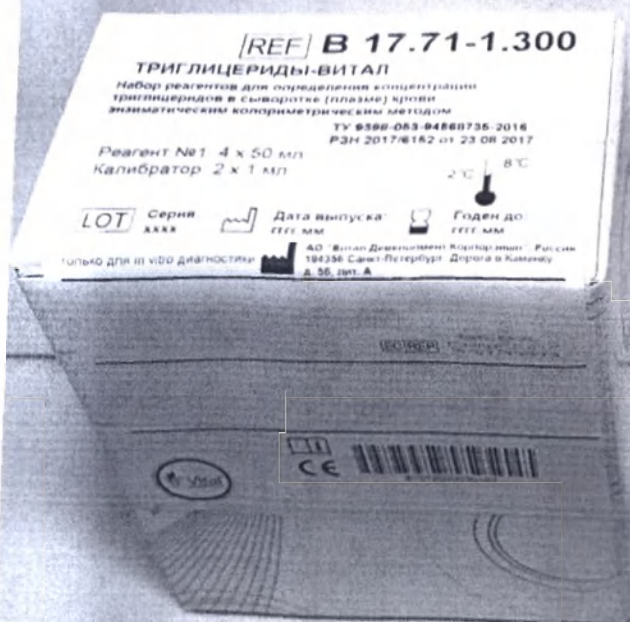

REF B 17.71-1.150


ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
триглицеридов в сыворотке (плазме) крови
энзиматическим колориметрическим методом

ТУ 9398-053-94568735-2016
РЗН 2017/6152 от 23.08.2017

Реагент №1: 5 x 40 мл

Калибратор: 2 x 1 мл



LOT

Серия:
xxxx



Дата выпуска:
ggg.мм



Годен до:
ggg.мм

только для in vitro диагностики




АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
191356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
д. 56, лит. А

CE

ВНИМАНИЕ! При
использовании 20-25°C
для хранения реагентов



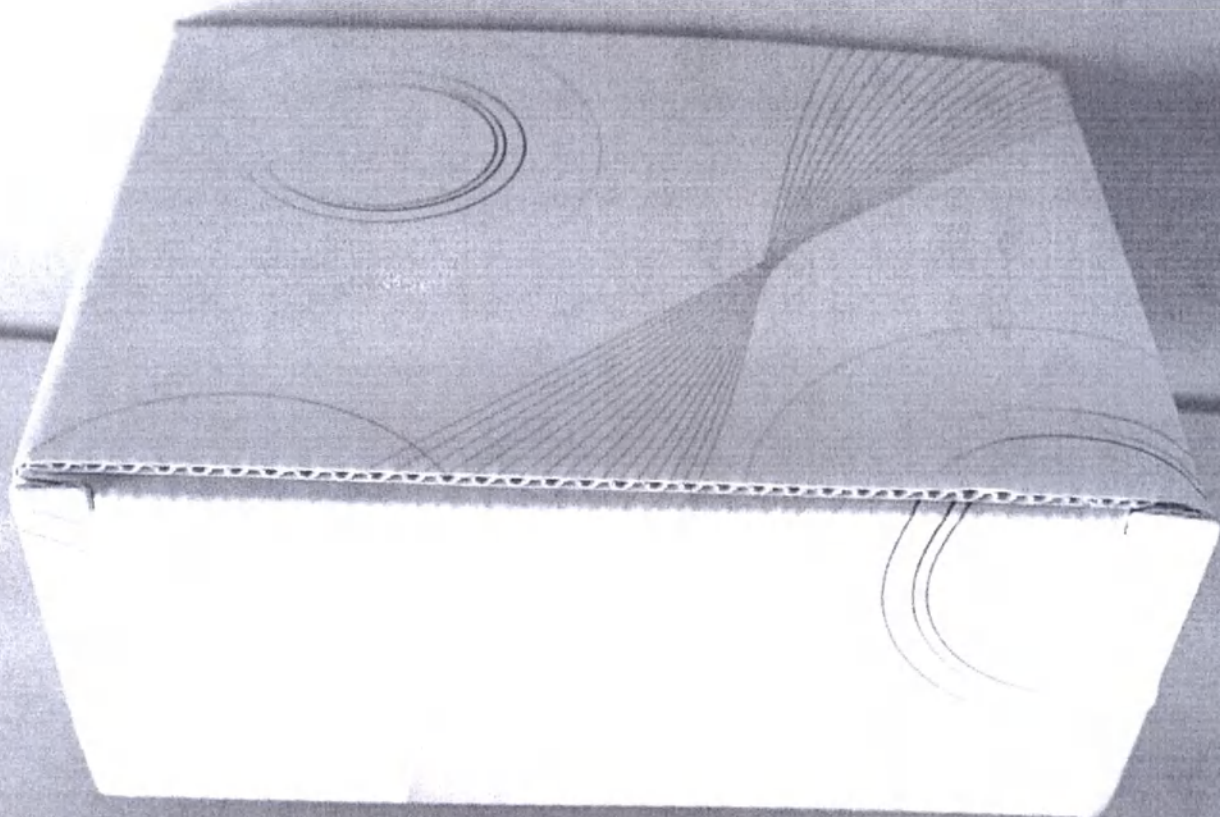

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 8 листа(ов)

Исп. директор

Плехов А.А.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



А.Г. Плехов

2020 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

**Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке
(плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом.**

Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом

LOT Серия: xxxx

Дата выпуска: гггг.мм

Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1 x 50 мл

ТУ 9398-053-94568735-2016

Калибратор: 1 x 1 мл

РЗН 2017/6152 от 23.08.2017

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

+2-8°C



5010232954236

Только для in vitro диагностики

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC

REP

ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

REF B 17.01

REF B 17.11

50 мл

Монореагент

+2-8°C

LOT xxxx

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

1 мл

2,85 ммоль/л

+2-8°C

LOT xxxx

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 1

КАЛИБРАТОР

Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 2 x 50 мл

Калибратор: 1 x 1 мл

ТУ 9398-053-94568735-2016

РЗН 2017/6152 от 23.08.2017

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C




Только для in vitro диагностики



5010232954236

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

REF B 17.01

REF B 17.11

50 мл

Монореагент

LOT xxxx



+2-8°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

REF B 17.01

REF B 17.11

50 мл

Монореагент

LOT xxxx



+2-8°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

1 мл

2,85 ммоль/л

LOT xxxx



+2-8°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 2 x 100 мл

Калибратор: 2 x 1 мл

ТУ 9398-053-94568735-2016

РЗН 2017/6152 от 23.08.2017



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,

194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



5010232954236

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC

REP

РЕАГЕНТ 1

ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

REF В 17.21

100 мл

Монореагент

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 1

ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

REF В 17.21

100 мл

Монореагент

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



КАЛИБРАТОР

ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

1 мл

2,85 ммоль/л

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



КАЛИБРАТОР

ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

1 мл

2,85 ммоль/л

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 5 x 40 мл

Калибратор: 2 x 1 мл

ТУ 9398-053-94568735-2016

РЗН 2017/6152 от 23.08.2017



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



5010232954236

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC

REP

ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

REF В 17.71-1.150

40 мл

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

1 мл

2,85 ммоль/л

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

1 мл

2,85 ммоль/л

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 1

КАЛИБРАТОР

КАЛИБРАТОР

ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

REF В 17.71-1.300

Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 4 x 50 мл

Калибратор: 2 x 1 мл

ТУ 9398-053-94568735-2016

РЗН 2017/6152 от 23.08.2017

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C




Только для in vitro диагностики



5010232954236

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

REF В 17.71-1.300

50 мл

LOT xxxx



+2-8°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

1 мл

2,85 ммоль/л

LOT xxxx



+2-8°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

1 мл

2,85 ммоль/л

LOT xxxx



+2-8°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 4 x 70 мл


Калибратор: 2 x 1 мл

ТУ 9398-053-94568735-2016

РЗН 2017/6152 от 23.08.2017



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



5010232954236

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC


REP

ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

REF В 17.71-1.420

70 мл

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики




Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

1 мл

2,85 ммоль/л

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики




ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

1 мл

2,85 ммоль/л

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 4 x 40 мл

Калибратор: 2 x 1 мл

ТУ 9398-053-94568735-2016

РЗН 2017/6152 от 23.08.2017

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



5010232954236

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC

REP

РЕАГЕНТ 1

ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

REF В 17.71-2.200

40 мл



xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

КАЛИБРАТОР

ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

1 мл

2,85 ммоль/л



xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



КАЛИБРАТОР

ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

1 мл

2,85 ммоль/л



xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом

LOT Серия: xxxx

Дата выпуска: гггг.мм

Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 6 x 40 мл

ТУ 9398-053-94568735-2016

Калибратор: 2 x 1 мл

РЗН 2017/6152 от 23.08.2017

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

+2-8°C




Только для in vitro диагностики



5010232954236

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



РЕАГЕНТ 1

ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

REF В 17.71-2.300

40 мл

LOT xxxx

+2-8°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

КАЛИБРАТОР

ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

1 мл

2,85 ммоль/л

LOT xxxx

+2-8°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



КАЛИБРАТОР

ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ

1 мл

2,85 ммоль/л

LOT xxxx

+2-8°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью



листа(ов)

Плехов А.Г.