Фотографические изображения представленных образцов медицинского изделия «Эндопротез для стентирования протока поджелудочной железы


по ТУ 9398-097-18037666-2016»,

производства АО "МедСил", Россия


ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

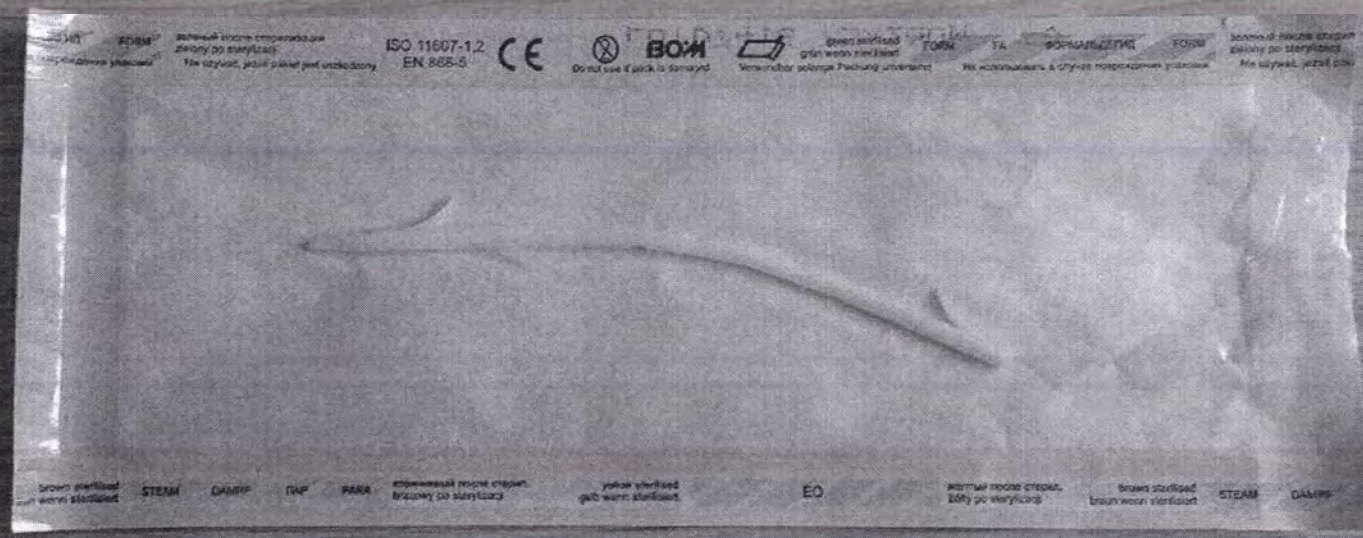

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

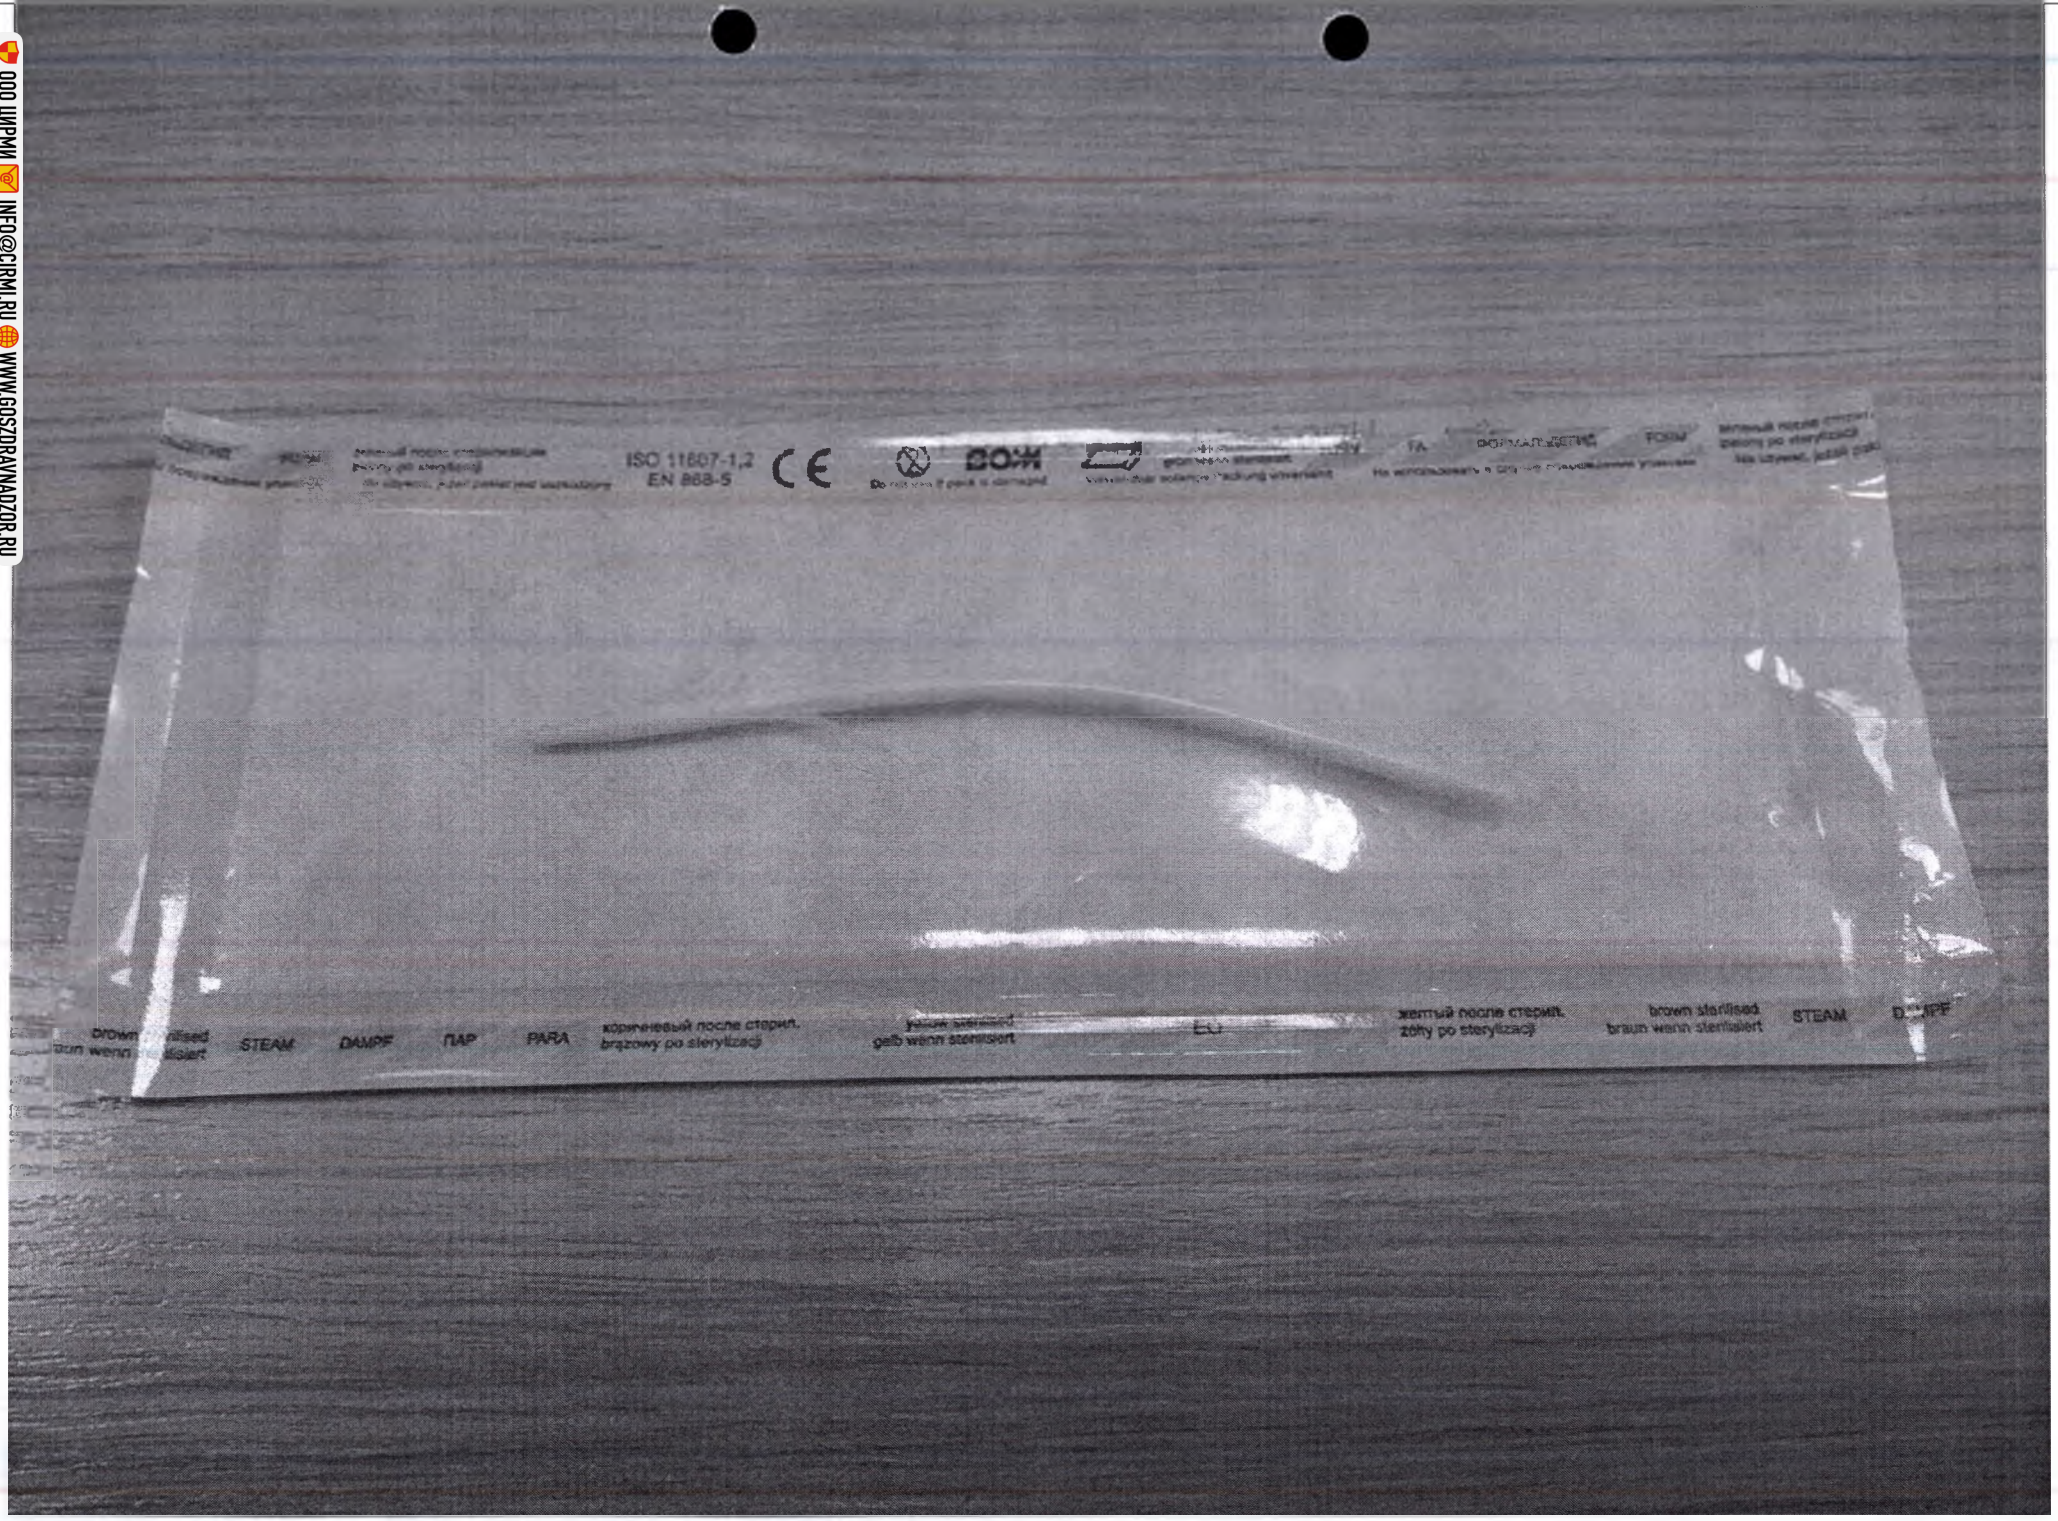

Этикетка

Эндопротез для стентирования протока поджелудочной железы
ЭСПЖ-10F-100
ТУ 9398-097-18037666-2016

Транспортировать при температуре не ниже -10°С и не выше +35°С и относительной влажности воздуха до 98%. Хранить в закрытых помещениях при температуре не ниже -10°С и не выше +40°С и относительной влажности воздуха до 98%. Изделие должно храниться на стеллажах в первичной упаковке.

LOT

Sterile	EO

Стерильно, апирогенно

Дата стерилизации

Годен до

Изготовитель: Россия,
ЗАО «МедСил»,
г.Мытищи Московской области, ул.Ядреевская, 4
тел/факс (495)583 36 62

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Этикетка

Эндопротез для стентирования протока поджелудочной железы ЭСПЖ-10F-80

ТУ 9398-097-18037666-2016

Транспортировать при температуре не ниже -10°С и не выше +35°С и относительной влажности воздуха до 98%. Хранить в закрытых помещениях при температуре не ниже -10°С и не выше +40°С и относительной влажности воздуха до 98%. Изделие должно храниться на стеллажах в первичной упаковке.

LOT

Sterile | EO

Стерильно, апирогенно

Дата стерилизации

Годен до

Изготовитель: Россия,
ЗАО «МедСил»,
г.Мытищи Московской области, ул.Ядреевская, 4
тел/факс (495)583 36 62

Этикетка

Эндопротез для стентирования протока поджелудочной железы ЭСПЖ-8F-80

ТУ 9398-097-18037666-2016

Транспортировать при температуре не ниже -10°С и не выше +35°С и относительной влажности воздуха до 98%. Хранить в закрытых помещениях при температуре не ниже -10°С и не выше +40°С и относительной влажности воздуха до 98%. Изделие должно храниться на стеллажах в первичной упаковке.

LOT

Sterile | EO

Стерильно, апирогенно

Дата стерилизации

Годен до

Изготовитель: Россия,
ЗАО «МедСил»,
г.Мытищи Московской области, ул.Ядреевская, 4
тел/факс (495)583 36 62

Этикетка

Эндопротез для стентирования протока поджелудочной железы ЭСПЖ-10F-100

ТУ 9398-097-18037666-2016

Транспортировать при температуре не ниже -10°С и не выше +35°С и относительной влажности воздуха до 98%. Хранить в закрытых помещениях при температуре не ниже -10°С и не выше +40°С и относительной влажности воздуха до 98%. Изделие должно храниться на стеллажах в первичной упаковке.

LOT

Sterile | EO

Стерильно, апирогенно

Дата стерилизации

Годен до

Изготовитель: Россия,
ЗАО «МедСил»,
г.Мытищи Московской области, ул.Ядреевская, 4
тел/факс (495)583 36 62

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU