

Анализатор cobas z 480**Основные компоненты анализатора**

Анализатор cobas z 480 состоит из следующих компонентов:


Блок термоциклера

Блок термоциклера с крышкой, вентиляцией, загрузчиком микроплашки и сканером штрих-кода микроплашки.

Блок детекции

Состоит из следующих элементов:

- Ламповый блок, в котором располагается ксеноновая лампа
- Оптический блок, включающий в себя жидкий проводник света, колесо фильтров эмиссии и детекции, и камеру CCD.

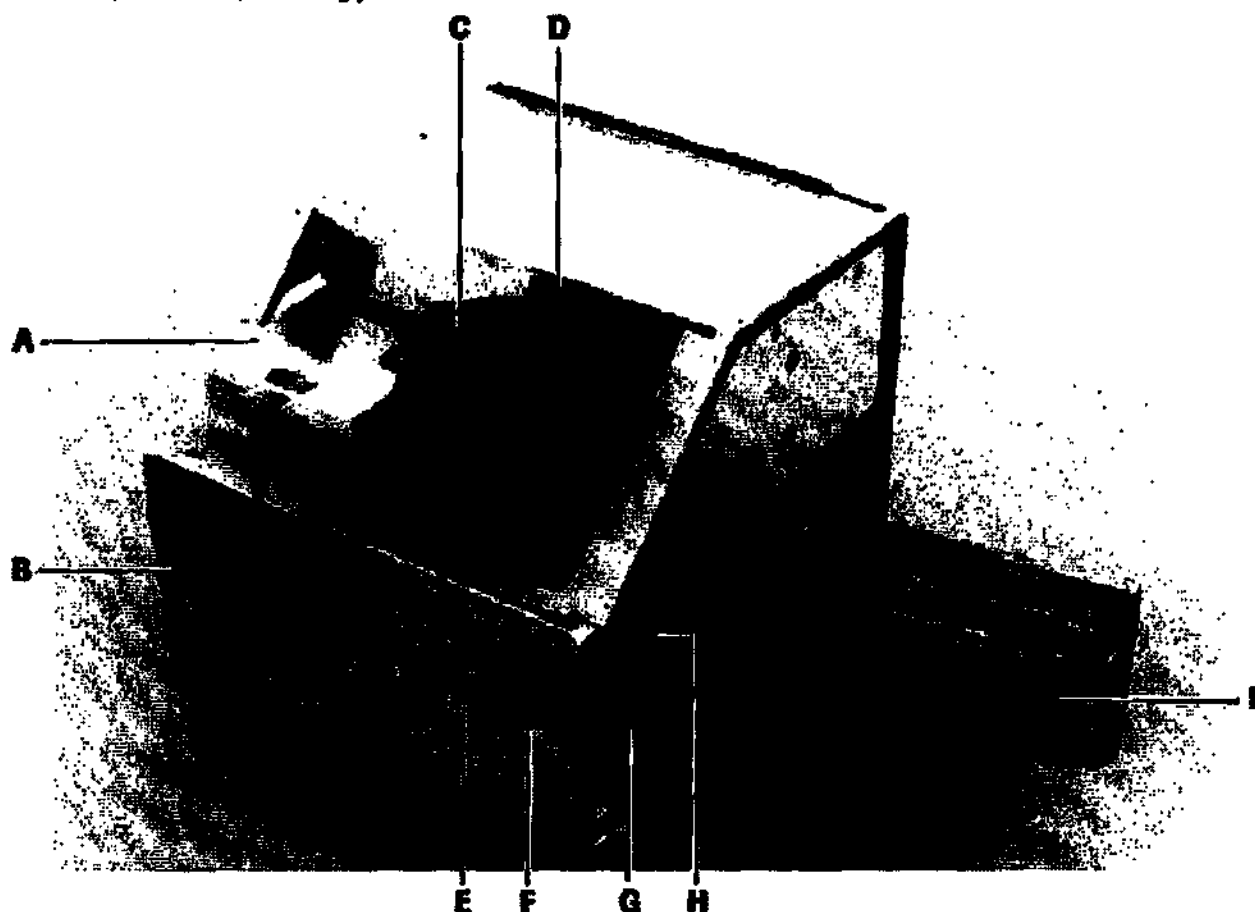

A Ламповый блок

B Корпус

C Блок детекции

D Колесо фильтров

E Индикатор статуса LED

F Загрузочная кнопка

G Блок термциклера

H Загрузчик микроплашки

I Дверца блока термоциклера (открыта) с вентиляторами

Рисунок А-38 Компоненты анализатора cobas z 480

Roche Diagnostics