




[Handwritten signature]



Катетер периферический (флексюля, канюля) с дополнительным портом и крылышками №16G (1.8X45мм)

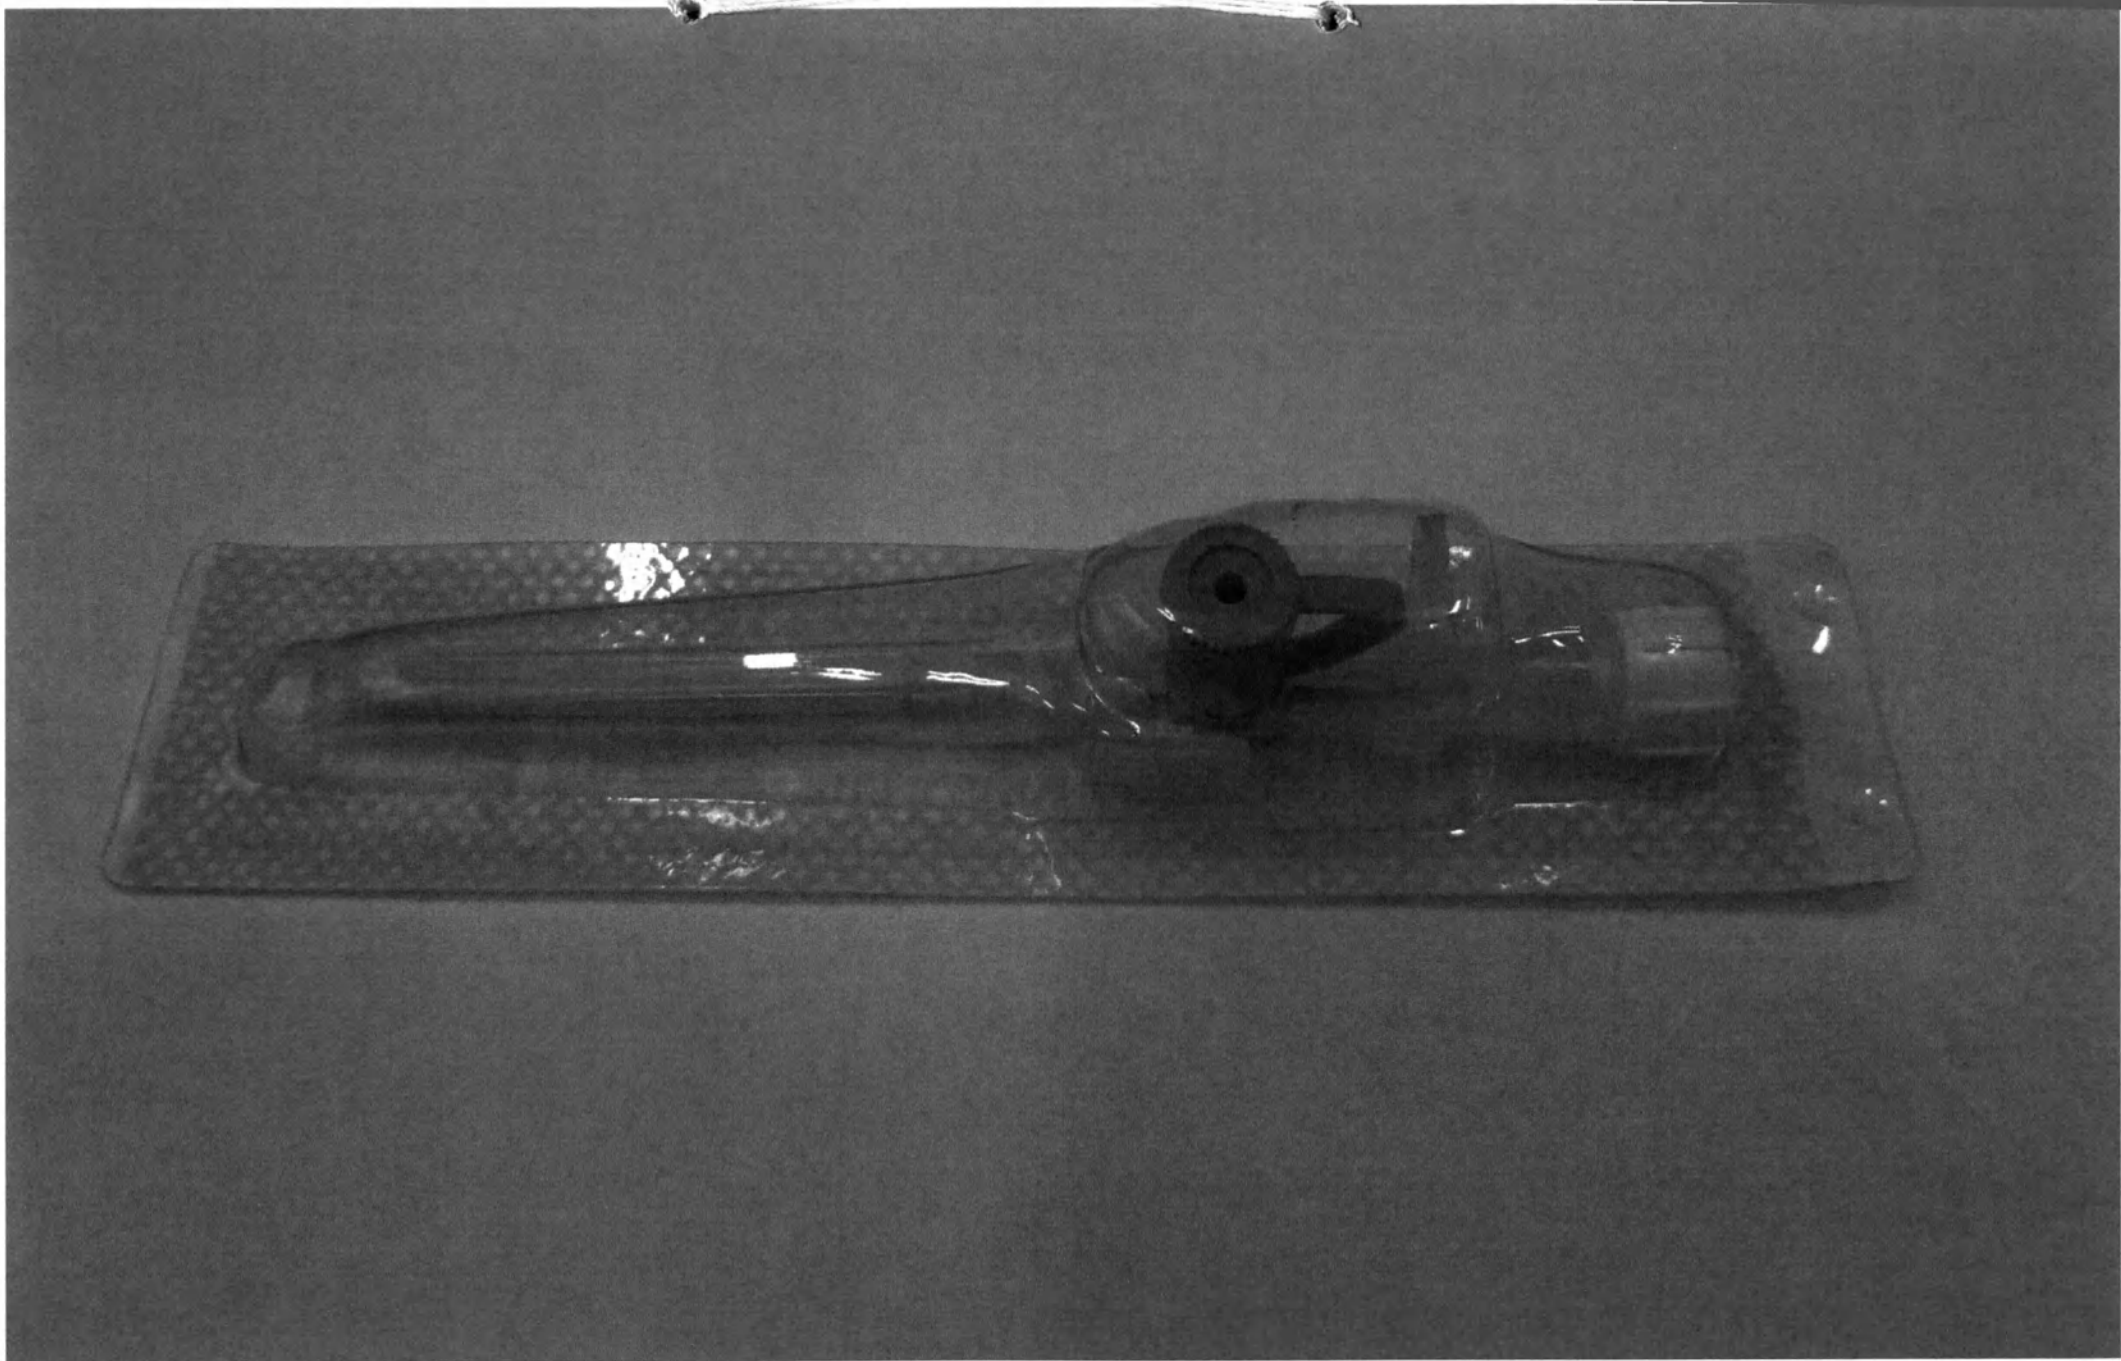

Катетер периферический (флексюля, канюля) с дополнительным портом и крылышками №18G (1,3x45мм)



Лезвия для безопасных бритв



Устройство для активного дренирования ран однократного применения с баллоном



Бритва безопасная



Мочеприемник женский




Ножницы для разрезания гипсовых повязок



Ножницы для стрижки волос



Отсасыватель хирургический

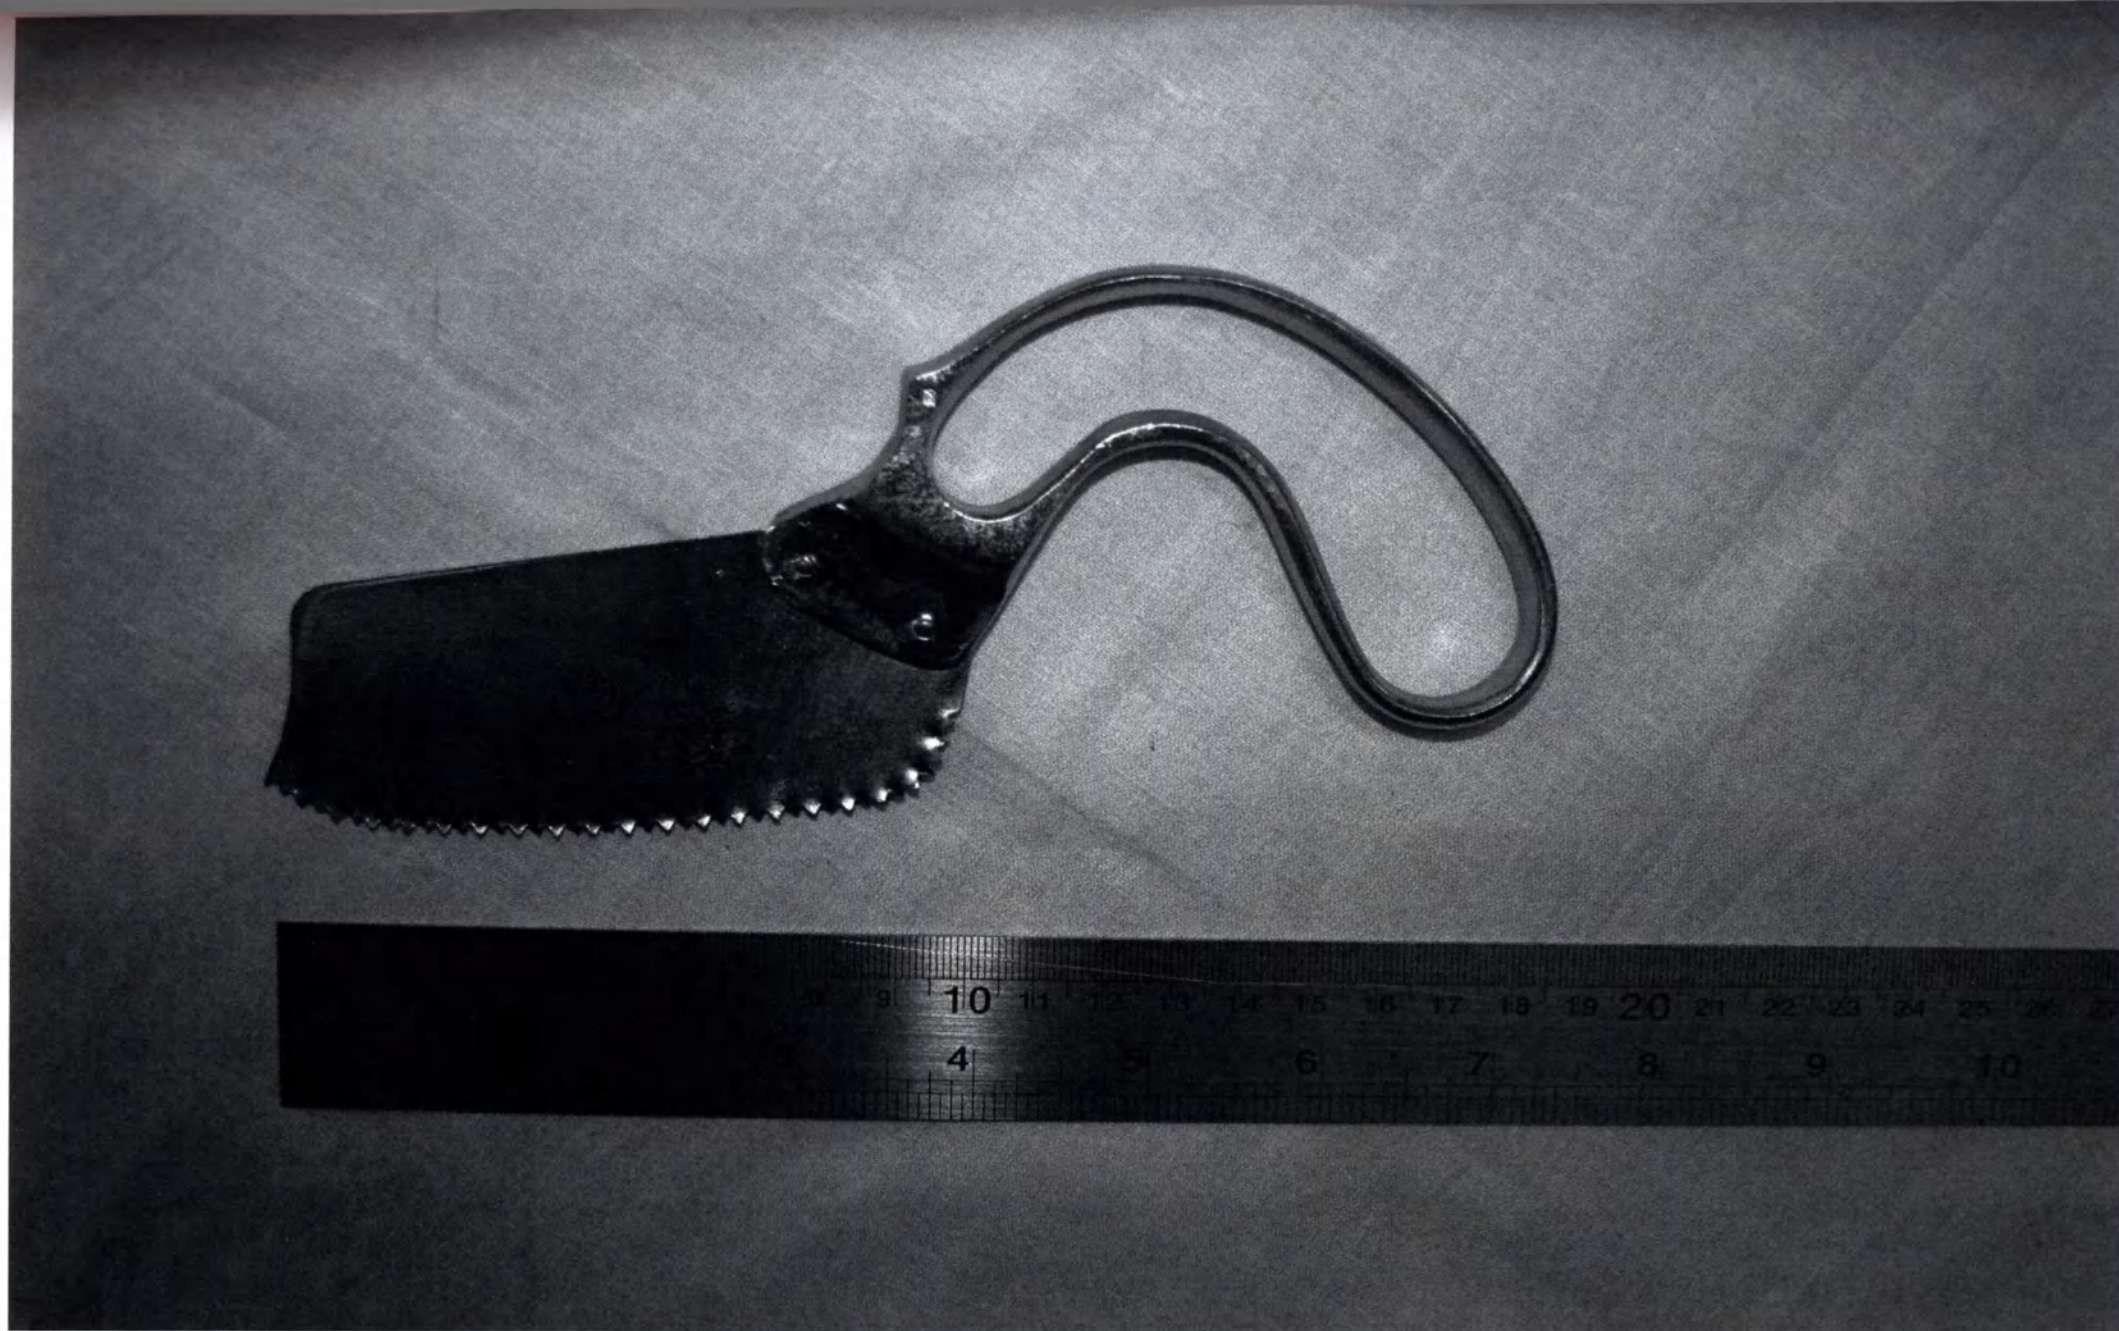


Пила для разрезания гипсовых повязок




Расширитель трахеотомический длиной 125 мм




Лоток почкообразный нержавеющей

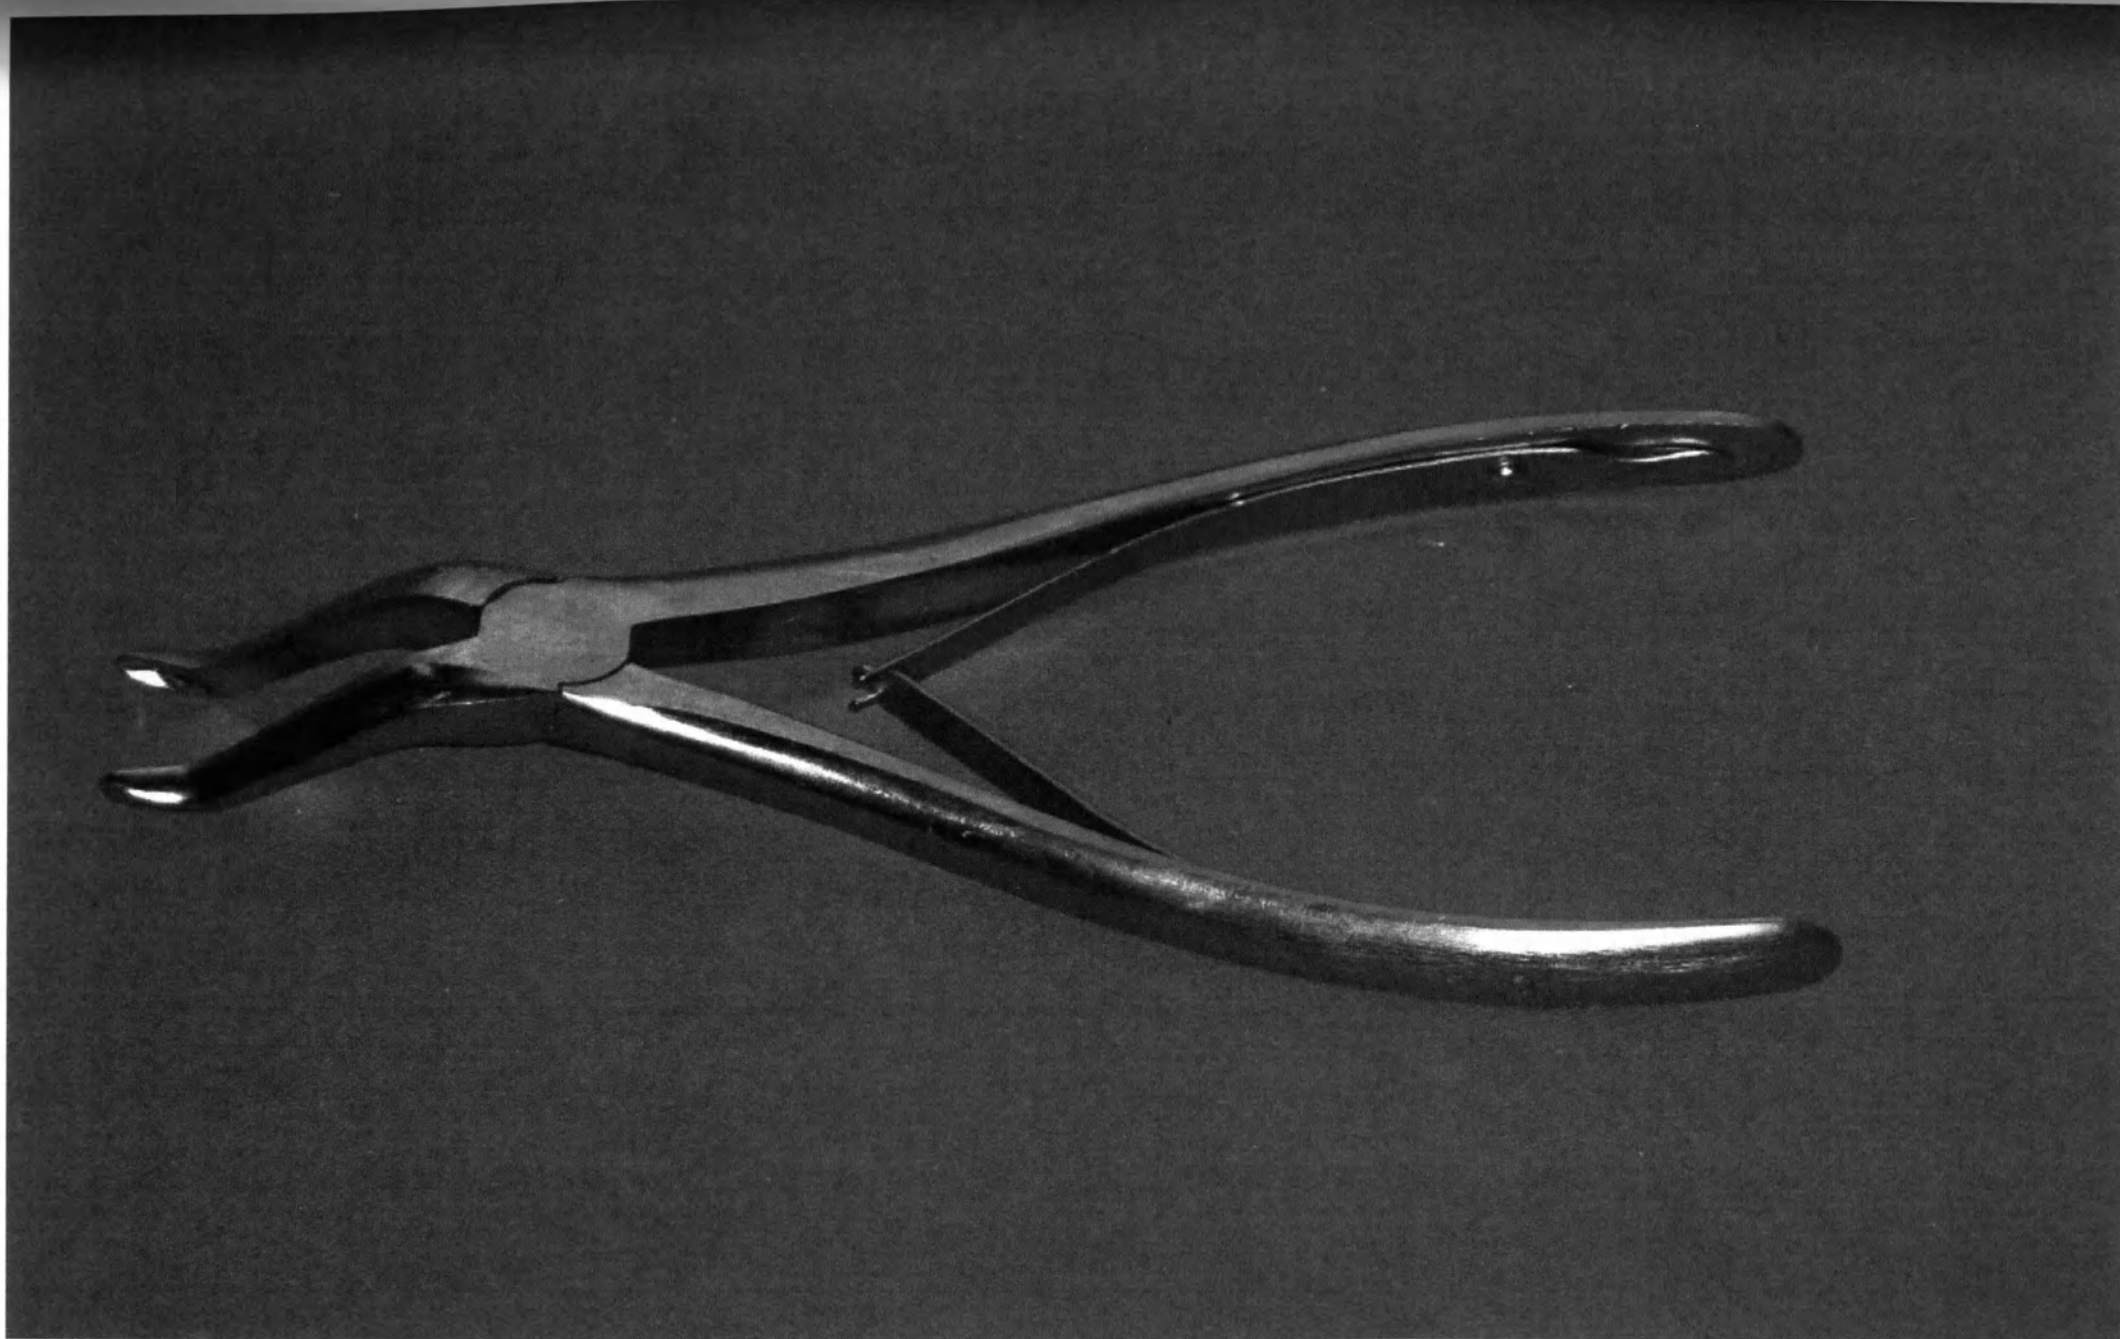

Щипцы штыковидные с узкими овальными губками

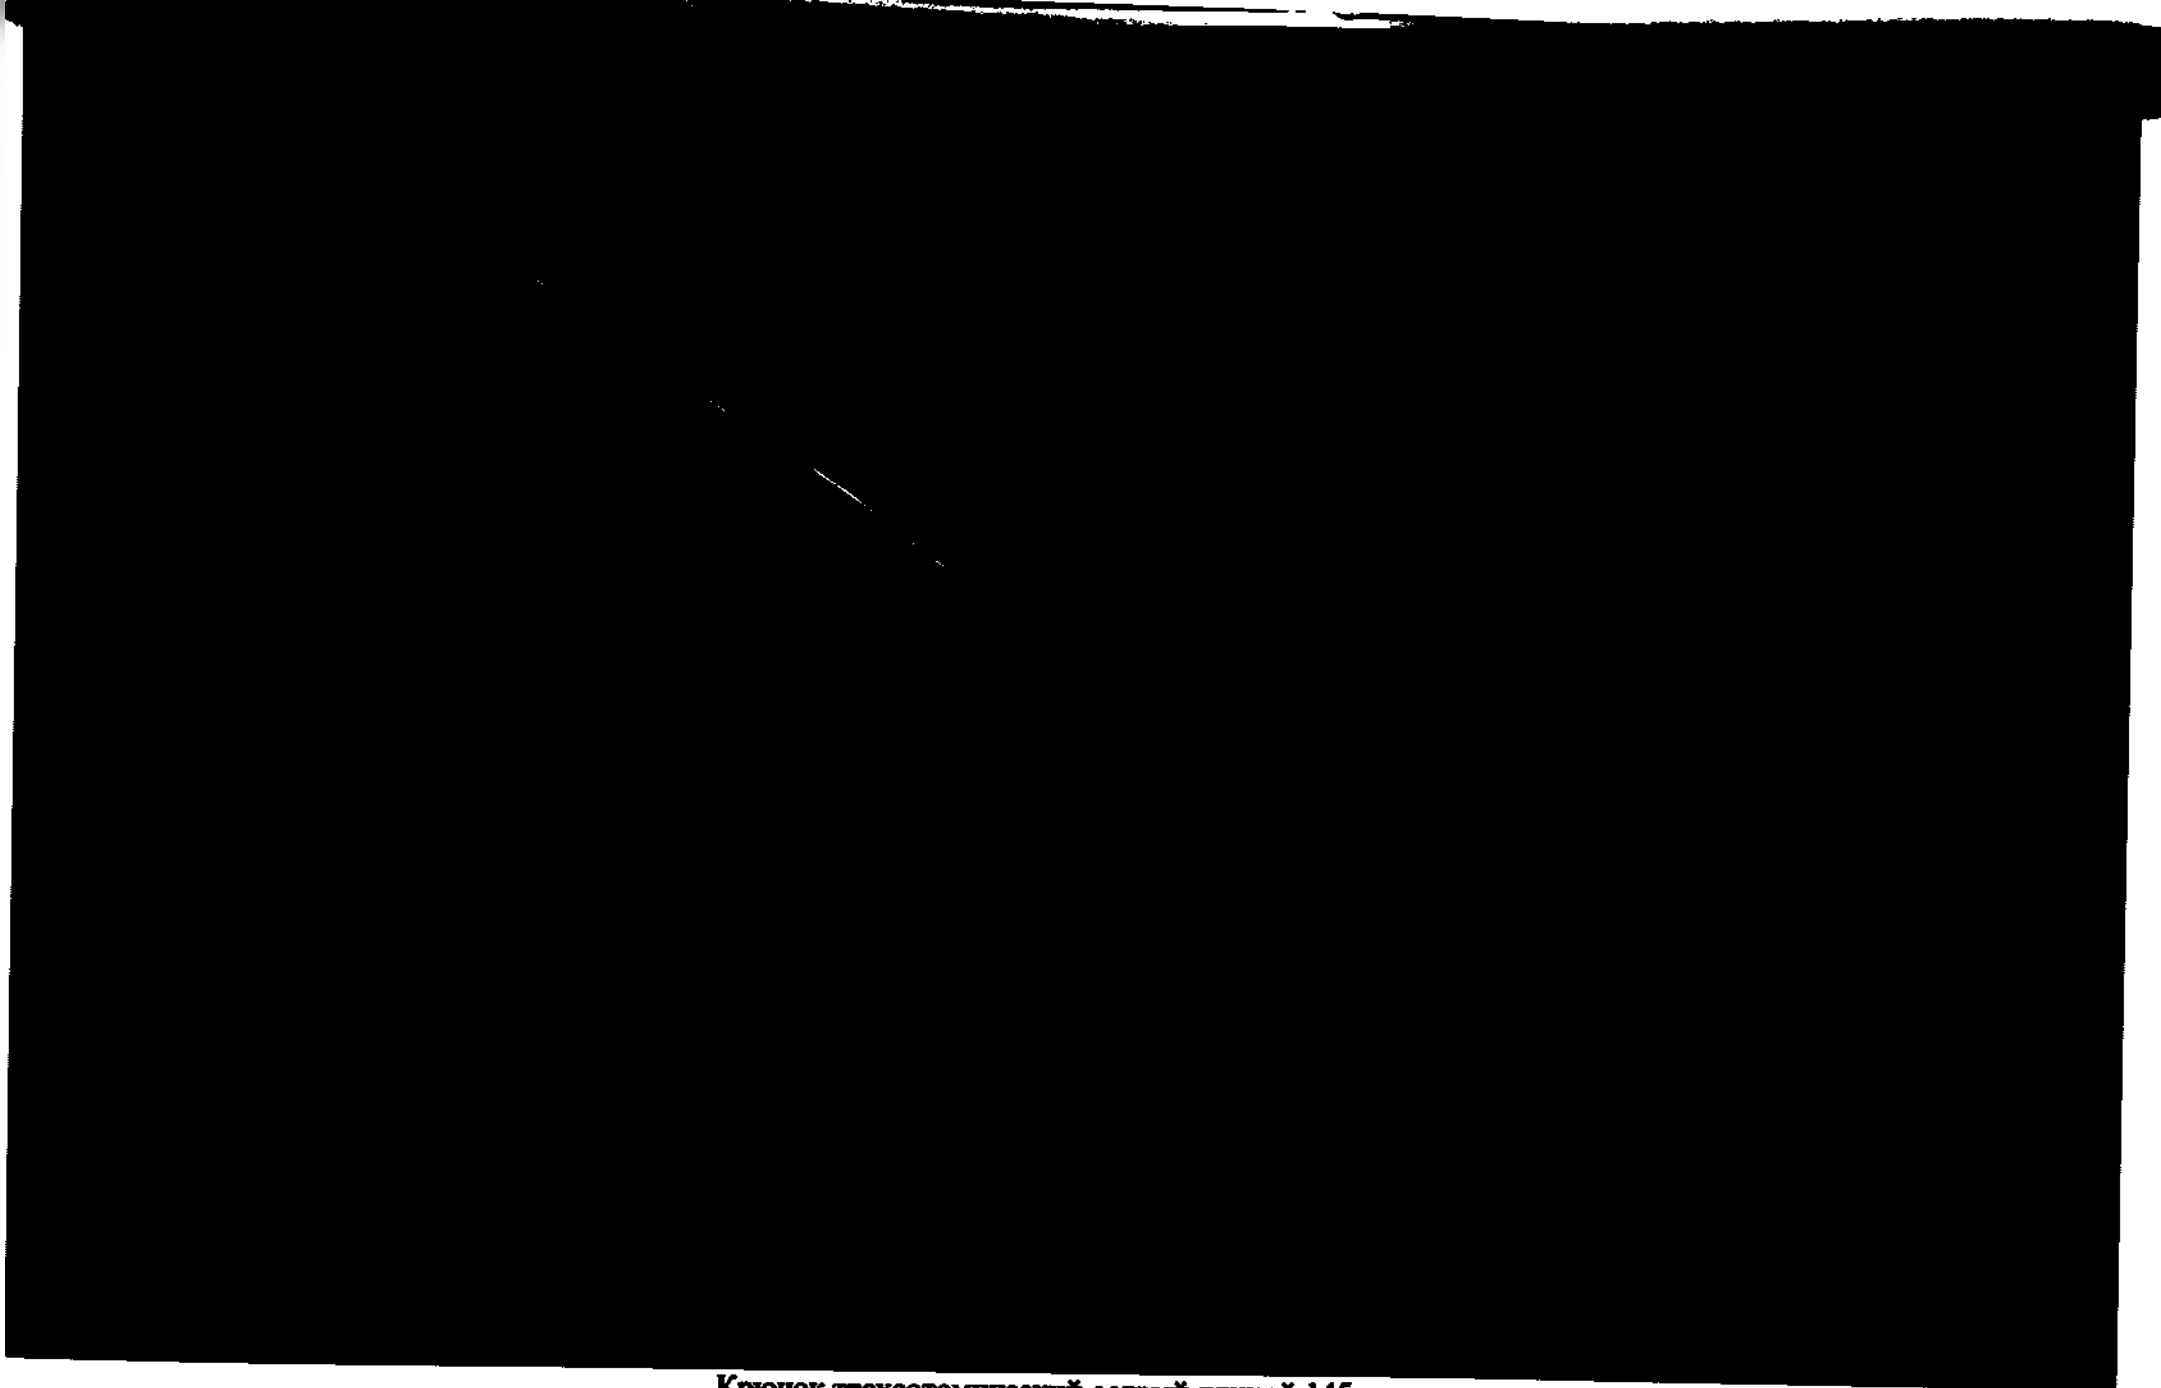


Крючок трахеотомический острый длиной 145 мм

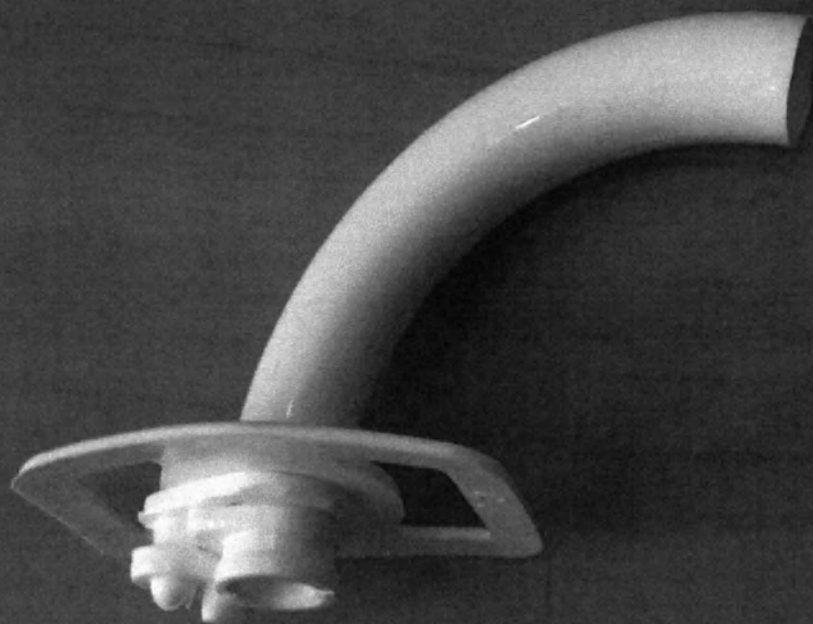

Трубка трахеотомическая пластмассовая №2 диаметром 9,3 мм




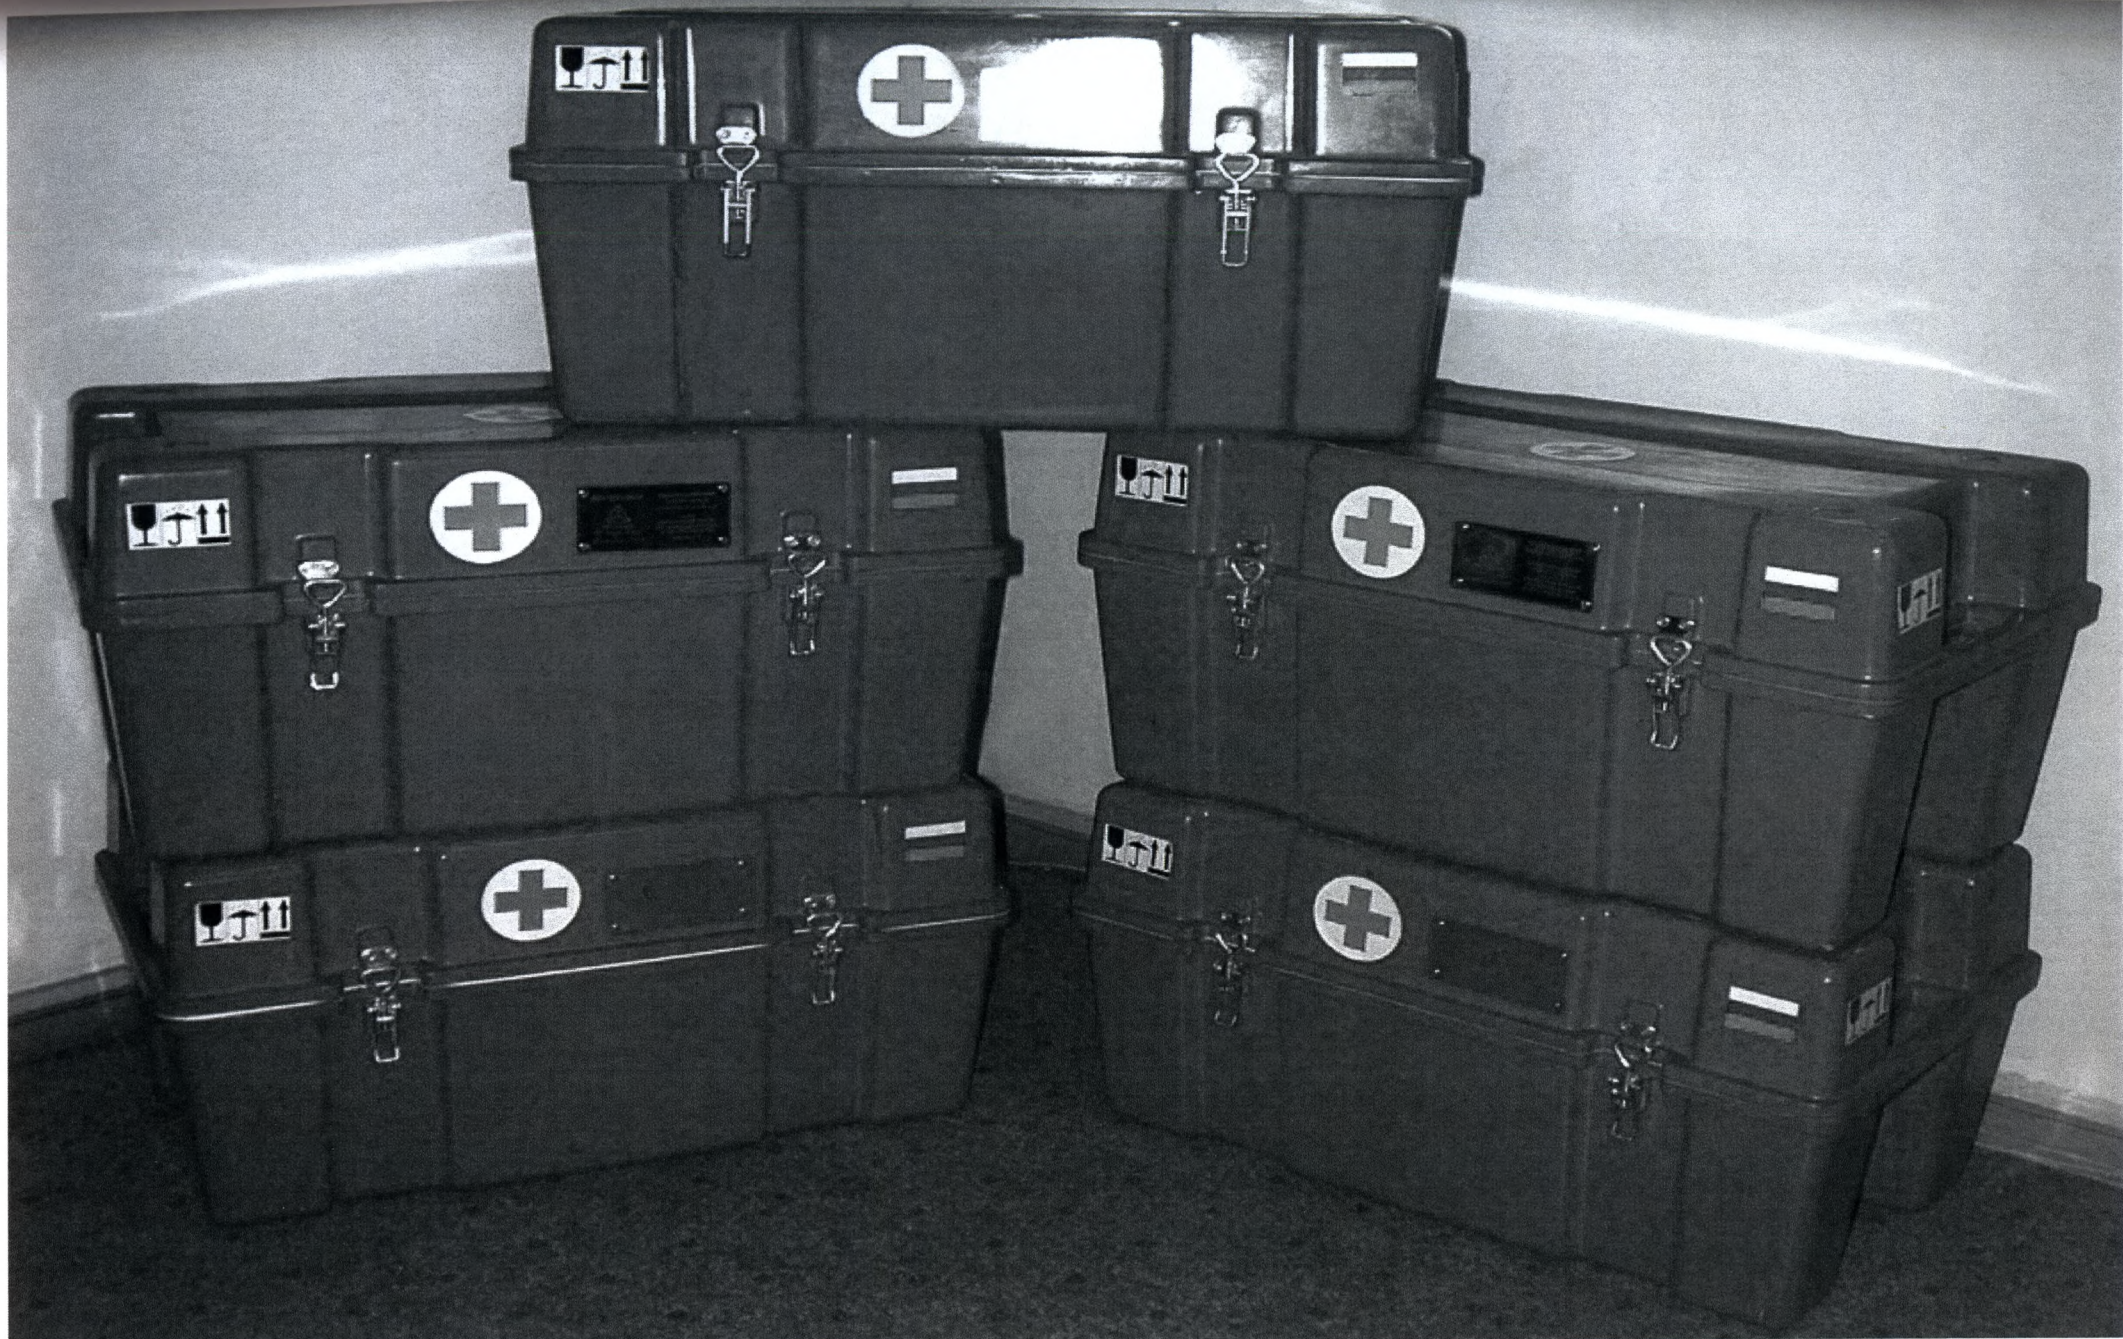

Набор для оказания помощи при повреждениях таза и конечностей НТК




Укладка для дренирования плевральной полости при напряженном пневмотораксе и герметизации плевральной полости при открытом пневмотораксе УД

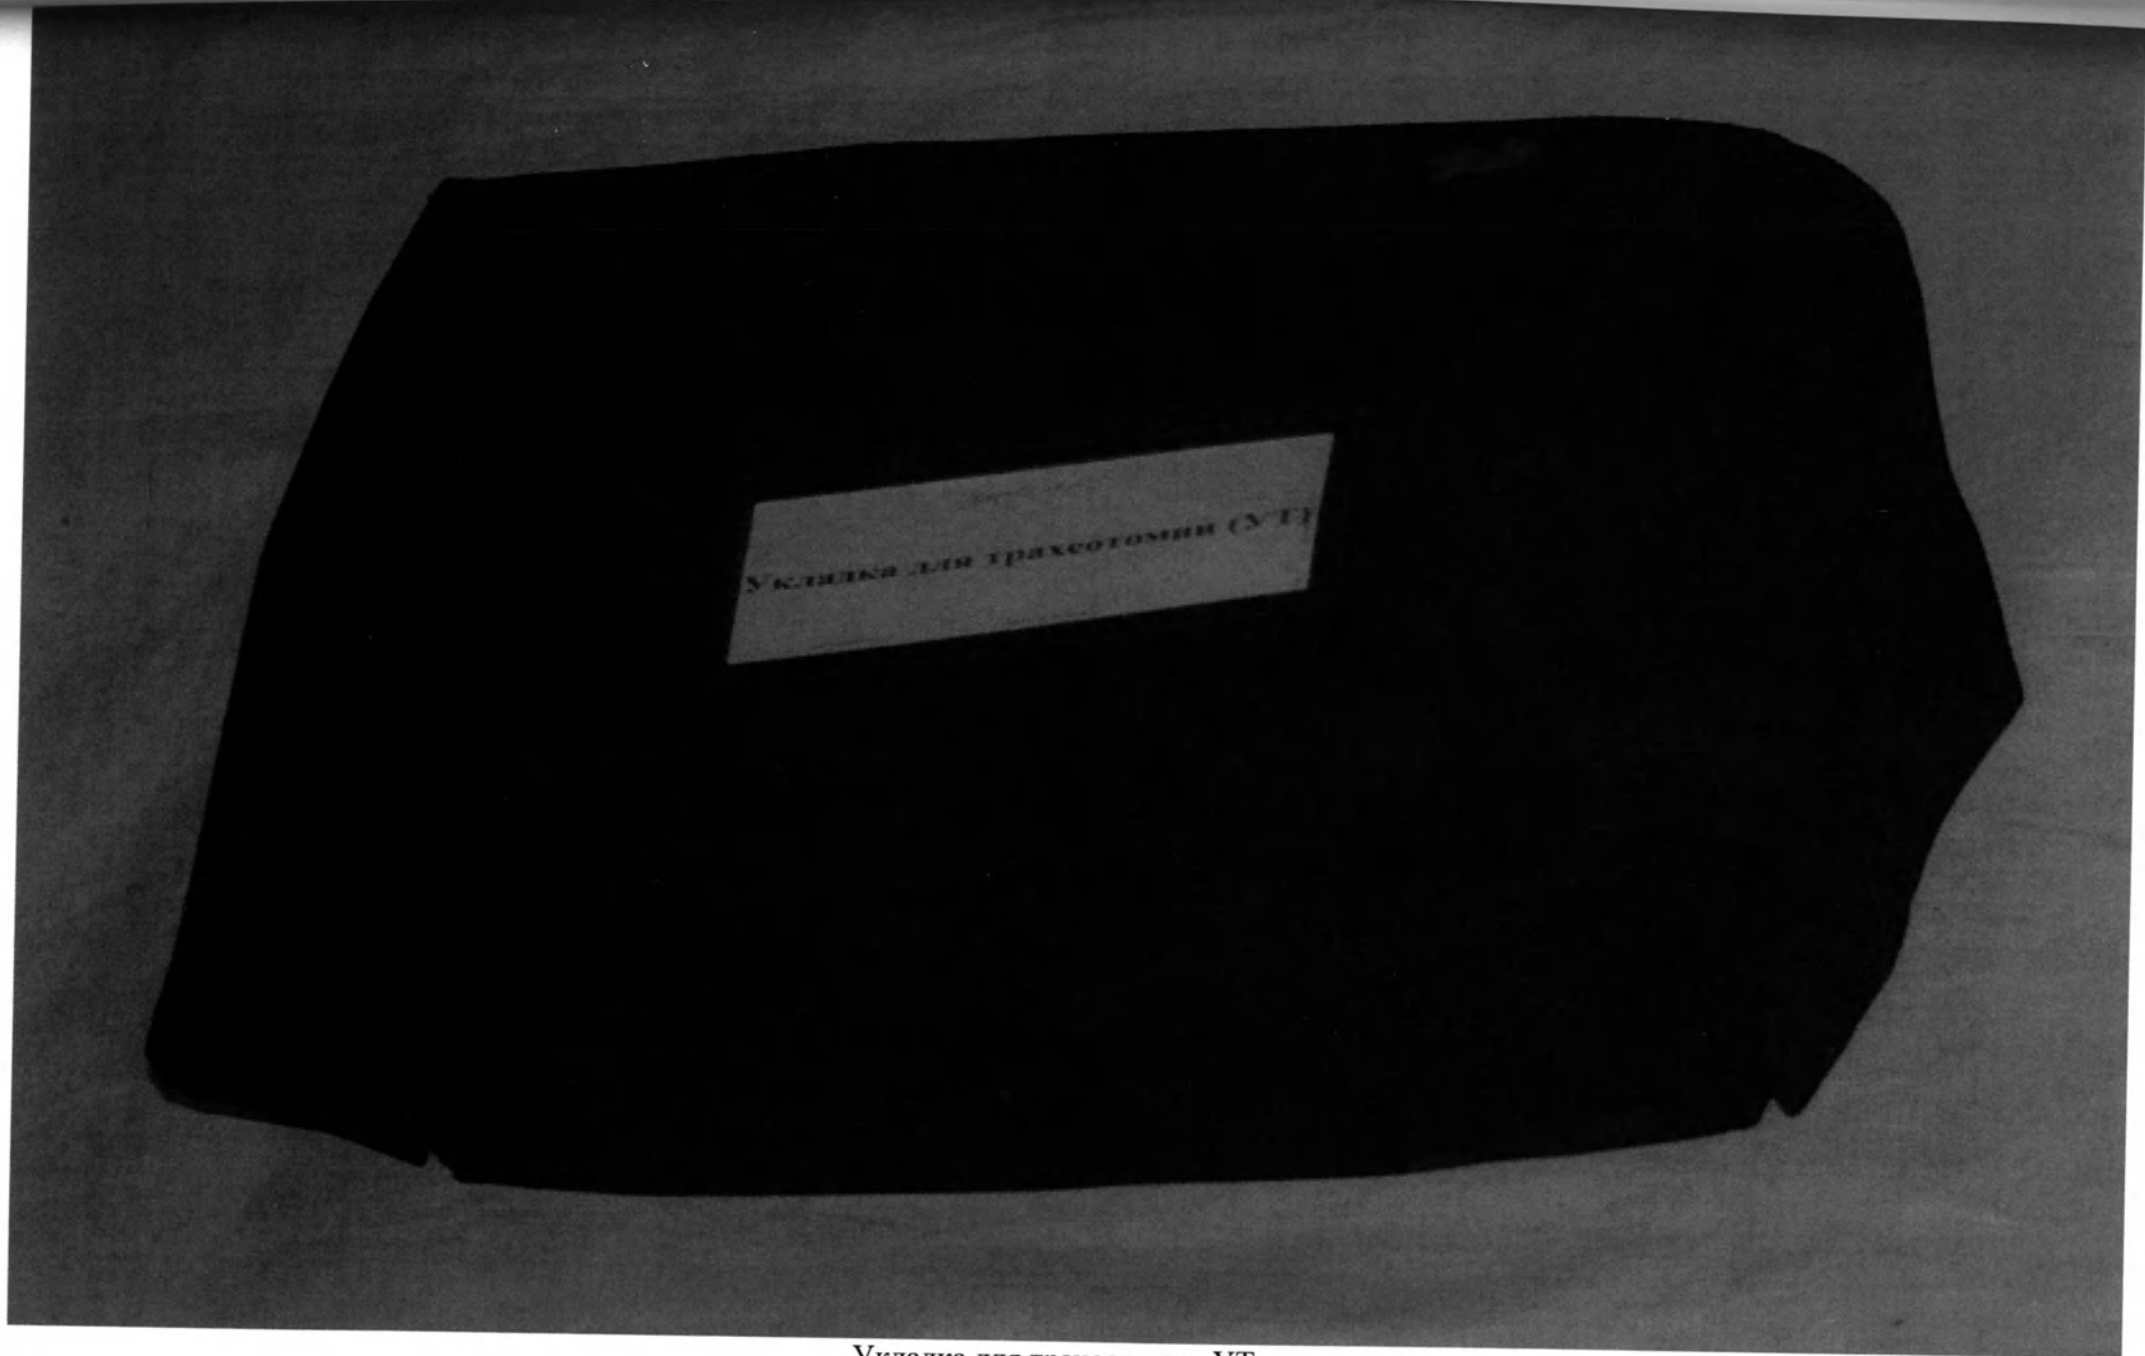

Укладка для трахеотомии УТ



Укладка общехирургическая № 2 УО №2

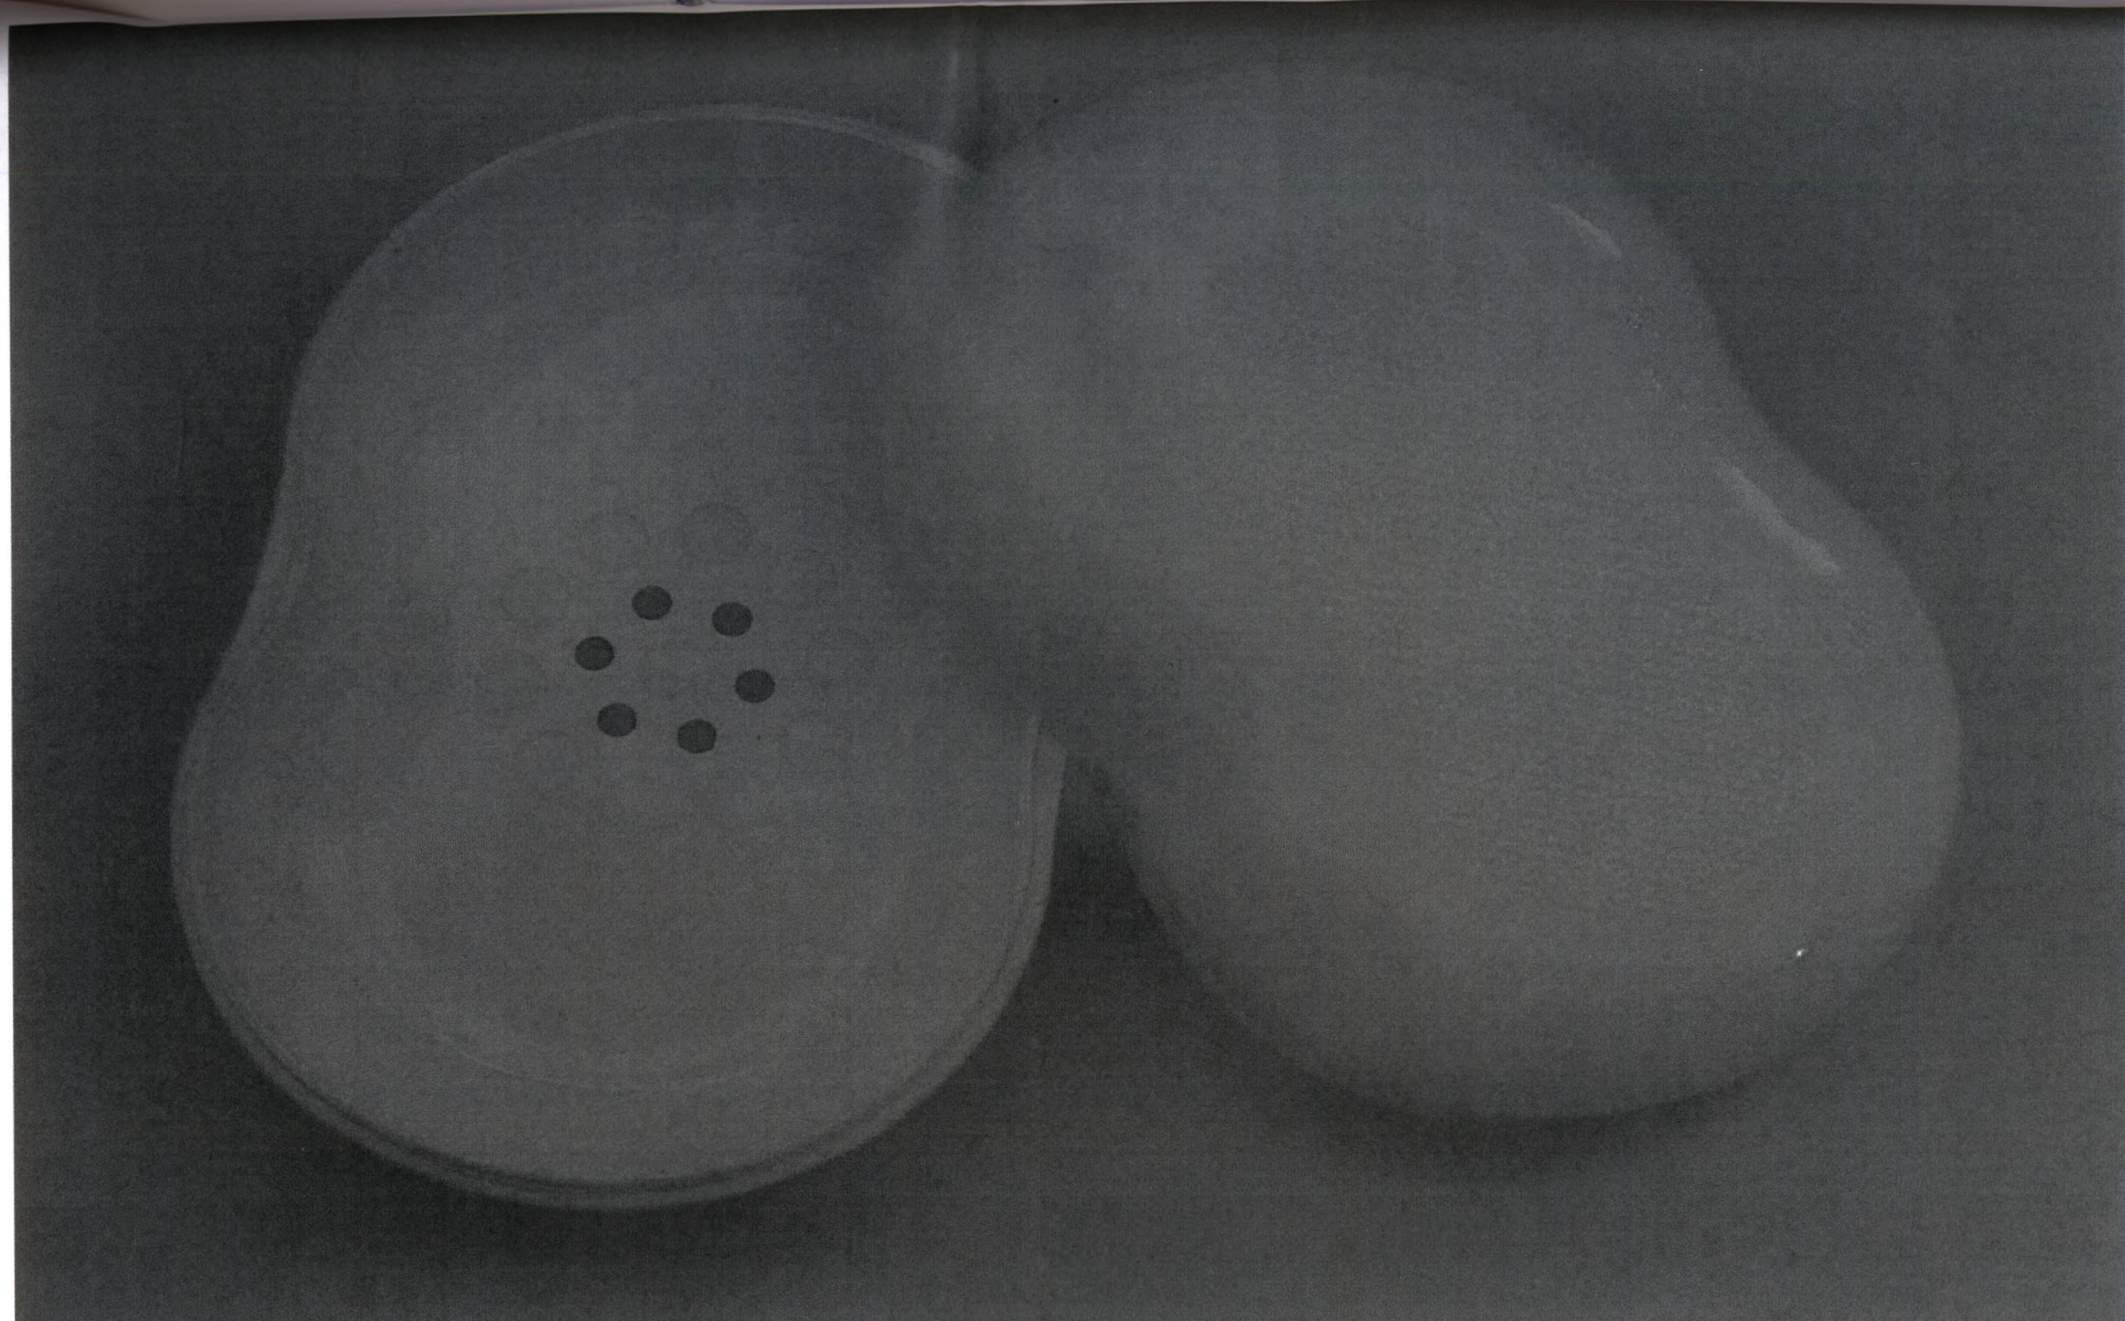


Прошито и пронумеровано

21 листов

Директор ООО «Спецмедтехника»

Миляев А.В.



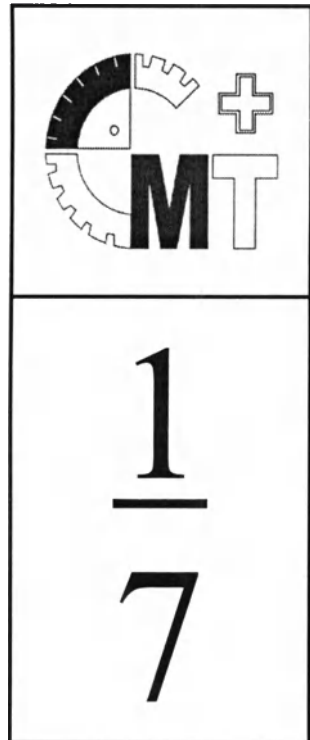

Комплект операционная большая КОБ

ТУ 9437-003-58379990-2013

РУ № ____ / ____ от ____

Зав. № _____

Дата изг. _____

Гарантийный срок эксплуатации комплекта - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150

Периодичность переконсервации комплектов 3 года.

Производитель:


ООО «Спецмедтехника»

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная д. 20

Тел. (812) 329-54-80, (812) 329-38-08

83x63x87 см.

Масса НЕТТО 70 кг.



2
7

Комплект операционная большая КОБ

ТУ 9437-003-58379990-2013

РУ № ____ / ____ от ____

Зав. № _____

Дата изг. _____

Гарантийный срок эксплуатации комплекта - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150

Периодичность переконсервации комплектов 3 года.

Производитель:


ООО «Спецмедтехника»

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная д. 20

Тел. (812) 329-54-80, (812) 329-38-08

83x63x87 см.

Масса НЕТТО 70 кг.

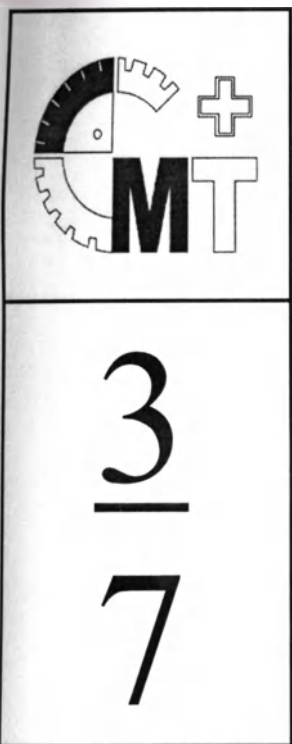

Комплект операционная большая КОБ

ТУ 9437-003-58379990-2013
РУ № ____ / ____ ОТ ____

Зав. № _____

Дата изг. _____

Гарантийный срок эксплуатации комплекта - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150

Периодичность переконсервации комплектов 3 года.

Производитель:

ООО «Спецмедтехника»
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная д. 20
Тел. (812) 329-54-80, (812) 329-38-08

63x43x87 см.
Масса НЕТТО 70 кг.

Комплект операционная большая КОБ

ТУ 9437-003-58379990-2013

РУ № ____ / ____ от ____

Зав. № _____

Дата изг. _____

Гарантийный срок эксплуатации комплекта - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150

Периодичность переконсервации комплектов 3 года.

Производитель:


ООО «Спецмедтехника»

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная д. 20

Тел. (812) 329-54-80, (812) 329-38-08

63x43x87 см.

Масса НЕТТО 70 кг.

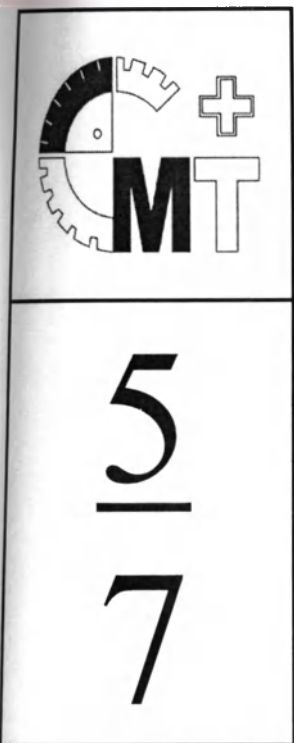

Комплект операционная большая КОБ

ТУ 9437-003-58379990-2013
РУ № ____ / ____ ОТ ____

Зав. № _____

Дата изг. _____

Гарантийный срок эксплуатации комплекта - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150

Периодичность переконсервации комплектов 3 года.

Производитель:

ООО «Спецмедтехника»
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная д. 20
Тел. (812) 329-54-80, (812) 329-38-08

63x43x87 см.
Масса НЕТТО 70 кг.

Комплект операционная большая КОБ

ТУ 9437-003-58379990-2013
РУ № ____ / ____ ОТ ____

Зав. № _____

Дата изг. _____

Гарантийный срок эксплуатации комплекта - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.


Условия хранения 1 по ГОСТ 15150

Периодичность переконсервации комплектов 3 года.

Производитель:

ООО «Спецмедтехника»
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная д. 20
Тел. (812) 329-54-80, (812) 329-38-08

63x43x87 см.
Масса НЕТТО 70 кг.

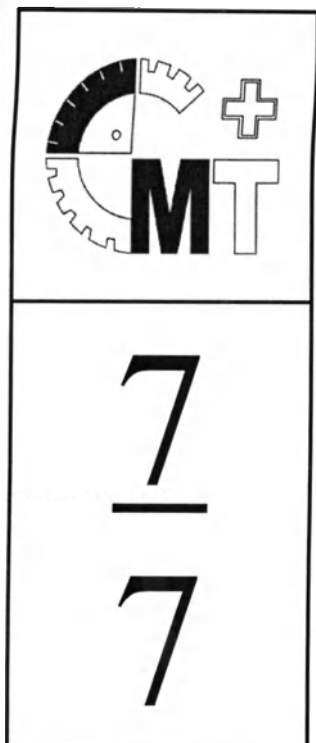

Комплект операционная большая КОБ

ТУ 9437-003-58379990-2013

РУ № ____ / ____ ОТ ____

Зав. № _____

Дата изг. _____

Гарантийный срок эксплуатации комплекта - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150

Периодичность переконсервации комплектов 3 года.

Производитель:

ООО «Спецмедтехника»

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная д. 20

Тел. (812) 329-54-80, (812) 329-38-08

63x43x87 см.

Масса НЕТТО 70 кг.

Прошнуровано и скреплено
печатью _____ лист (ов)
Должность _____
Подпись _____

