






Комплект электродов для генератора сигналов локации *РЗН 2013/1244 от 30.09.2013

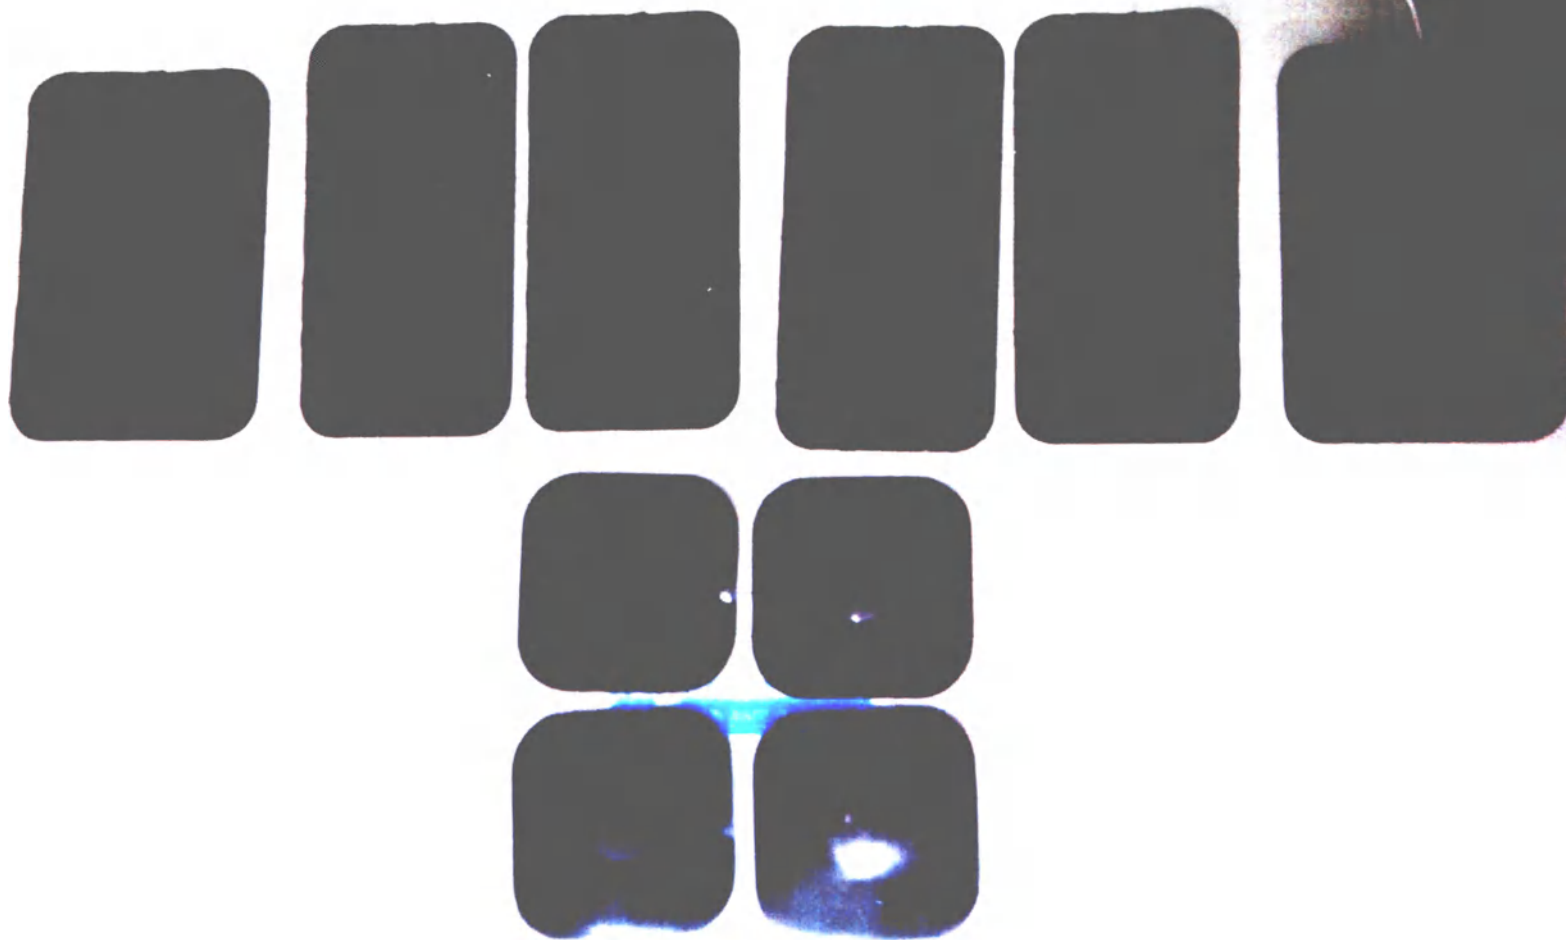

HP LaserJet P1102

Биоток Unity 6.1

Данное программное обеспечение предназначено для получения, обработки, сохранения и последующего просмотра данных, а также передачи управляющих команд для «Комплекса для электрофизиологических исследований и электроанатомического картирования многоканального «Биоток» ТУ 9441-007-4037130-2016». Также может использоваться отдельно для просмотра ранее записанных данных.

Применим: Электрофизиологическое исследование; Электроанатомическое картирование

Минимальные требования к рабочей станции:


- Четырёхядерный процессор, работающий на тактовой частоте 2,8 ГГц;
- Жесткий диск со свободным объёмом памяти не менее 80 Гб;
- ОЗУ не менее 2 Гб;
- Монитор с разрешением не менее 1920x1080;
- Операционная система Windows 7, 8, 8.1, 10;
- Клавиатура;
- Мышь;
- Сетевая карта Gigabit Ethernet;
- DirectX 9c;
- Программа для чтения PDF файлов.

В составе пакета DVD диск, содержащий программное обеспечение Биоток Unity в виде архивного файла типа zip (описание установки приведено в руководстве по эксплуатации) и руководство по эксплуатации в виде файла типа pdf.

Поставщик: ООО «Л.М.З. «Биоток», Адрес: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 118





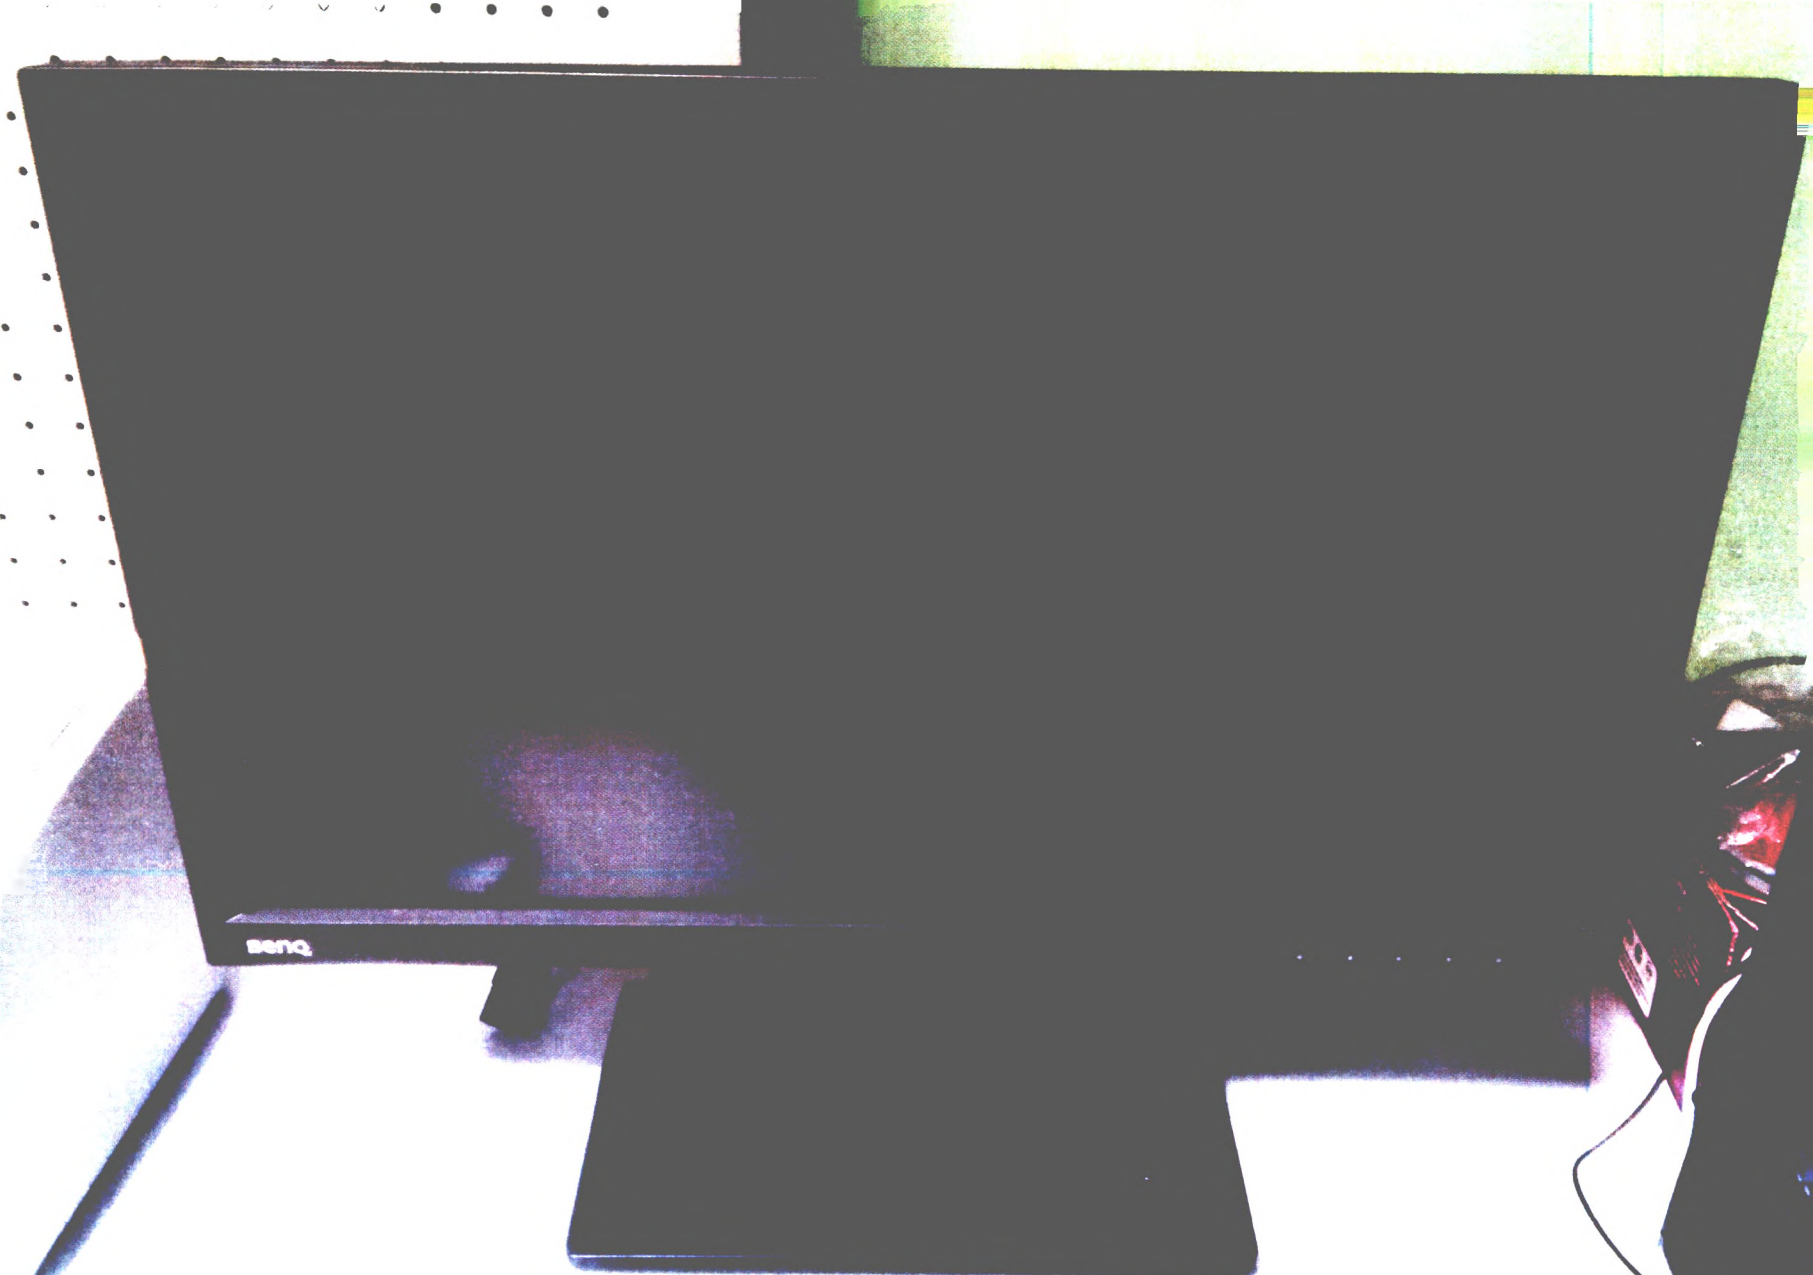

benq



Кабель сетевой для системного блока Покупное стандартное изделие
Кабель сетевой для принтера Покупное стандартное изделие
Кабель сетевой для монитора Покупное стандартное изделие



Рабочая станция в составе:

Системный блок ПК Процессор Intel Core i5 с тактовой частотой
не менее 2,8ГГц, жесткий диск не менее 80 ГБ, ОЗУ не менее 4ГБ.

Монитор BenQ, разрешение не менее 1920x1080 точек.

Принтер лазерный HP LaserJet 1022


Клавиатура Gigabyte

Манипулятор «Мышь» ThermalTake

Кабель сетевой для системного блока Покупное стандартное изделие


Кабель сетевой для принтера Покупное стандартное изделие

Кз  ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU стандартное изделие

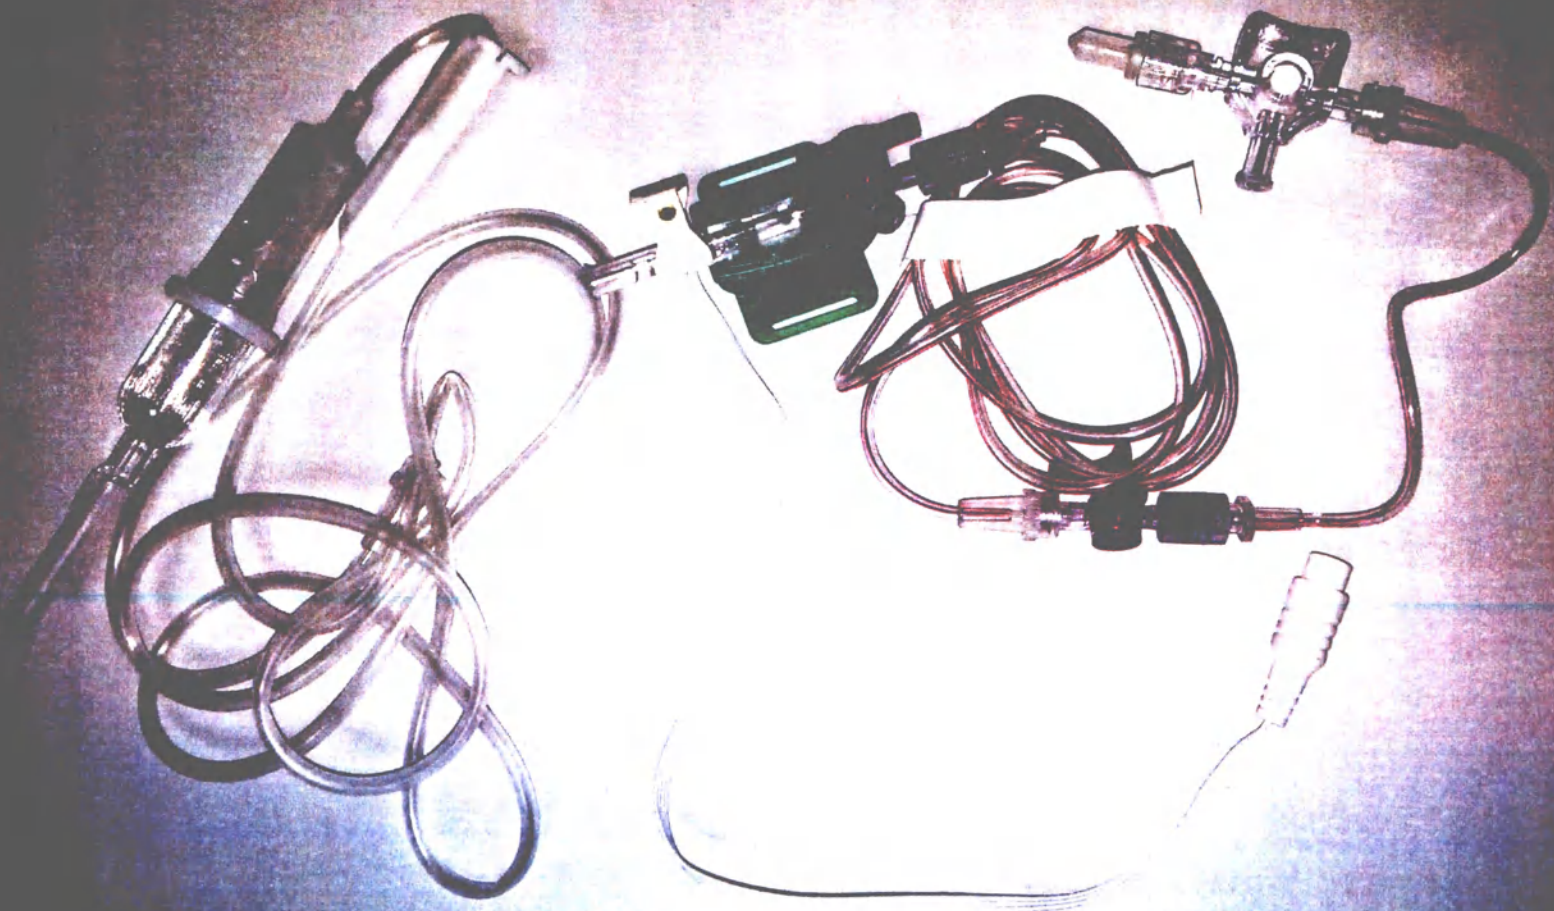



сертификат УТР 5м Покупное стандартное

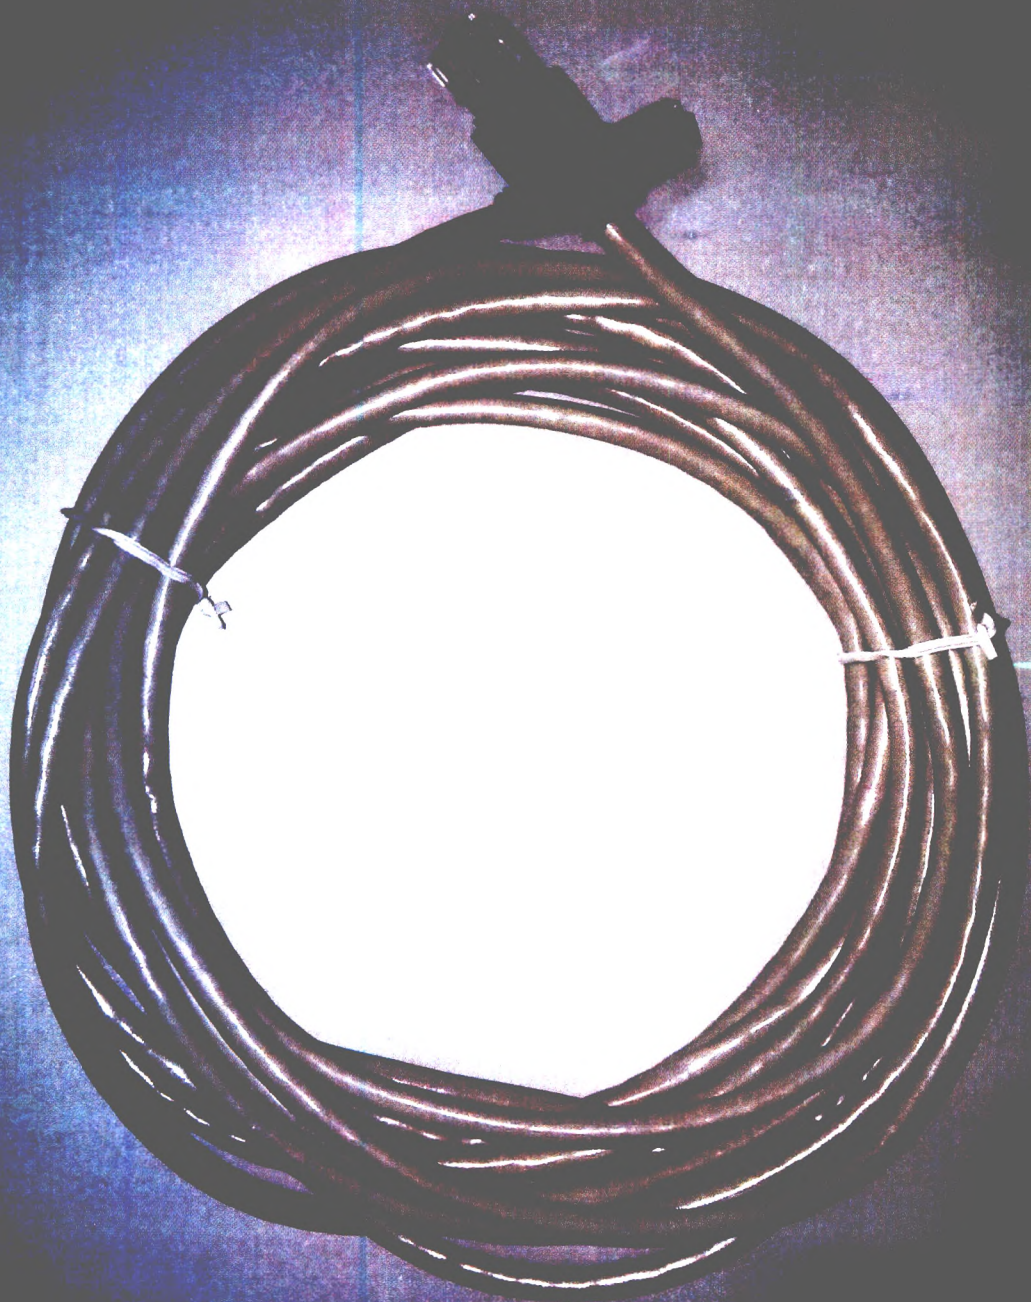

Кабель питания деструктора радиочастотного БСД





ART

CVP





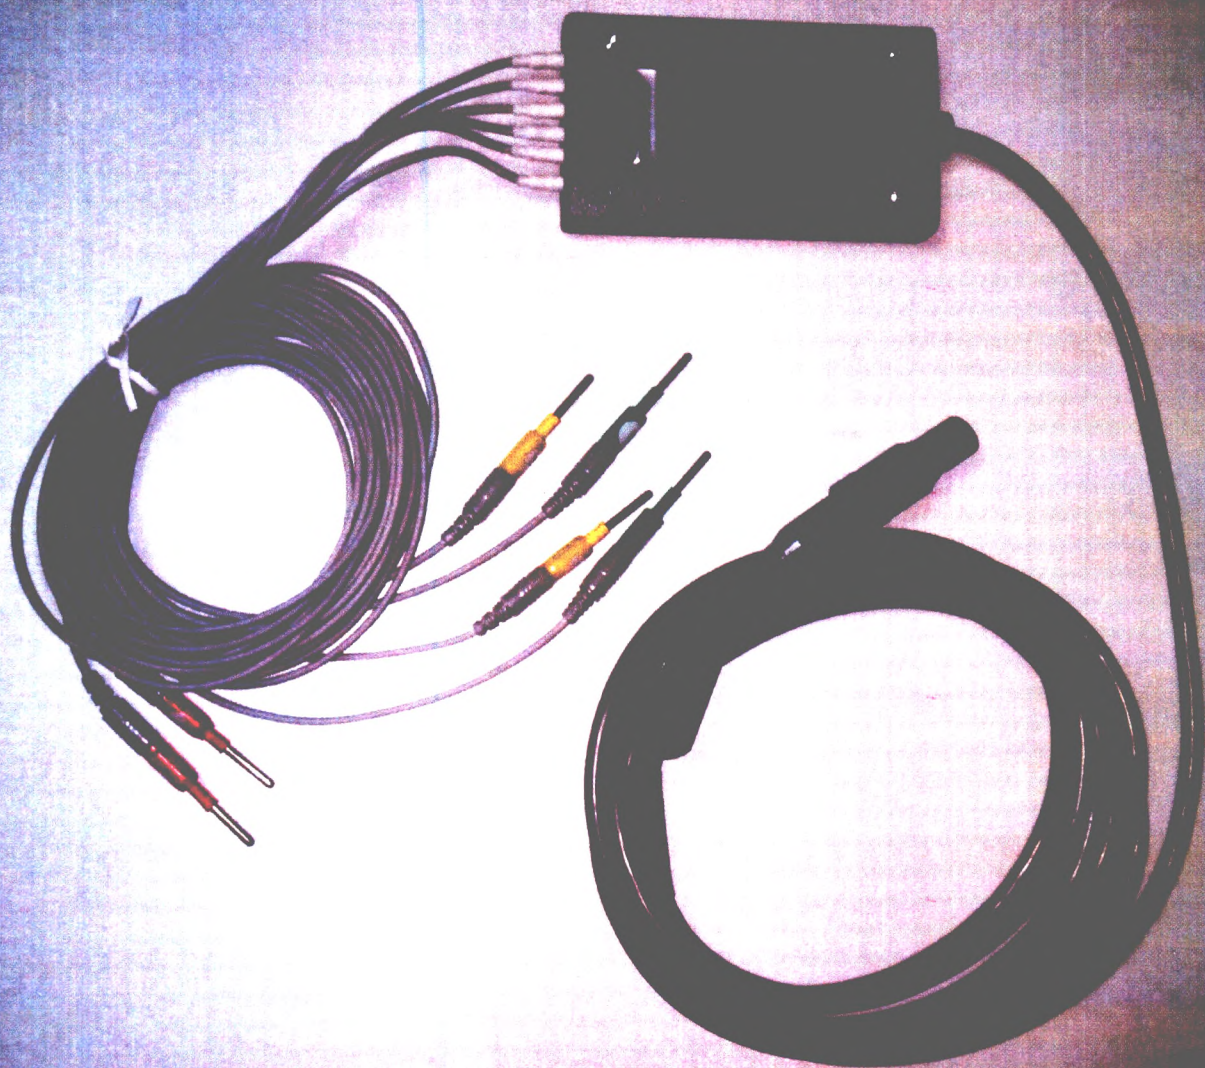

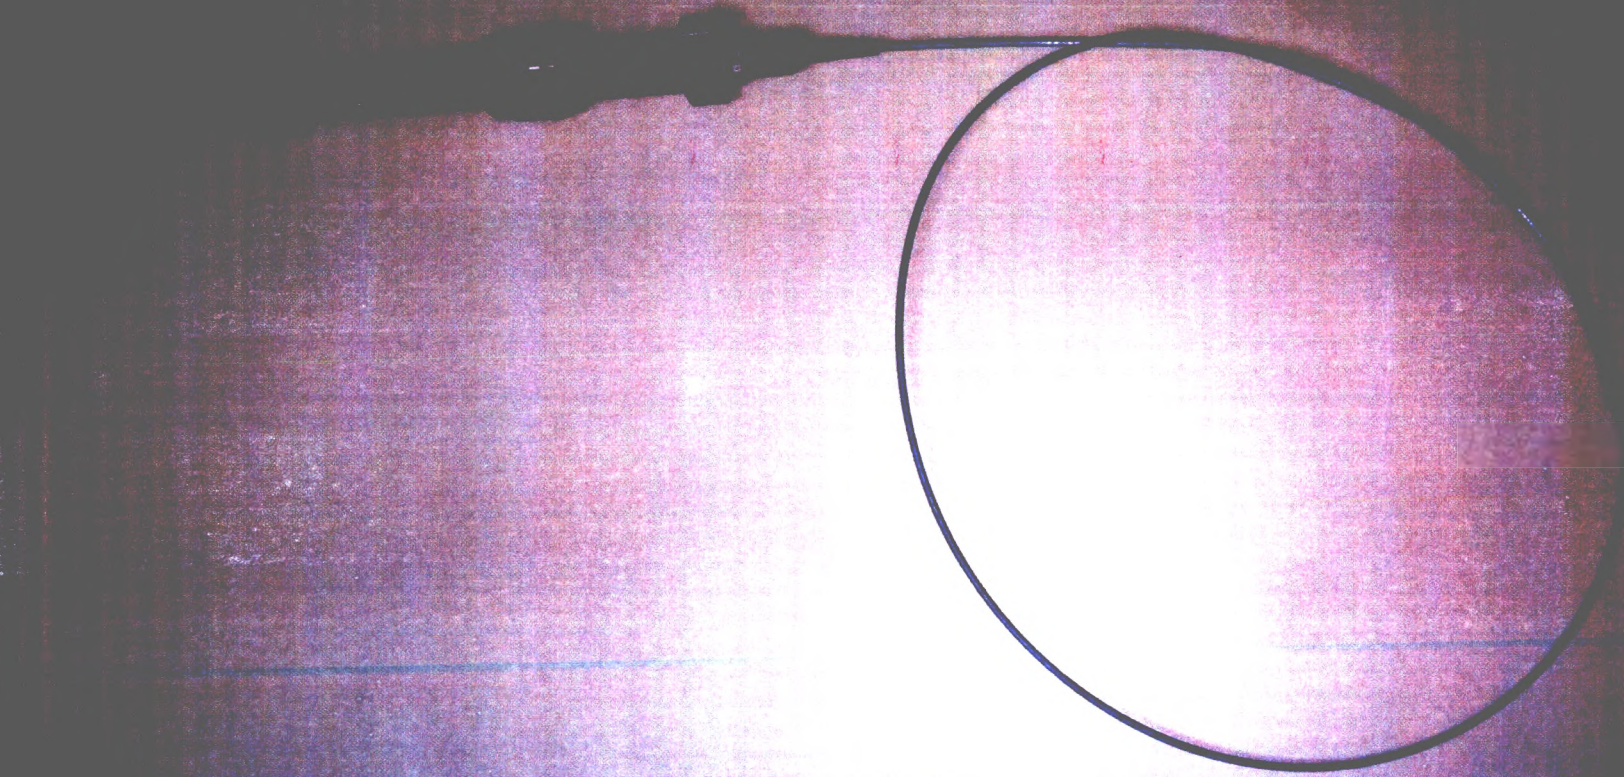

РУ N° ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010

2

001 08500201ET0A

Severamente, si
a il 10 il più
Scudo relativo
Dato: 10.10.10
Tutti i membri

Uomo per
- i propri
non agiti
della 100
a l'unico

Dopo aver
sulla ditta
nel caso
prodotti
non hanno
la risposta
quindi scattare lo strip
a trascinare sul passacavo del cavo
GRIGLIOTTINI & A PINZETTI
le al telefono rimando la ditta

1.5
The first letter after the middle letter
on while the second letter
consequently while the
W - 5 years - 10
Molto - 8



Order No.:
MES50A-1R1B

MEDICAL POWER ADAPTOR

MODEL NO.: MES50A-1


INPUT : 100-240VAC, 50-60Hz, 1.5 D 8A

OUTPUT : 5.0V --- 7.50A 37.5W MAX



PIN1: 5.0V

PIN15: 0V



Indoor use only

CAUTION
DO NOT OPEN
RISK OF ELECTRIC SHOCK
ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR


MADE IN TAIWAN


EJ



Сетевой адаптер питания основного блока

полностью соответствует ГОСТ Р МЭК 60950-1

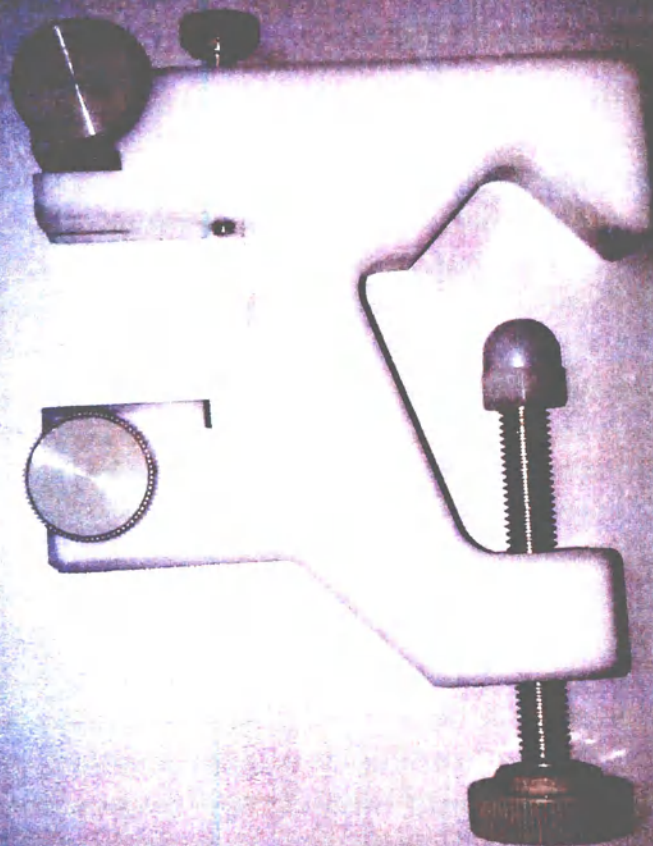

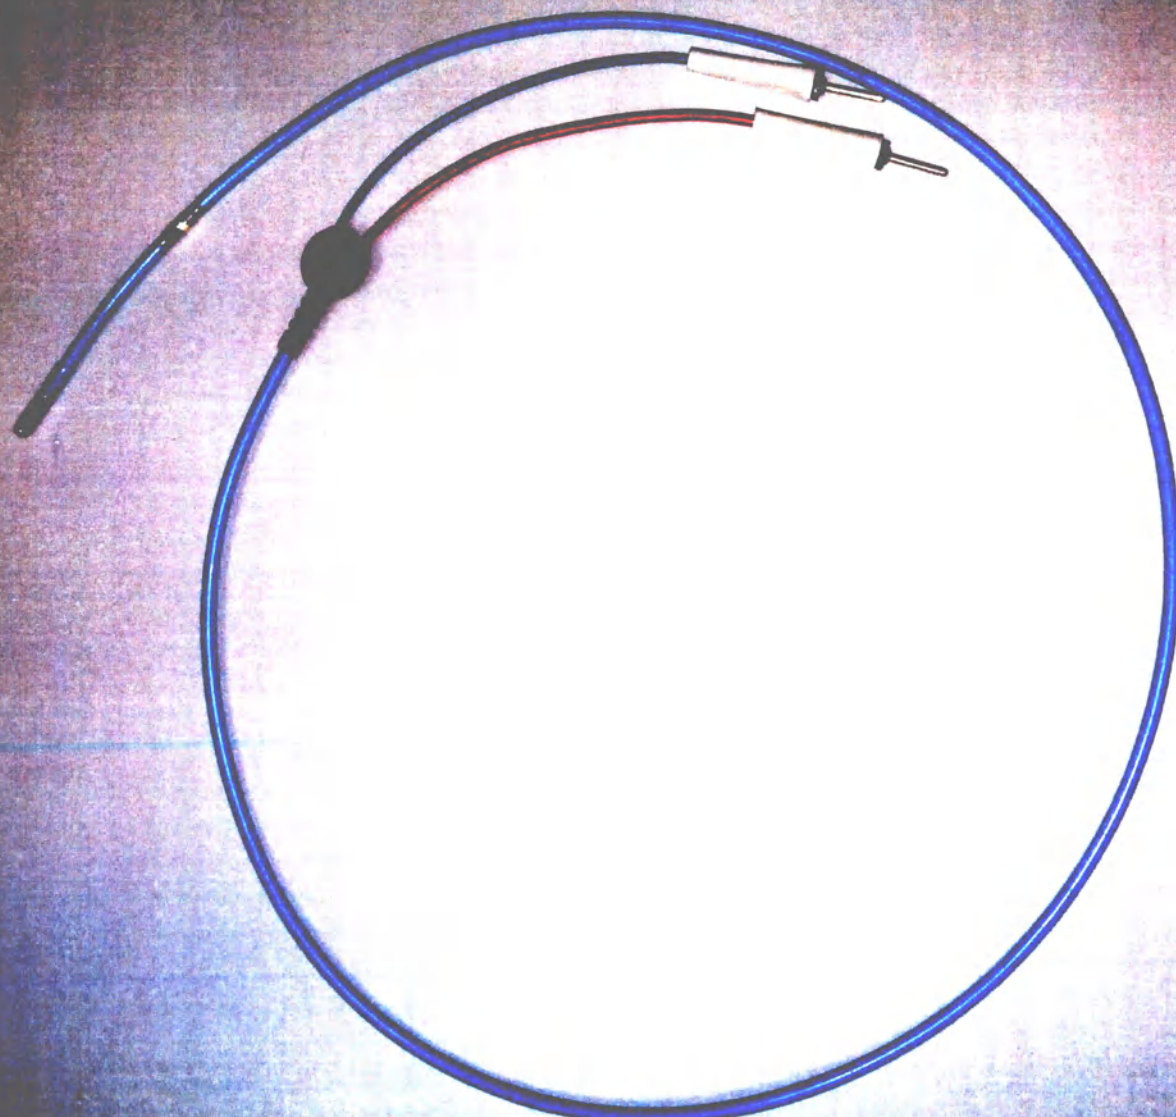

для проведения чреспищеводной электрической стимуляции сердца
000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
01-ДМС-ПТ РЗН 2015/2784 от 25.06.2015

000 "ДМС "Докторская Фармацевтика"

