




«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «НПК Негатоскоп. ру»
М.А. Чупров
«*Чупров*» 2017 г

Фотографические изображения медицинского изделия:


«Негатоскоп медицинский по ТУ 9452-001-11349579-2016»
в вариантах исполнения: негатоскоп однокадровый, негатоскоп двухкадровый,
негатоскоп трехкадровый, негатоскоп четырехкадровый, с принадлежностями

2017


«Негатоскоп медицинский по ТУ 9452-001-11349579-2016» в варианте исполнения: негатоскоп однокадровый, с принадлежностями. Вид изделия (фронтально)

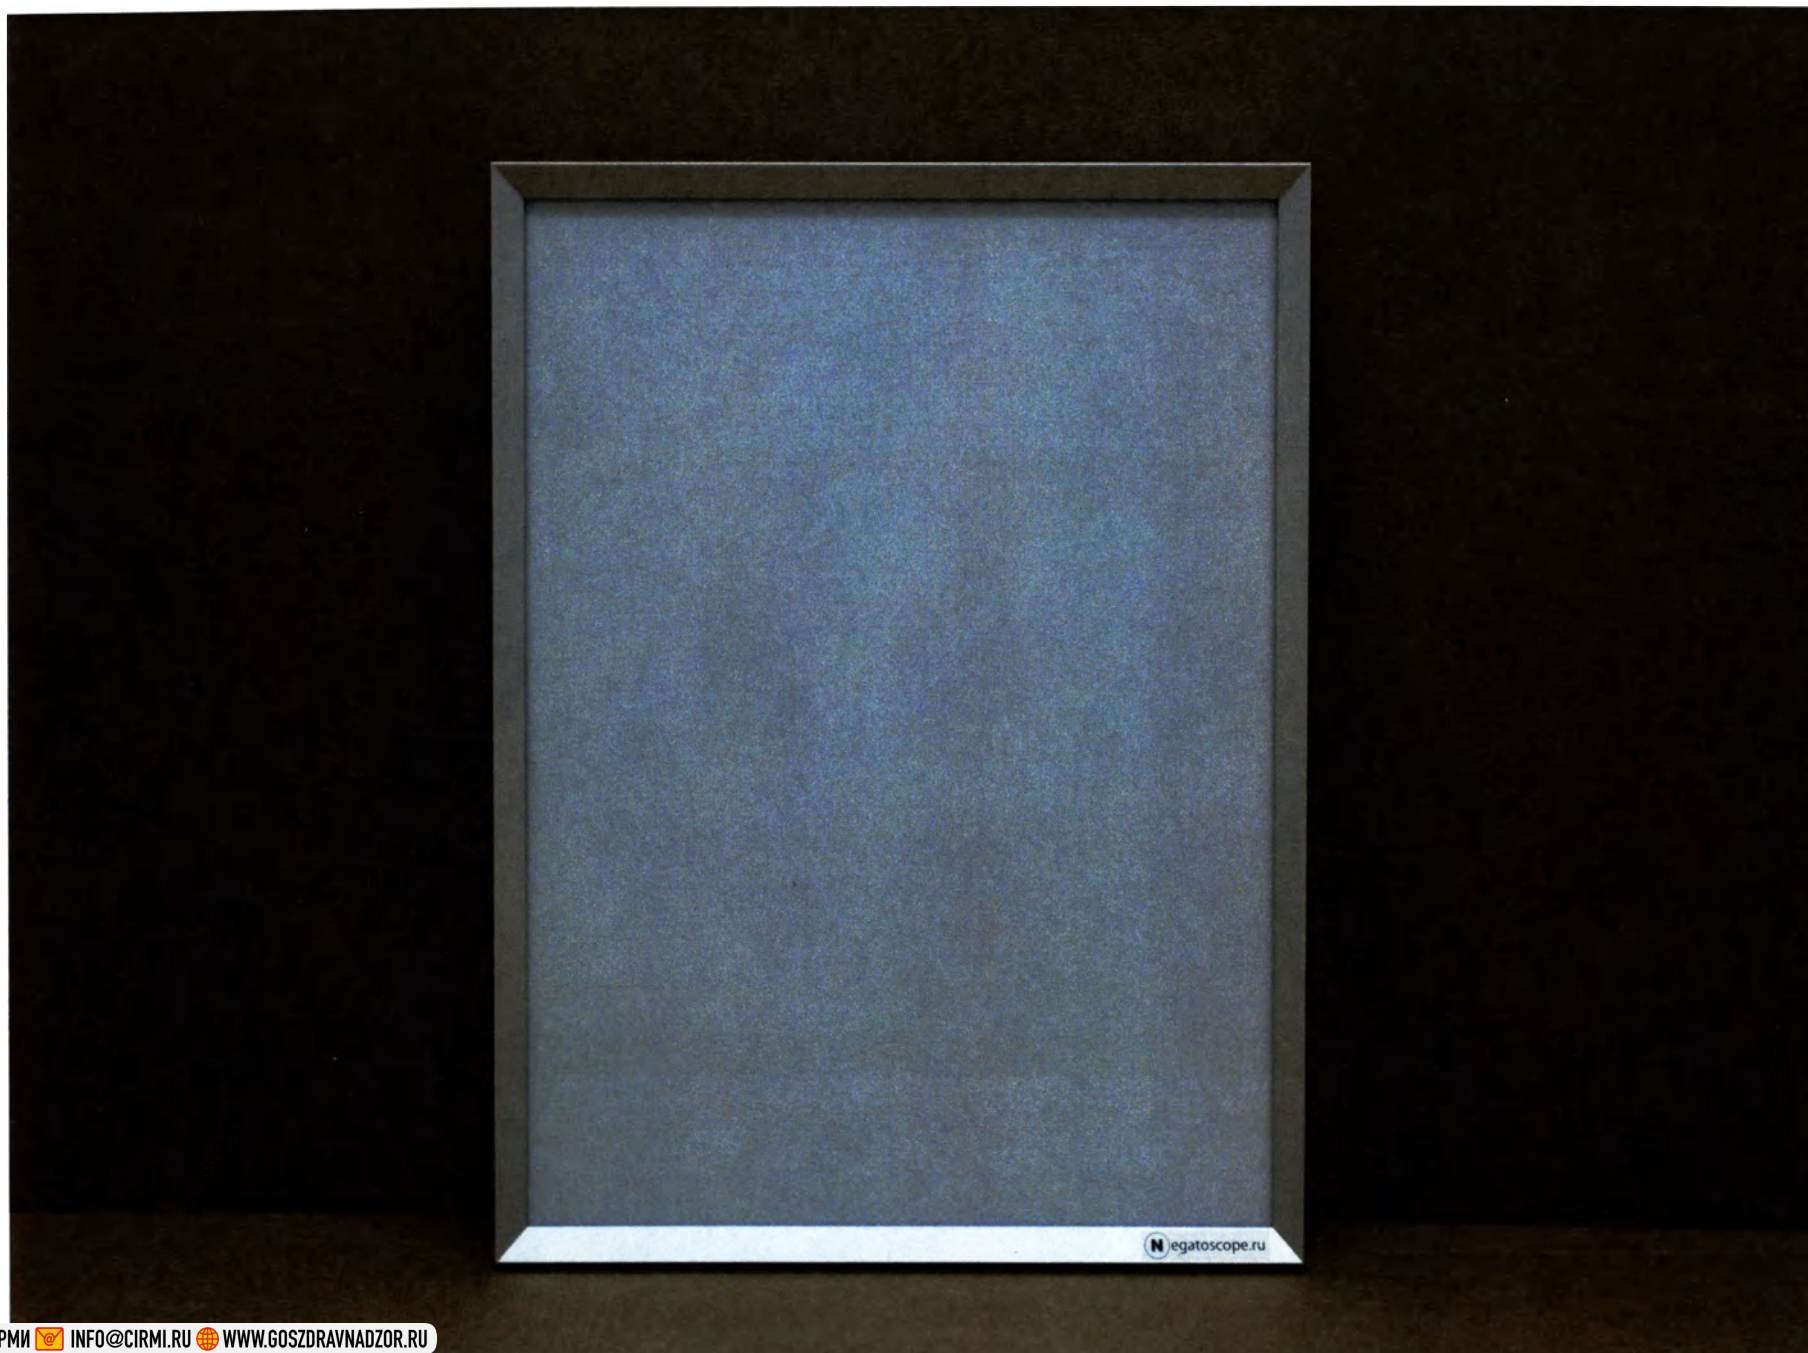


«Негатоскоп медицинский по ТУ 9452-001-11349579-2016» в варианте исполнения: негатоскоп однокадровый, с принадлежностями. Вид изделия (задняя часть, шильда).

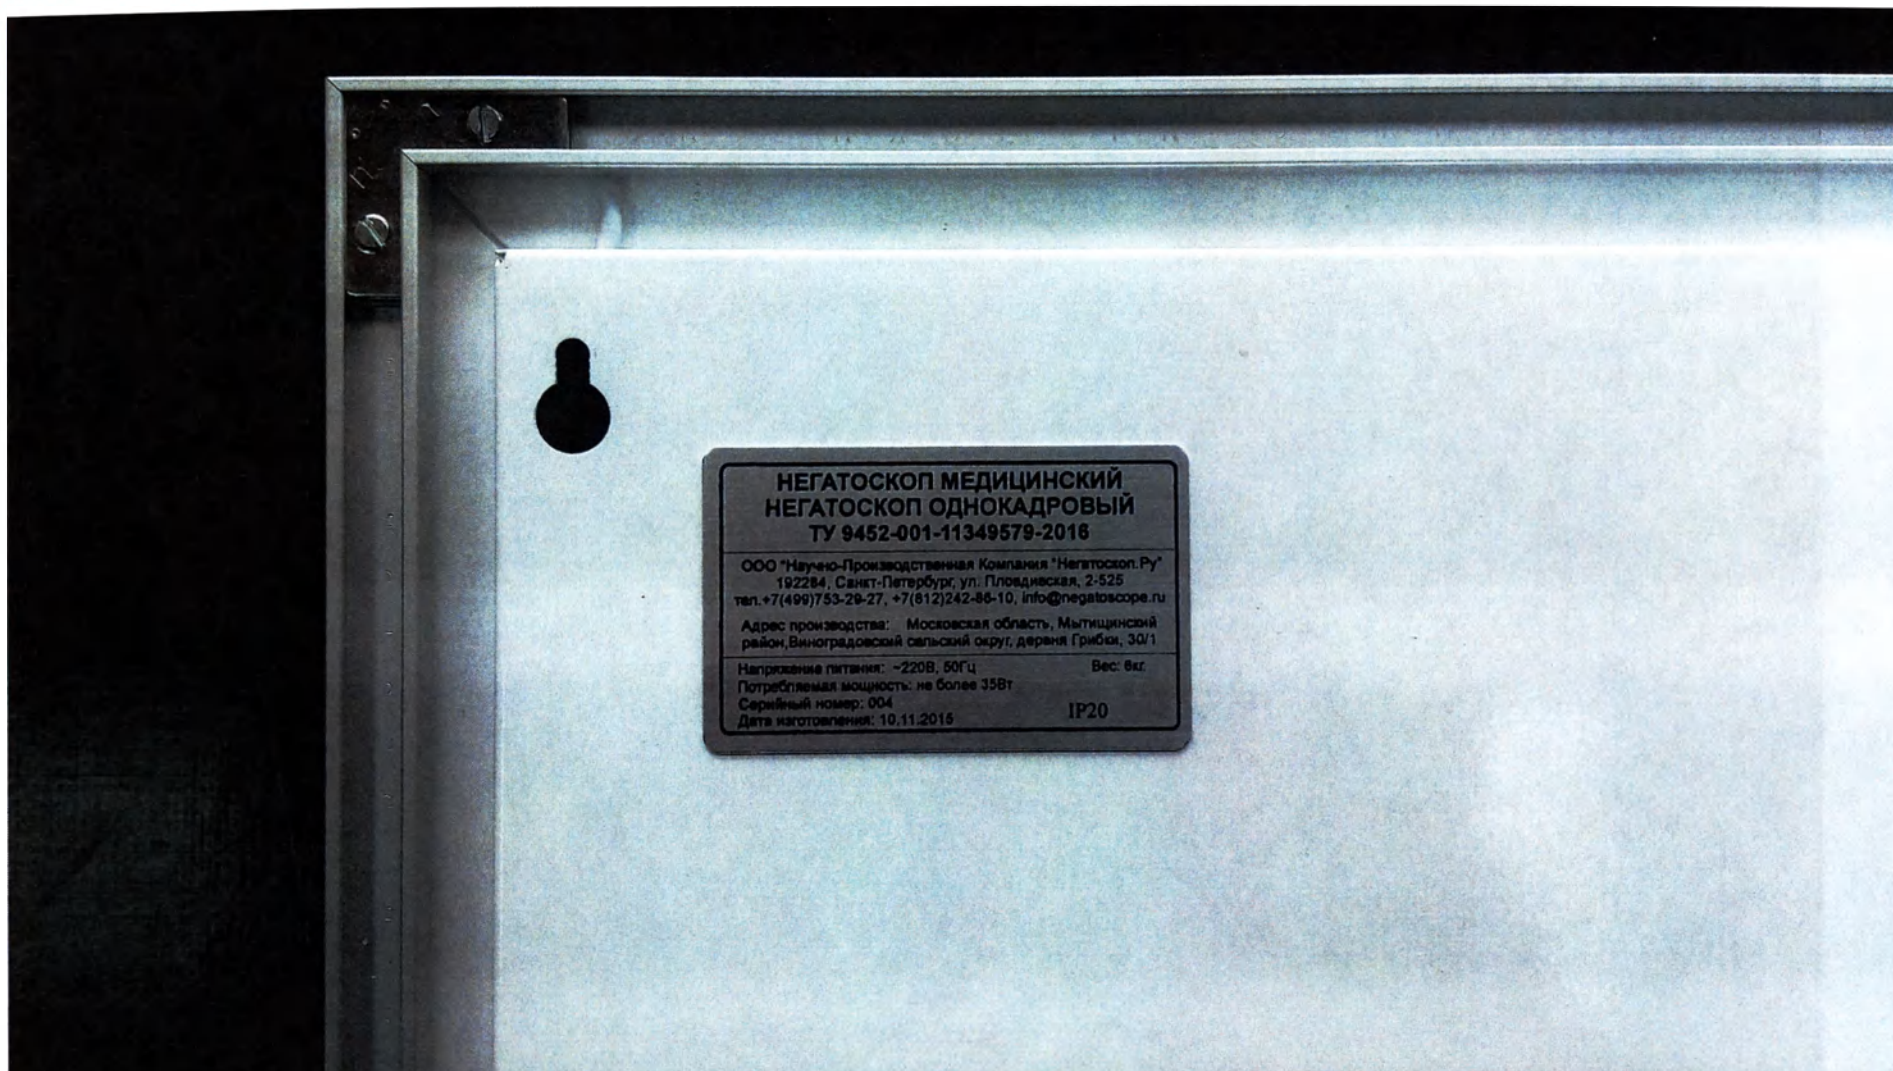


«Негатоскоп медицинский по ТУ 9452-001-11349579-2016» в варианте исполнения: негатоскоп однокадровый, с принадлежностями. Вид изделия (задняя часть).

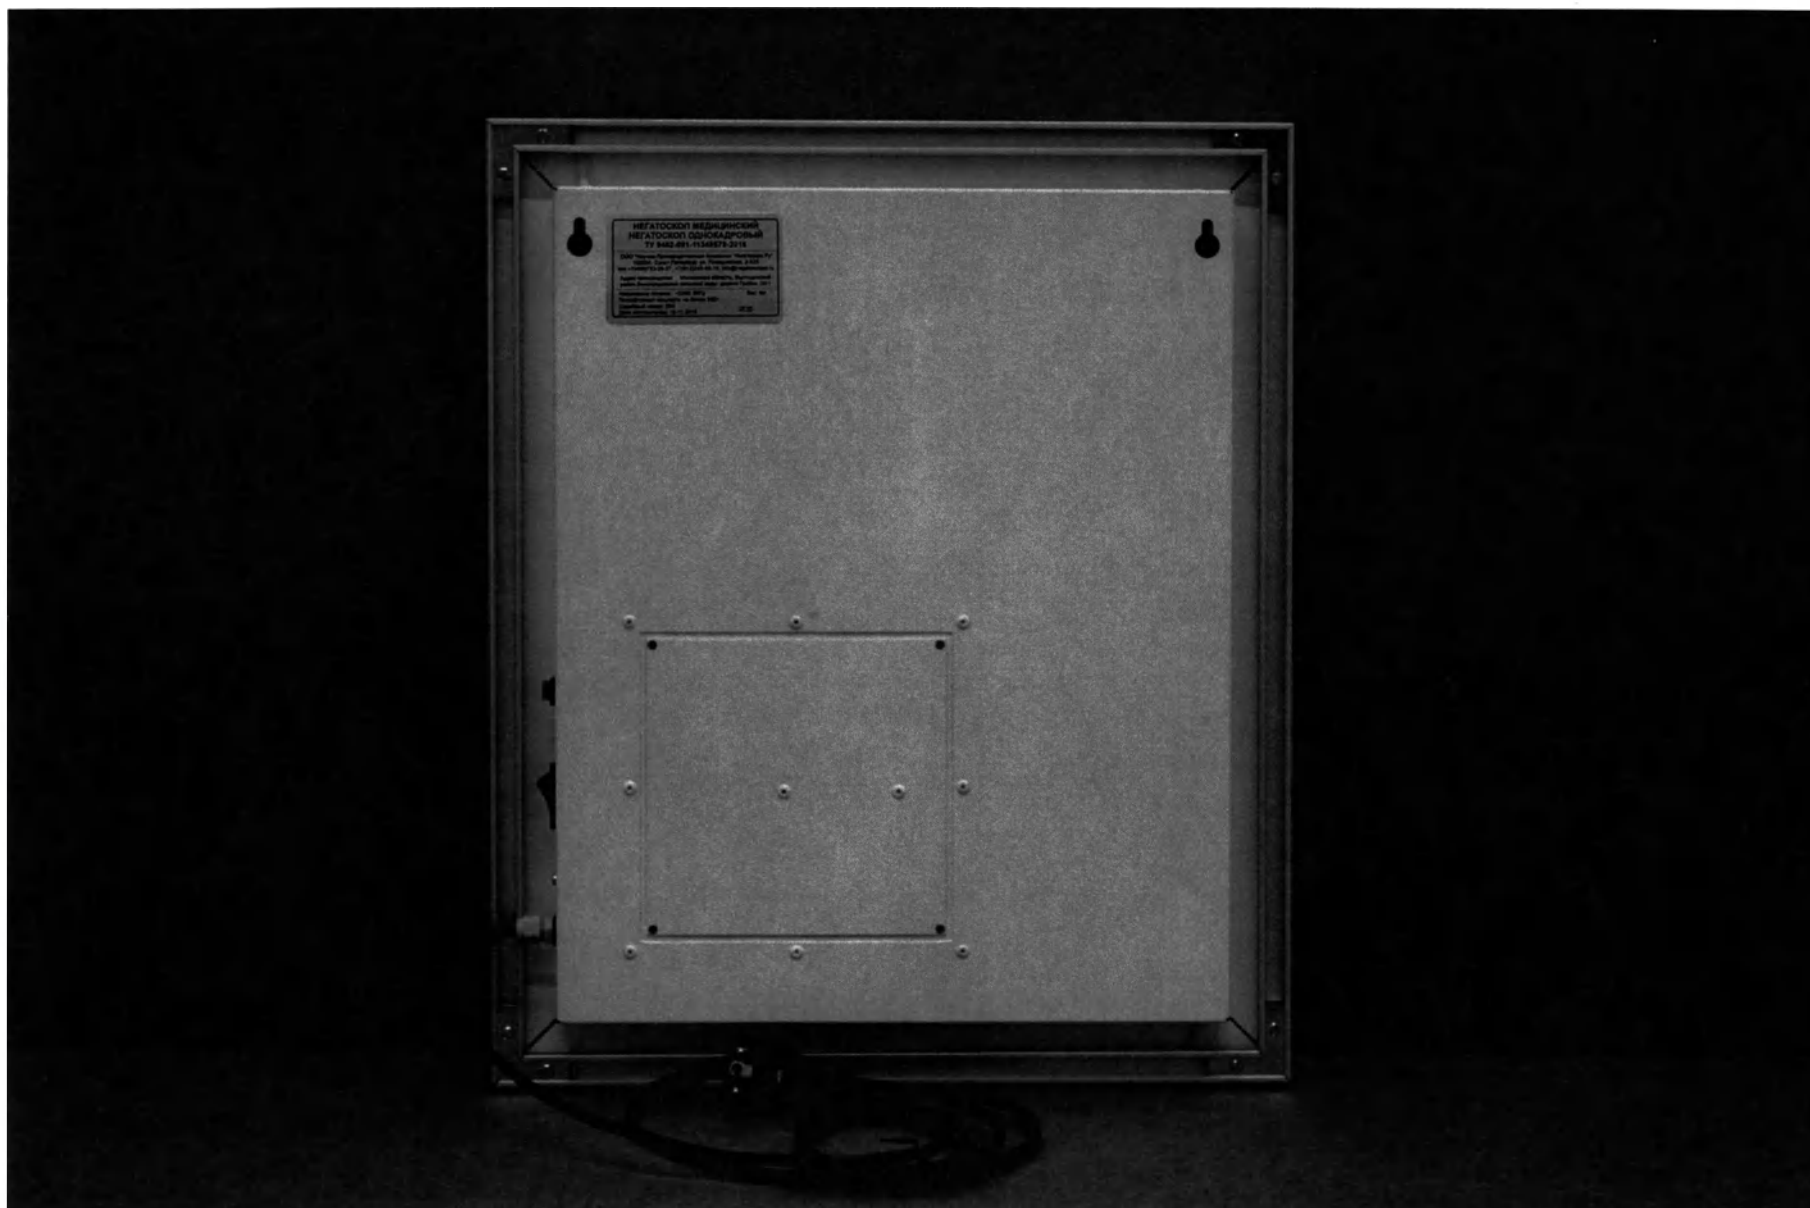


«Негатоскоп медицинский по ТУ 9452-001-11349579-2016» в варианте исполнения: негатоскоп однокадровый, с принадлежностями. Вид изделия (сбоку, кнопочное управление).

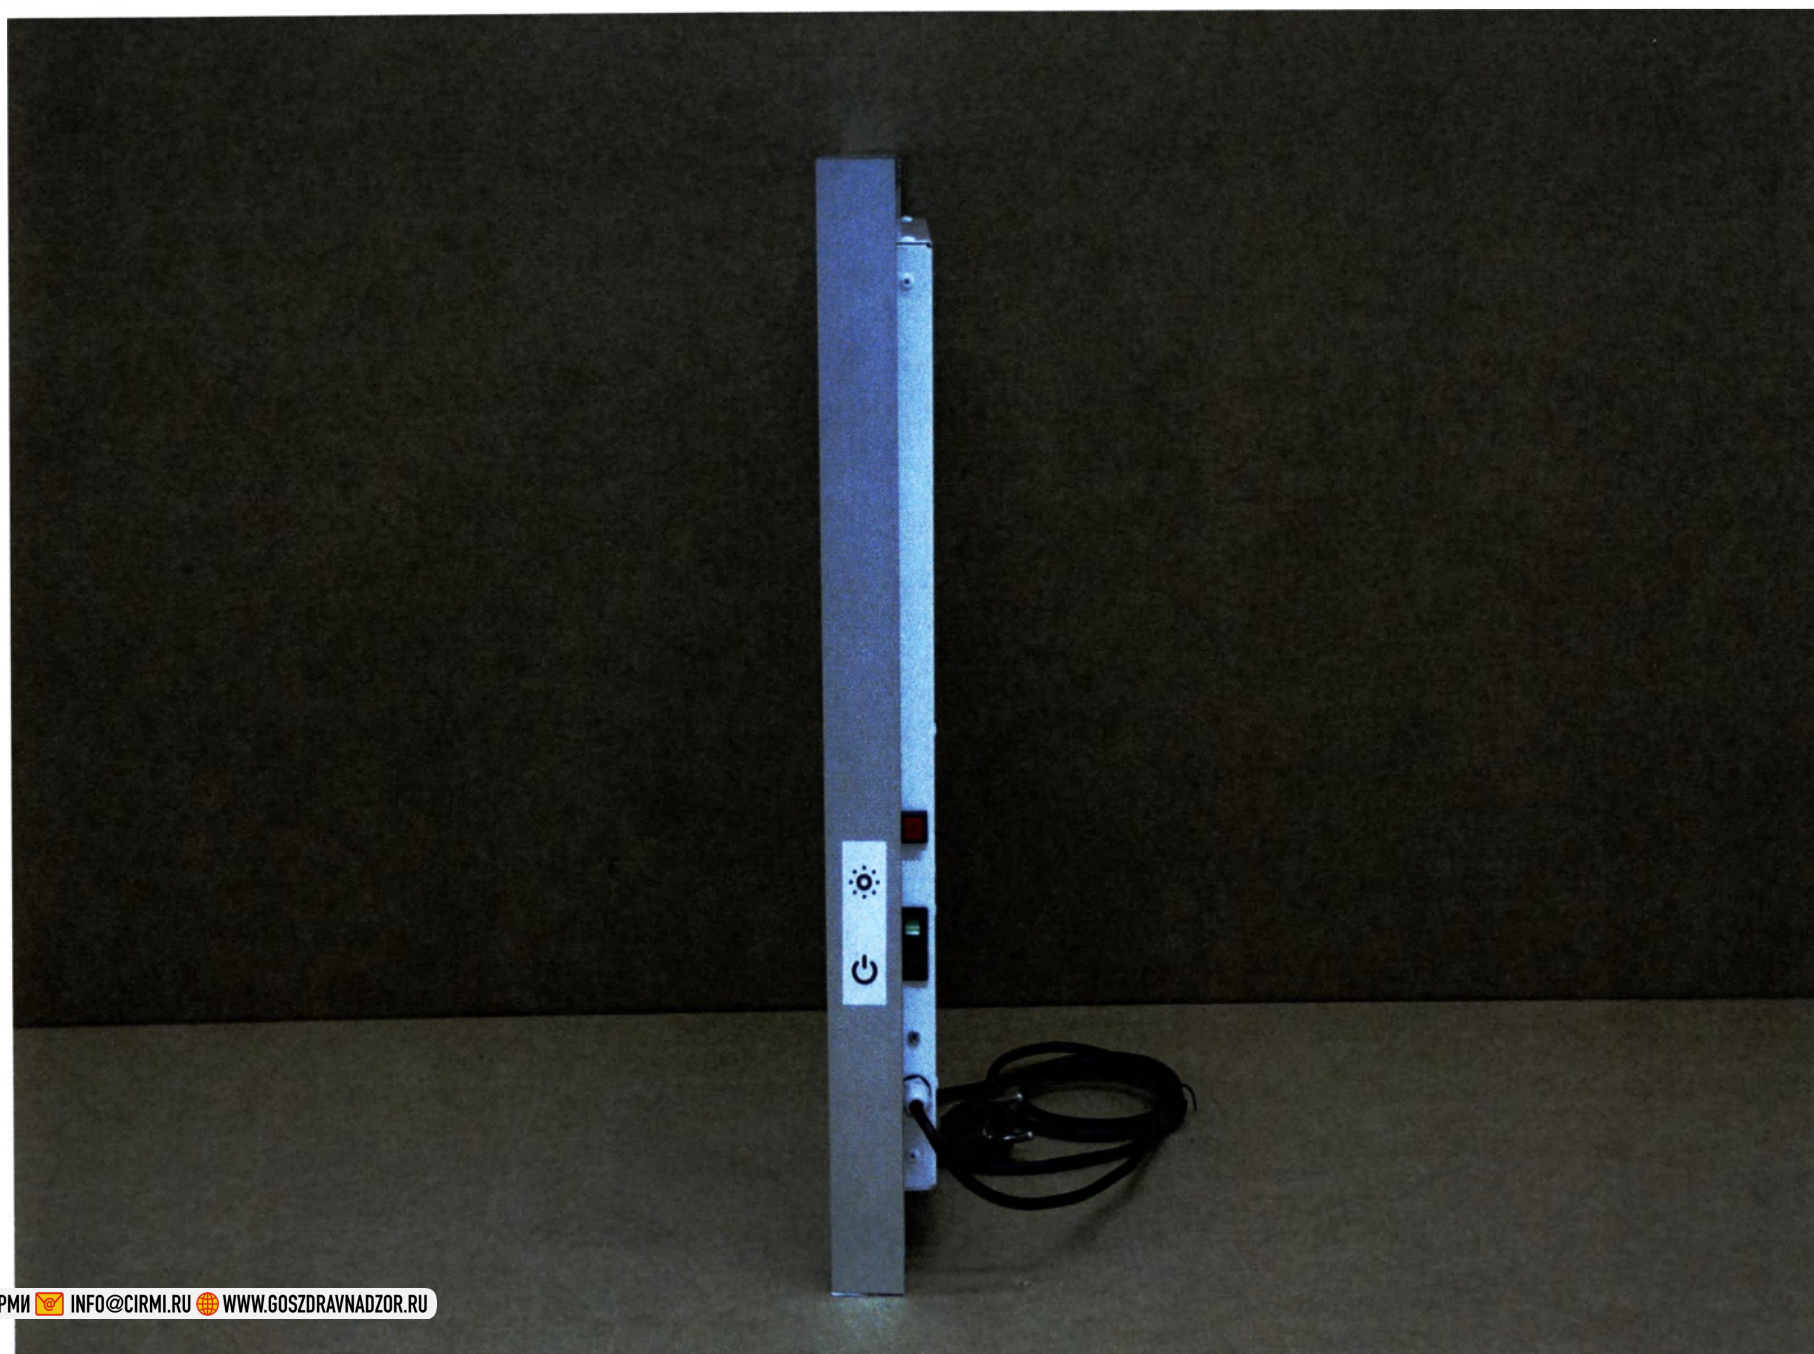


«Негатоскоп медицинский по ТУ 9452-001-11349579-2016» в варианте исполнения: негатоскоп двухкадровый, с принадлежностями. Вид изделия (фронтально).

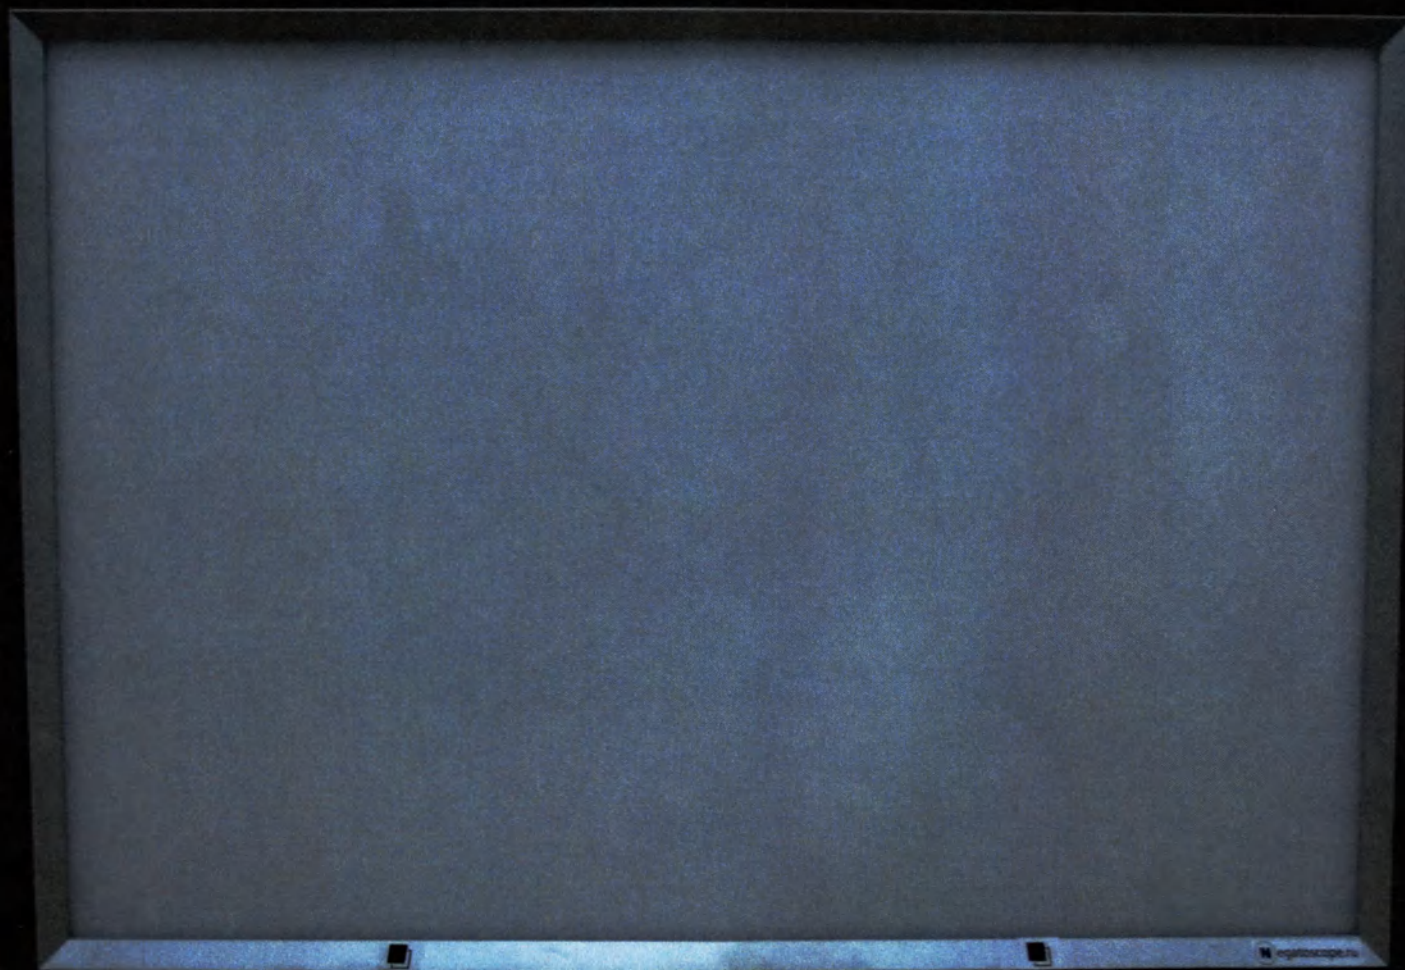

«Негатоскоп медицинский по ТУ 9452-001-11349579-2016» в варианте исполнения: негатоскоп двухкадровый, с принадлежностями. Вид изделия (задняя часть, шильда).

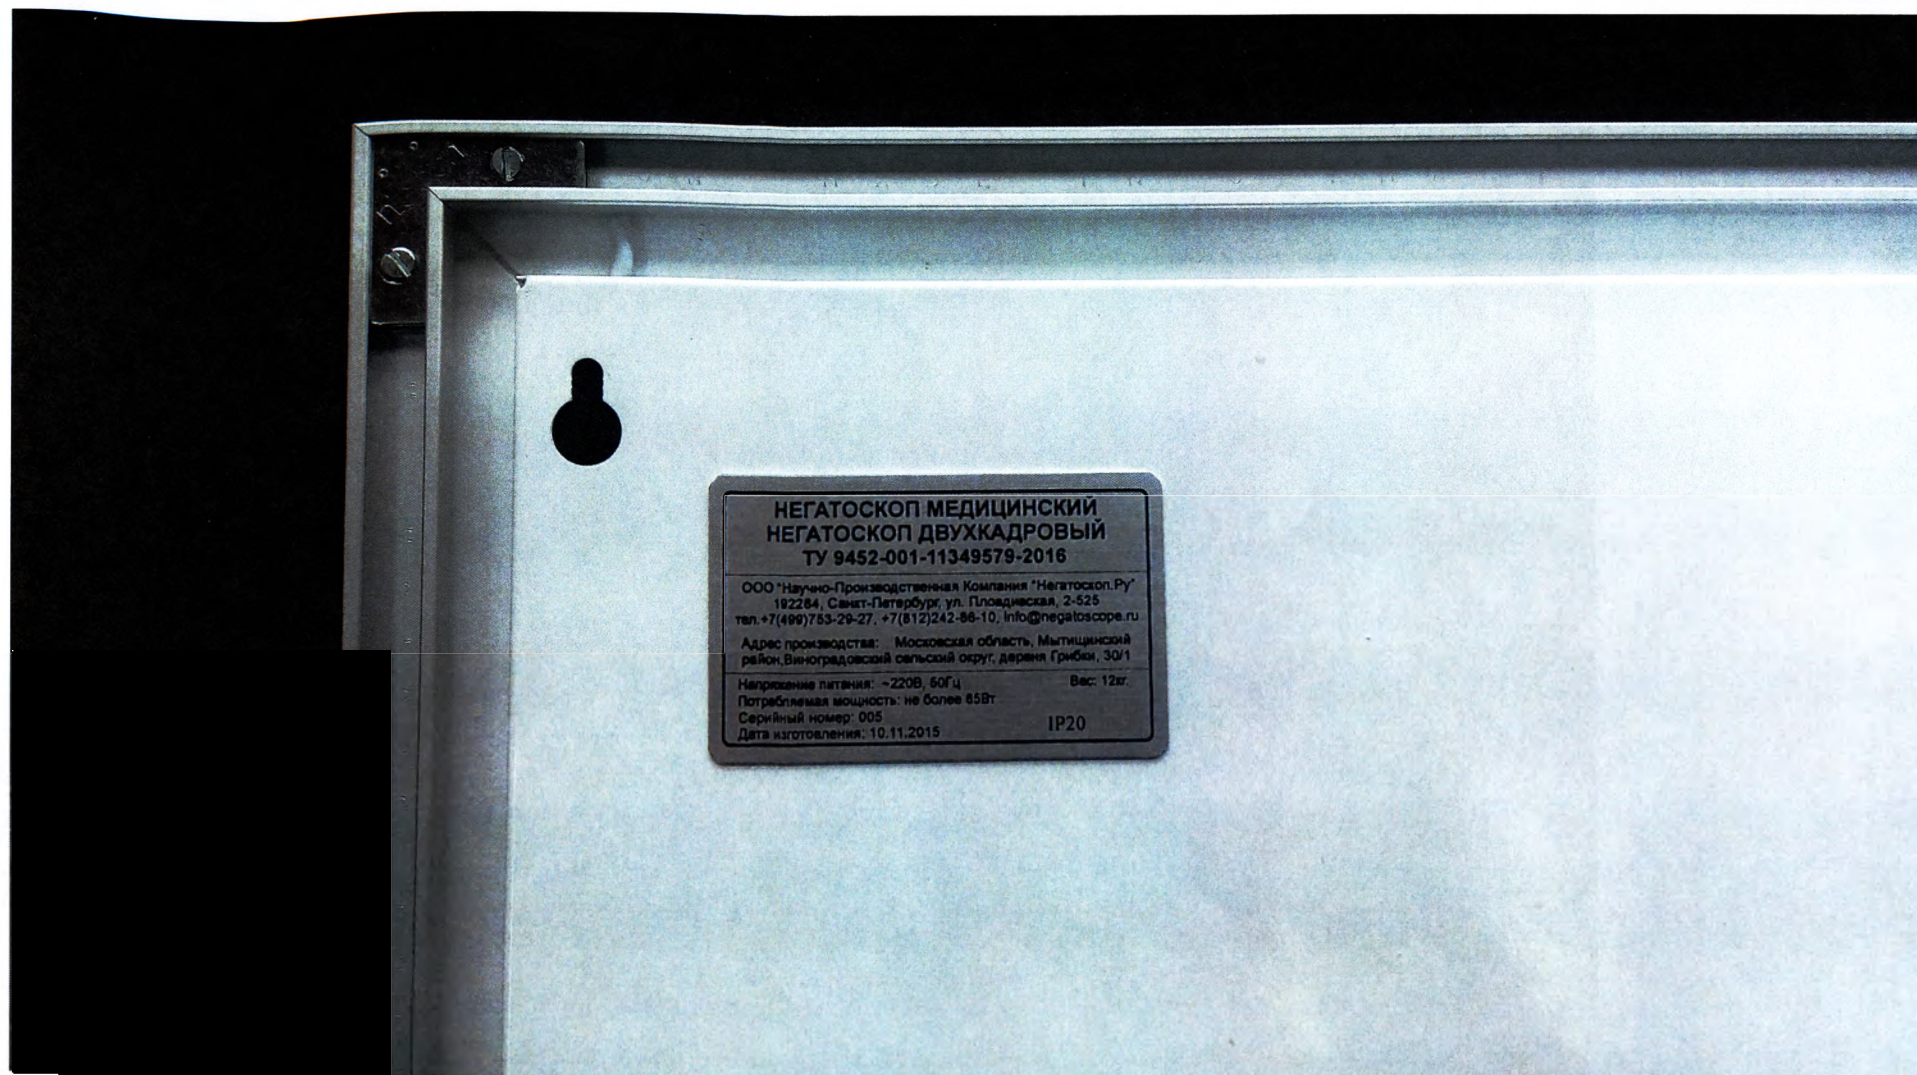


«Негатоскоп медицинский по ТУ 9452-001-11349579-2016» в варианте исполнения: негатоскоп двухкадровый, с принадлежностями. Вид изделия (задняя часть)

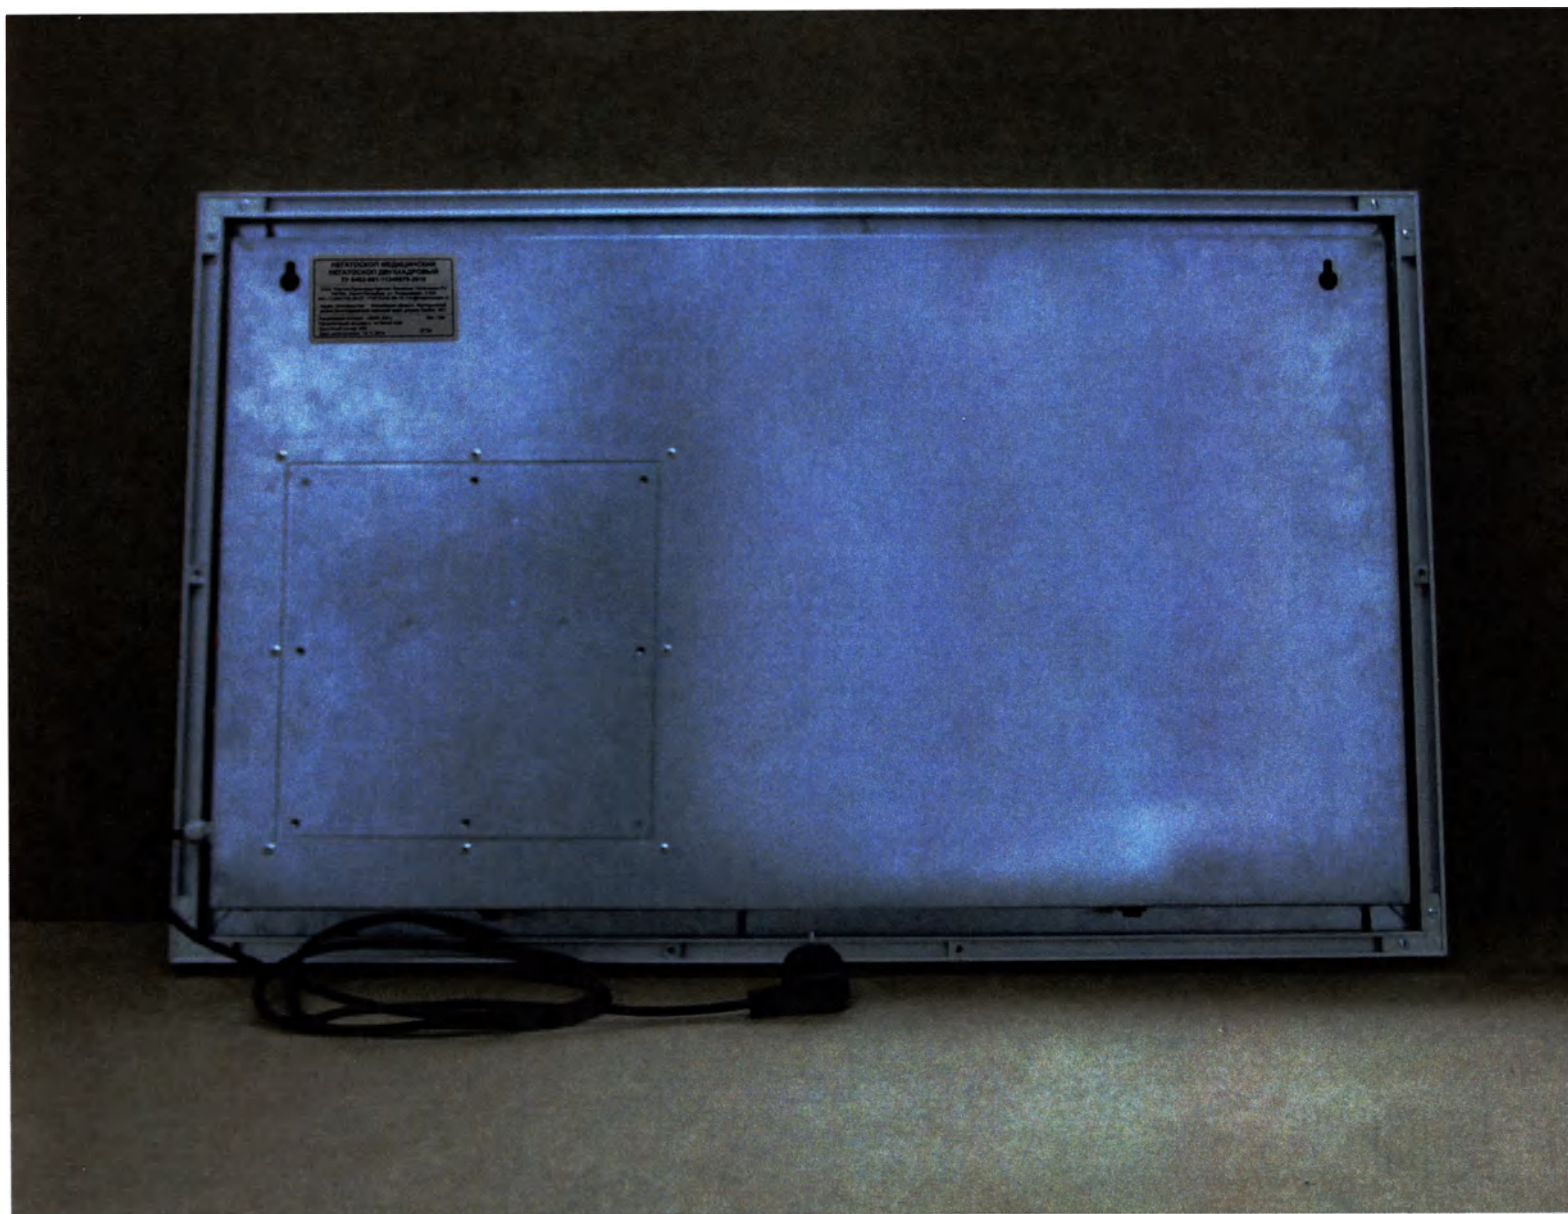


«Негатоскоп медицинский по ТУ 9452-001-11349579-2016» в варианте исполнения: негатоскоп двухкадровый, с принадлежностями. Вид изделия (сбоку, кнопочное управление).




«Негатоскоп медицинский по ТУ 9452-001-11349579-2016» в варианте исполнения: негатоскоп трехкадровый, с принадлежностями. Вид изделия (фронтально)

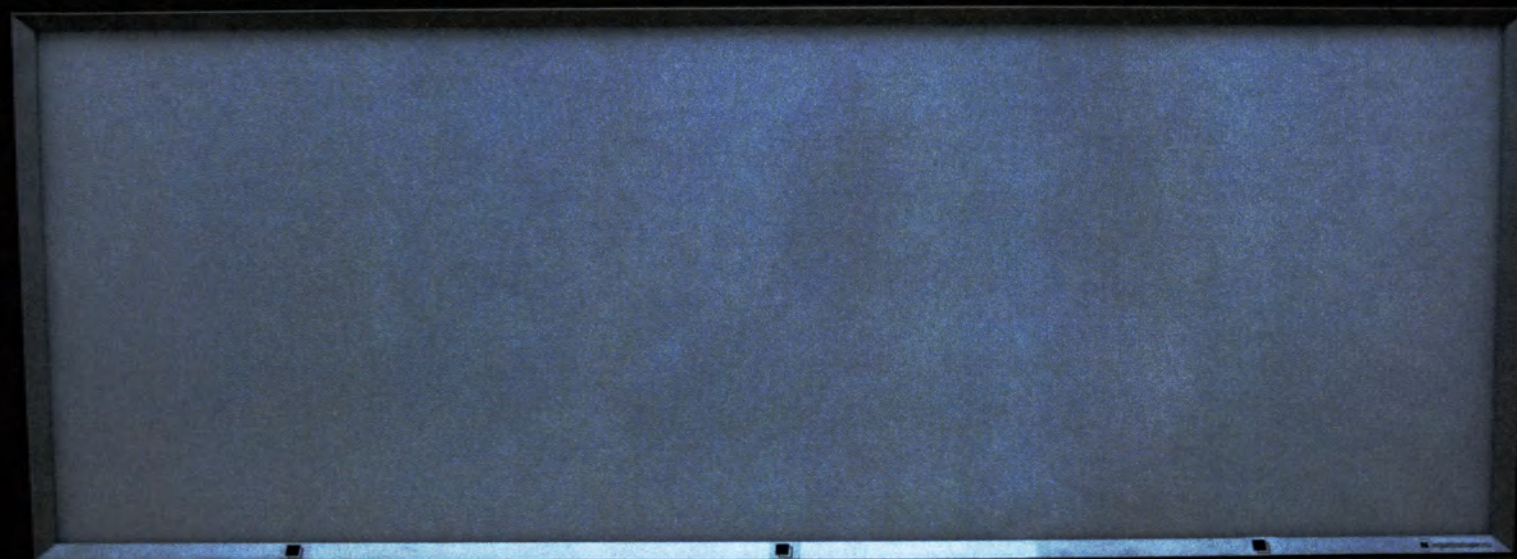


«Негатоскоп медицинский по ТУ 9452-001-11349579-2016» в вариантах исполнения: негатоскоп трехкадровый, с принадлежностями. Вид изделия (задняя часть, шильда).

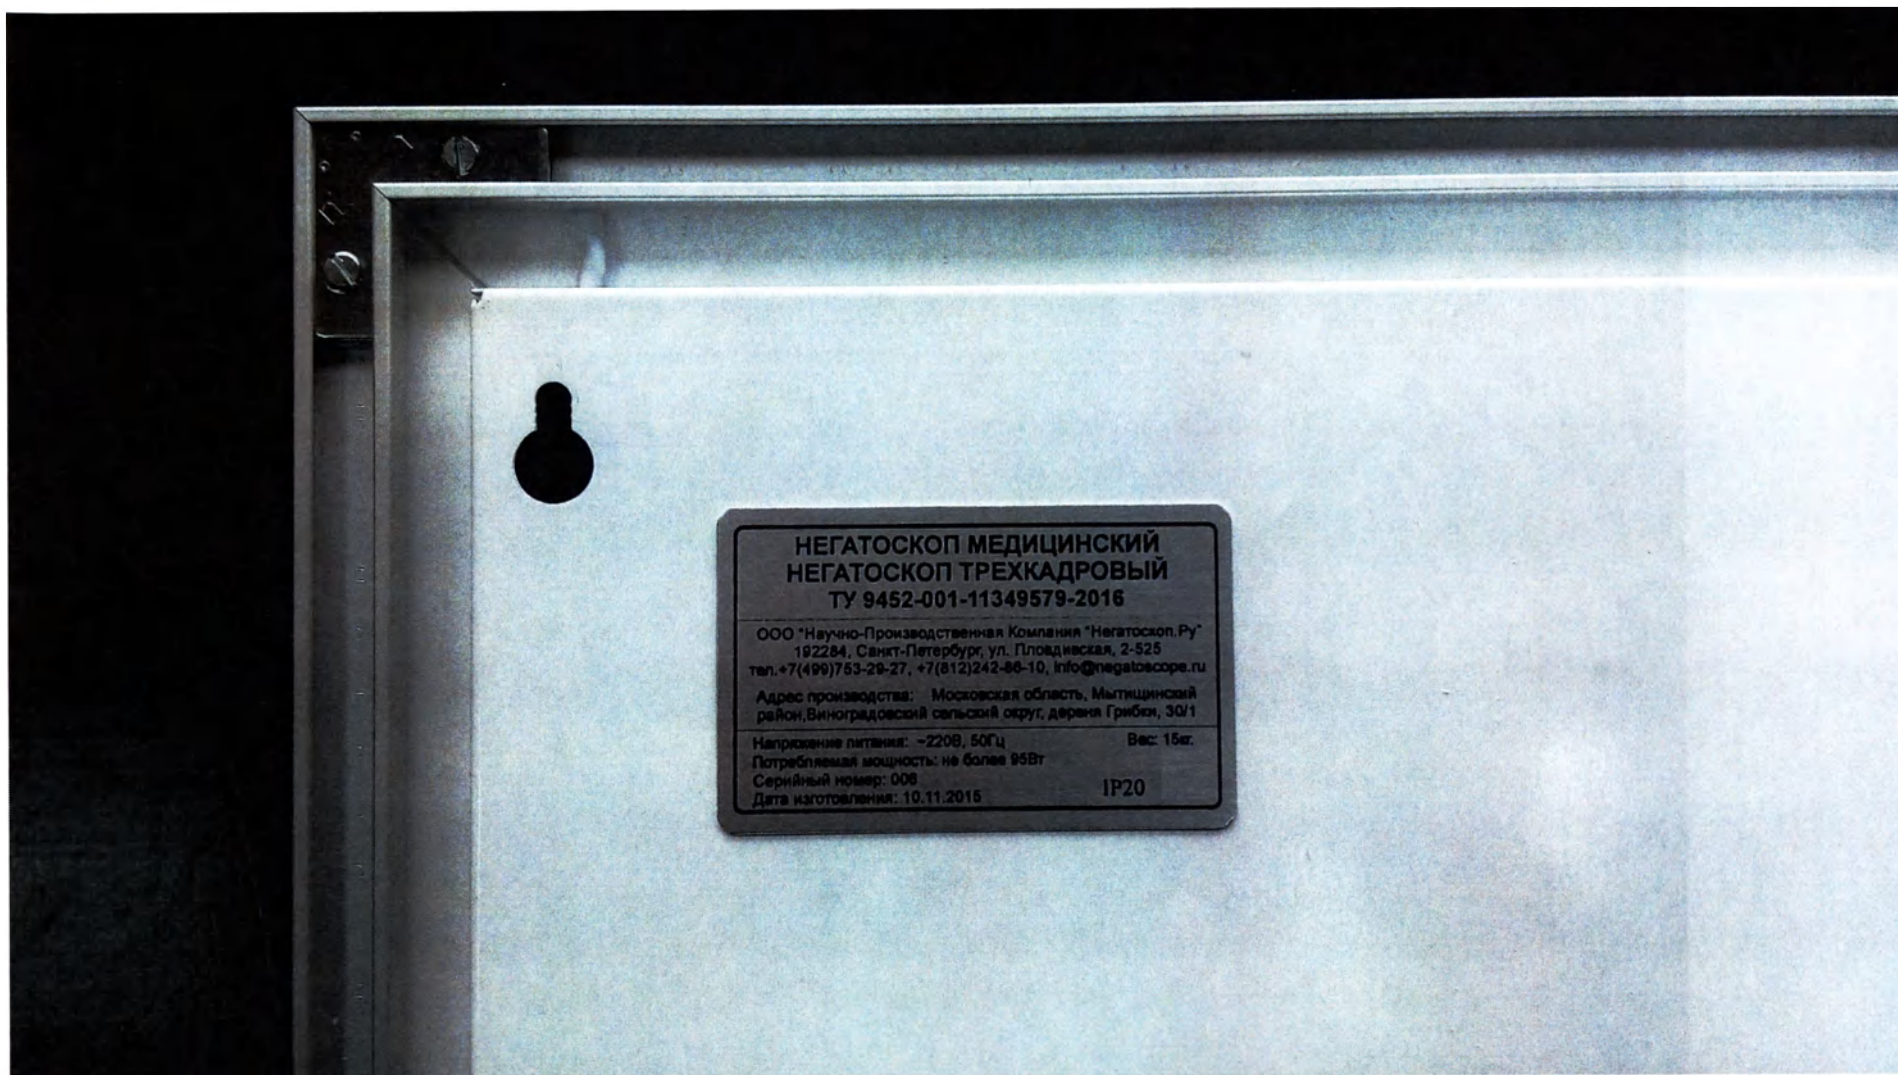


«Негатоскоп медицинский по ТУ 9452-001-11349579-2016» в вариантах исполнения: негатоскоп трехкадровый, с принадлежностями. Вид изделия (задняя часть).

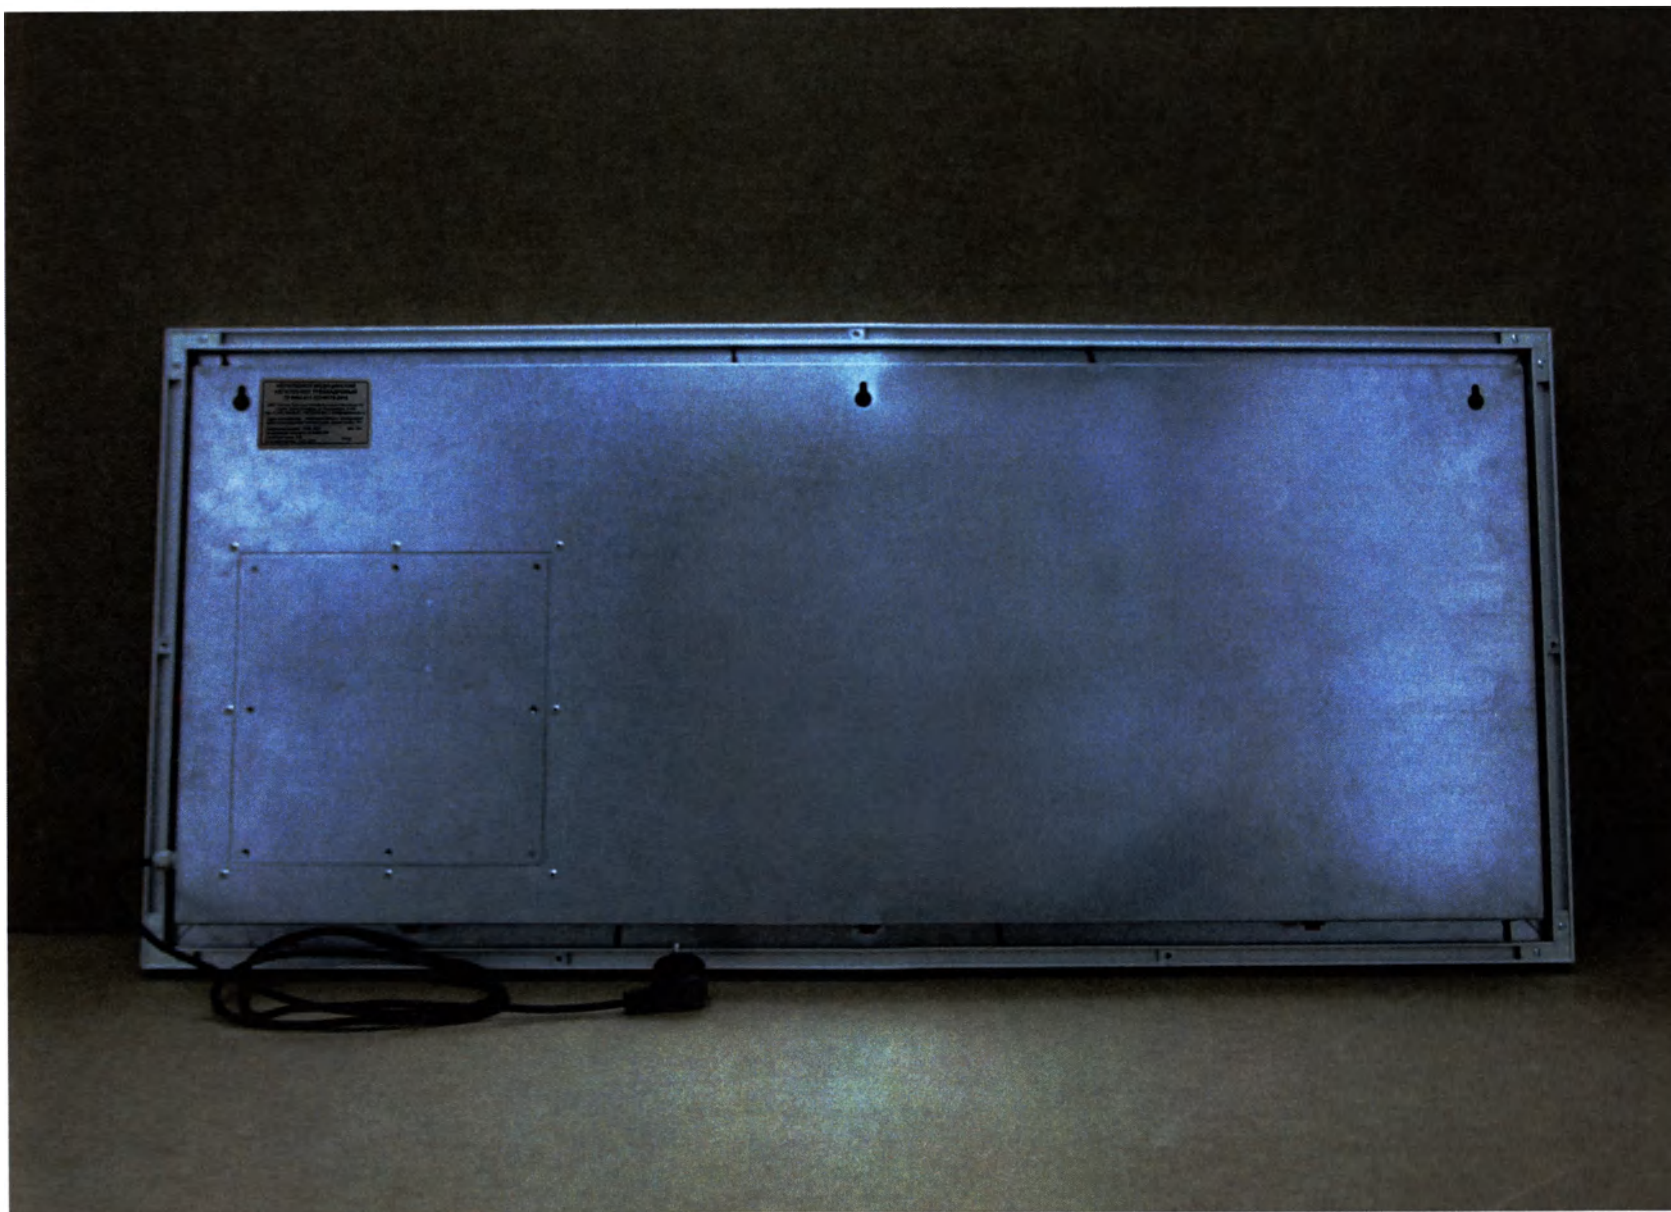


«Негатоскоп медицинский по ТУ 9452-001-11349579-2016» в варианте исполнения: негатоскоп трехкадровый, с принадлежностями. Вид изделия (сбоку, кнопочное управление).

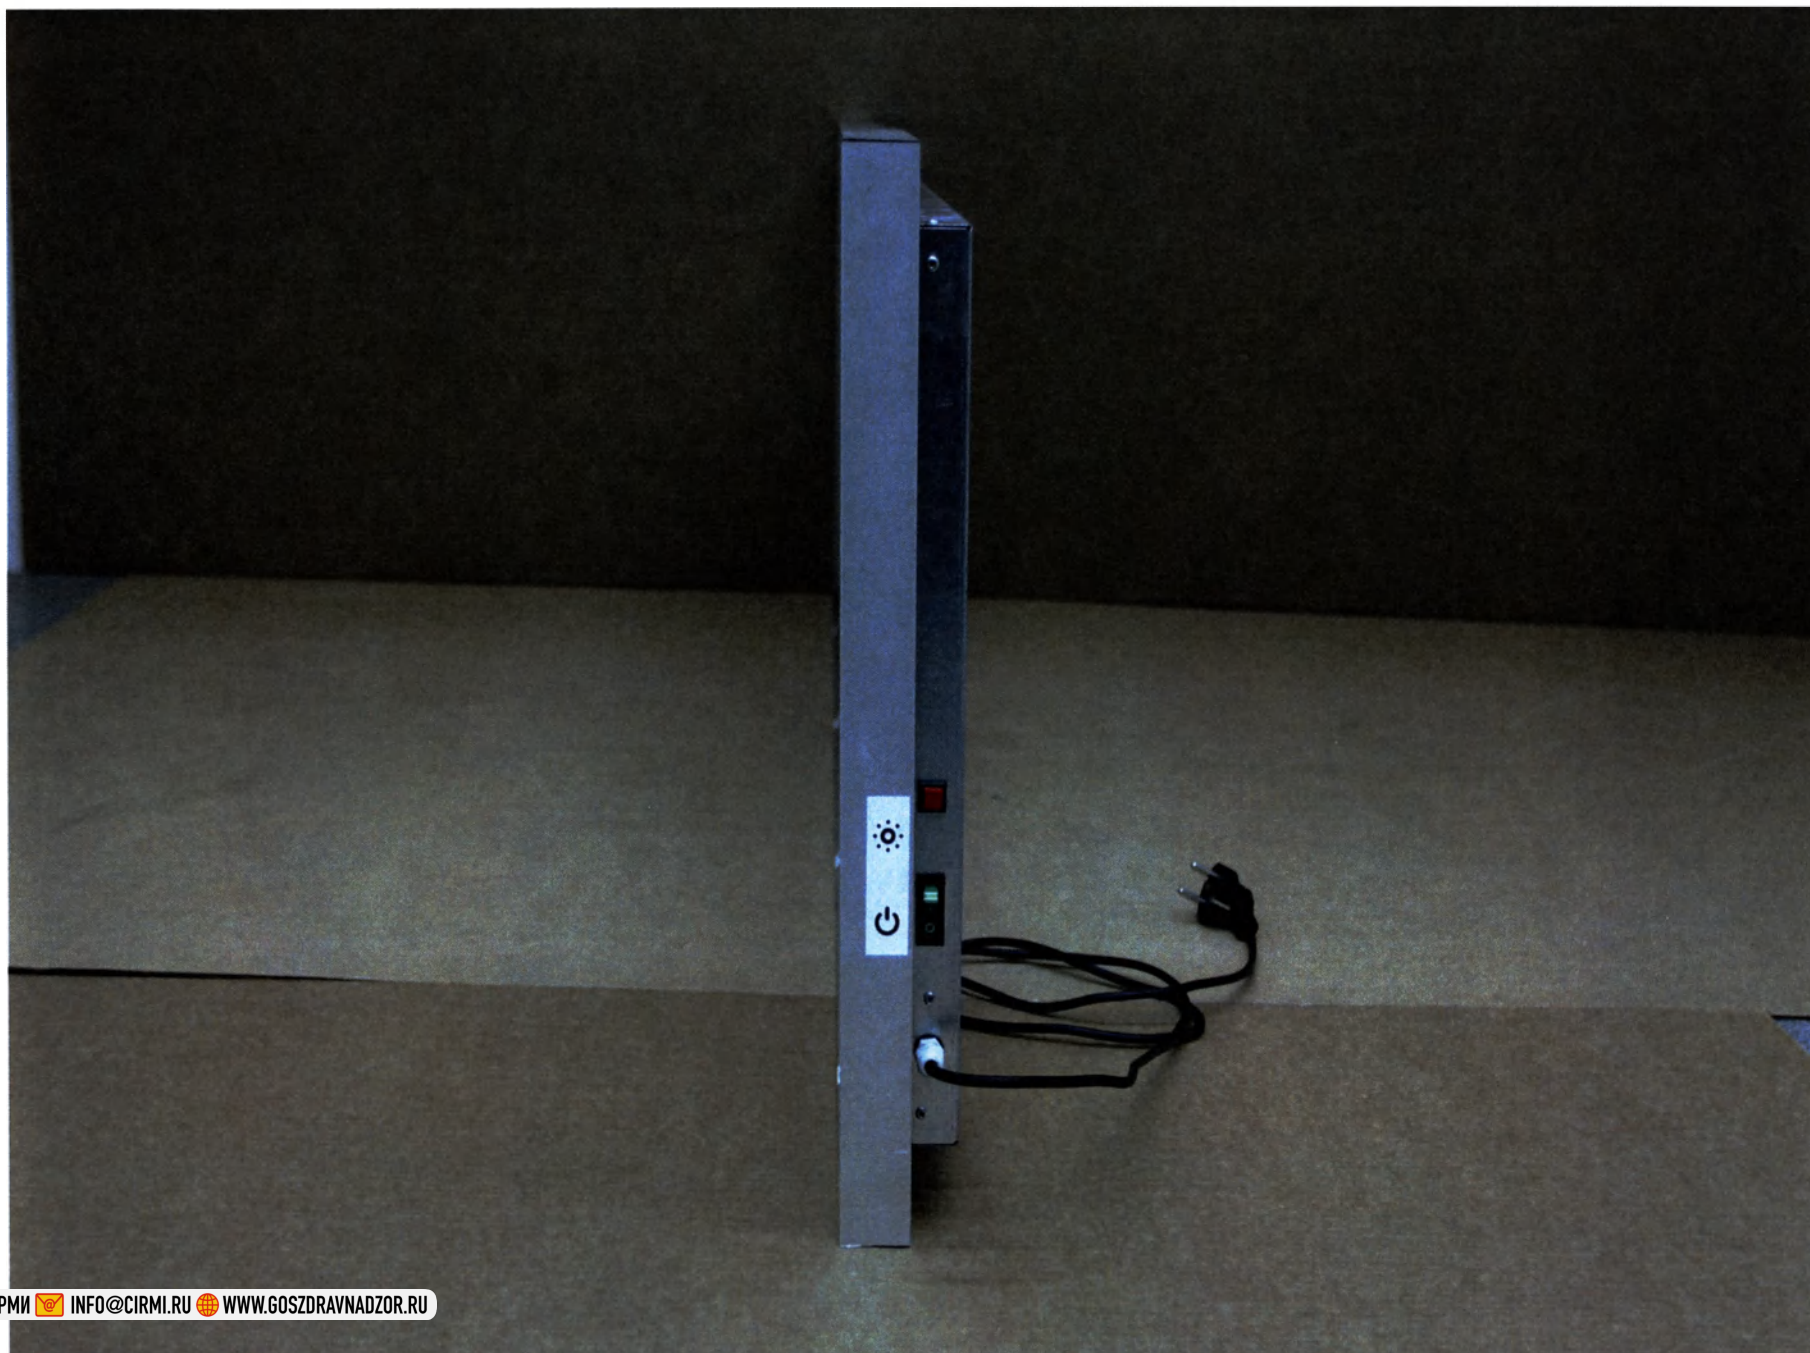


«Негатоскоп медицинский по ТУ 9452-001-11349579-2016» в вариантах исполнения: негатоскоп четырехкадровый, с принадлежностями. Вид изделия (фронтально).

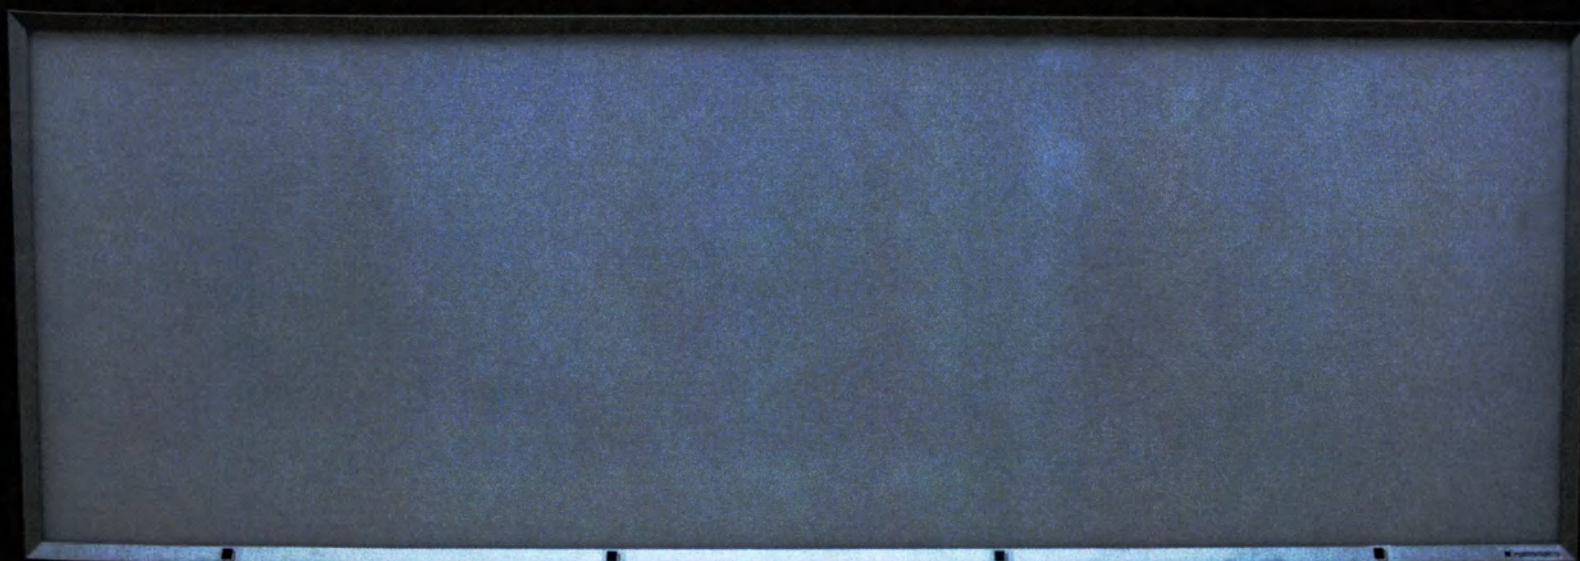


«Негатоскоп медицинский по ТУ 9452-001-11349579-2016» в вариантах исполнения: негатоскоп четырехкадровый, с принадлежностями. Вид изделия (сидеть, часть, шильда).

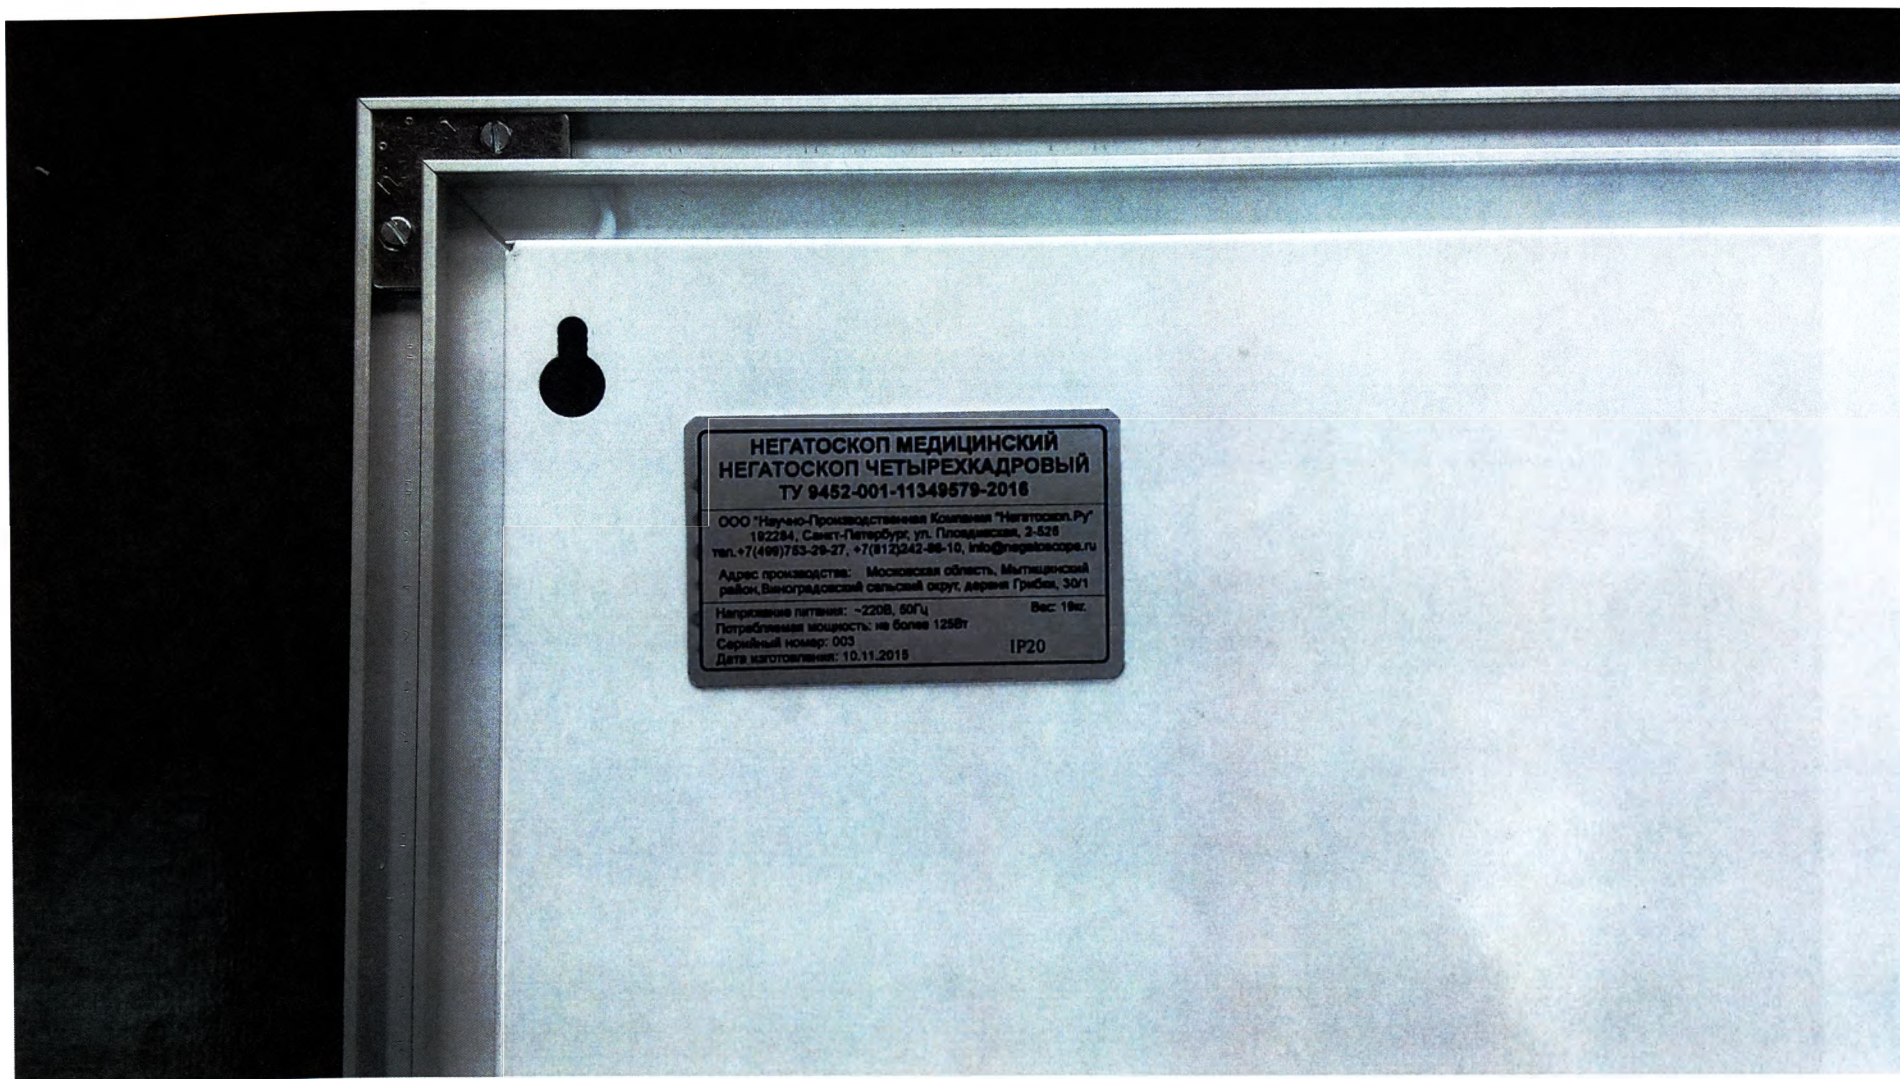

«Негатоскоп медицинский по ТУ 9452-001-11349579-2016» в вариантах исполнения: негатоскоп четырехкадровый, с принадлежностями. Вид изделия (задняя часть).

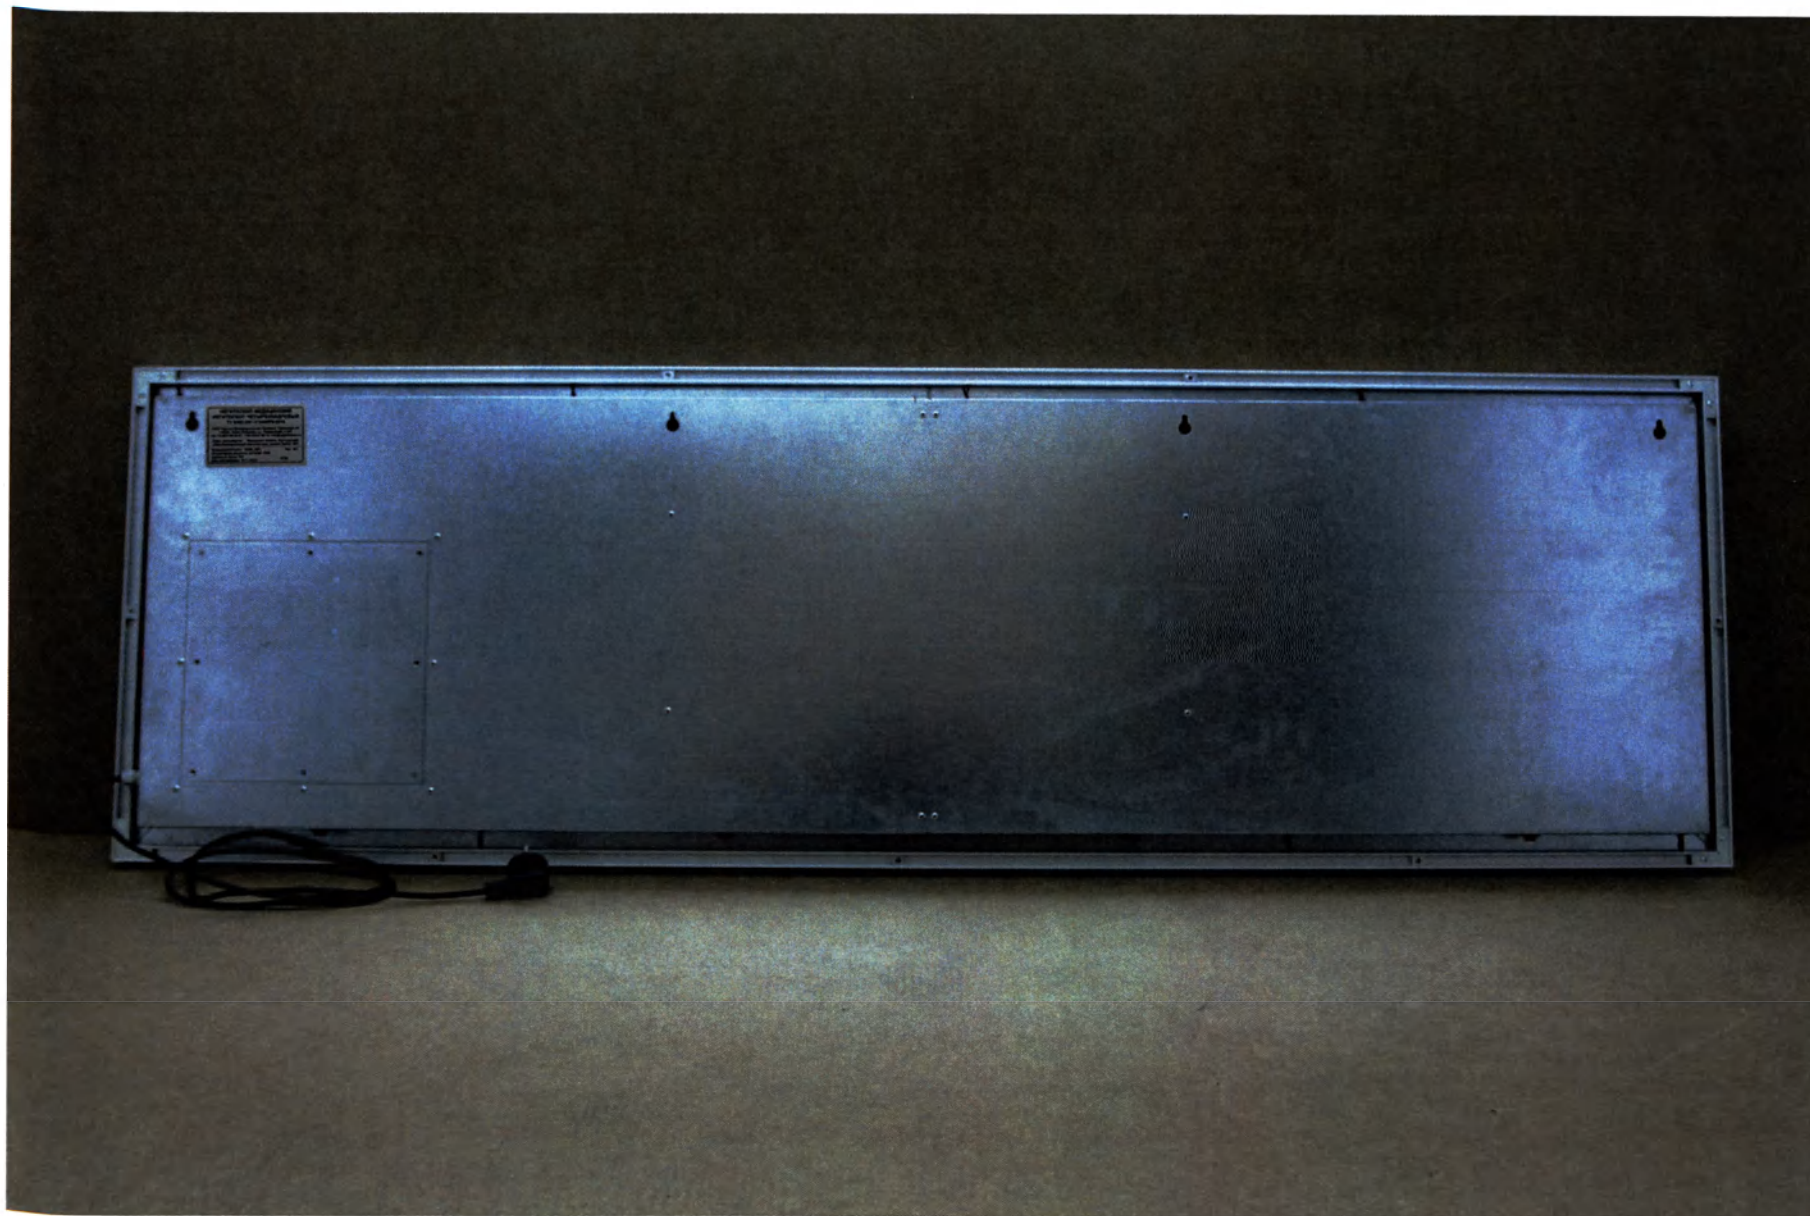

«Негатоскоп медицинский по ТУ 9452-001-11349579-2016» в вариантах исполнения: негатоскоп четырехкадровый, с принадлежностями. Вид изделия (сбоку, кнопочное управление).

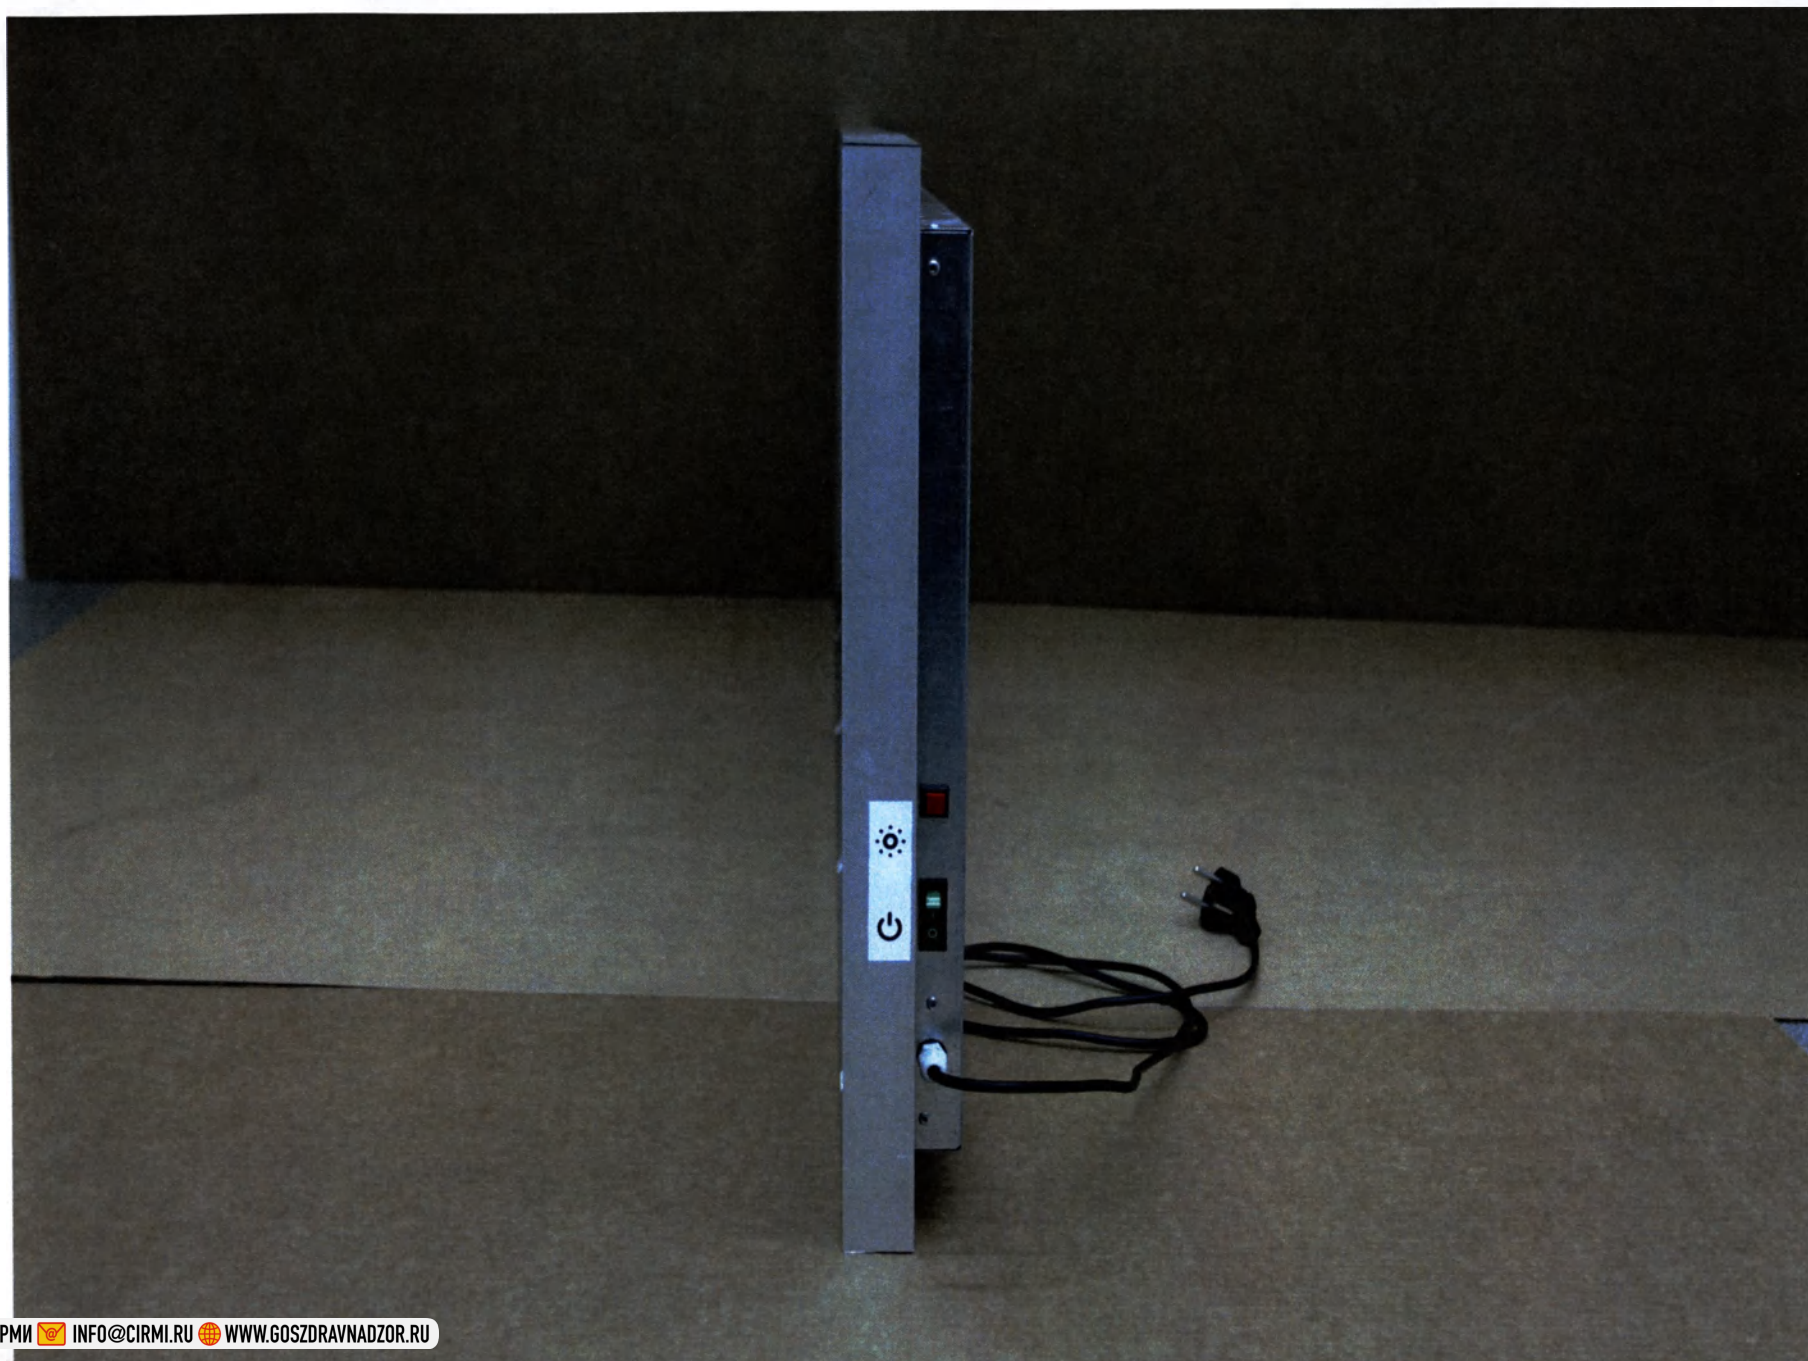

Генеральный директор
ООО ЦПМ Империум.ру
Муровский М.И.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 14

Семнадцати листах

