

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "МедТест-М"


Михеева М. М.

2016 г.



Фотографическое изображение медицинского изделия

Печь стоматологическая VITA V60 i-Line принадлежностями

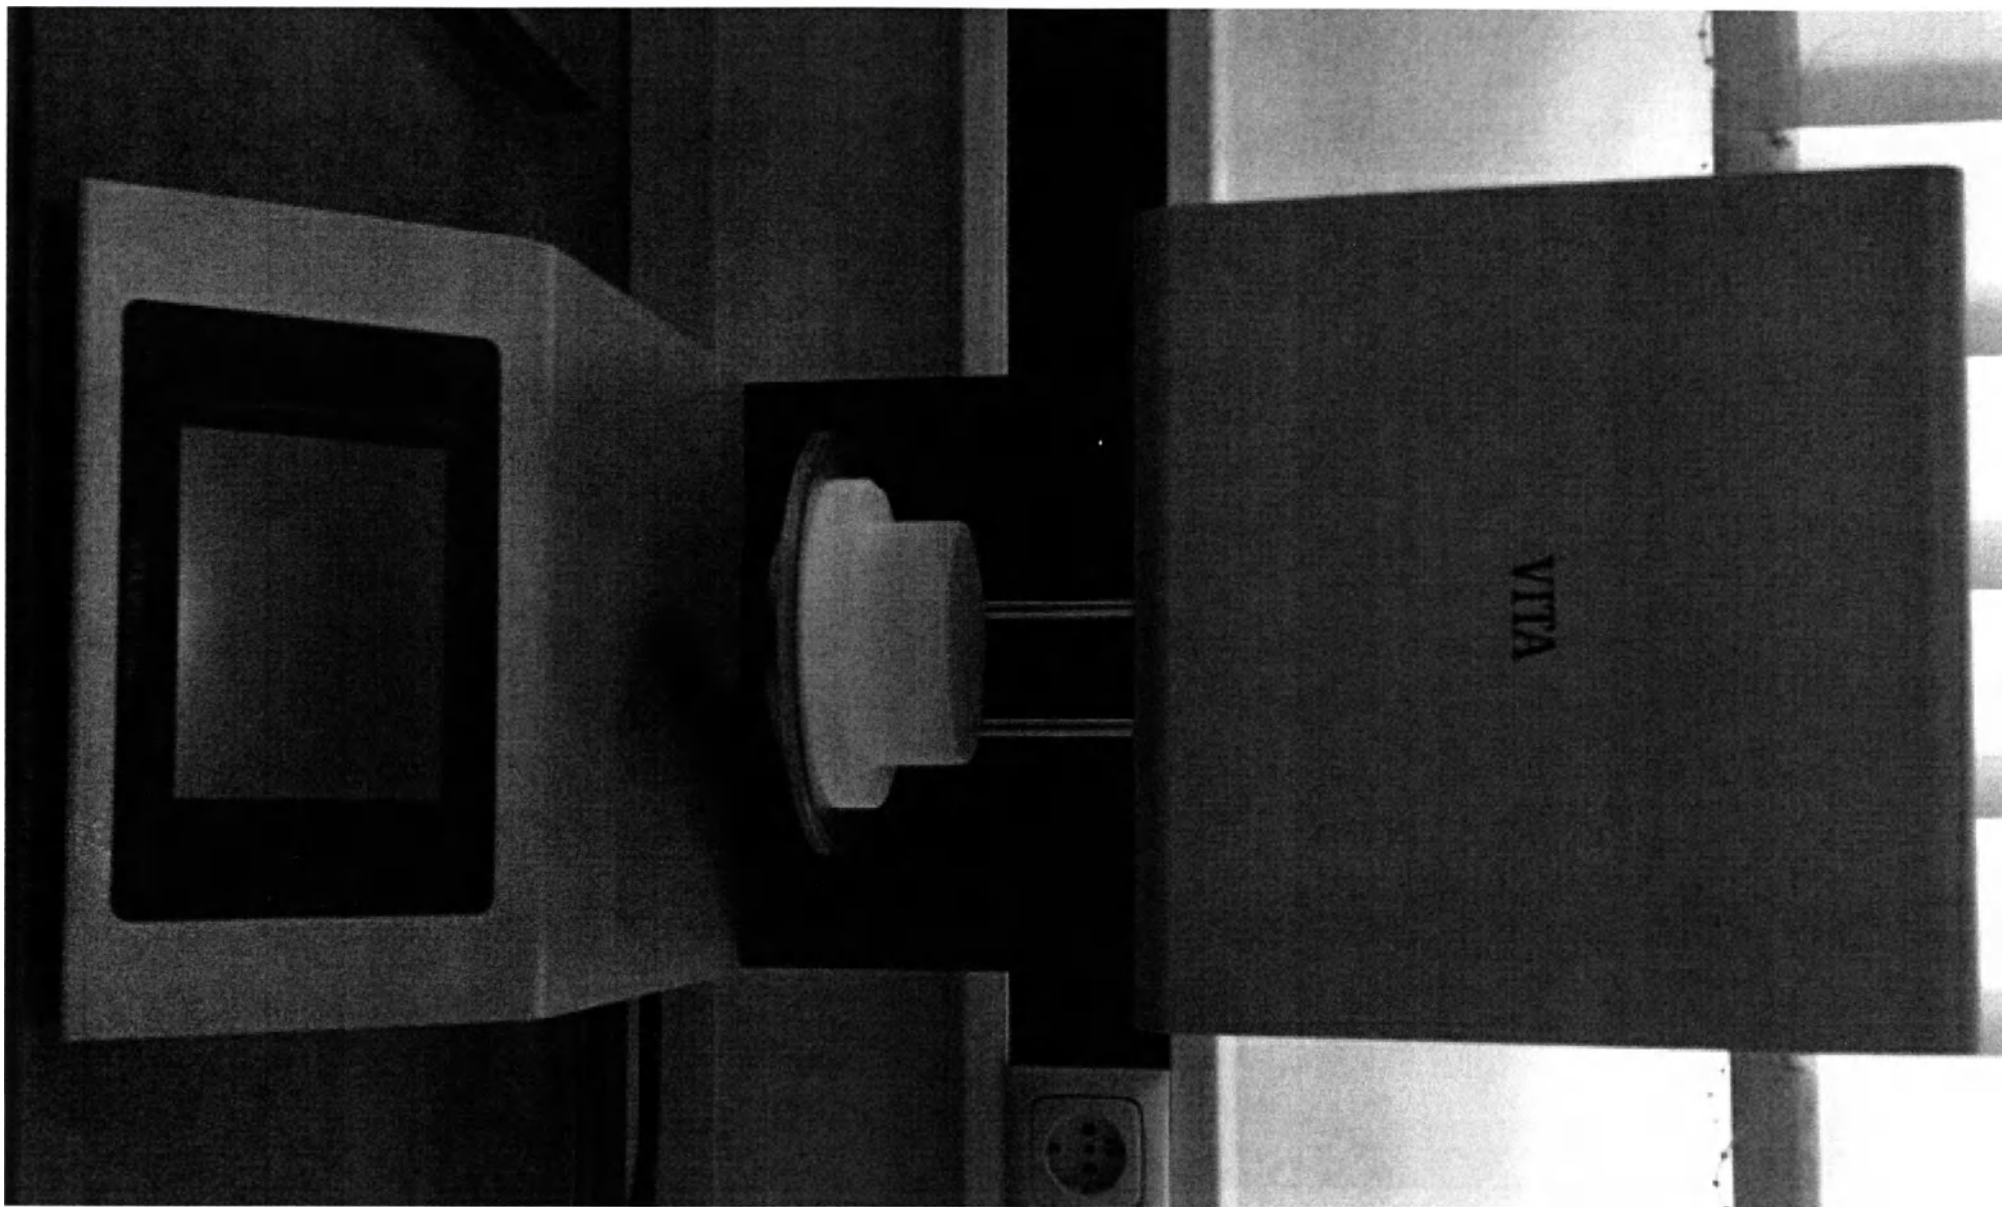

I.Базовая комплектации
Рисунок 1 - Печь для обжига

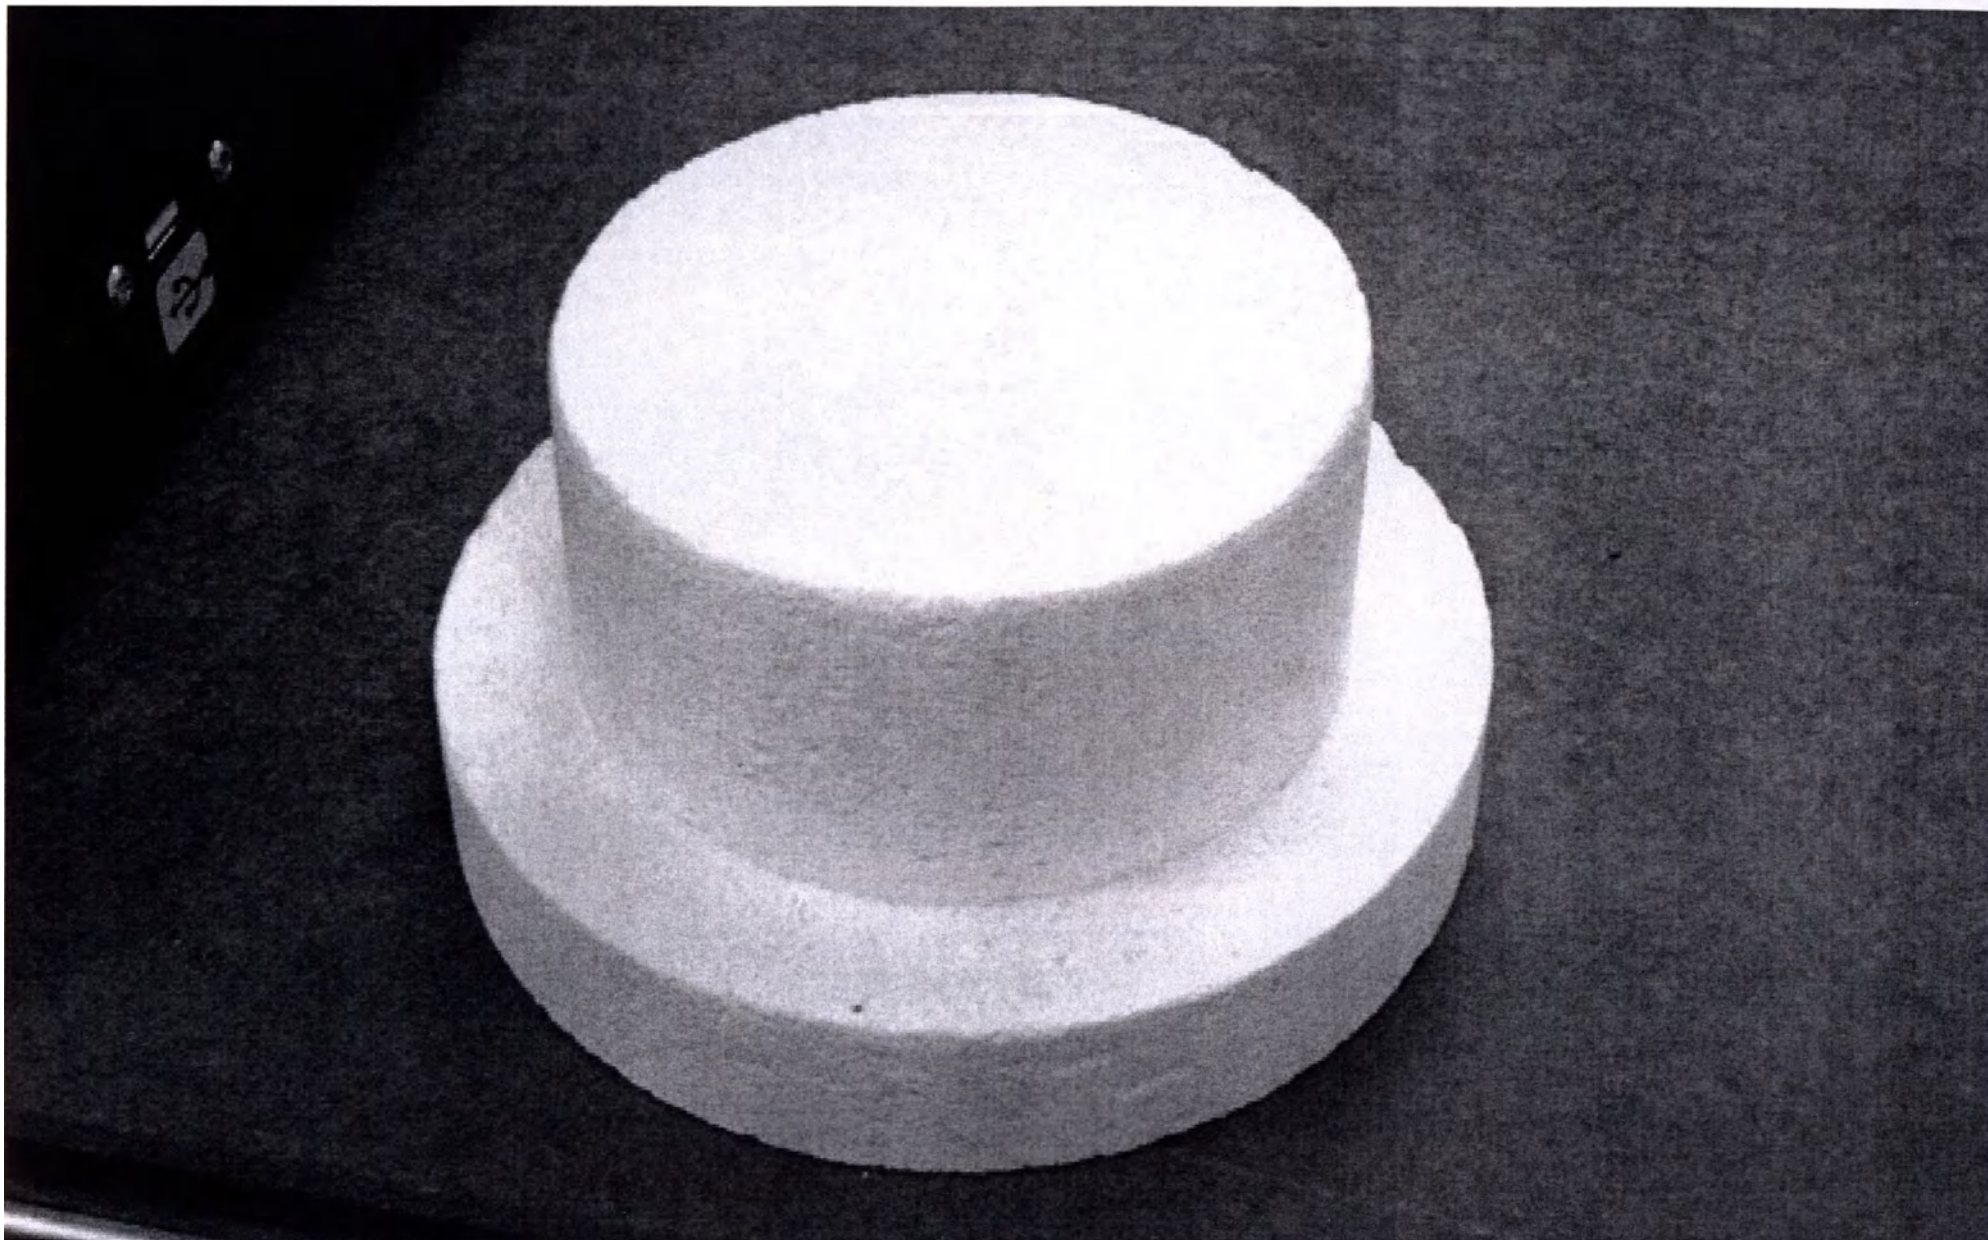


Рисунок 2 – Цоколь для обжига



Рисунок 3 – Кабель электрический сетевой

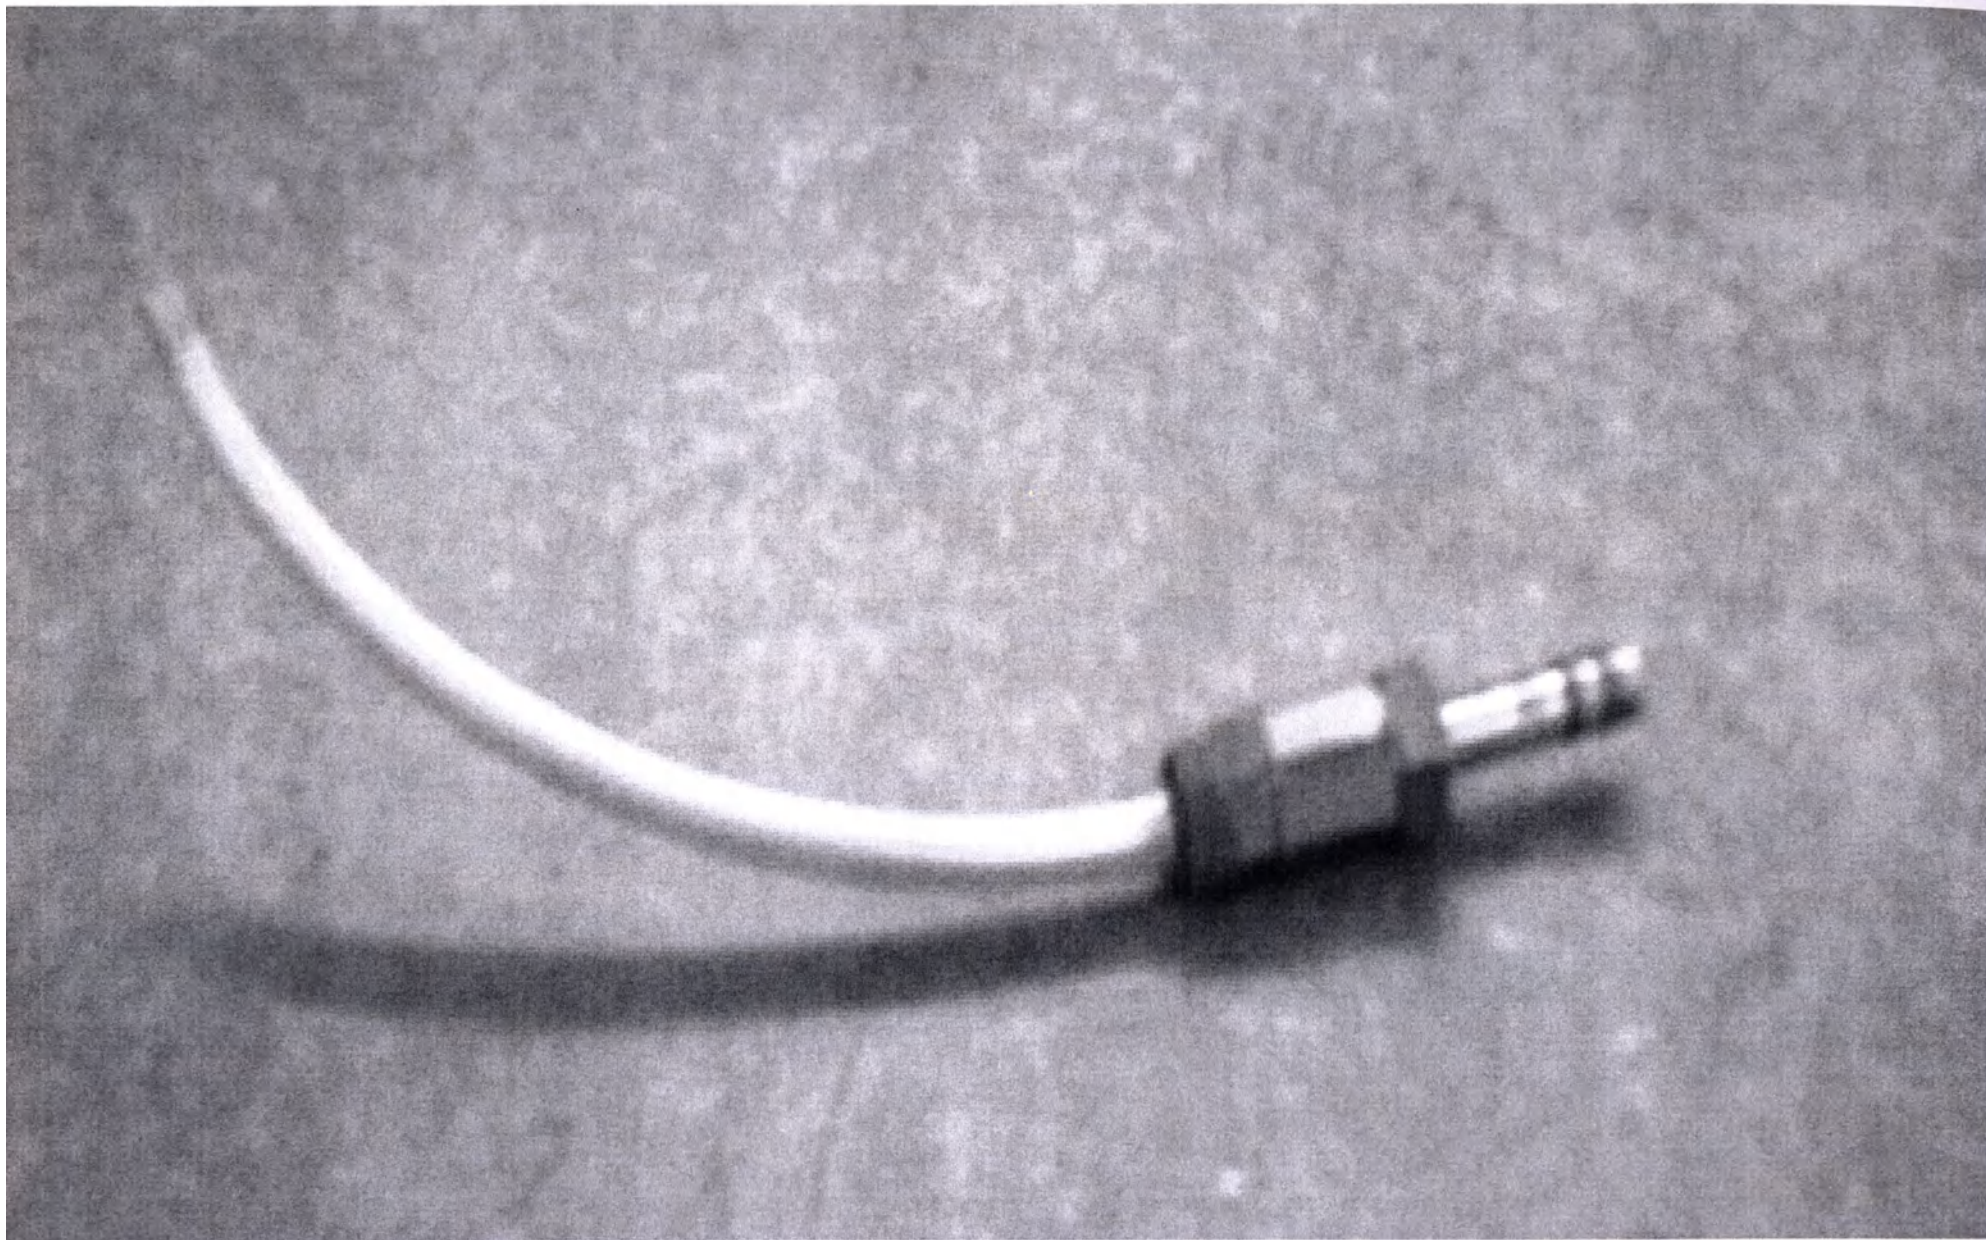


Рисунок 4 – Кабель соединительный для вакуумного насоса



Рисунок 5 – Трубка вакуумная

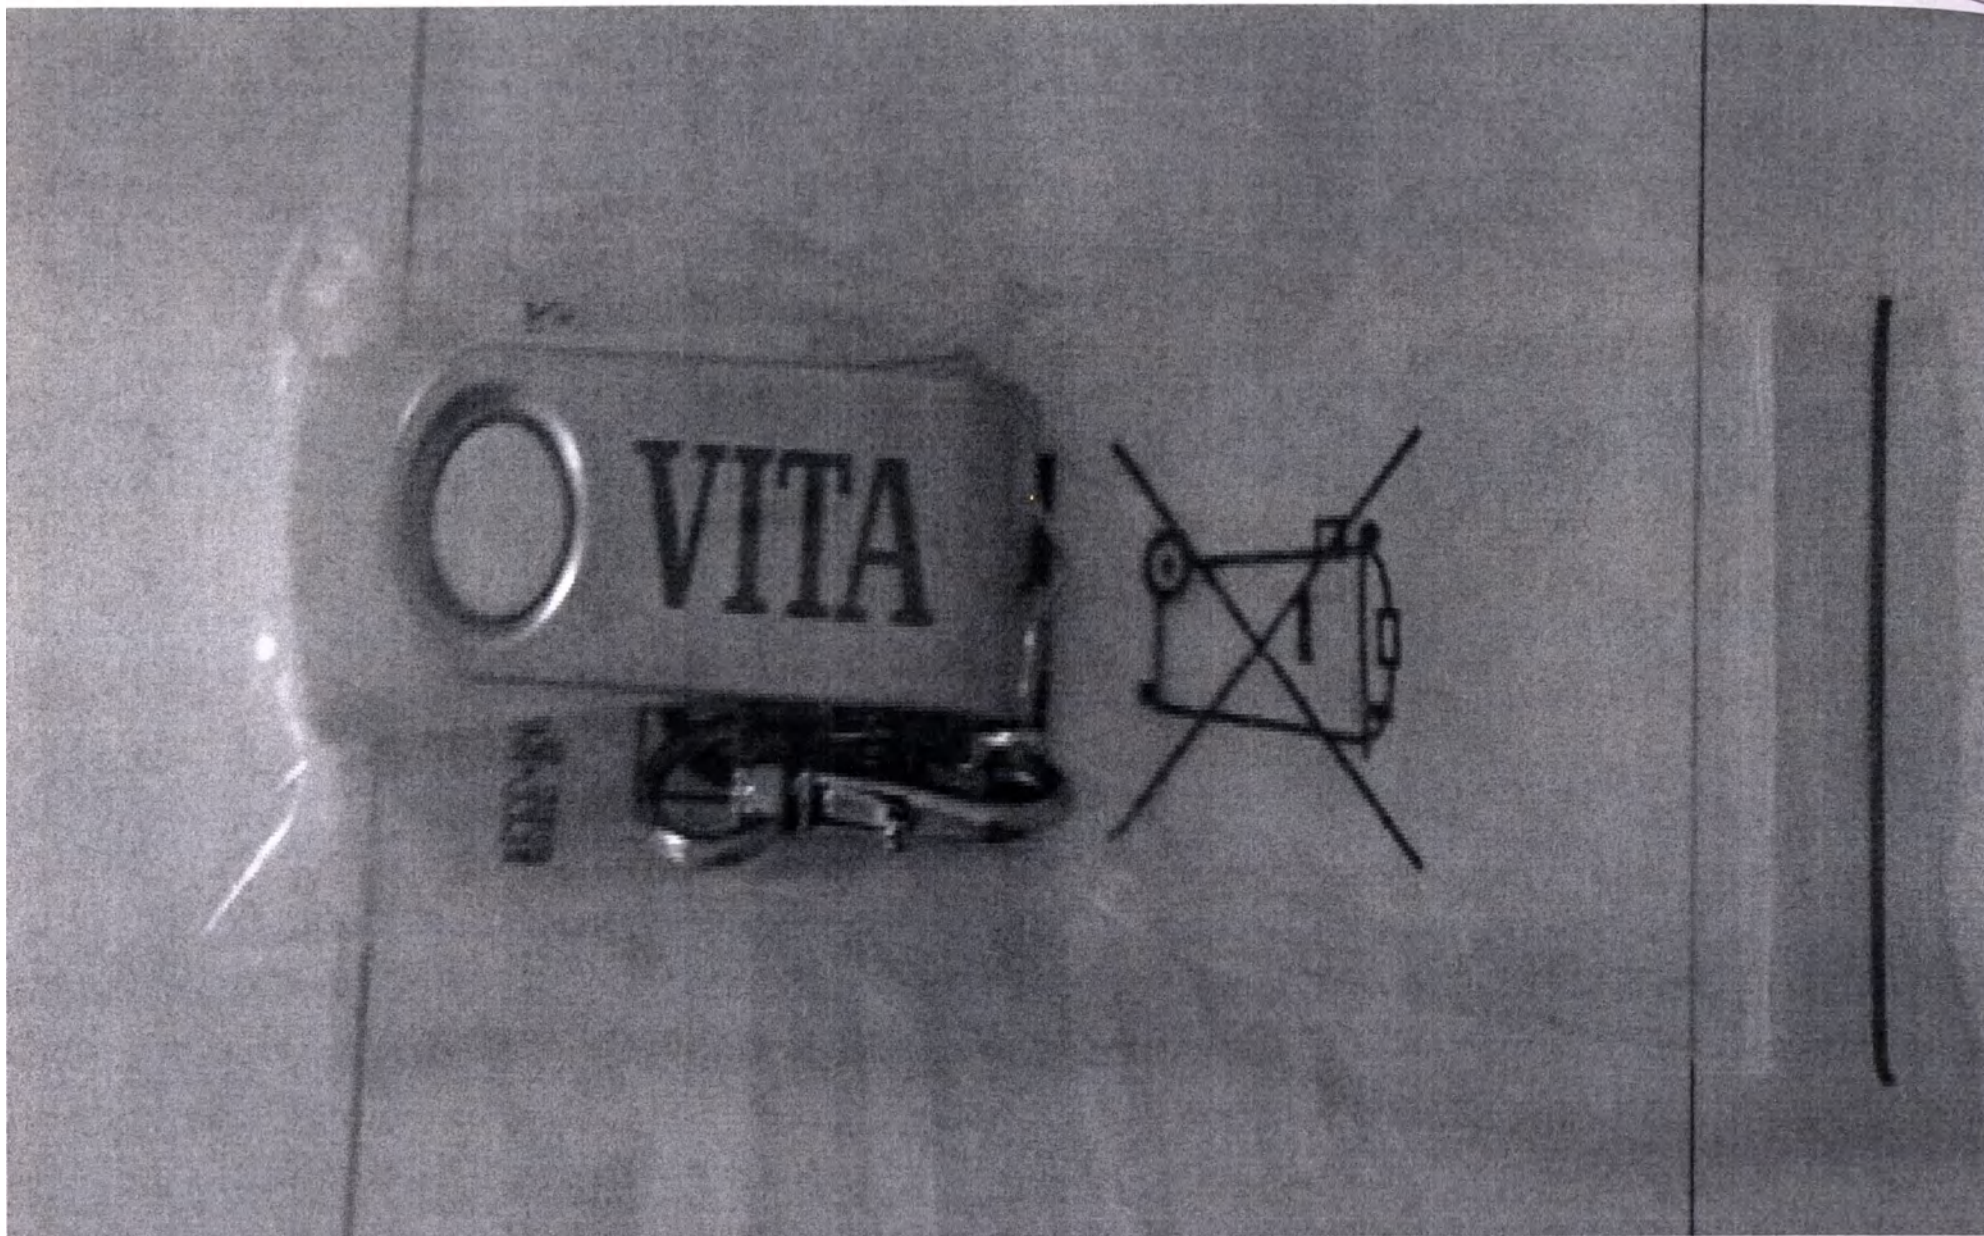


Рисунок 6 – Флешка установочная USB



Рисунок 7 – Инструкция

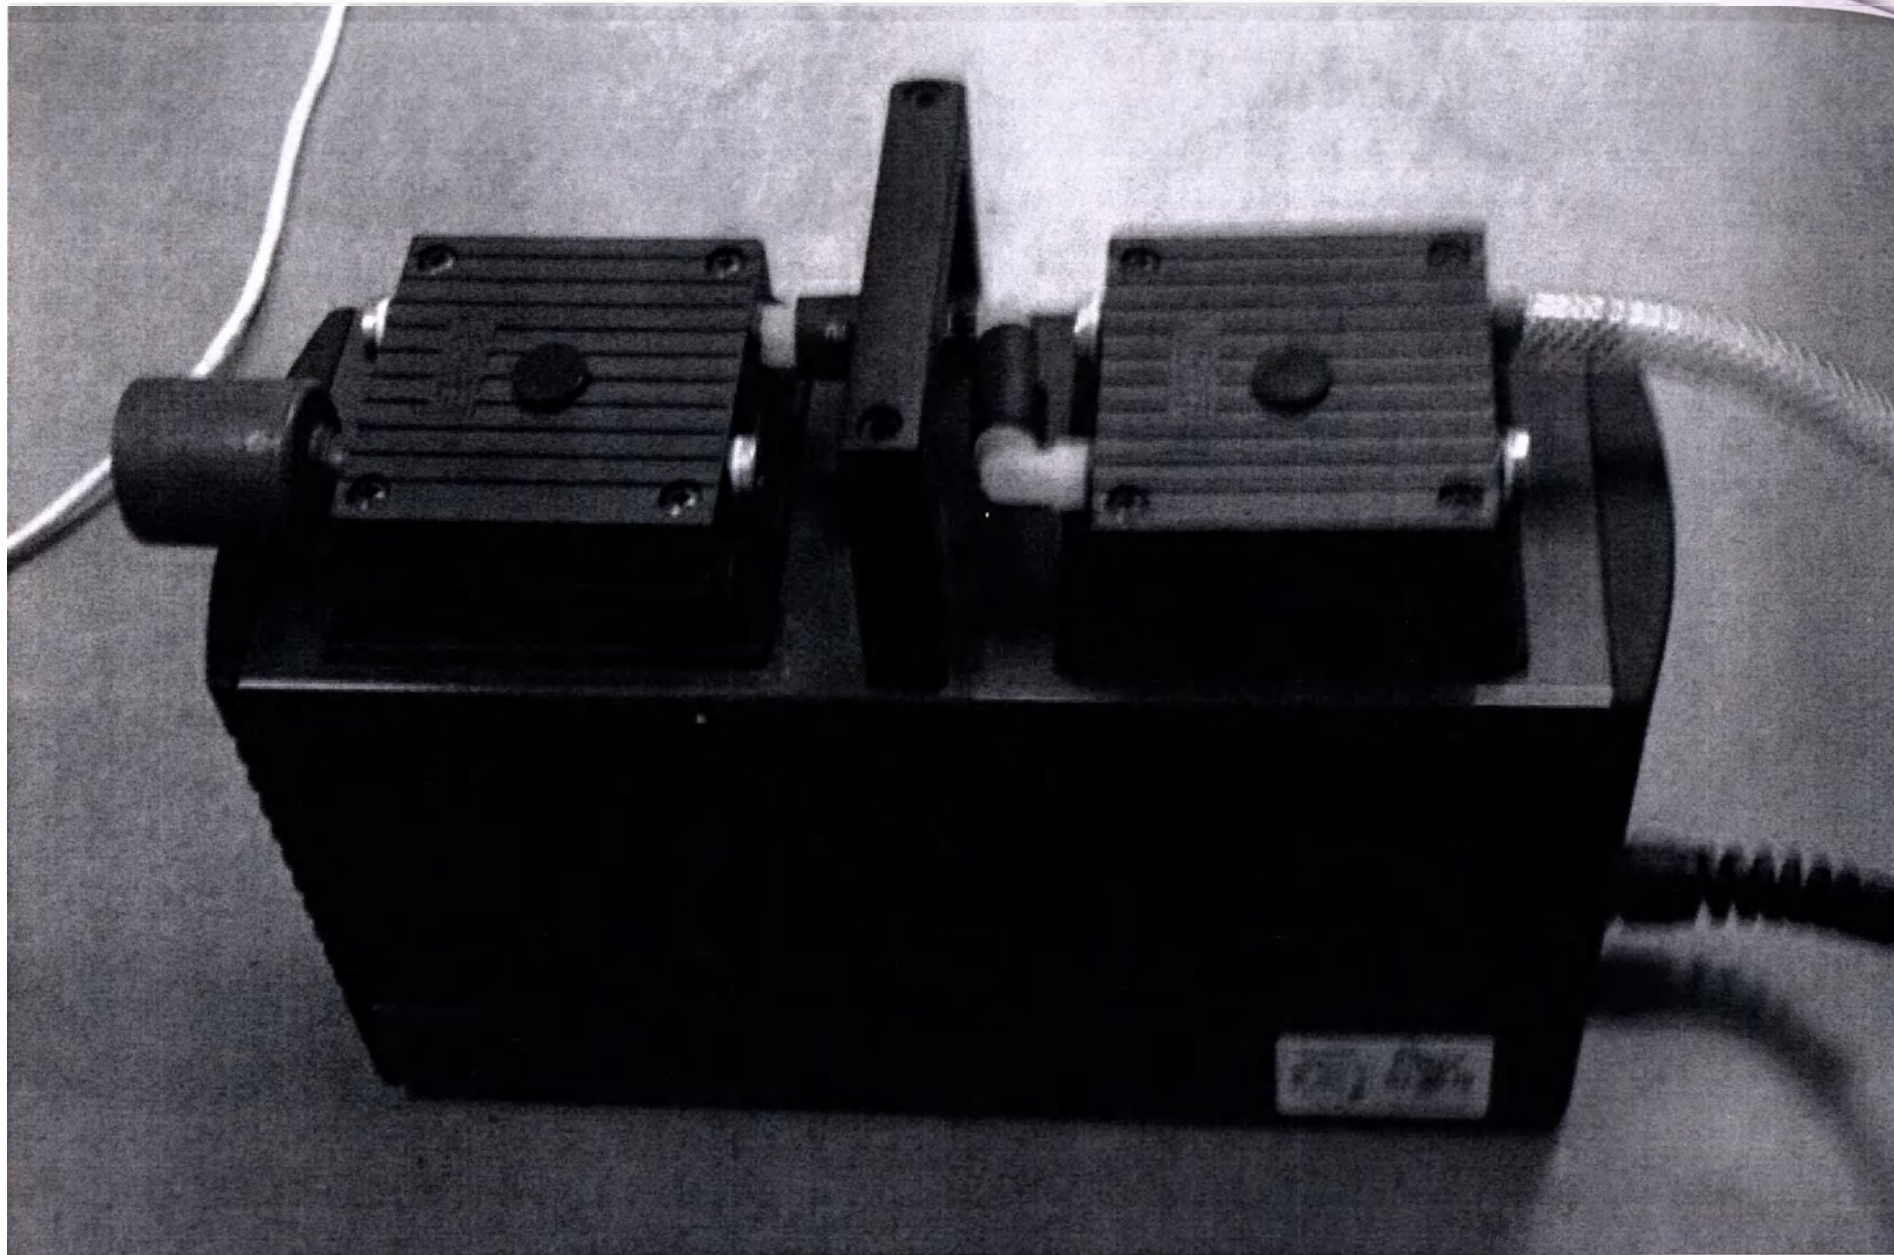


Рисунок 8 - Насос вакуумный 230/240 V, 50/60 Гц


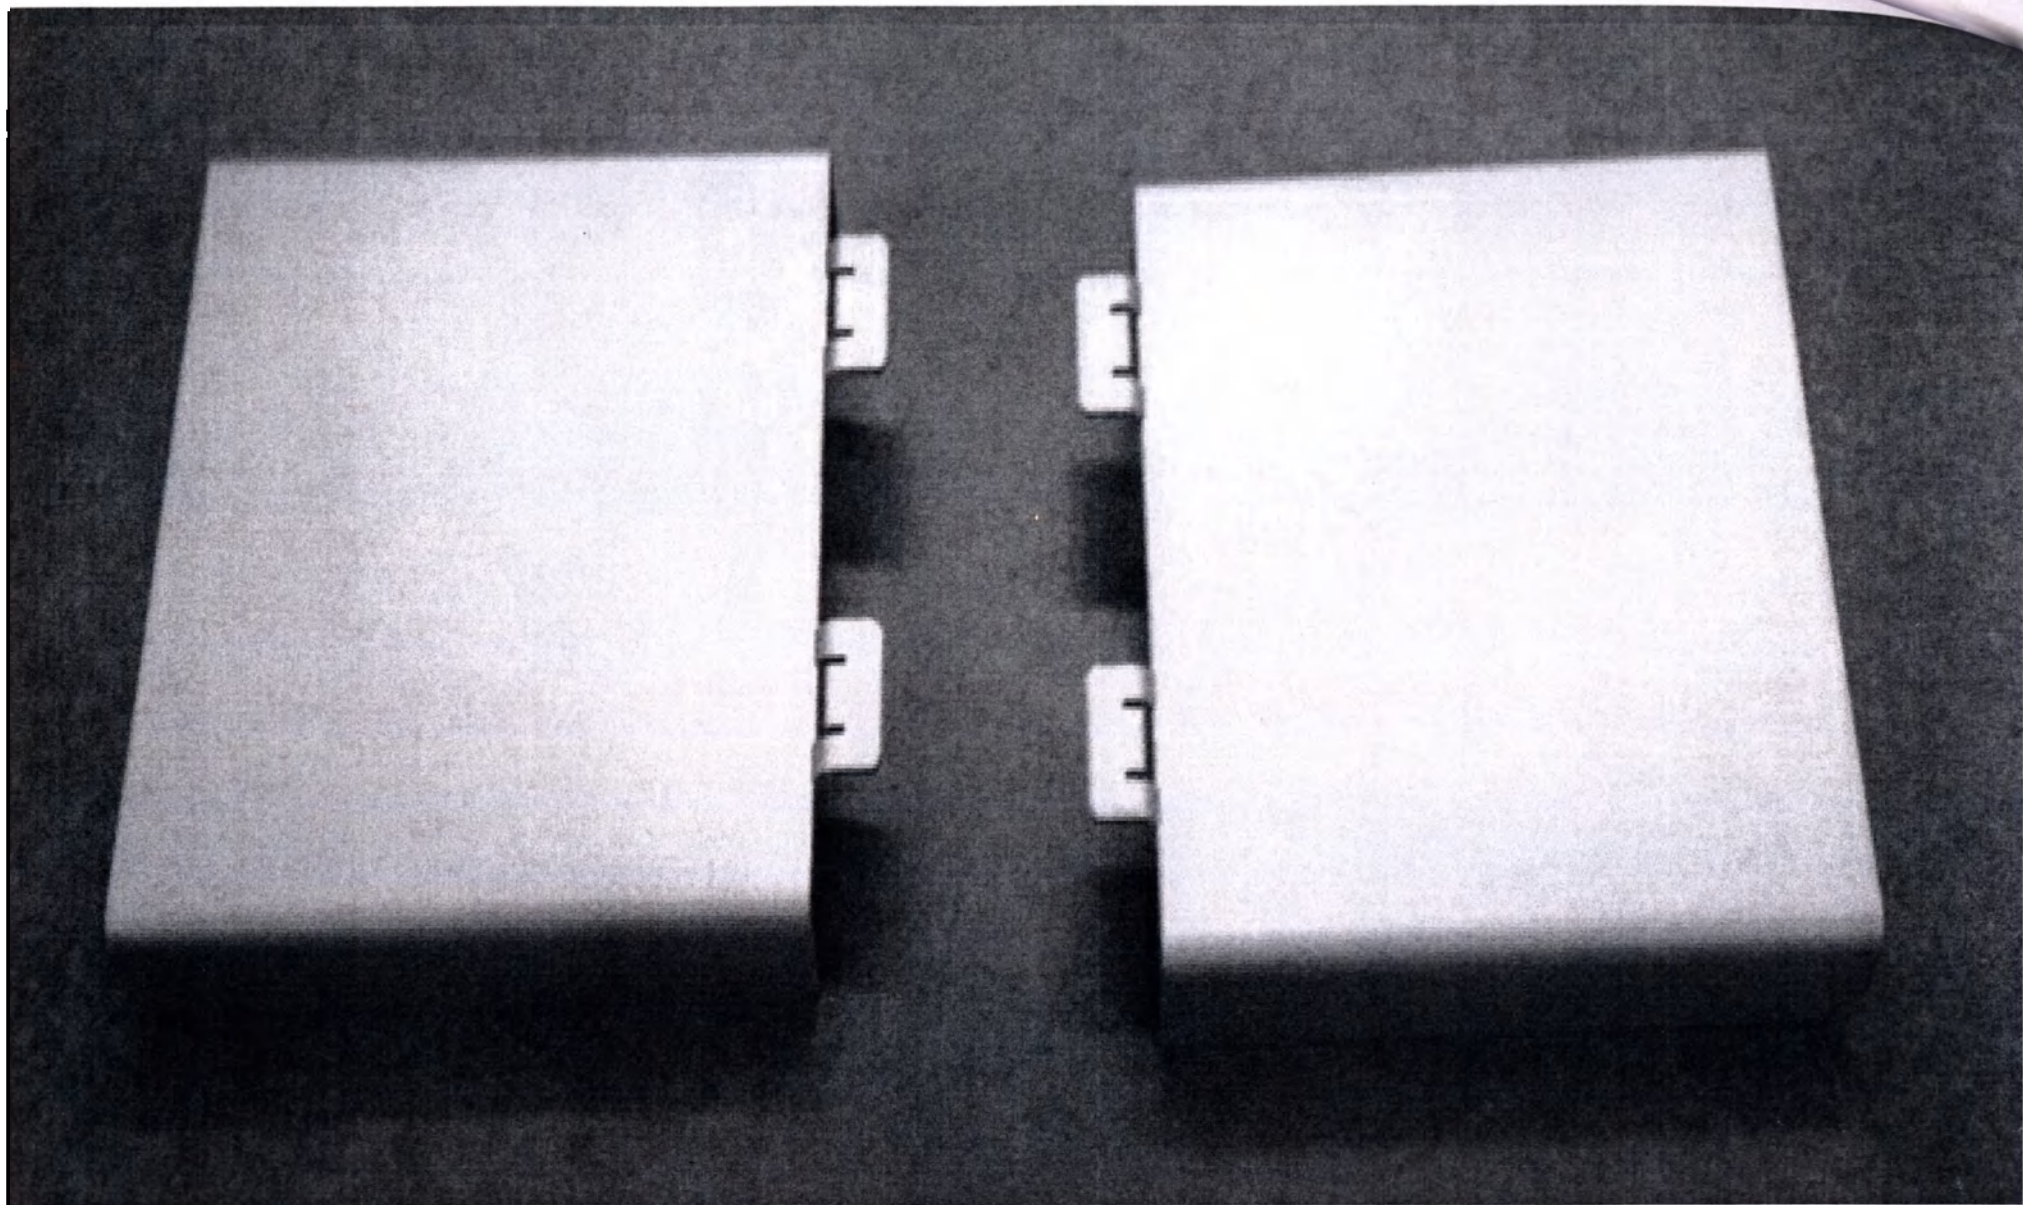


Рисунок 9 - 2 боковых столика для обжиговых изделий

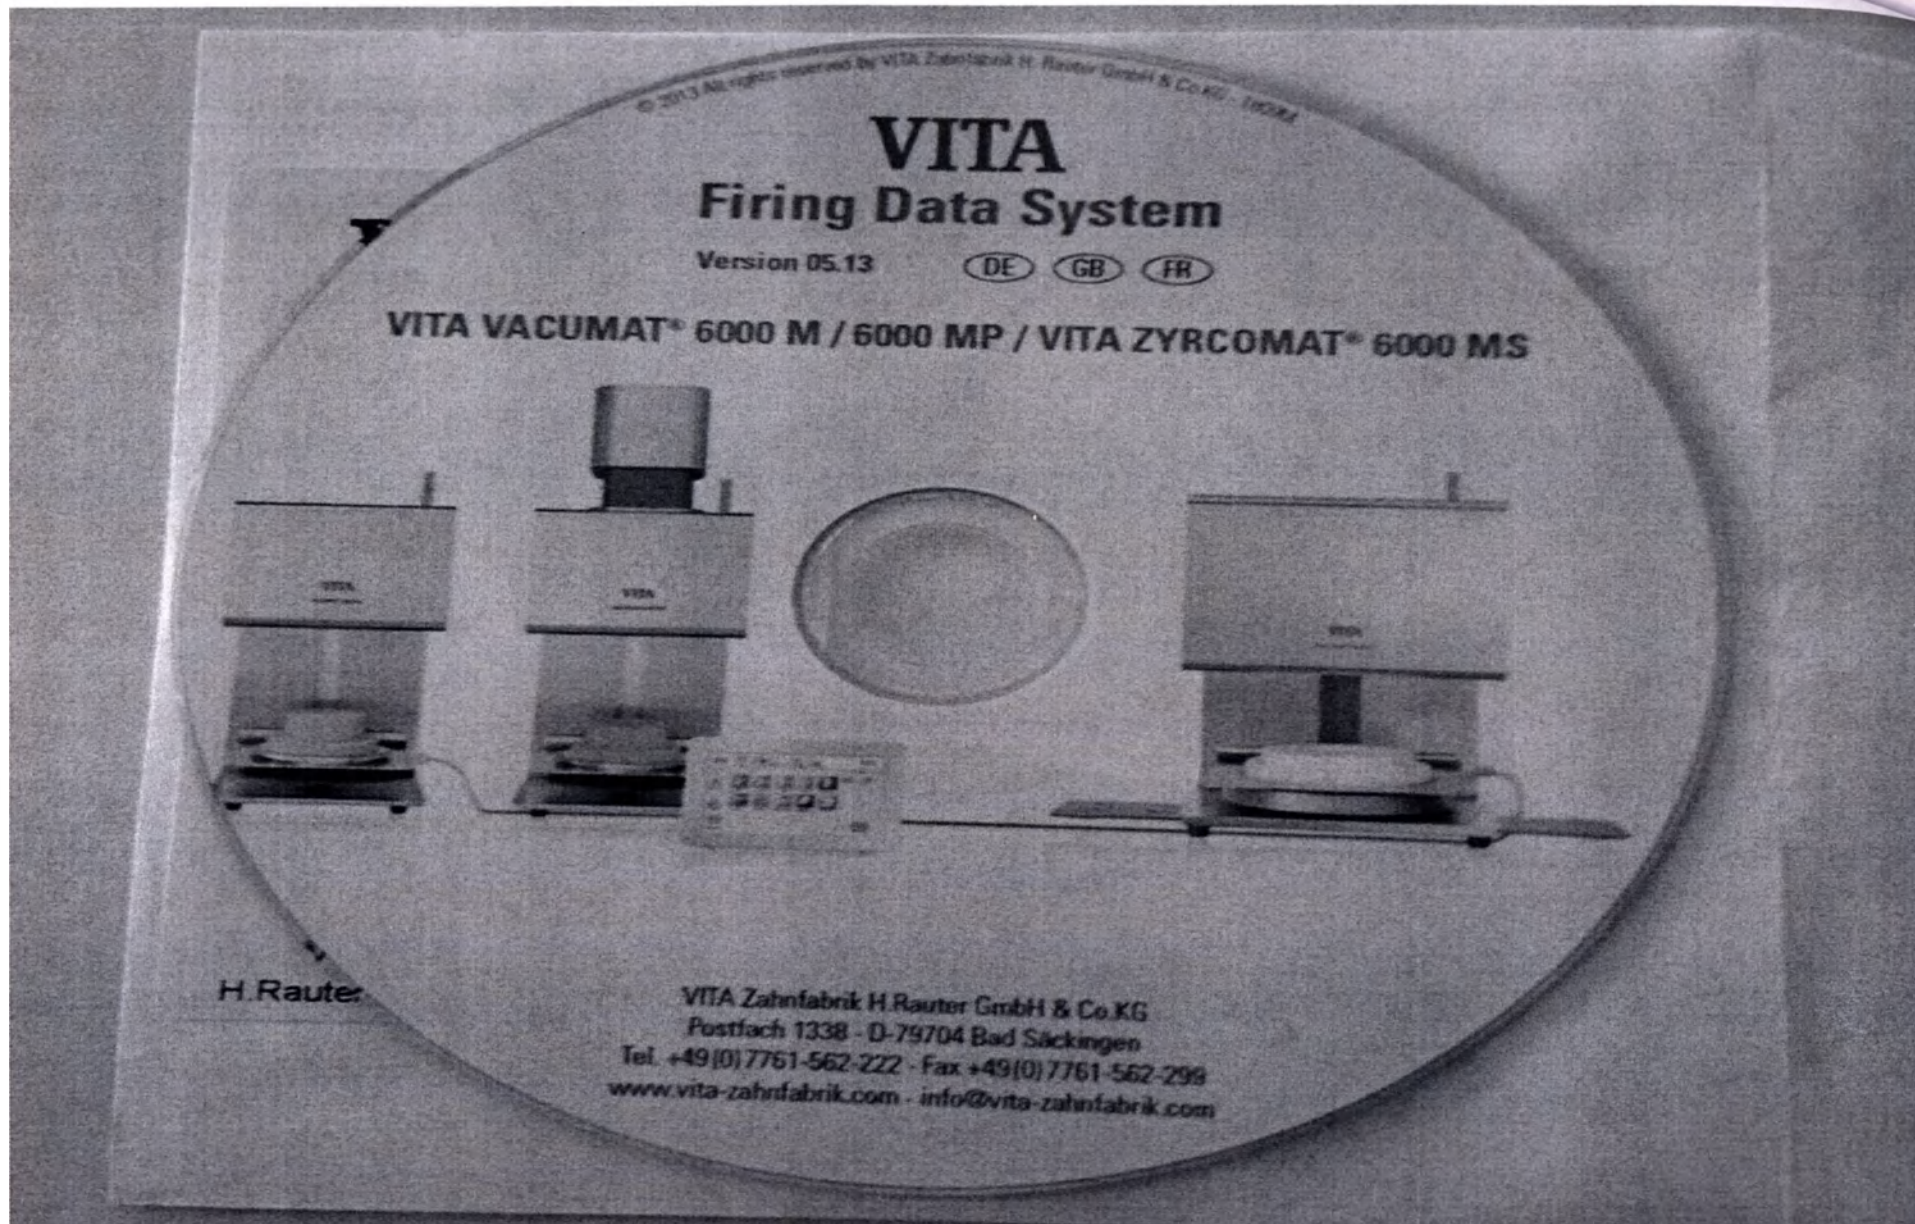

II. Принадлежности к изделию:
Рисунок 10 - Диск CD FDS (Firing-Data-System)

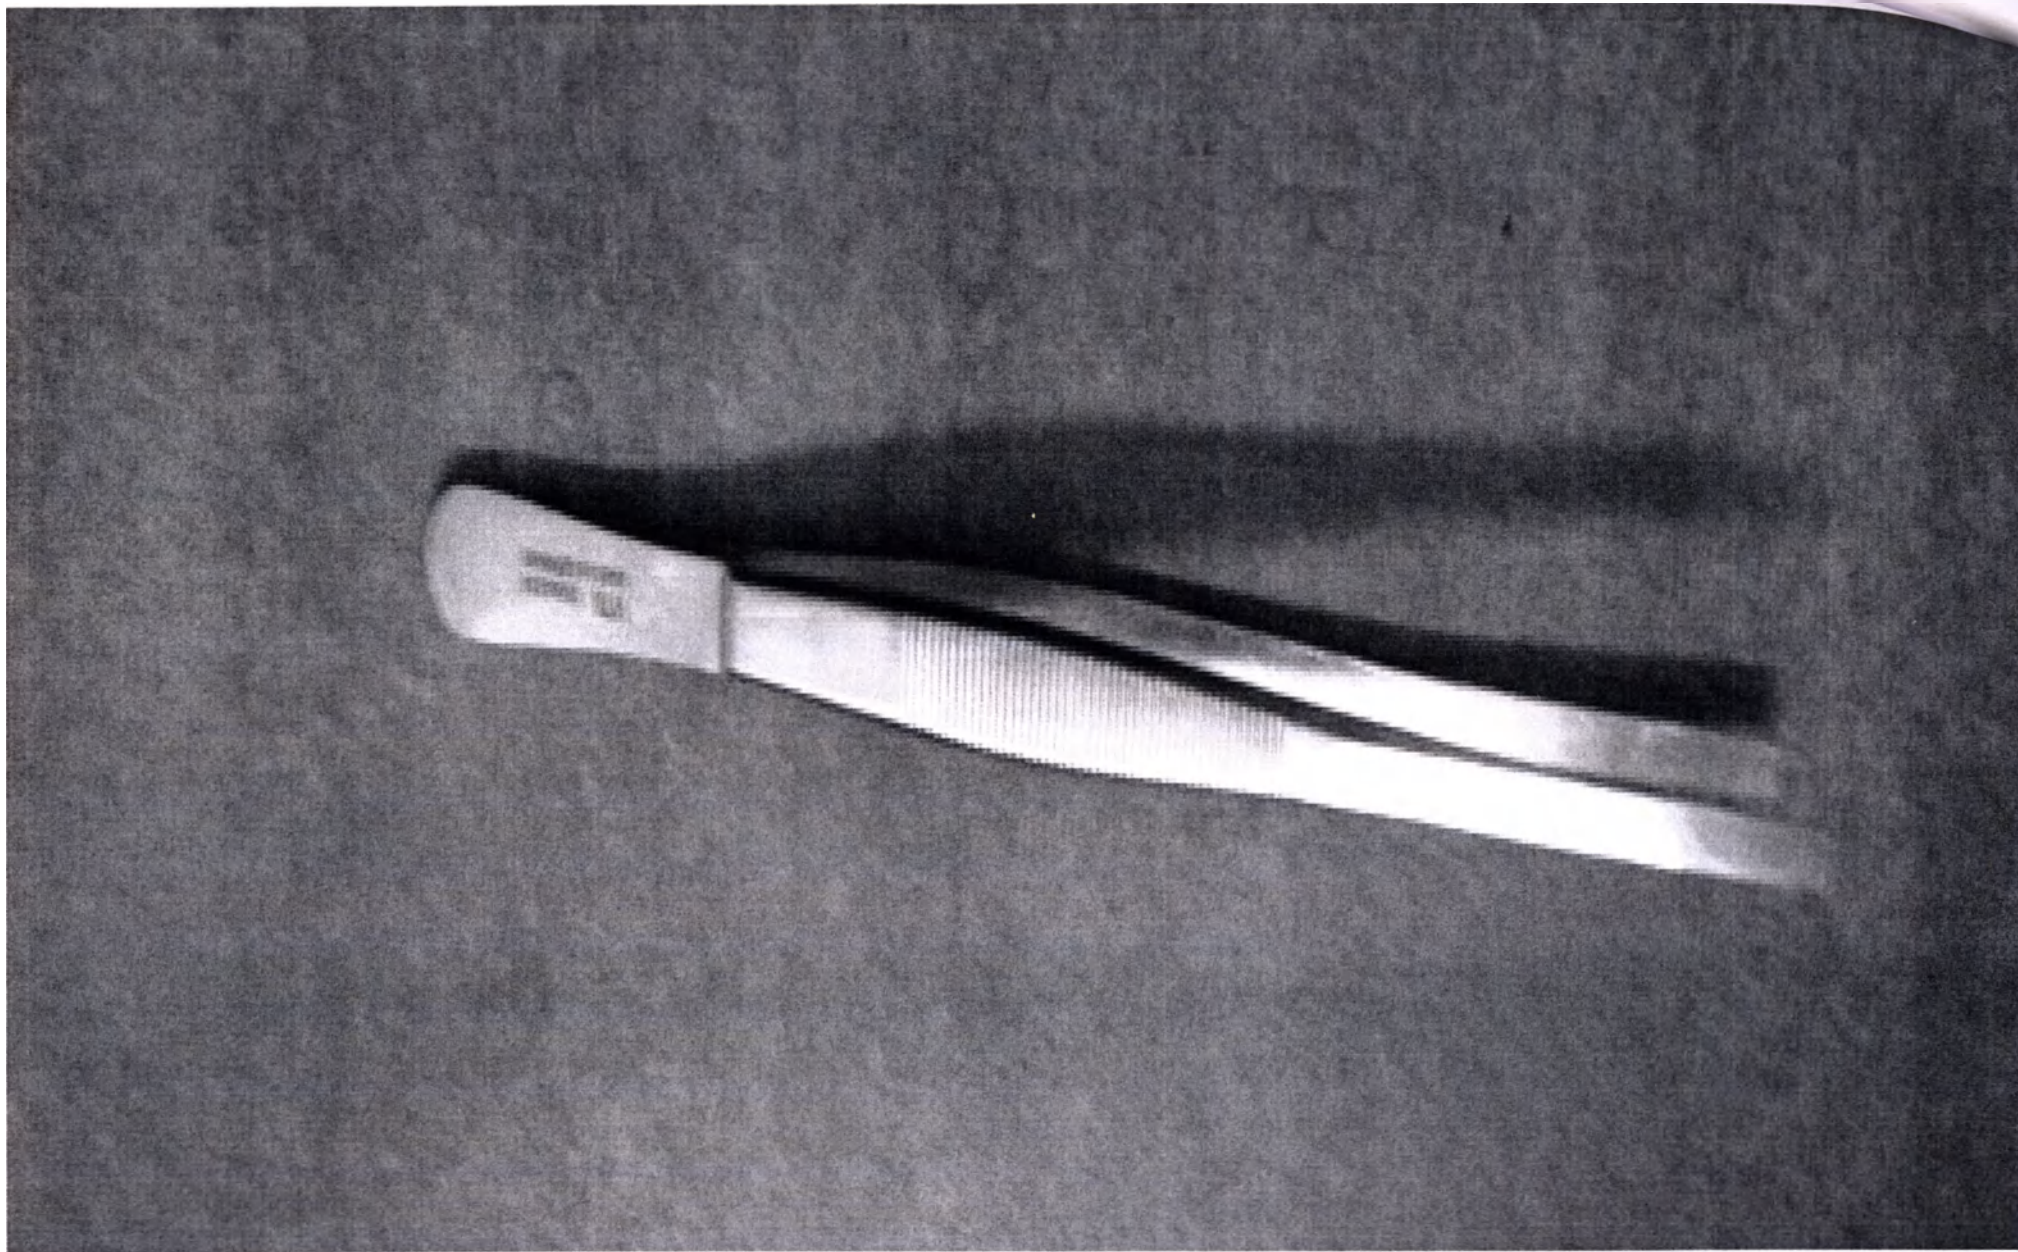


Рисунок 11 – Пинцет



Рисунок 12 - Обжиговые трегеры



Рисунок 13 - Вата огнеупорная

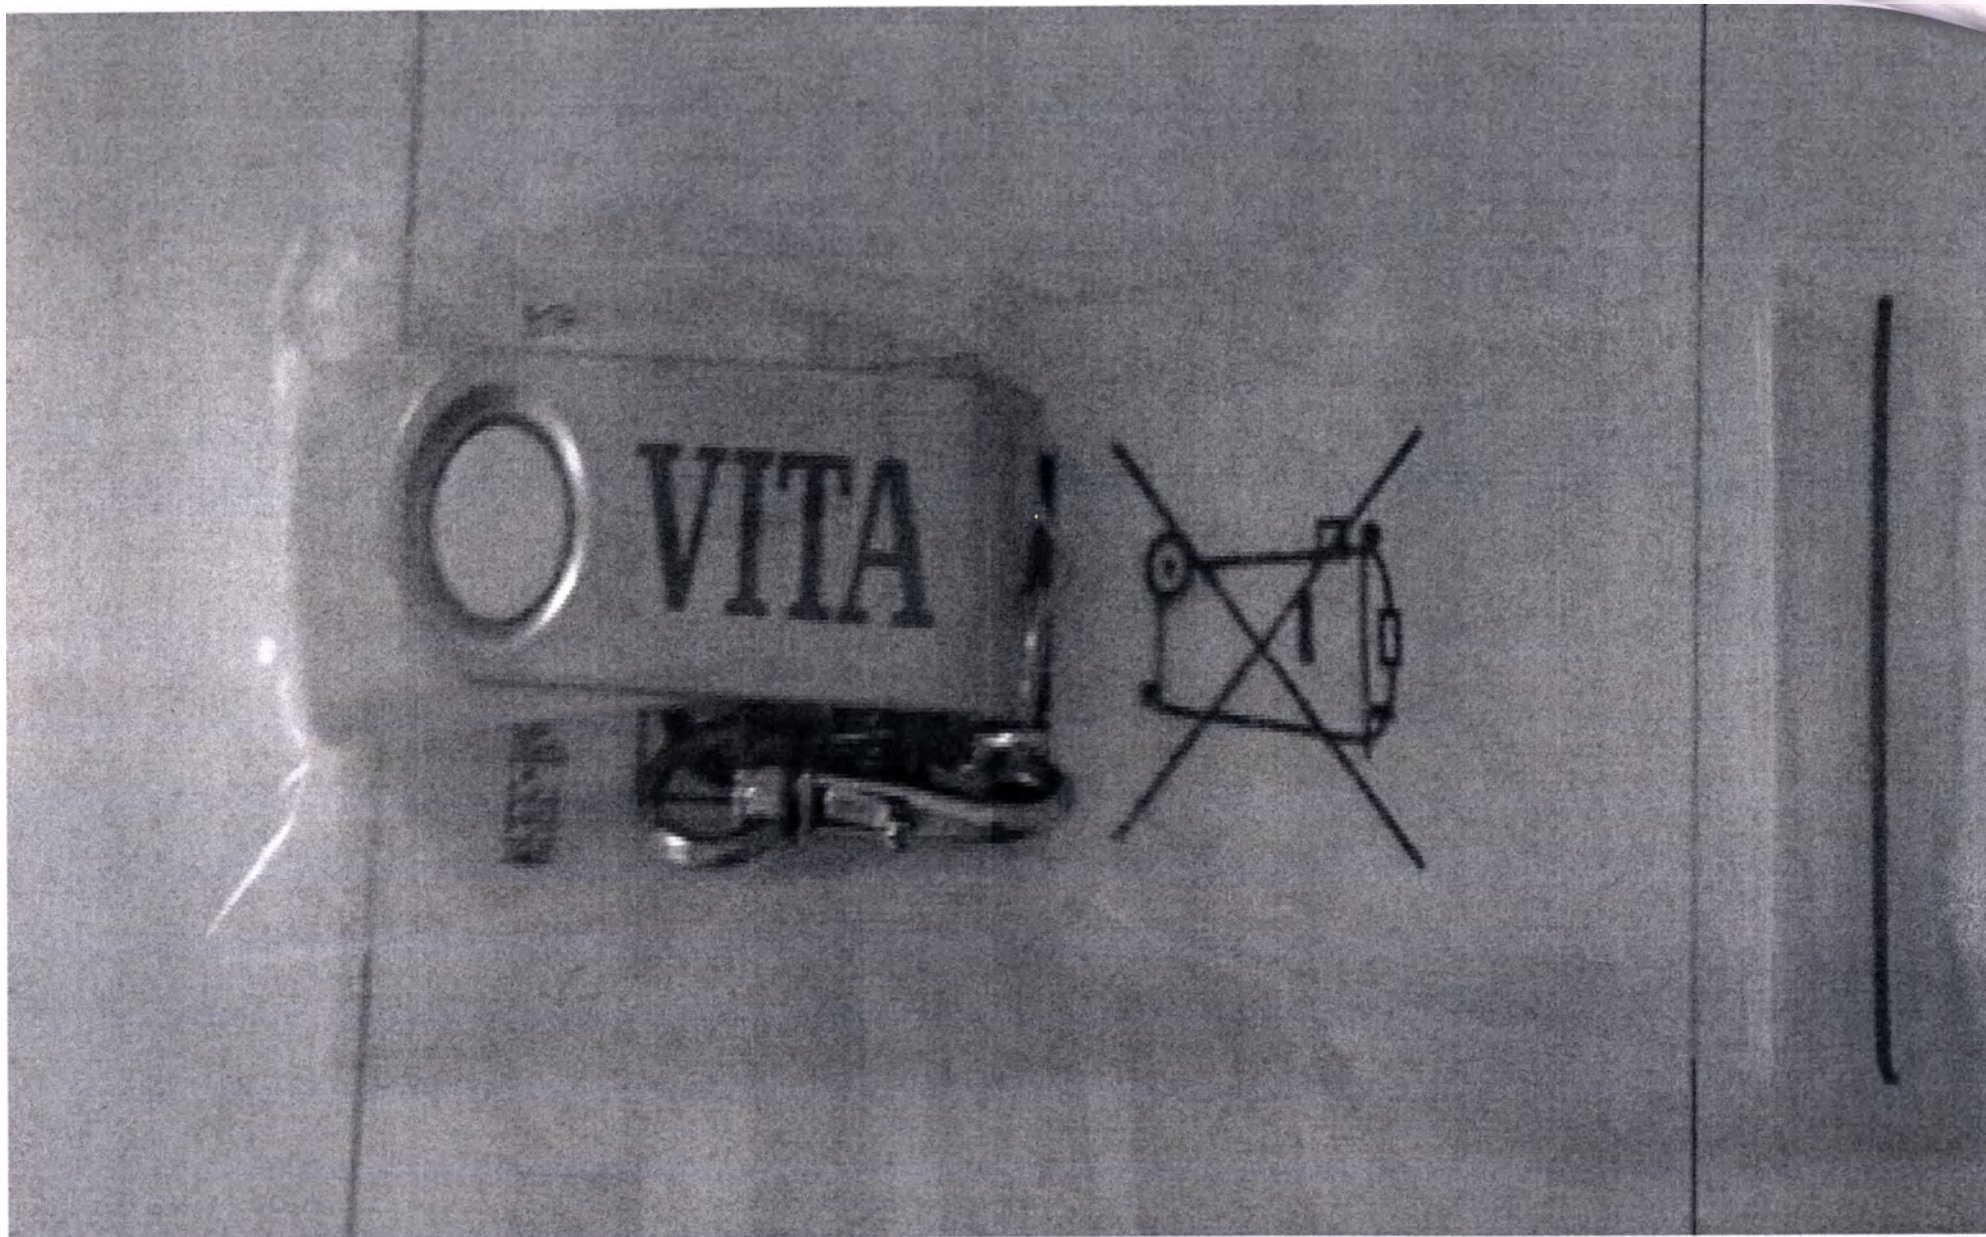


Рисунок 14 – Флешка установочная USB

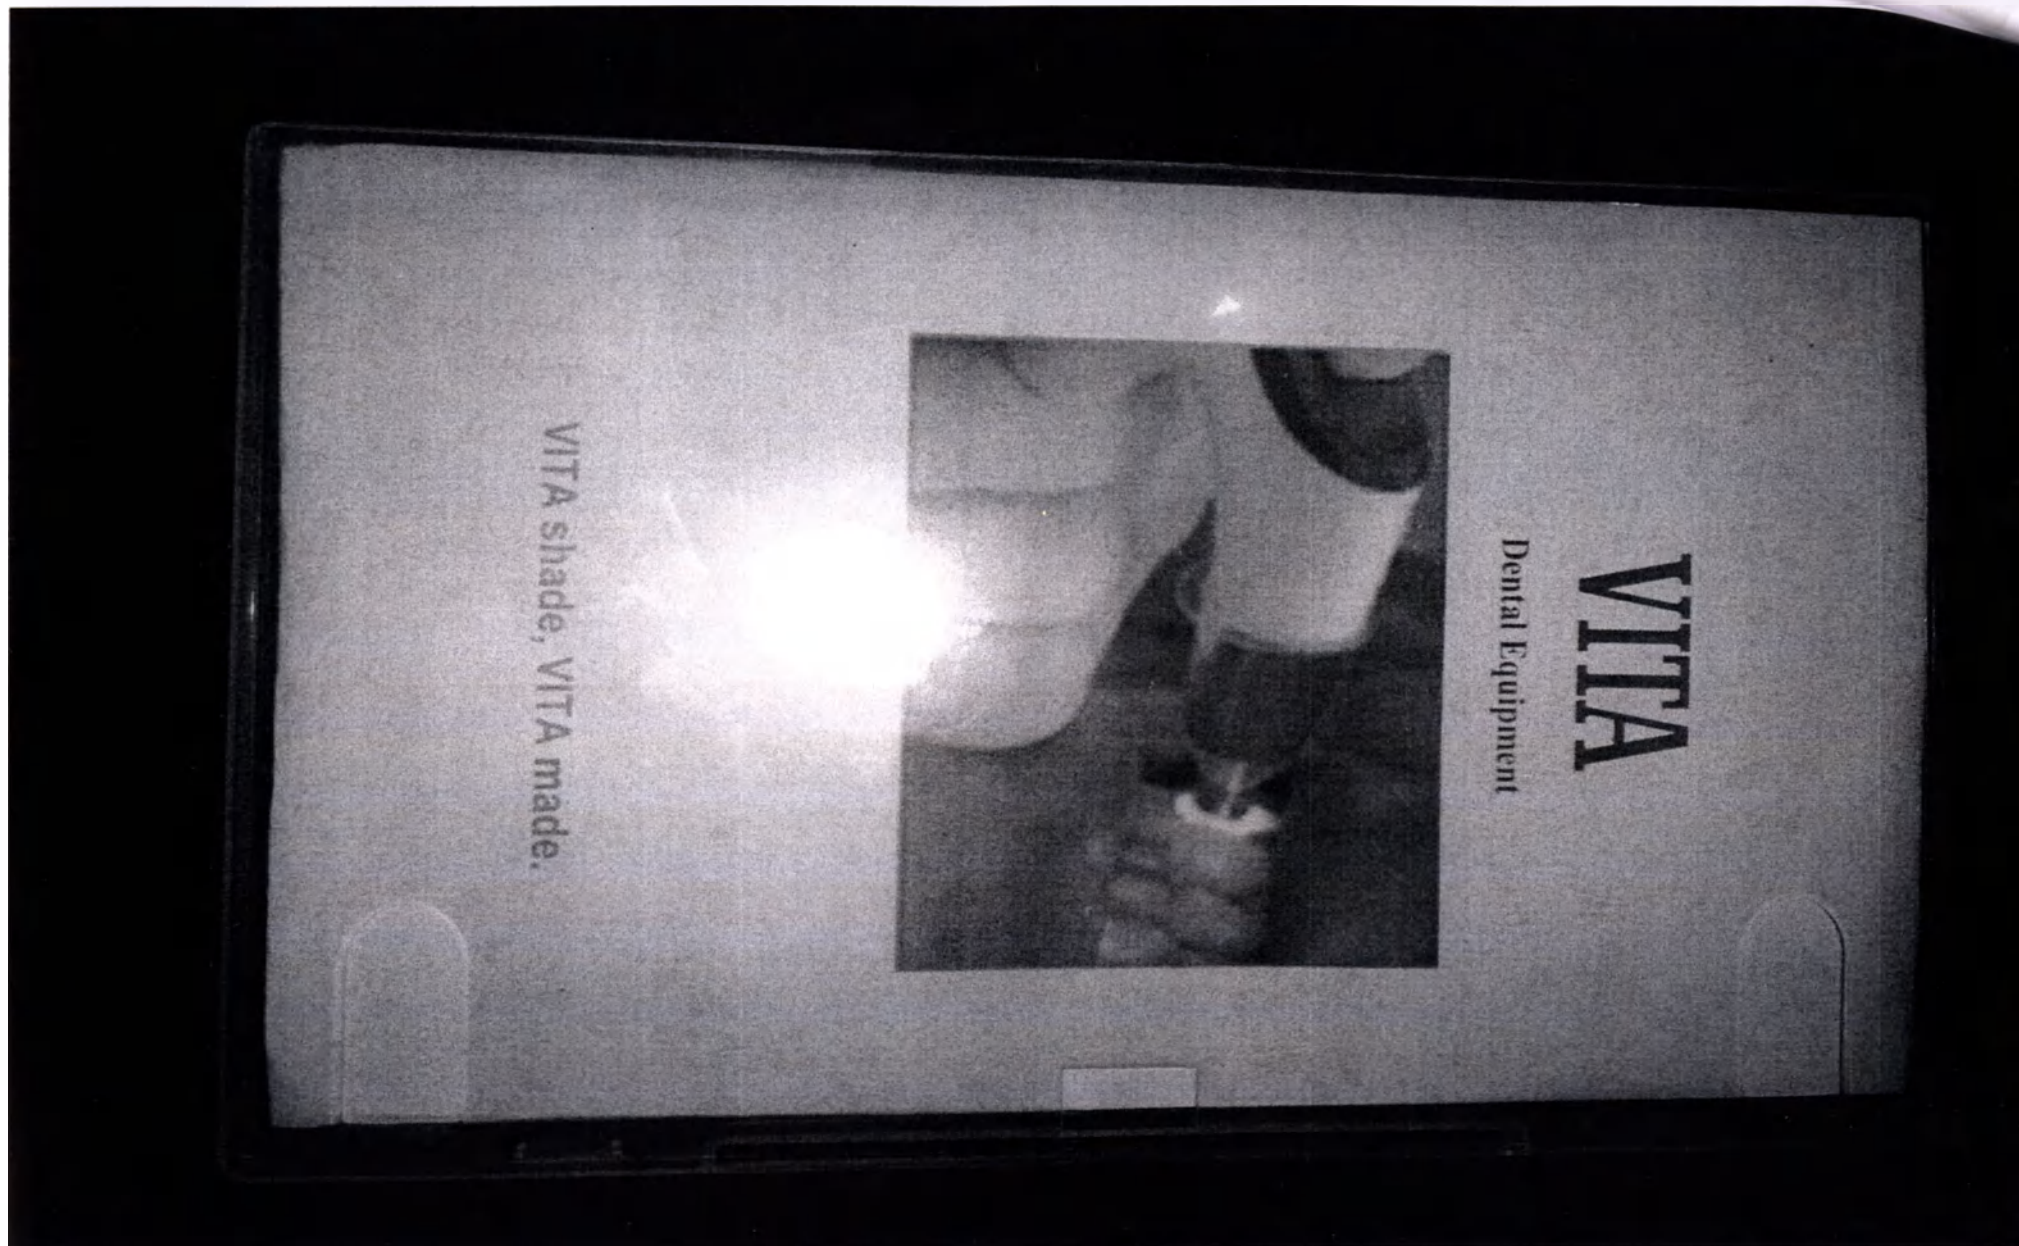


Рисунок 15 – Диск DVD VITA Dental Equipment

