

## Фотографические изображения

«Микроскоп сканирующий медико-биологический для лабораторных исследований Nanozoomer SQ C13140-21, с принадлежностями»

рис.1. Микроскоп сканирующий медико-биологический для лабораторных исследований Nanozoomer SQ C13140-21



Рис.2. Сетевой шнур



Рис.3. Соединительный кабель USB 3.0 A-  
B: 3м



Рис.4. Резервный предохранитель ТЗ.15  
А250В.



Рис.5. Объектив 20х/NA0.75: CFI Plan Apo Lambda 20х



Рис.6. Специальное калибровочное стекло

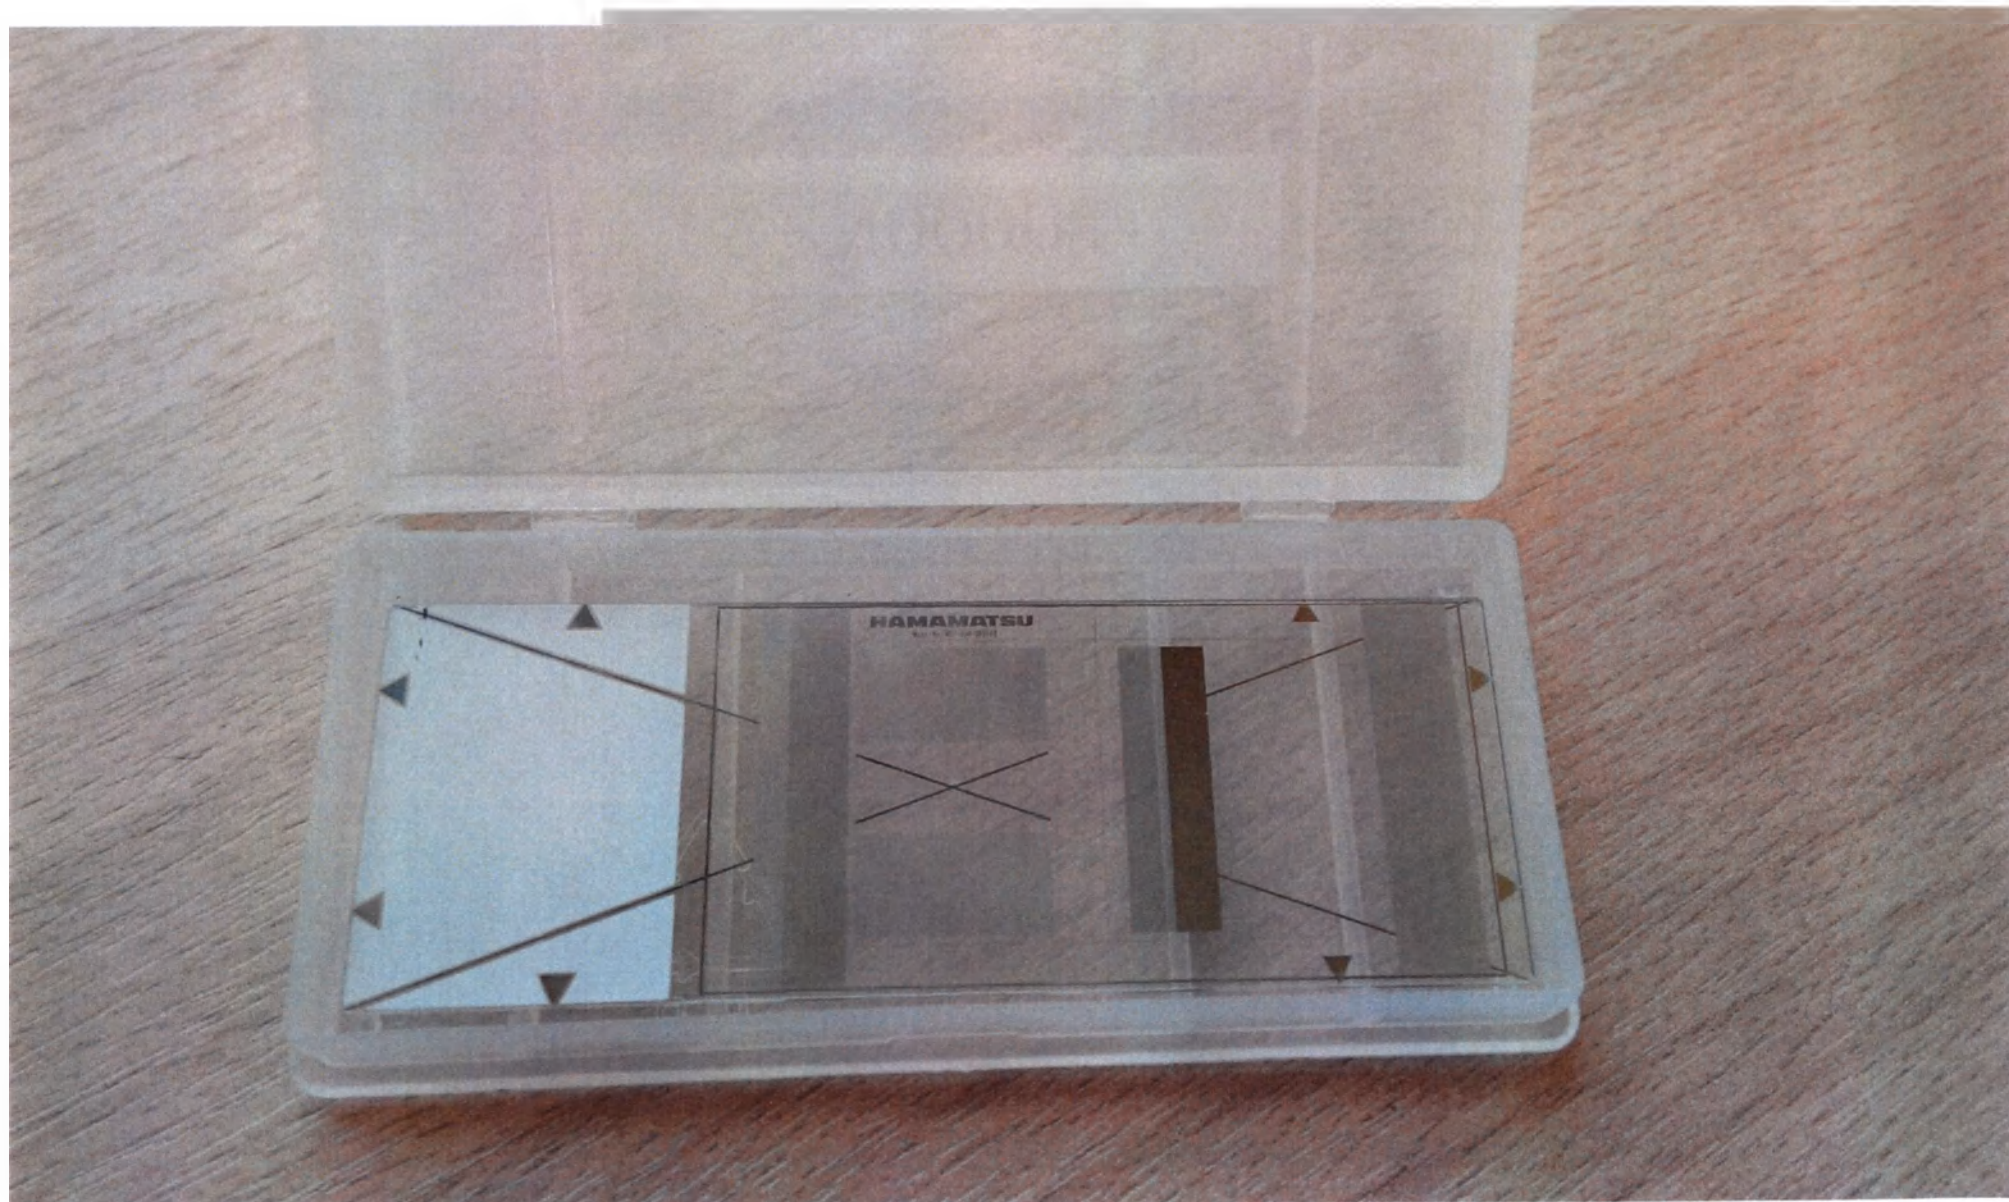


Рис.7. Руководство по эксплуатации  
устройства

Микроскоп сканирующий NanoZoomer-SQ  
C13140-21  
Руководство по эксплуатации

[Знак IVD (Медицинское изделие для диагностики in vitro)]  
[Знак соответствия нормам ЕС (CE)]

Благодарим за приобретение данного продукта.

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ВНИМАНИЕ</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Во избежание травм пользователя и порчи оборудования при использовании системы необходимо соблюдать меры предосторожности, приведенные в Главе 1. Данное Руководство описывает правильный метод работы с системой и содержит предупреждения, следуя которым можно избежать несчастных случаев. Перед использованием системы внимательно ознакомьтесь с данным Руководством.</li><li>• После изучения храните Руководство в доступном месте для последующего обращения.</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

/подпись/  
[Подпись от руки:  
Макс Скуглунд  
Генеральный директор]

[Печать компании «Хамаматсу Фотоникс Нурден Акциебулаг»]

Вер. 1.0 Ред.3  
Январь 2016 г.  
«ХАМАМАТСУ ФОТНИКС К.К.» (HAMAMATSU PHOTONICS K.K.)

A1100301-02

Рис.8. Установочный диск U10074-22  
NDP Scan.

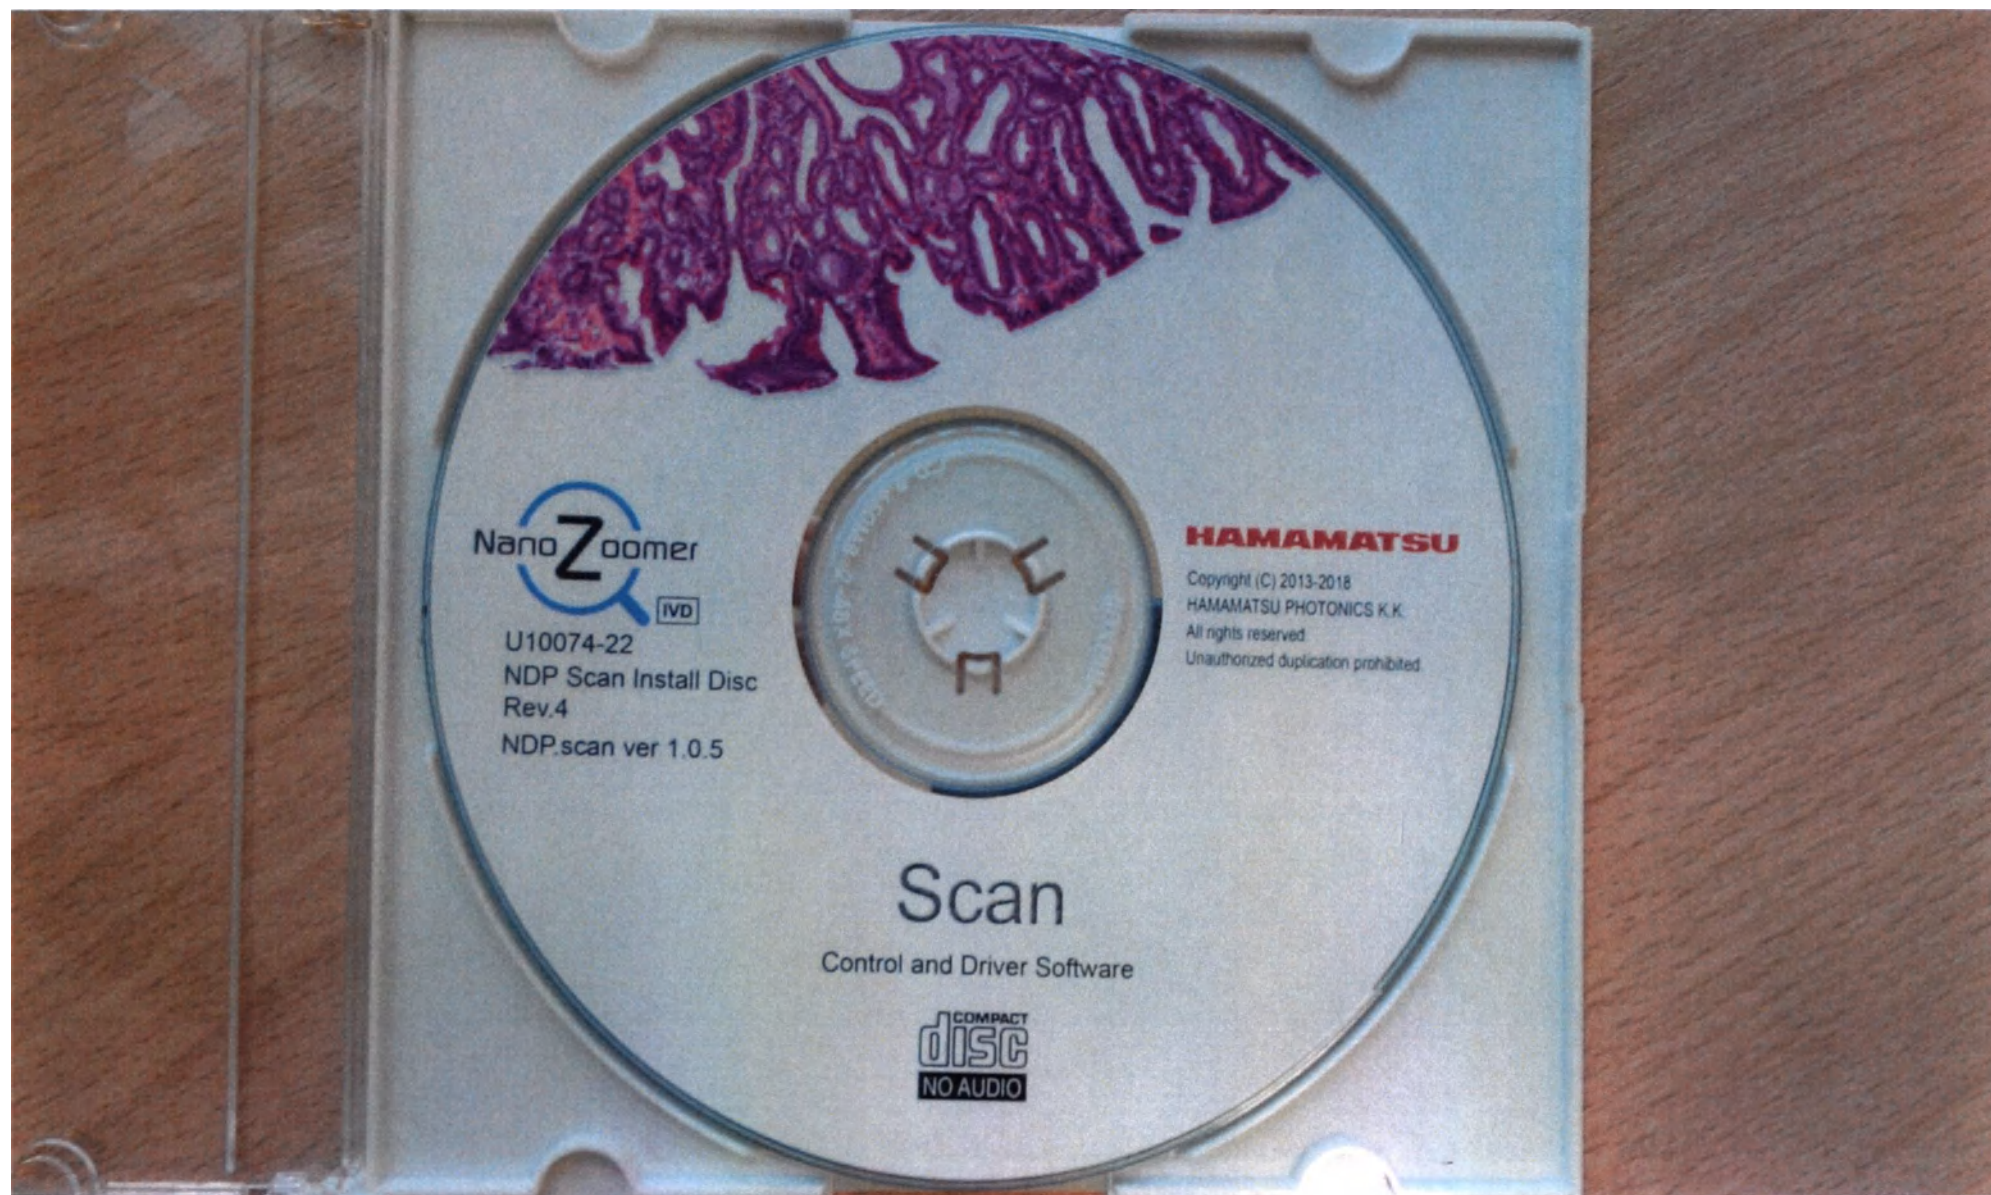


Рис.9. Установочный диск U12388-21  
NDP.view2.

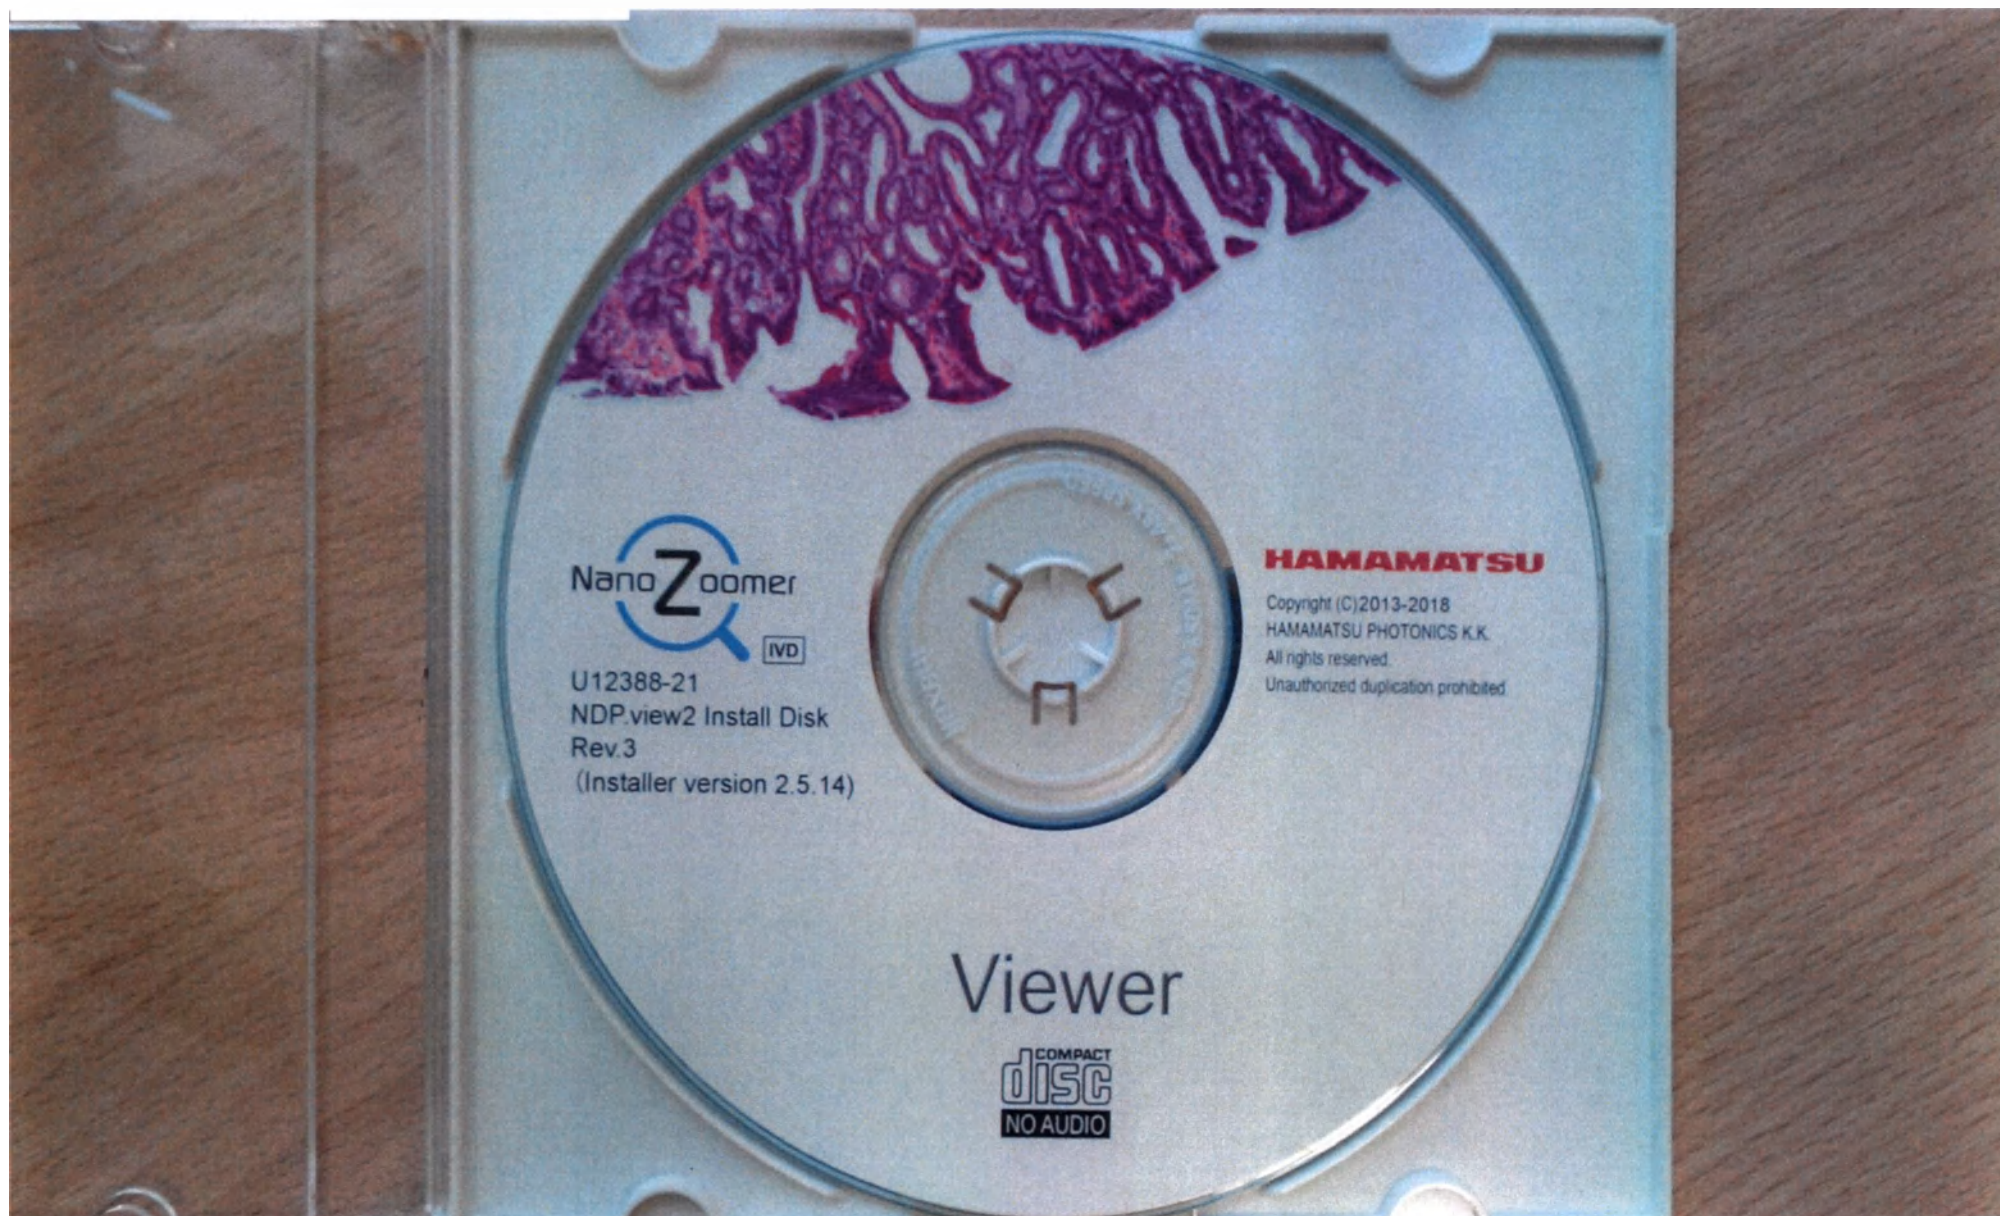


Рис.10. Установочный диск U10074-23  
VMS Auto Copy


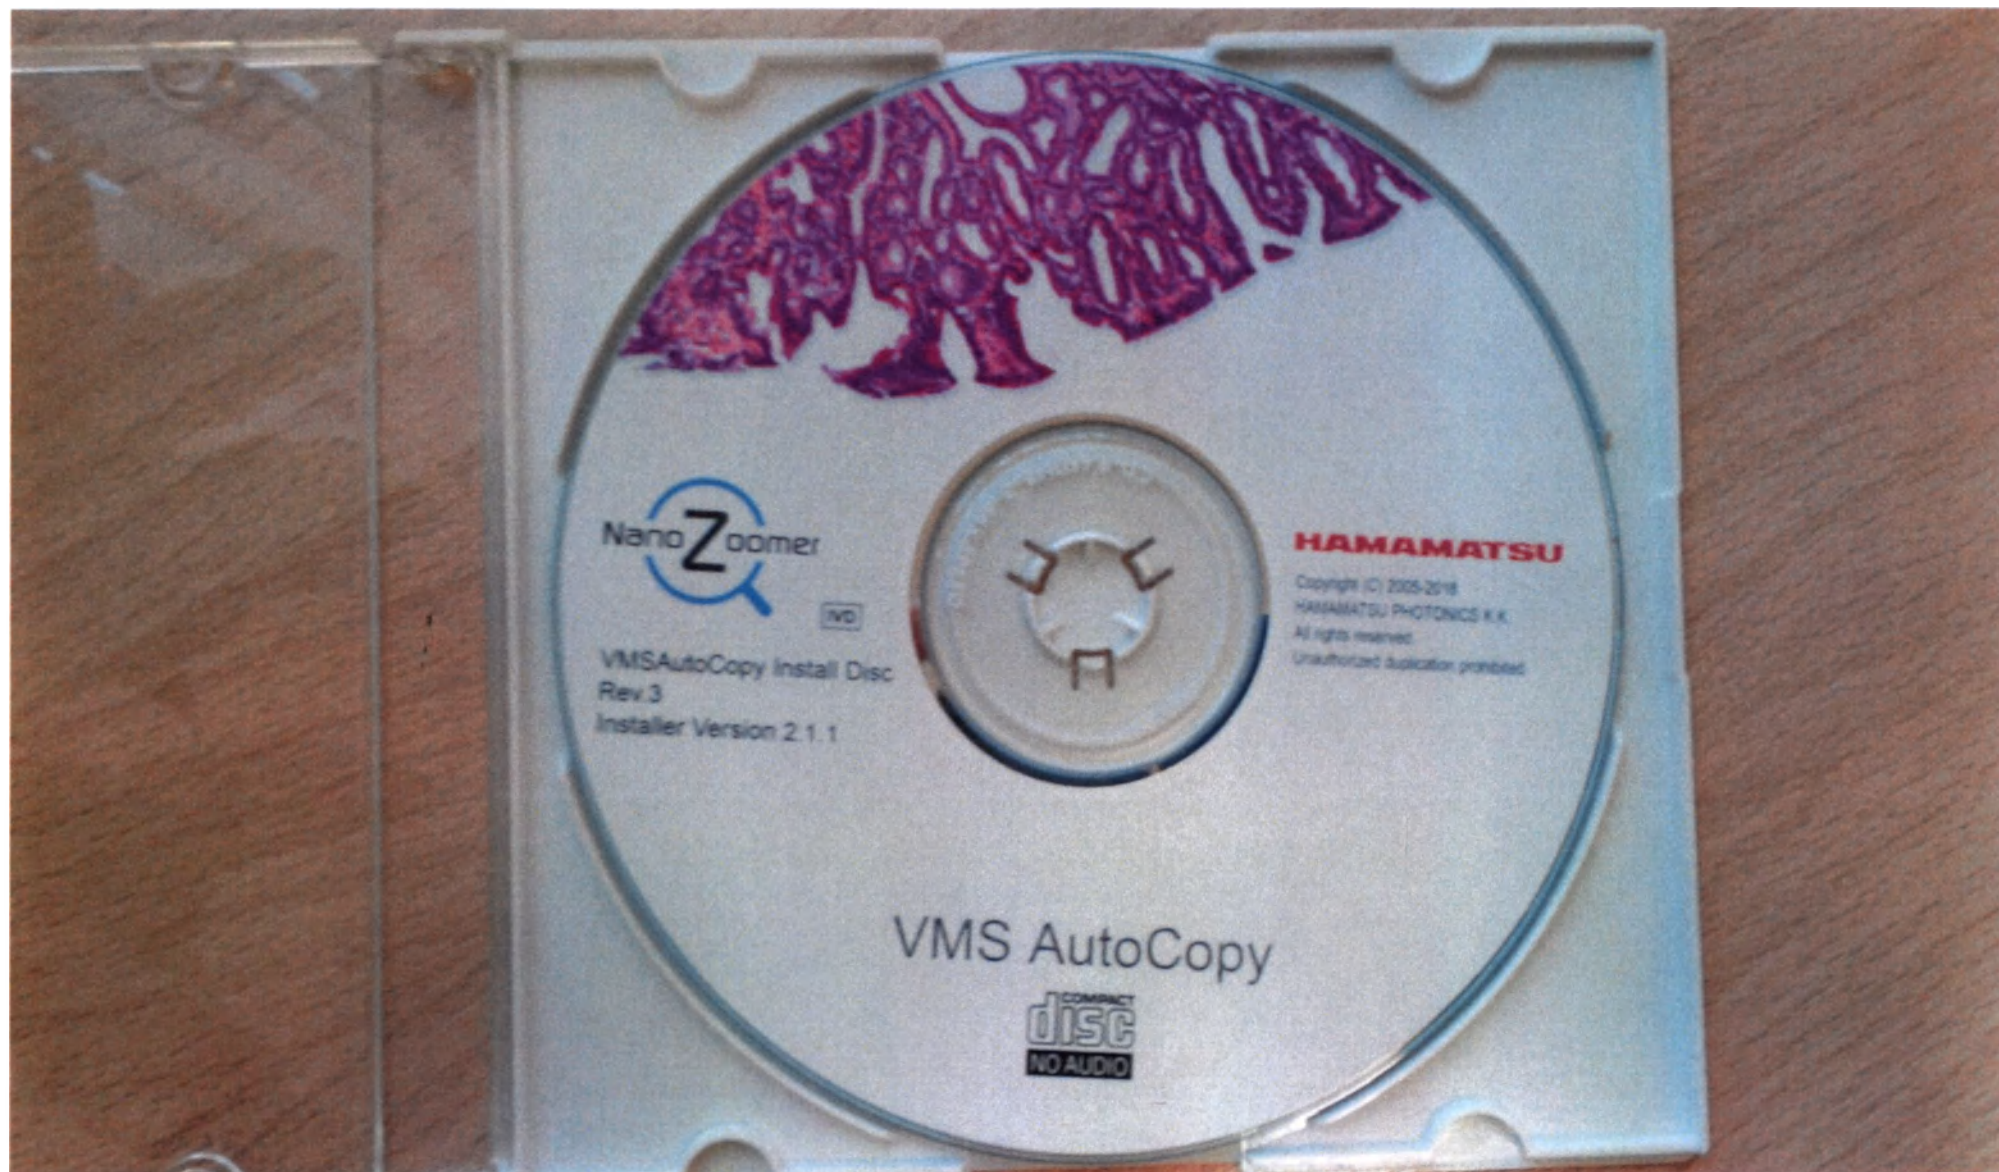


Рис.11. Диск с резервными параметрами



ПРОШУ  
В КОЛИЧЕСТВЕ 12 ЛИСТОВ  
«09» декабря 20 16 год  
Генеральный директор  
ООО «БиоВитрум»  
Цимберг В.В.

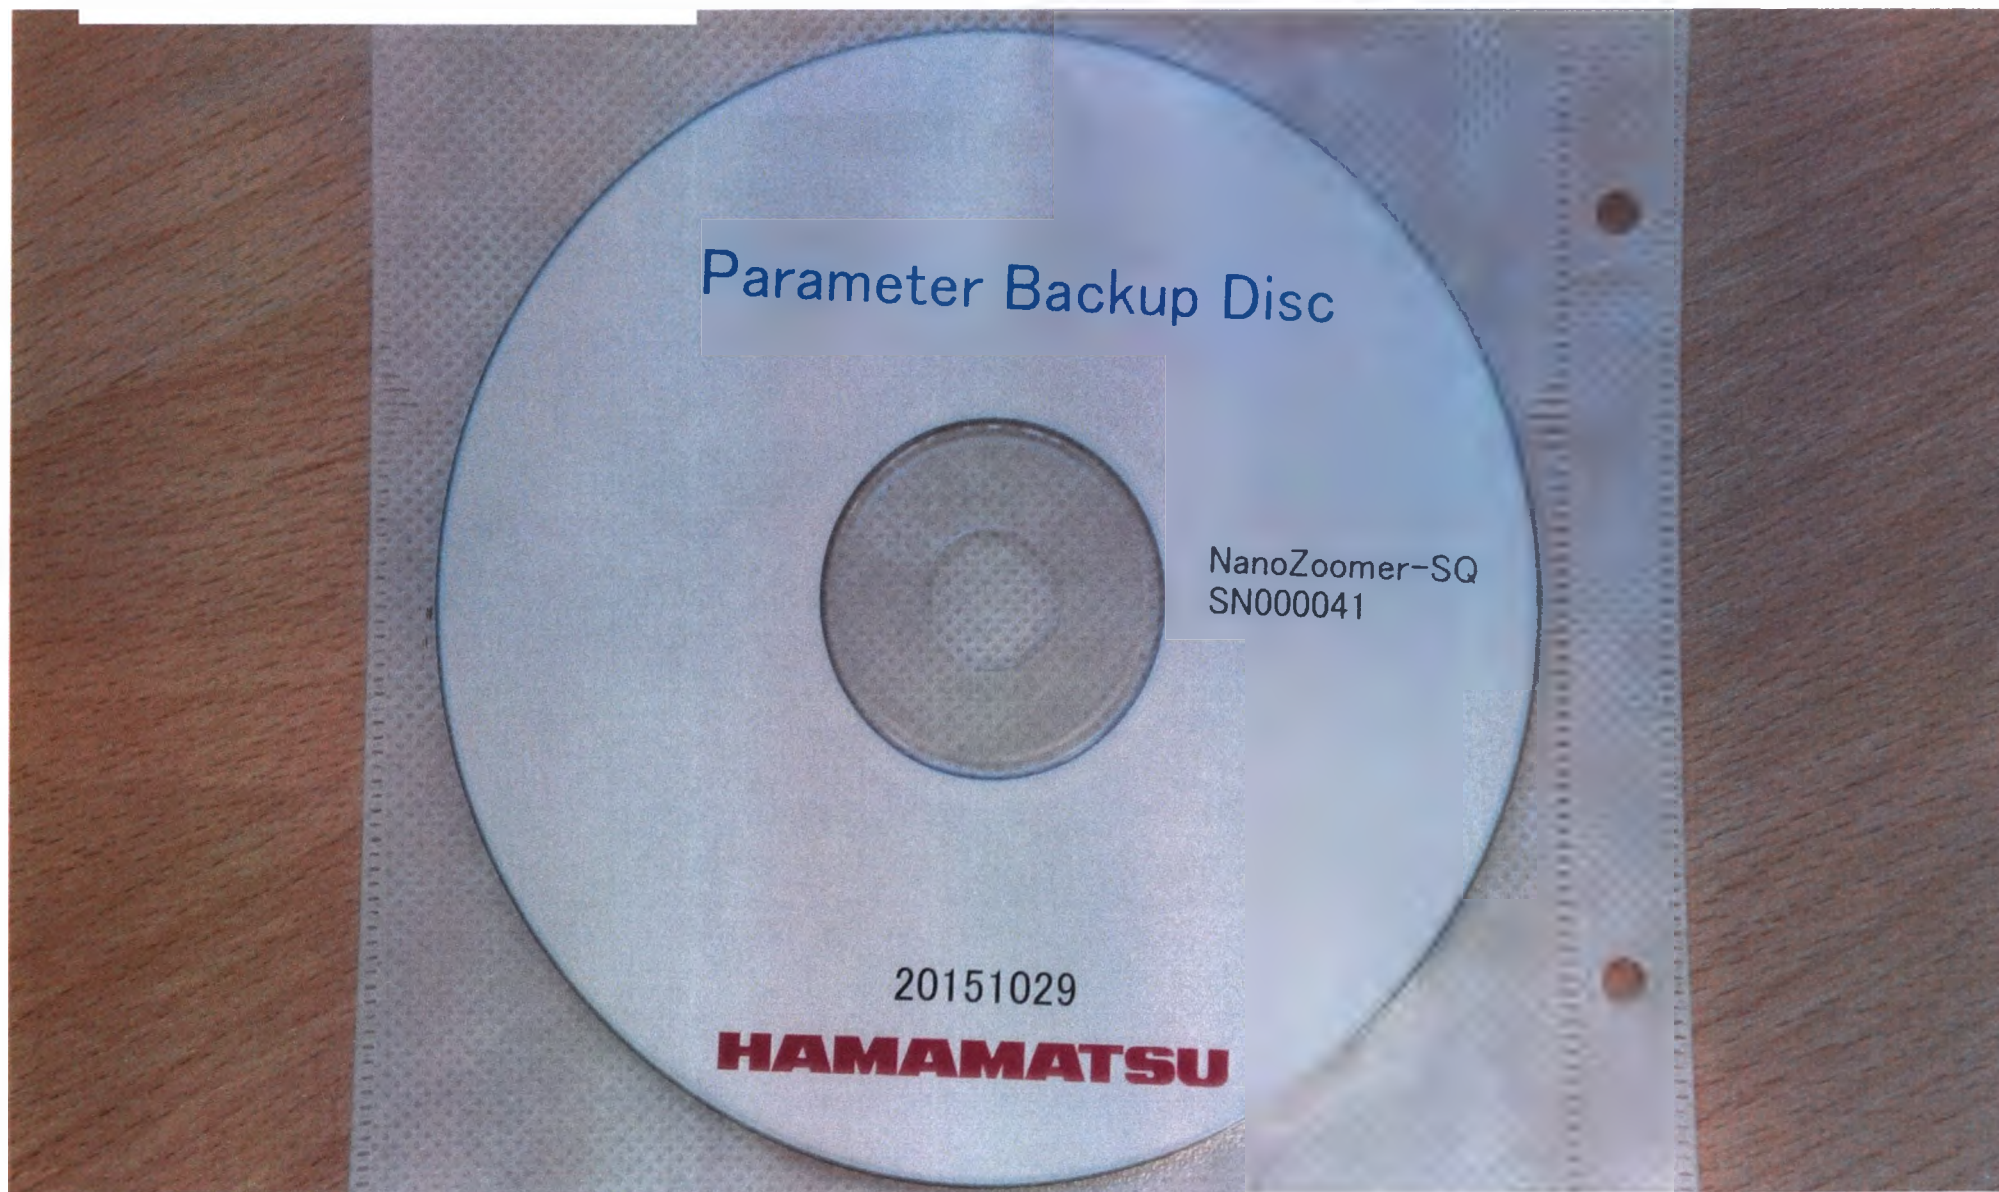