


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС (комплект 1))»


Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
« 04 » 2019 г.



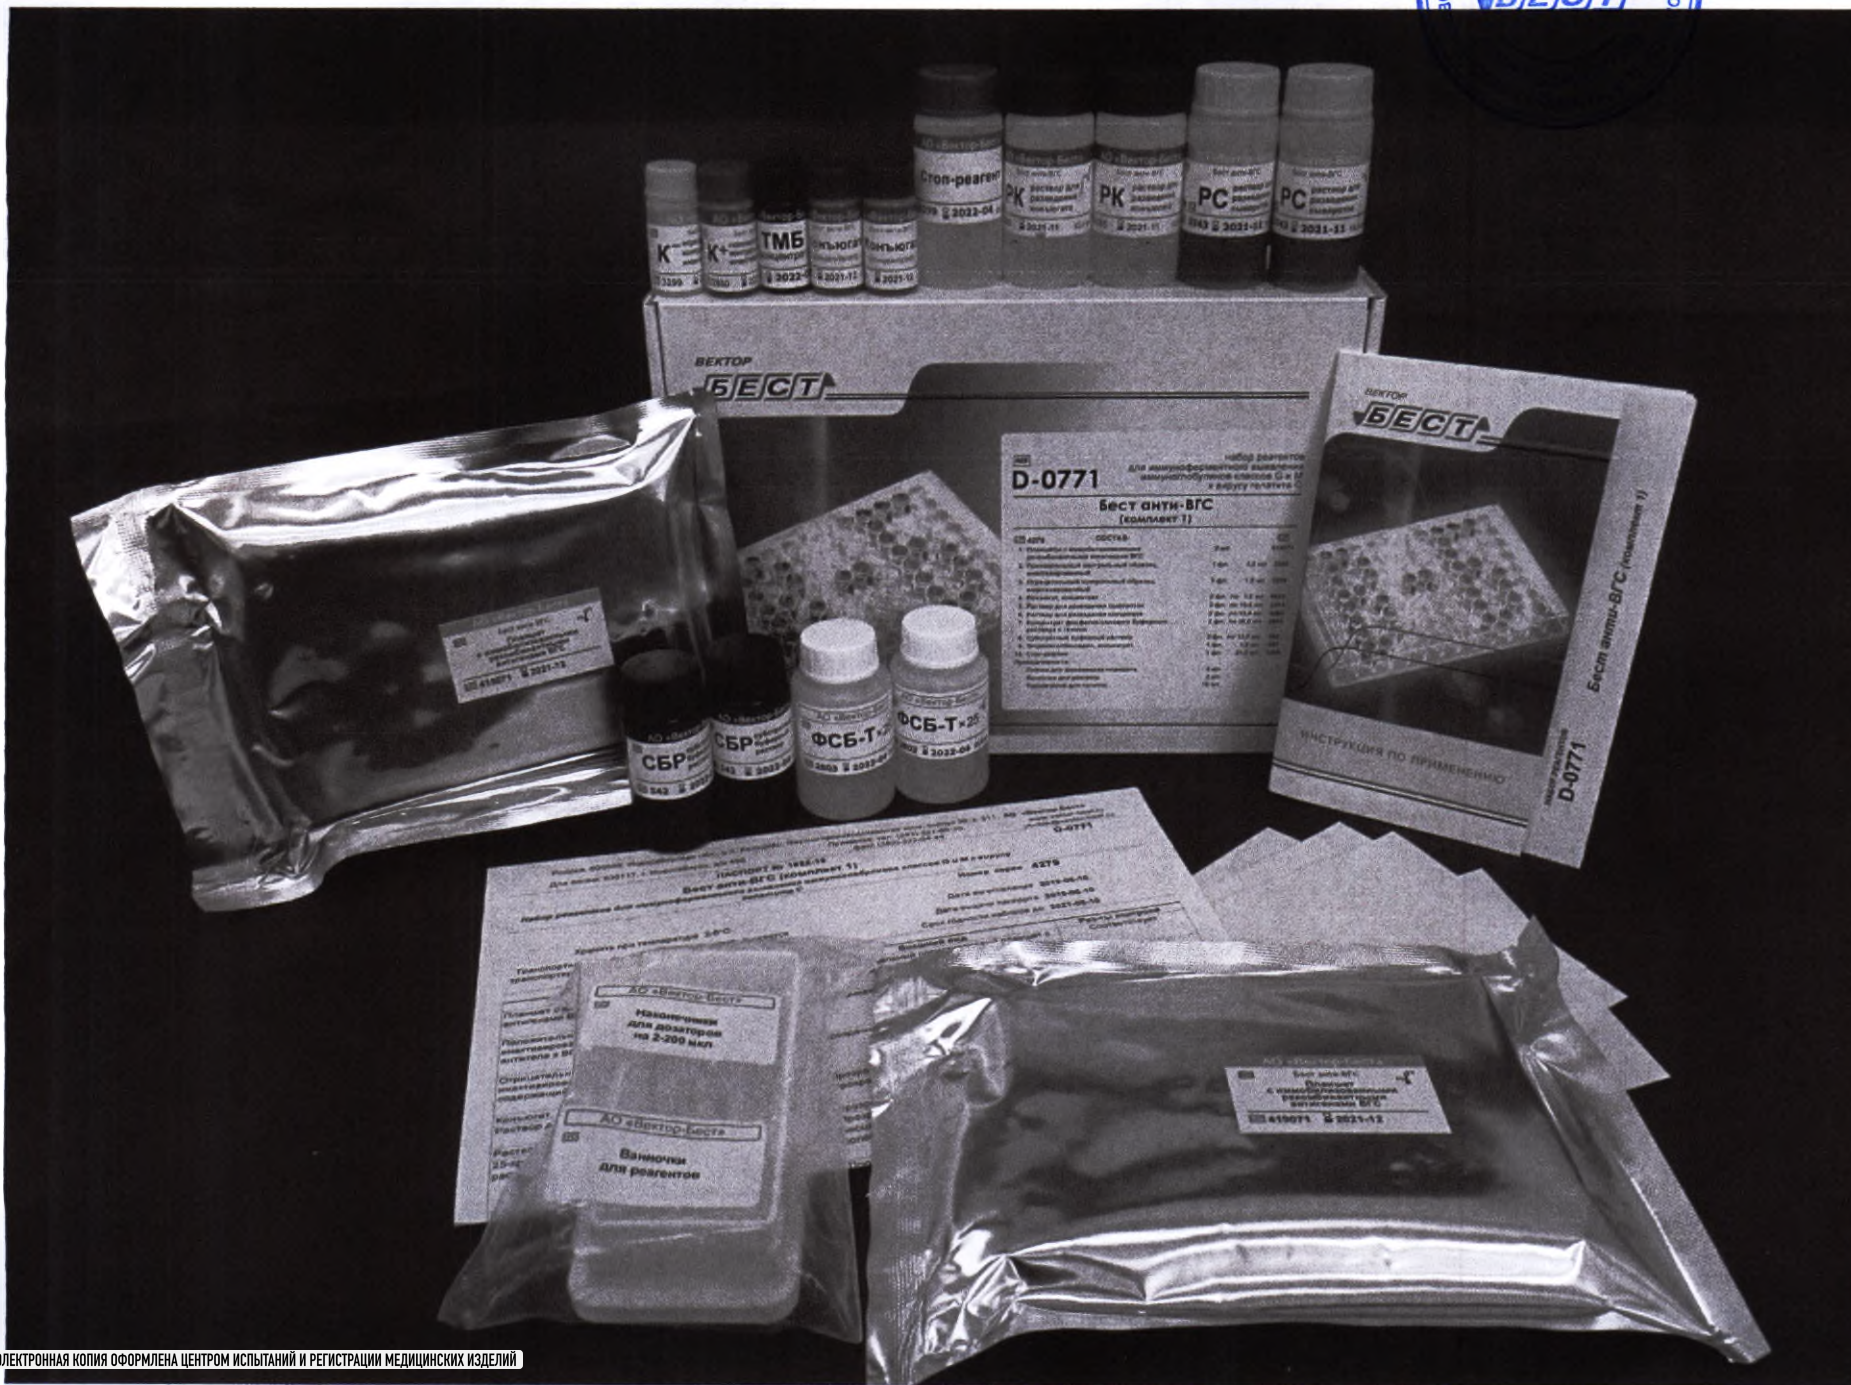

ВЕКТОР

БЕСТ

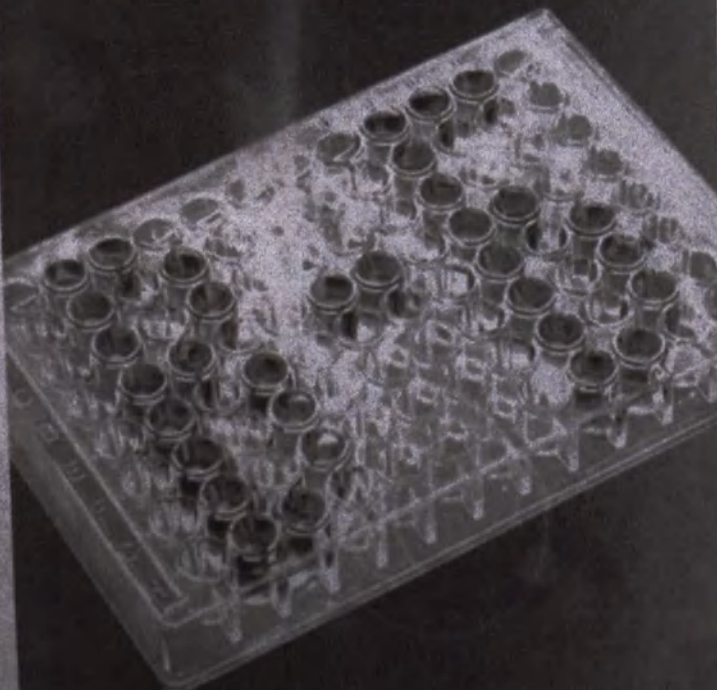

REF

D-0771

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов классов G и M
к вирусу гепатита С

Бест анти-ВГС
(комплект 1)

LOT 4279

СОСТАВ:

	2 шт.	419071
1. Планшеты с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС	2 шт.	419071
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,0 мл	3930
3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,0 мл	3299
4. Конъюгат, концентрат	2 фл. по 1,5 мл	9625
5. Раствор для разведения сывороток	2 фл. по 10,0 мл	2343
6. Раствор для разведения конъюгата	2 фл. по 13,0 мл	4285
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл. по 28,0 мл	2803
8. Субстратный буферный раствор	2 фл. по 13,0 мл	542
9. Тетраметилбензидин, концентрат	1 фл. 1,5 мл	497
10. Стоп-реагент	1 фл. 21,0 мл	1299

Принадлежности:


Плёнка для заклеивания планшета	4 шт.
Ванночки для реагента	2 шт.
Наконечники для пипеток	16 шт.

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС (комплект 1))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»




Хусаинов М.Д.
«04» 2019 г.

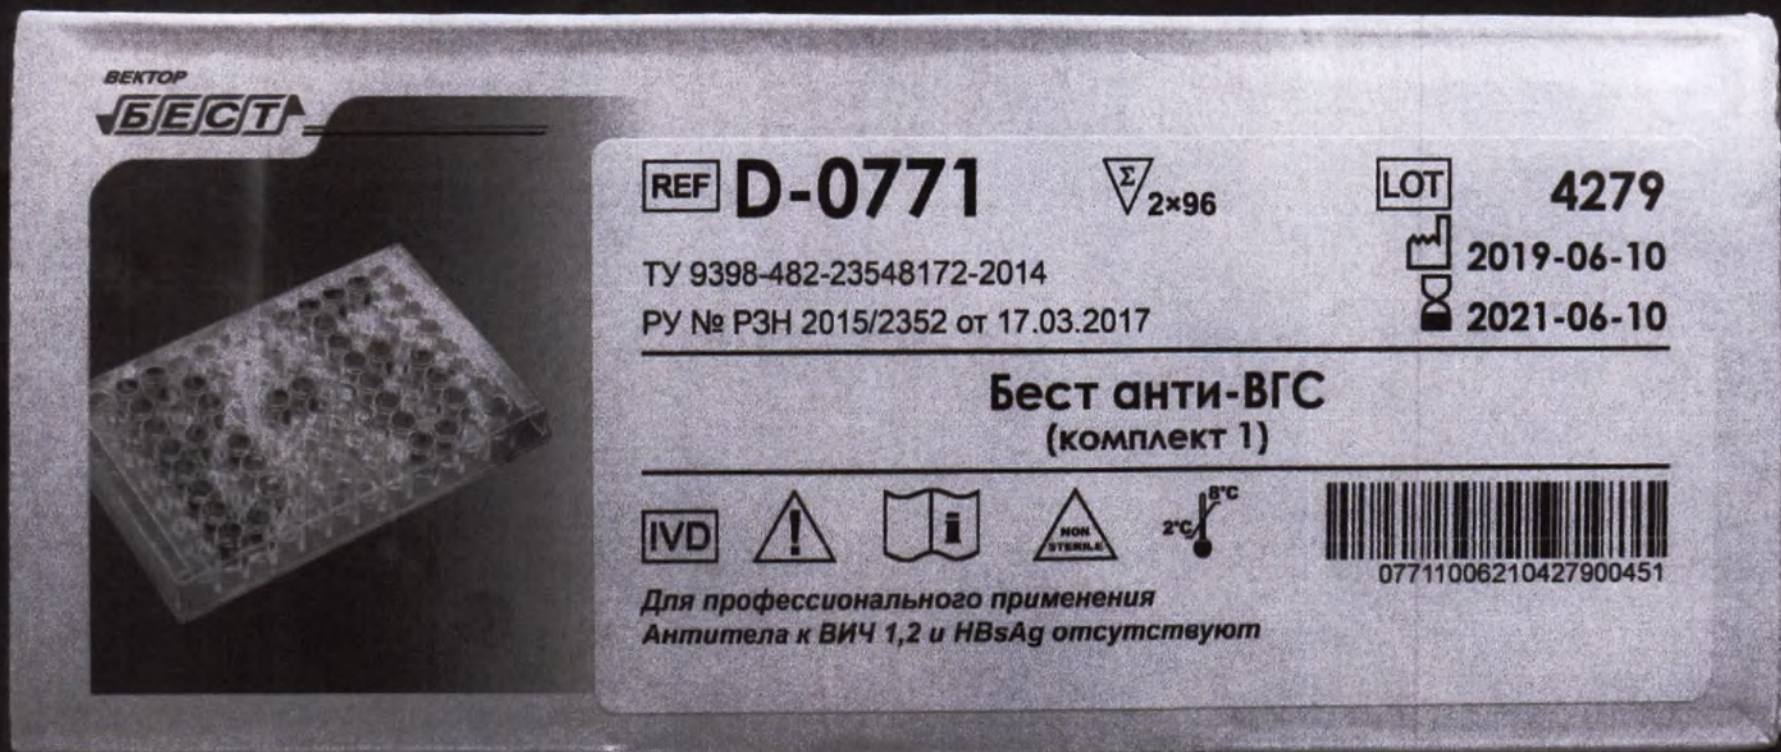

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС (комплект 1))» № 1

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» 14.07.2019 г.

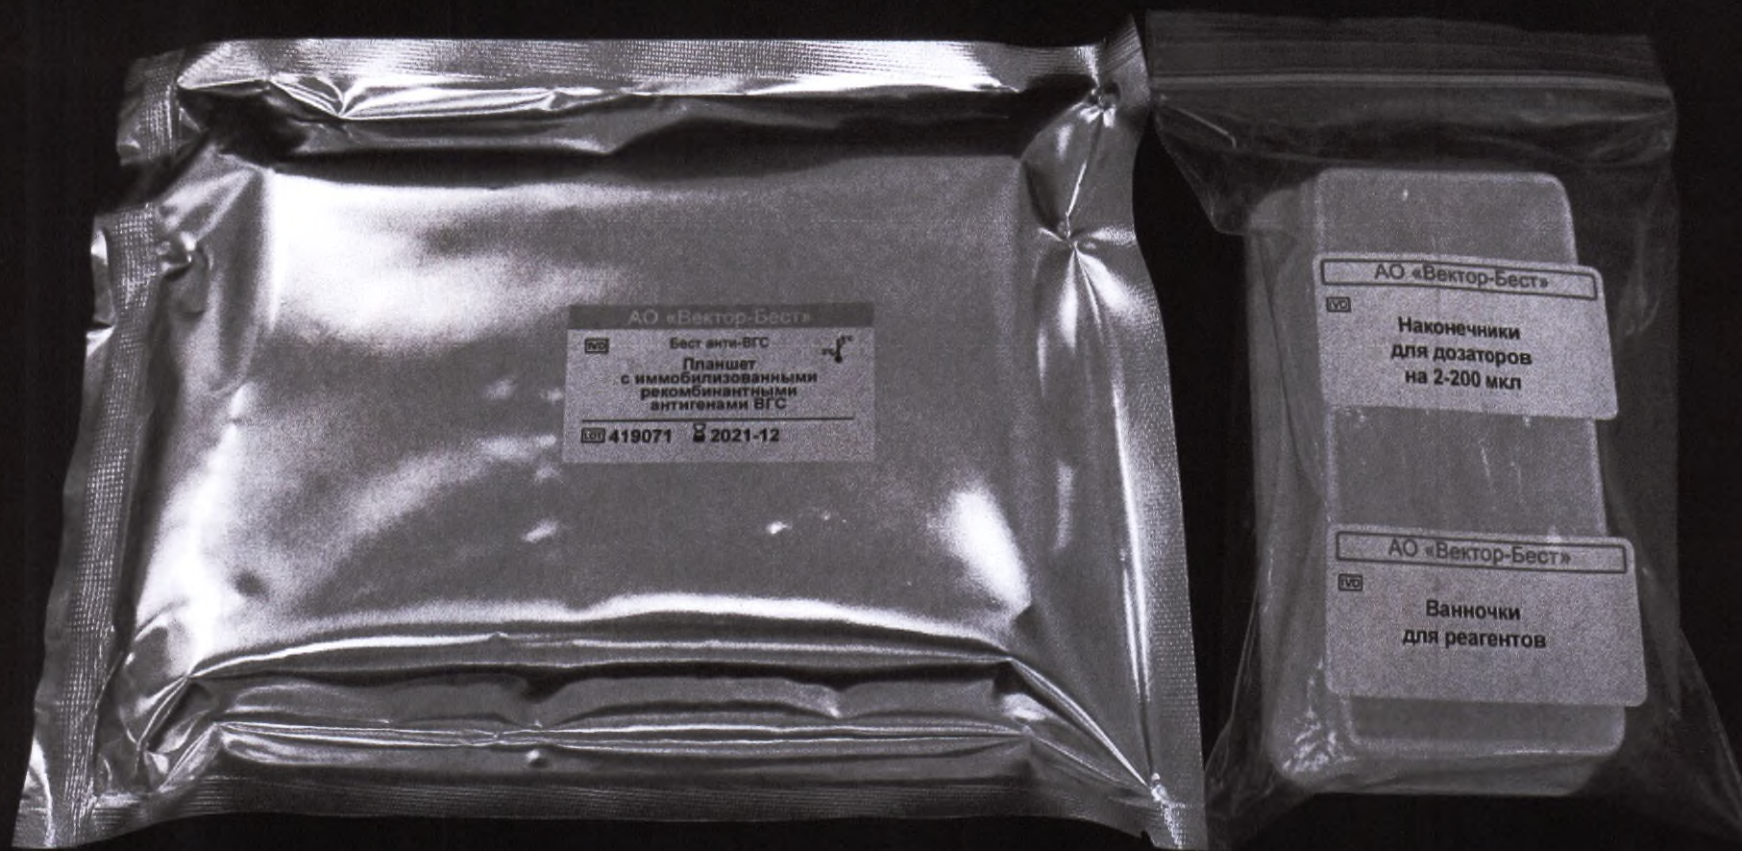

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС (комплект 1))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

« 4 » 10 2019 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС (комплект 1))» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.


«11» 02 2019 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС (комплект 1))» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
2019 г.

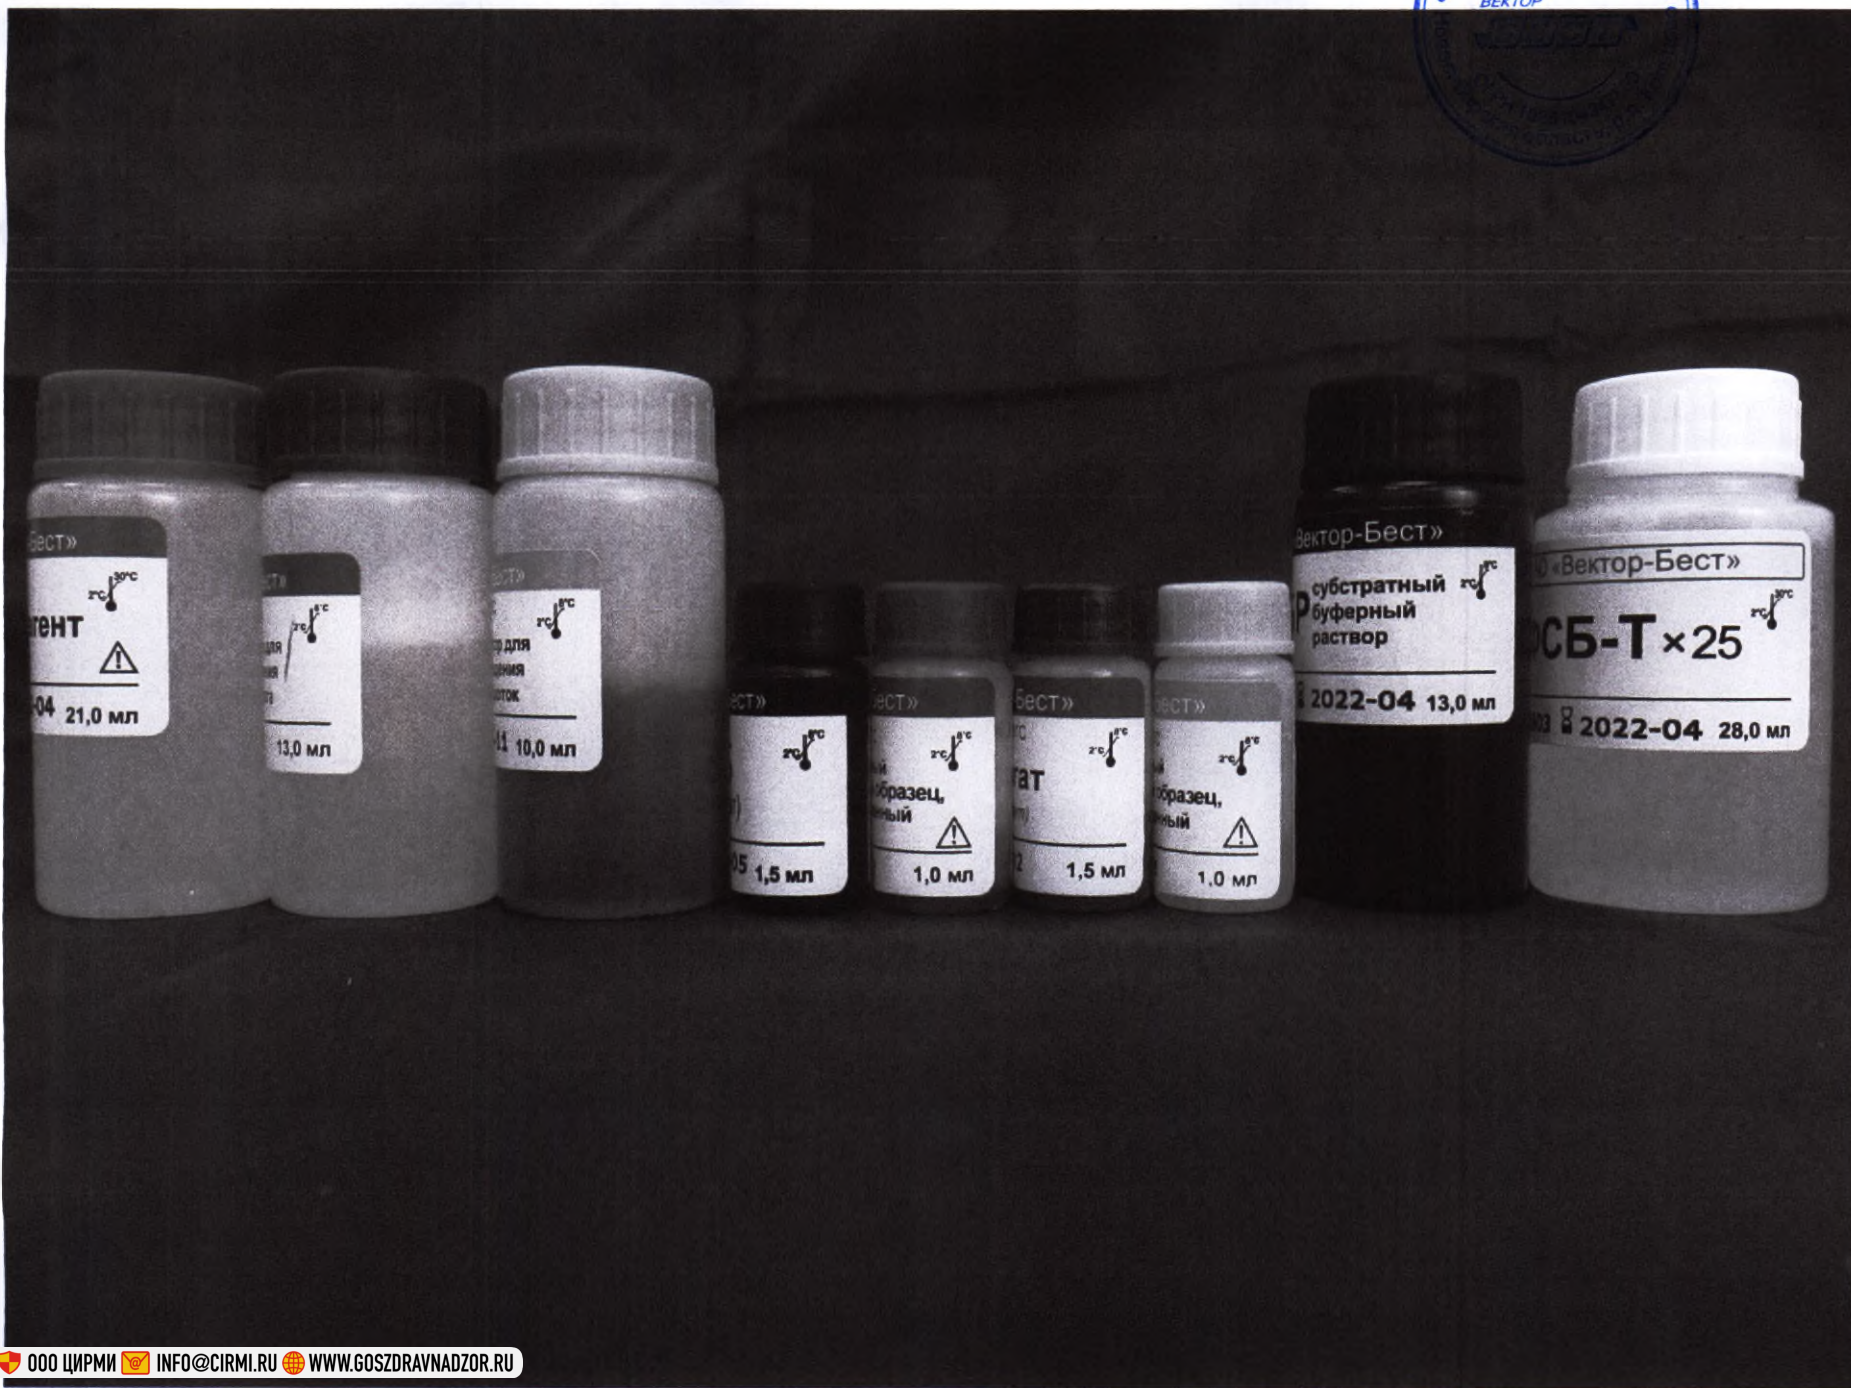


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС (комплект 2))»

Генеральный директор
 АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.


« 14 » 07 2019 г.

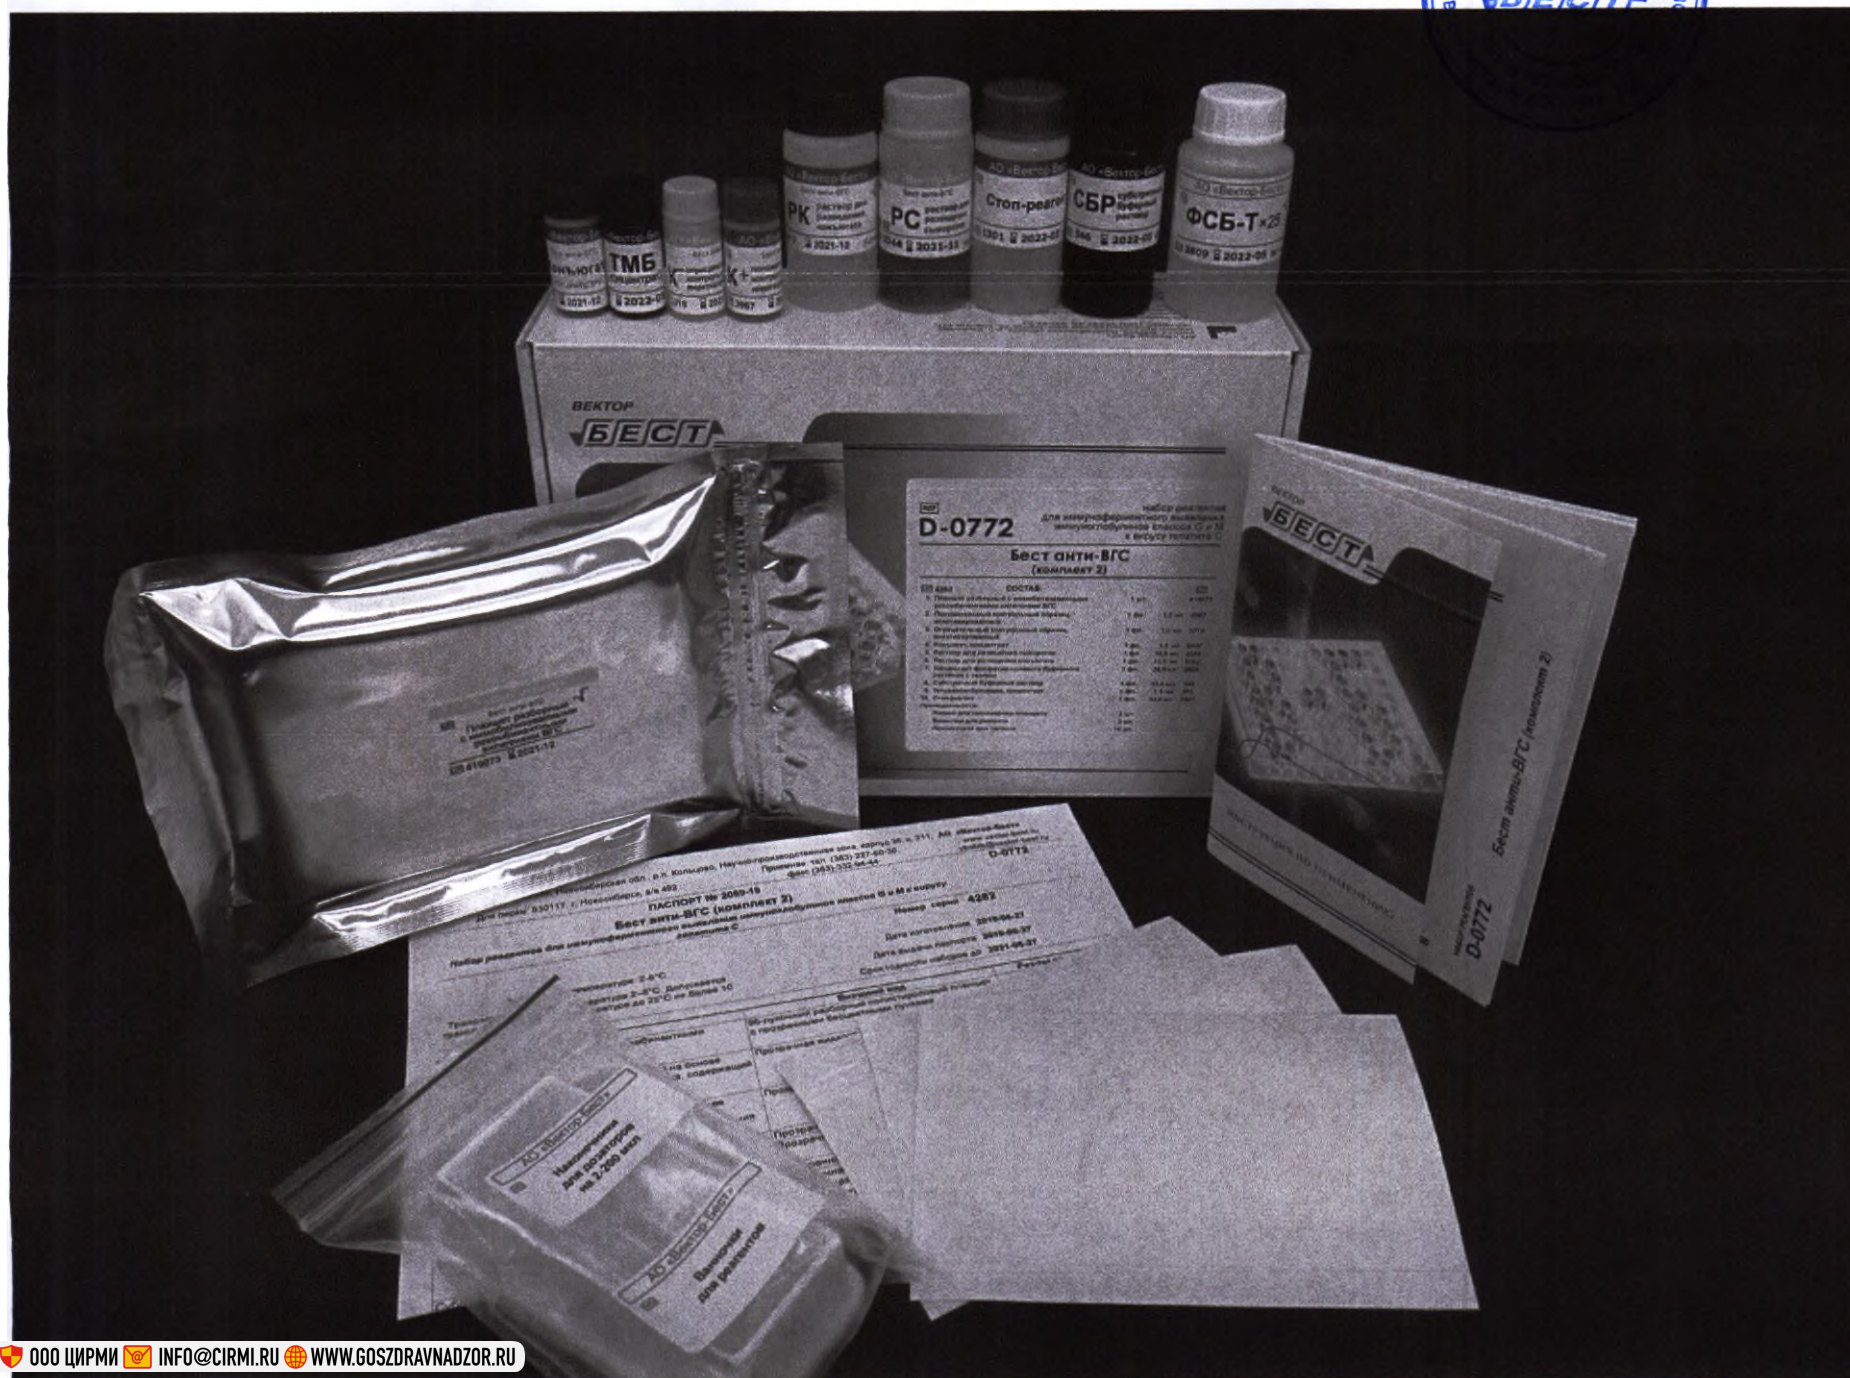



ВЕКТОР

БЕСТ

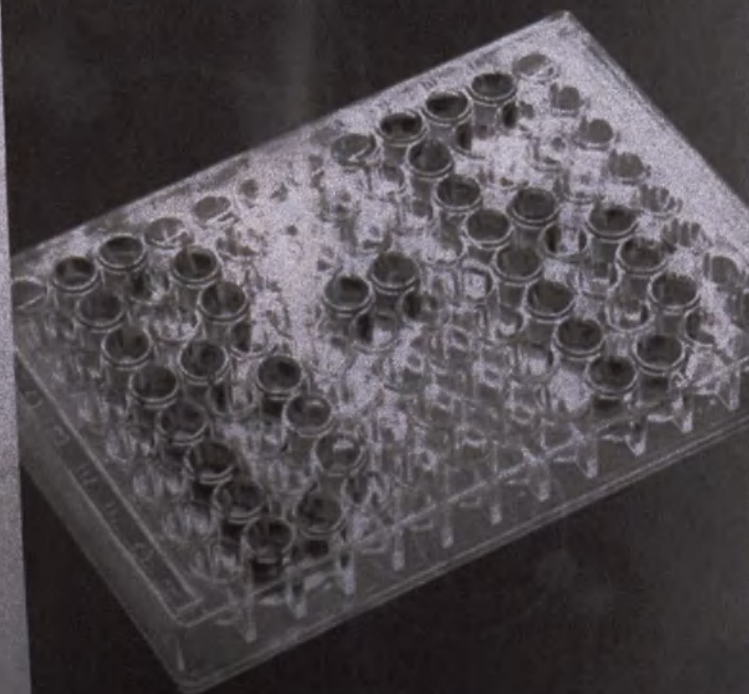

REF

D-0772

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов классов G и M
к вирусу гепатита С

**Бест анти-ВГС
(комплект 2)**

LOT 4282

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС	1 шт.	419073
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,0 мл	3967
3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,0 мл	3319
4. Конъюгат, концентрат	1 фл. 1,5 мл	9637
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл. 10,0 мл	2344
6. Раствор для разведения конъюгата	1 фл. 13,0 мл	4313
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 28,0 мл	2809
8. Субстратный буферный раствор	1 фл. 13,0 мл	546
9. Тетраметилбензидин, концентрат	1 фл. 1,5 мл	501
10. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл	1301
Принадлежности:		
Пленка для заклеивания планшета	3 шт.	
Ванночки для реагента	2 шт.	
Наконечники для пипеток	16 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС (комплект 2))» № 2


Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2019 г.



БЕКТОР
БЕСТ

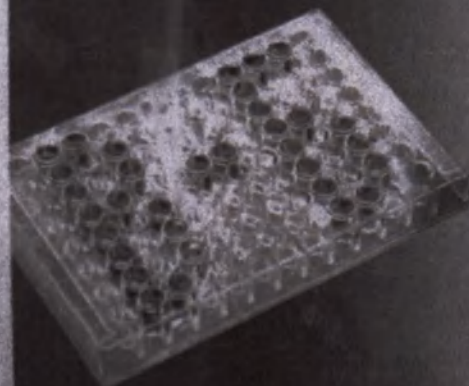

REF **D-0772**

Σ 12x8

LOT **4282**

ТУ 9398-482-23548172-2014

РУ № РЗН 2015/2352 от 17.03.2017

 **2019-06-27**

 **2021-06-27**

Бест анти-ВГС
(комплект 2)

IVD



07722706210428200353


Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС (комплект 2))» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

« 11 » 04 2019 г.

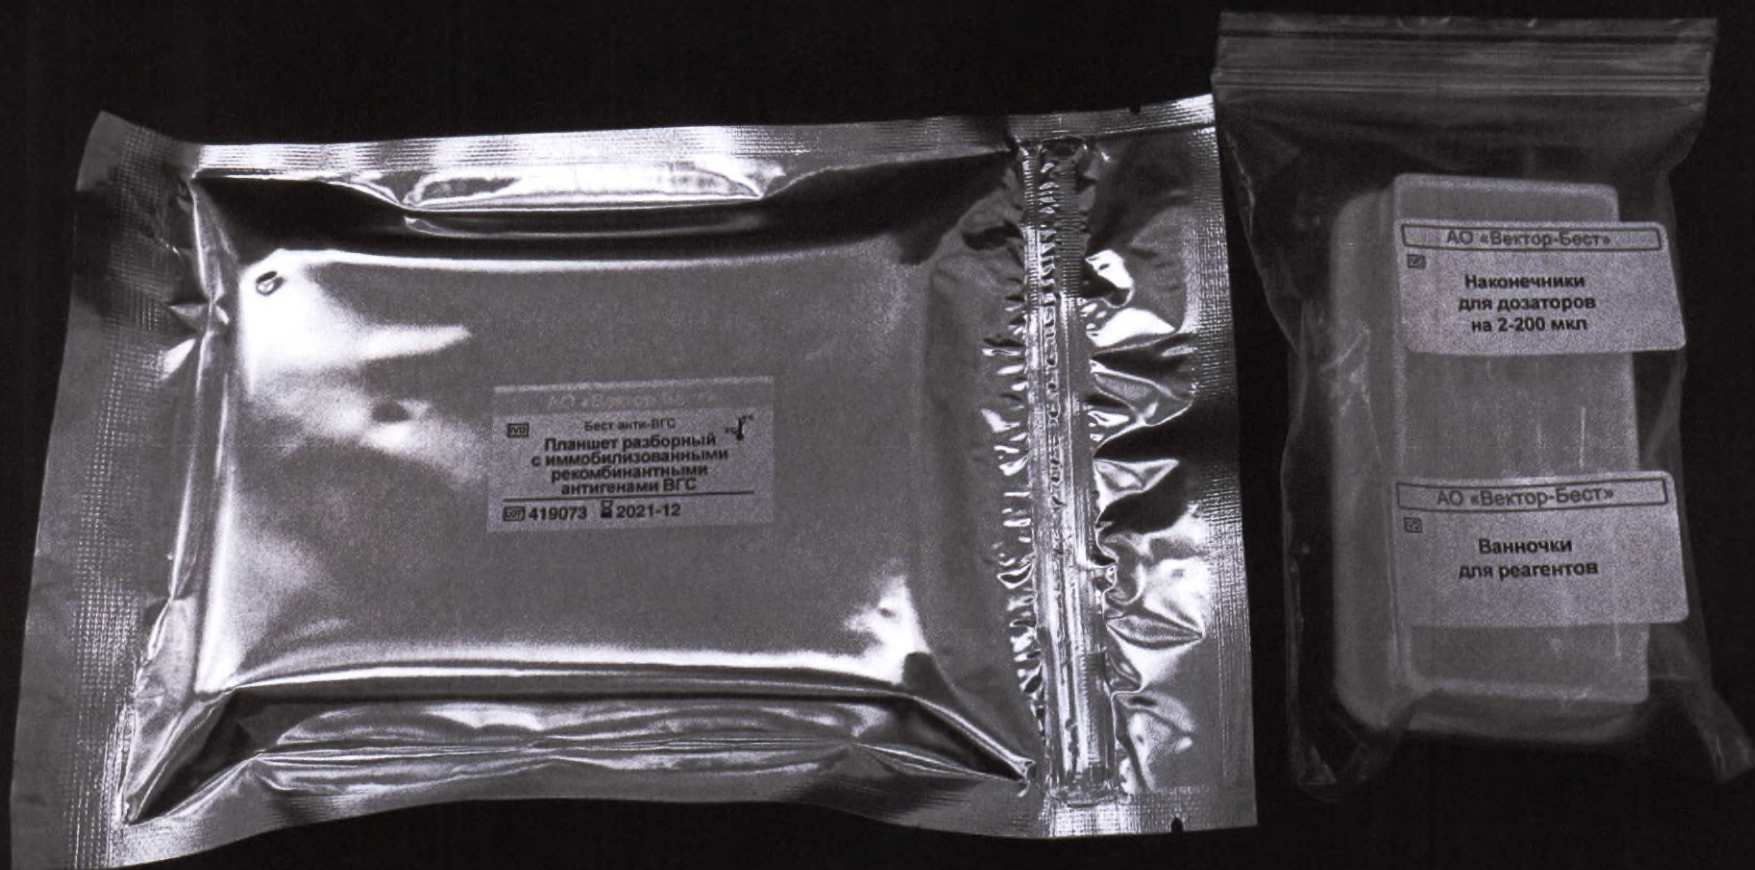


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС (комплект 2))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2019 г.

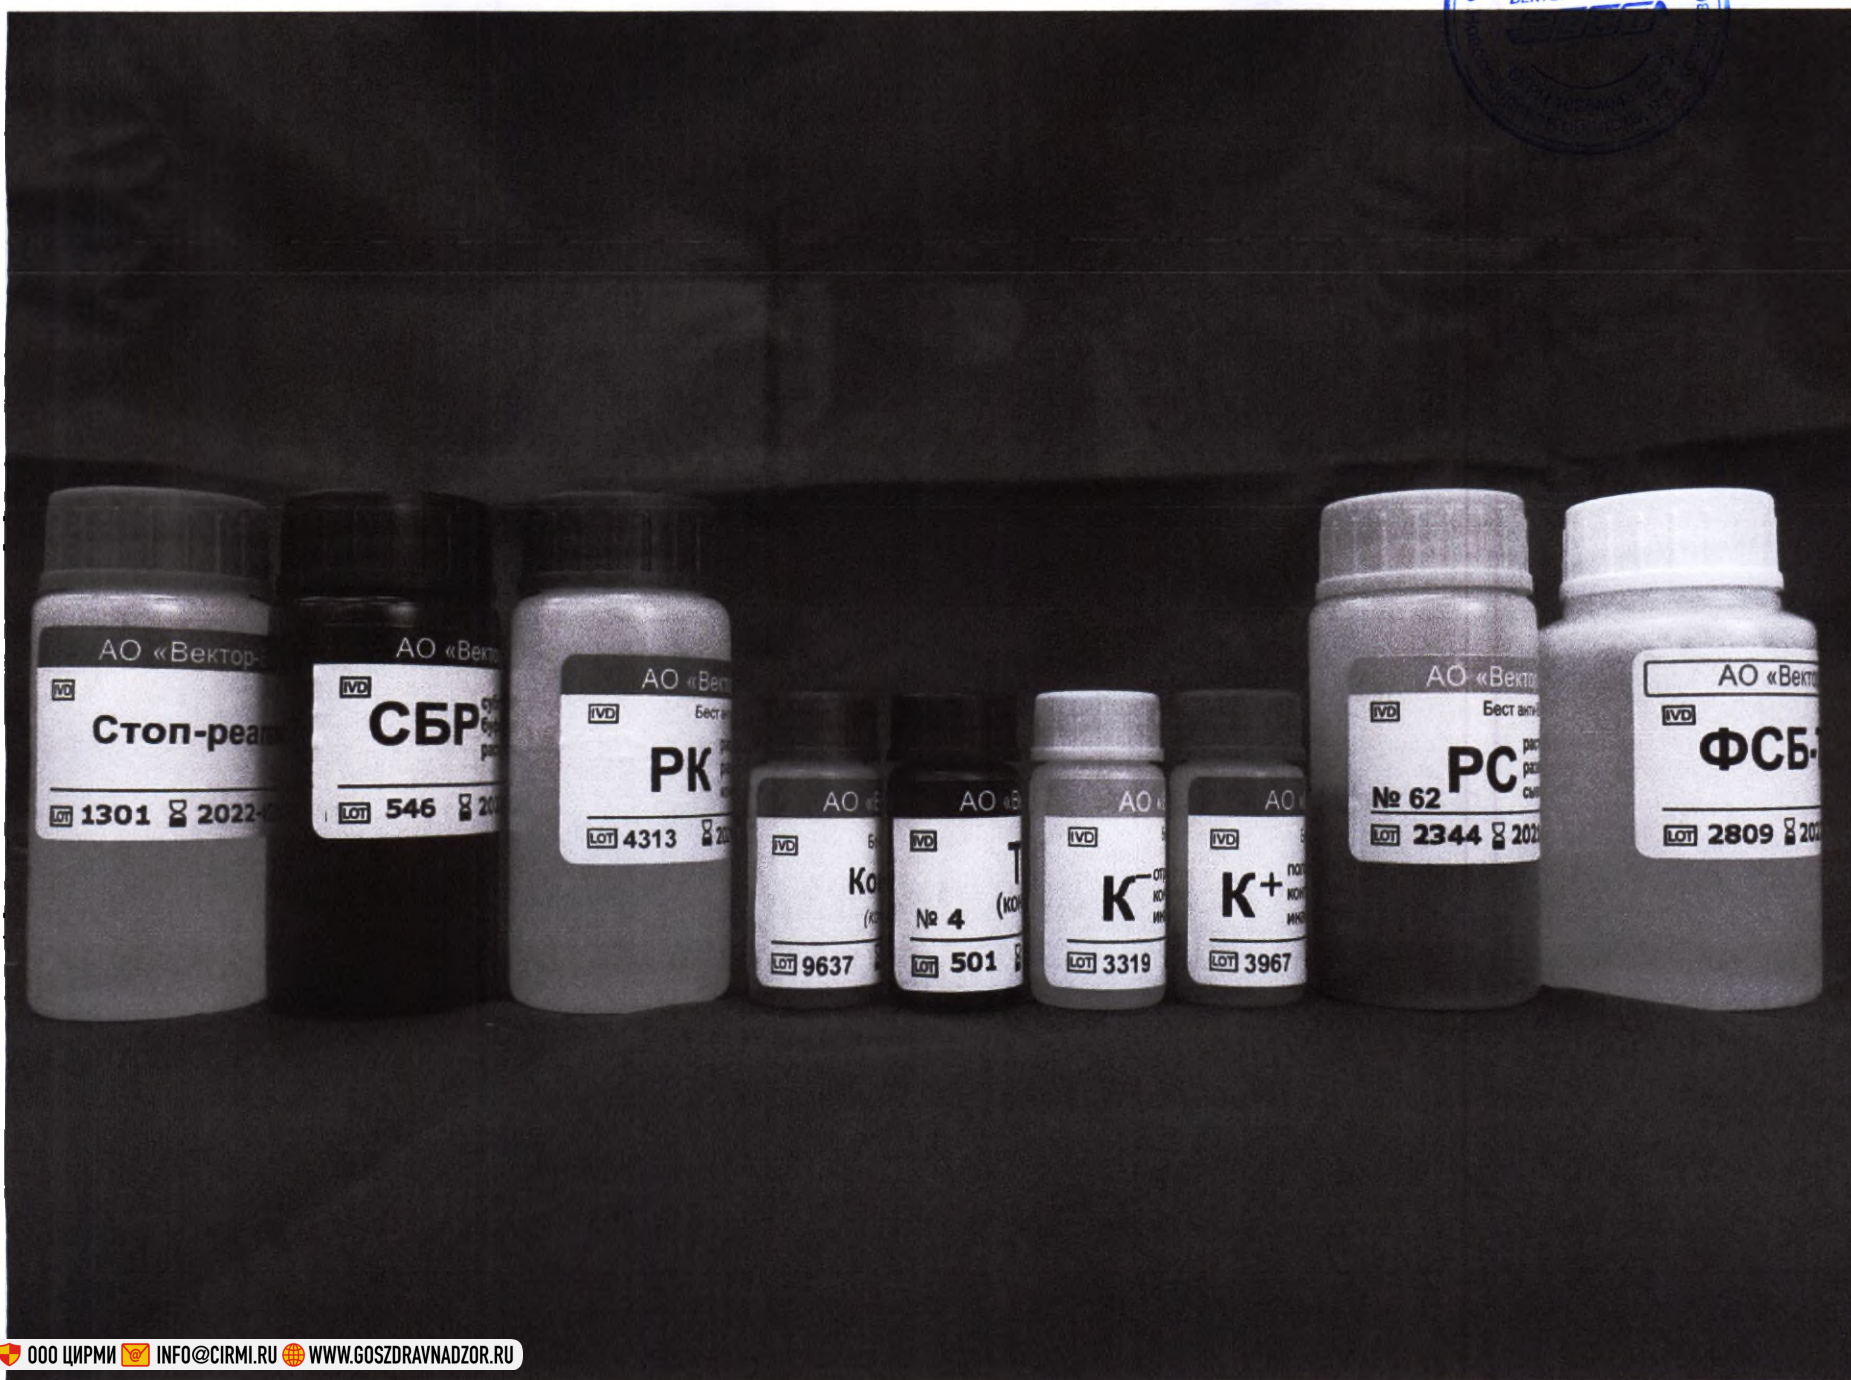


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС (комплект 2))» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»




Хусаинов М.Д.
« 14 » 07 2019 г.

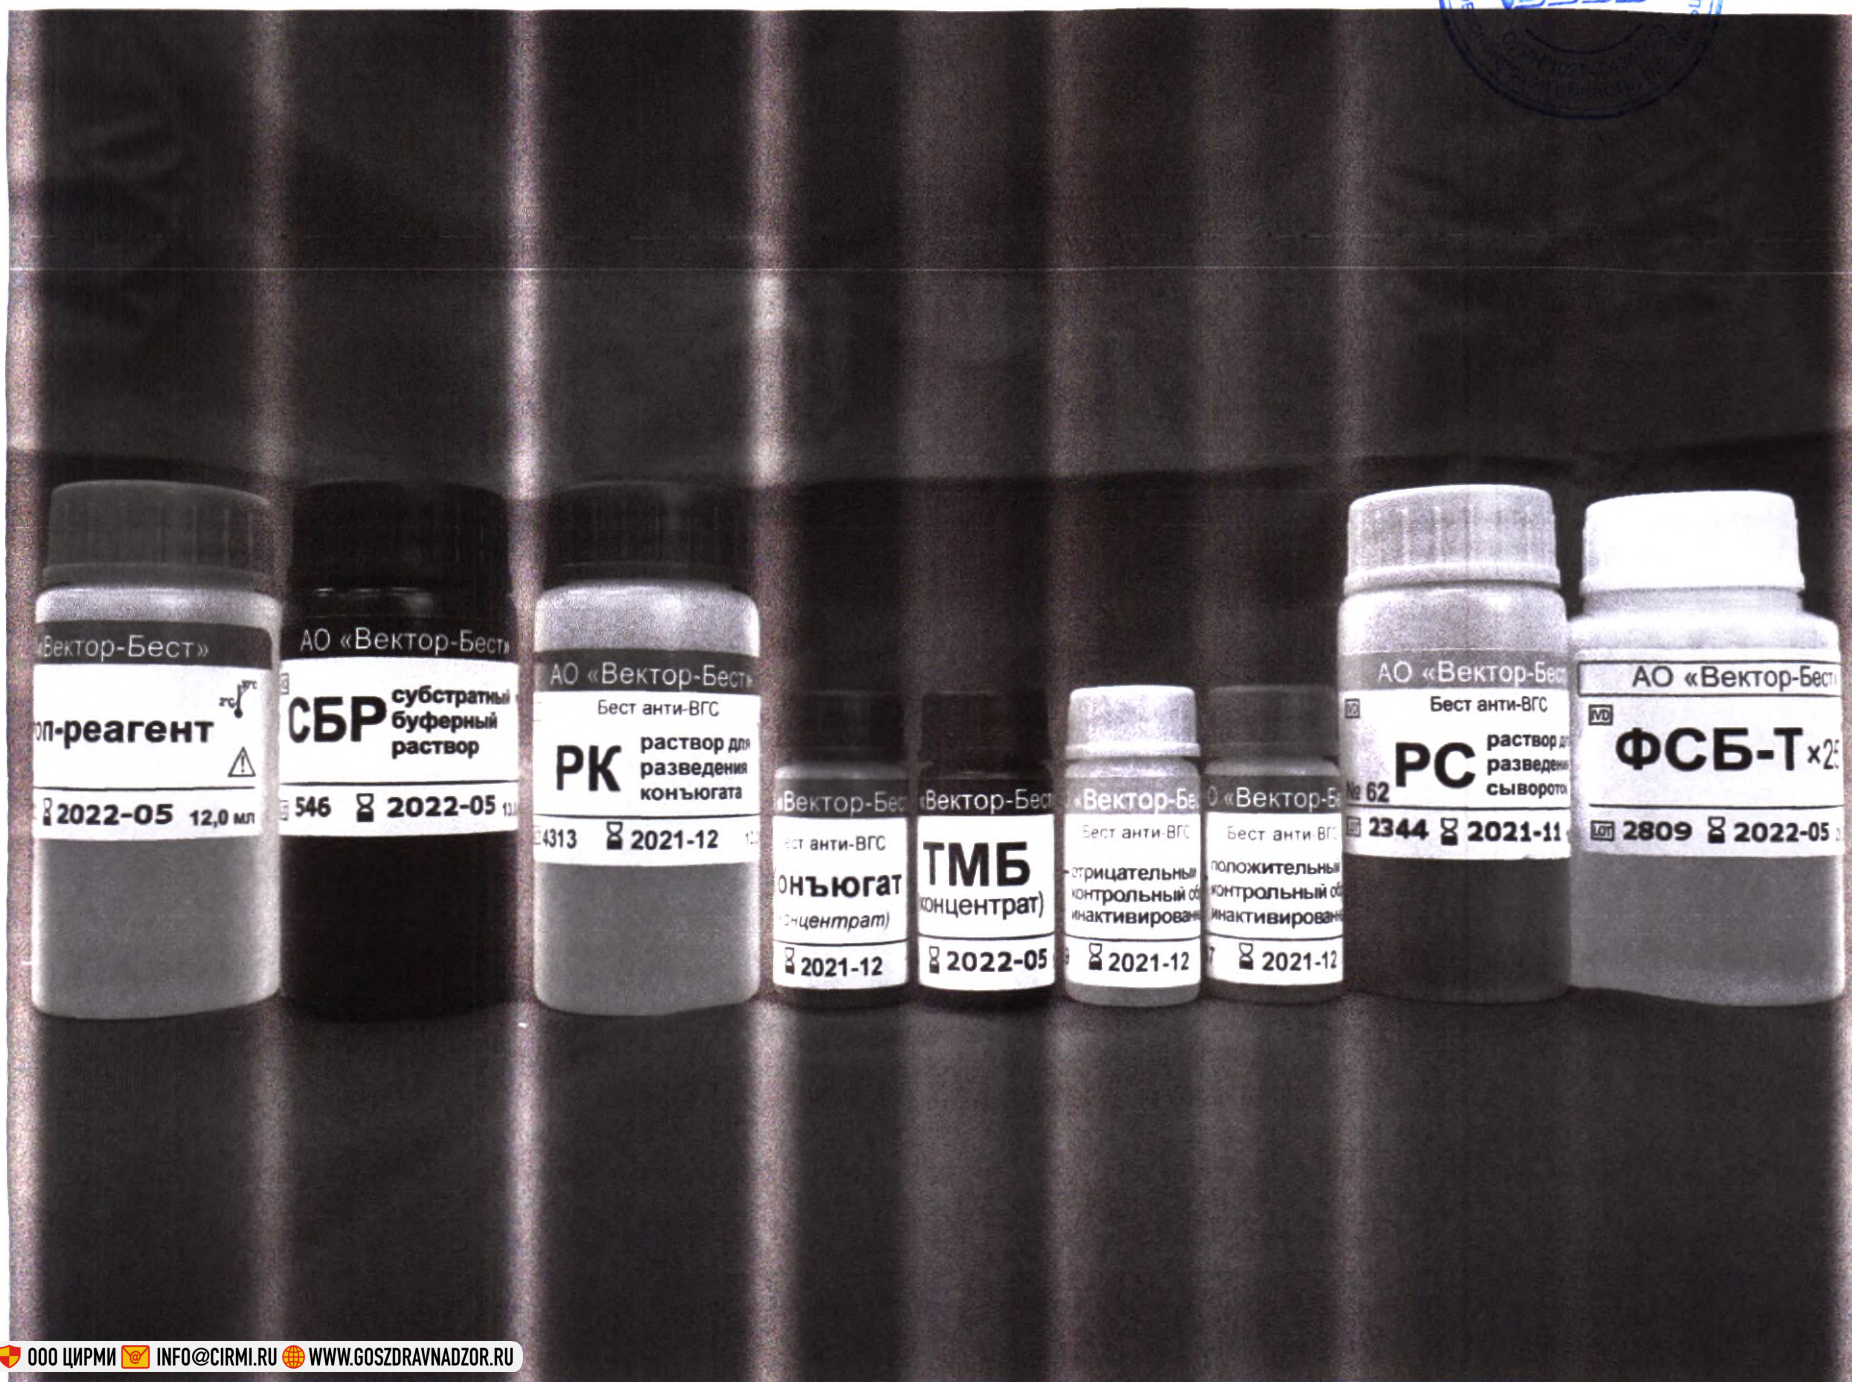

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС (комплект 2))» № 4


Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
07 2019 г.
Акционерное общество
«Вектор-Бест»
ВЕКТОР

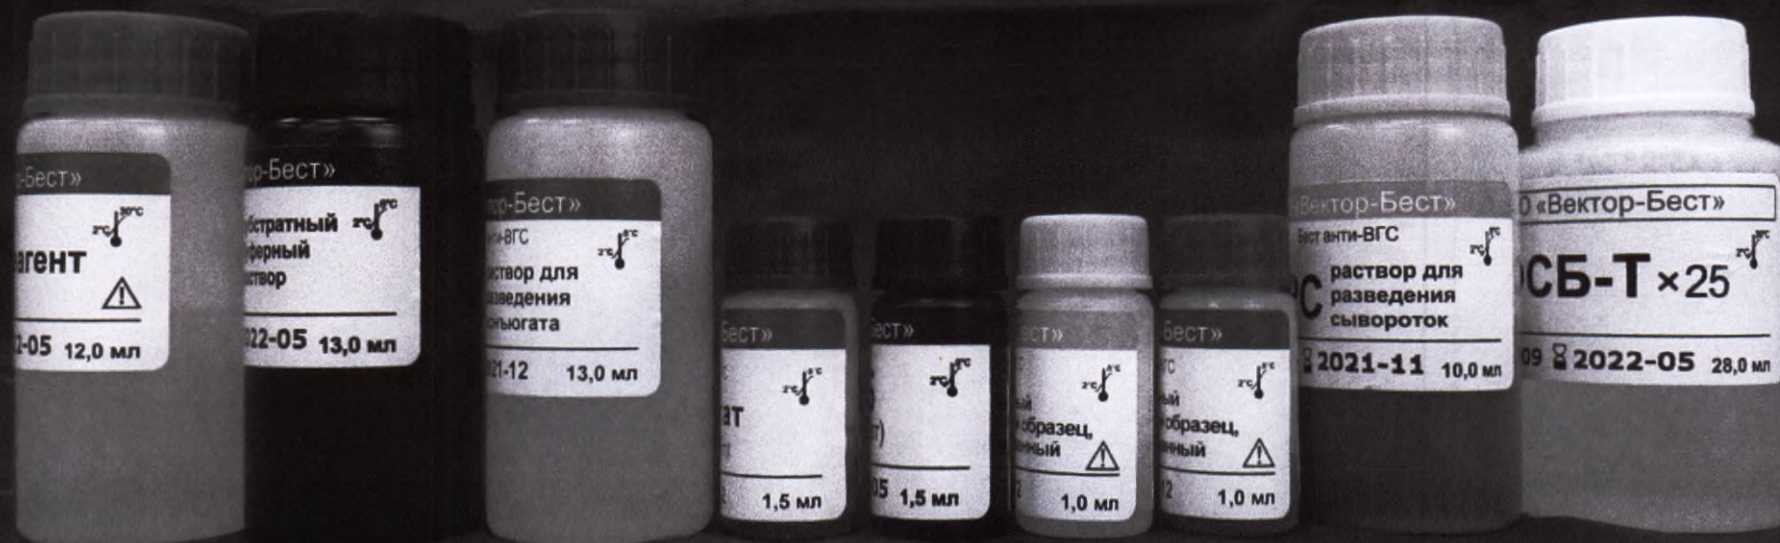

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС (комплект 3))»


Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«11» 07 2019 г.

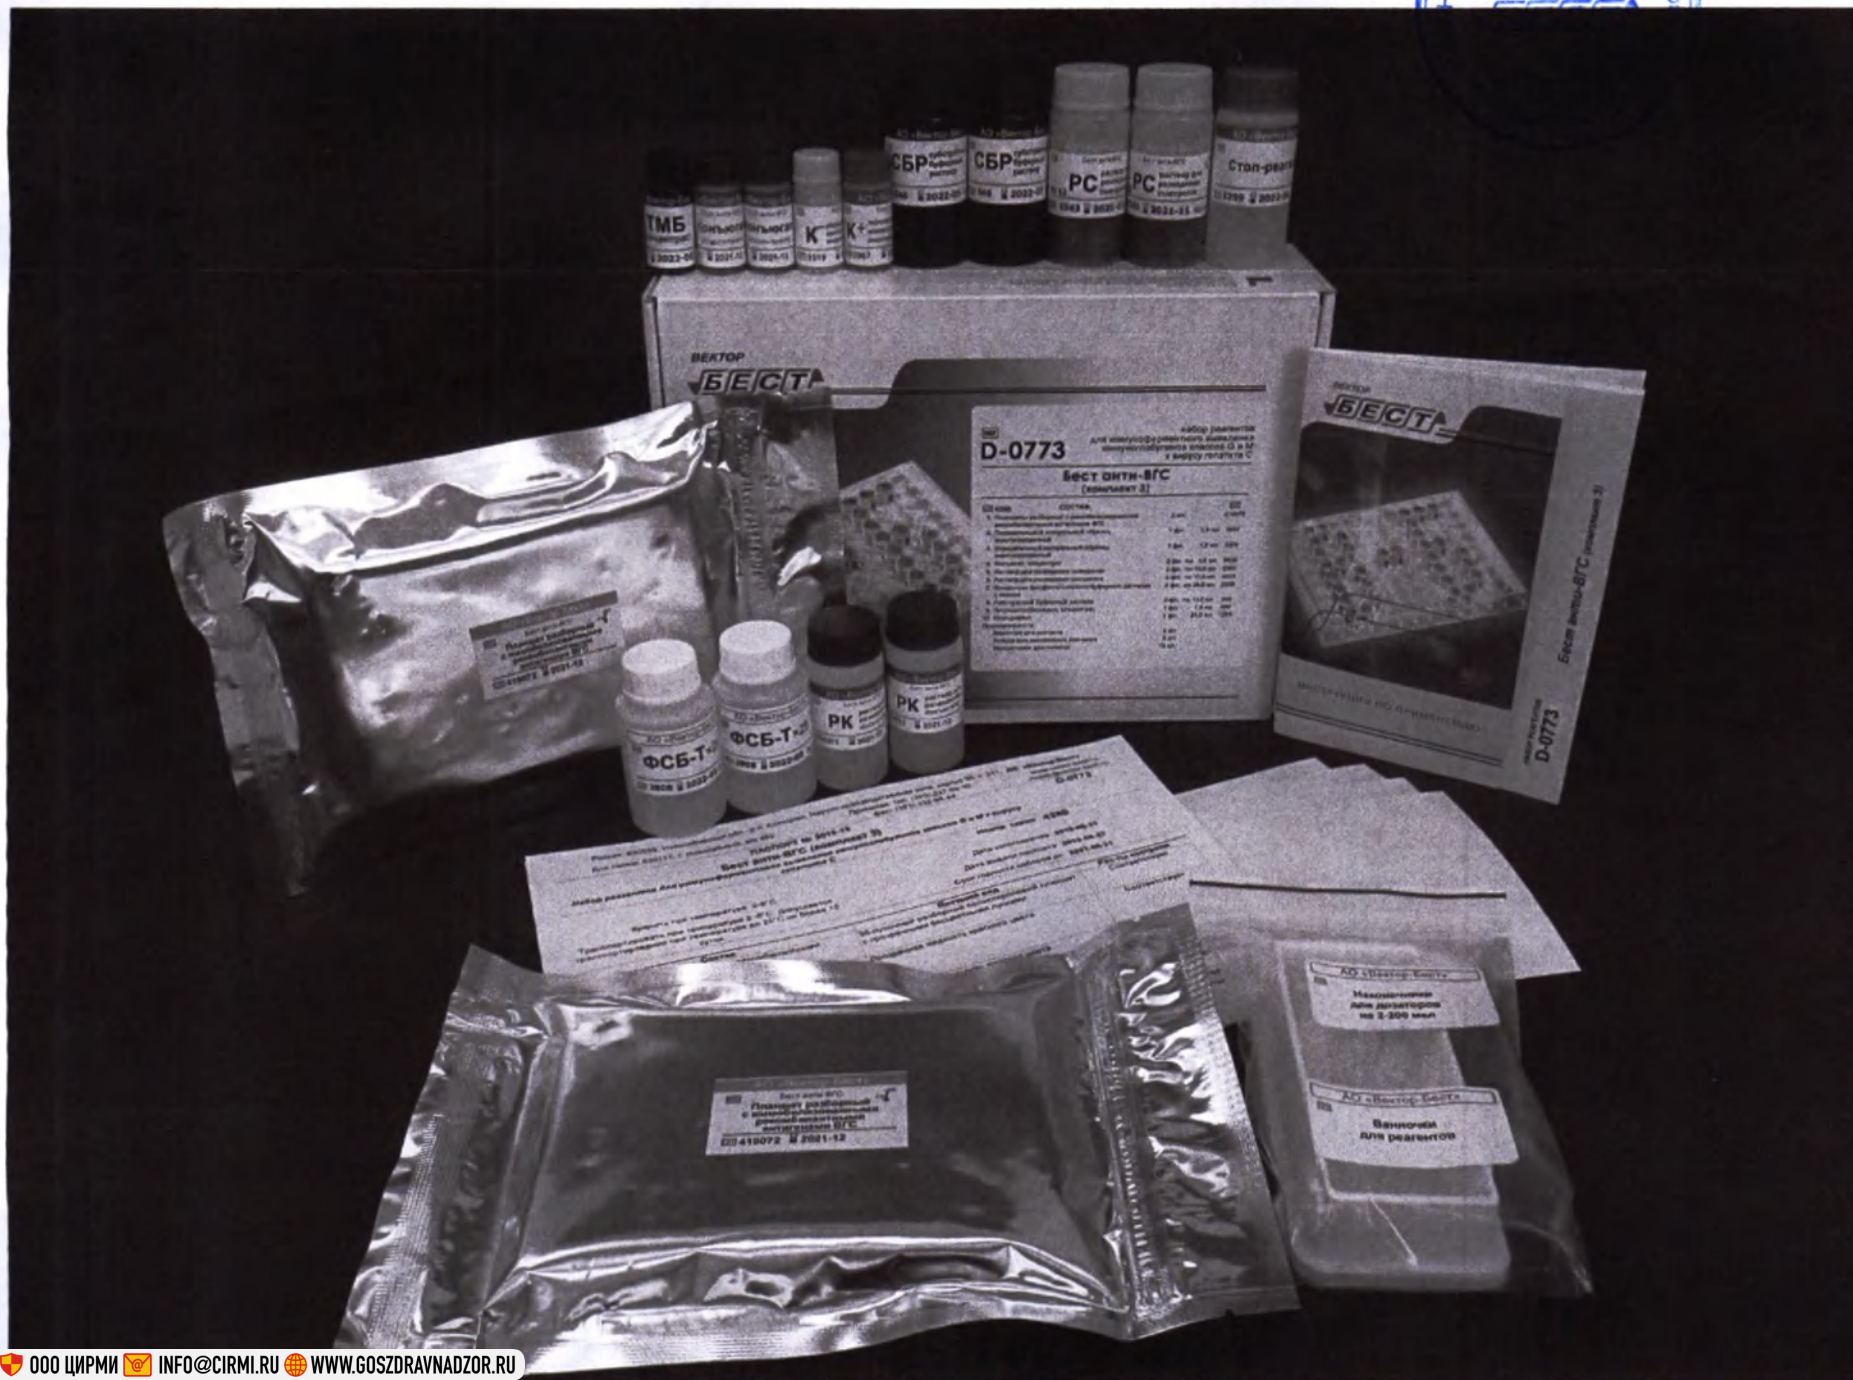



ВЕКТОР

БЕСТ

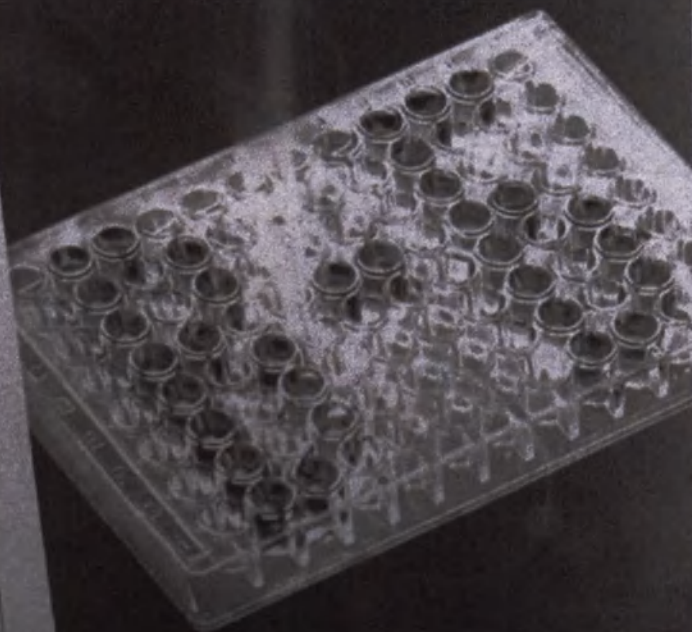

REF

D-0773

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов классов G и M
к вирусу гепатита С

**Бест анти-ВГС
(комплект 3)**

КОП 4280

СОСТАВ:

1. Планшеты разборные с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС	2 шт.	КОП 419072
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,0 мл	3967
3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,0 мл	3319
4. Конъюгат, концентрат	2 фл. по 1,5 мл	9628
5. Раствор для разведения сывороток	2 фл. по 10,0 мл	2343
6. Раствор для разведения конъюгата	2 фл. по 13,0 мл	4313
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл. по 28,0 мл	2808
8. Субстратный буферный раствор	2 фл. по 13,0 мл	548
9. Тетраметилбензидин, концентрат	1 фл. 1,5 мл	488
10. Стоп-реагент	1 фл. 21,0 мл	1299
Принадлежности:	2 шт.	
Ванночки для реагента	4 шт.	
Плёнка для заклеивания планшета	16 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС (комплект 3))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
«11» 07 2019 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС (комплект 3))» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.


«11»

2019 г.

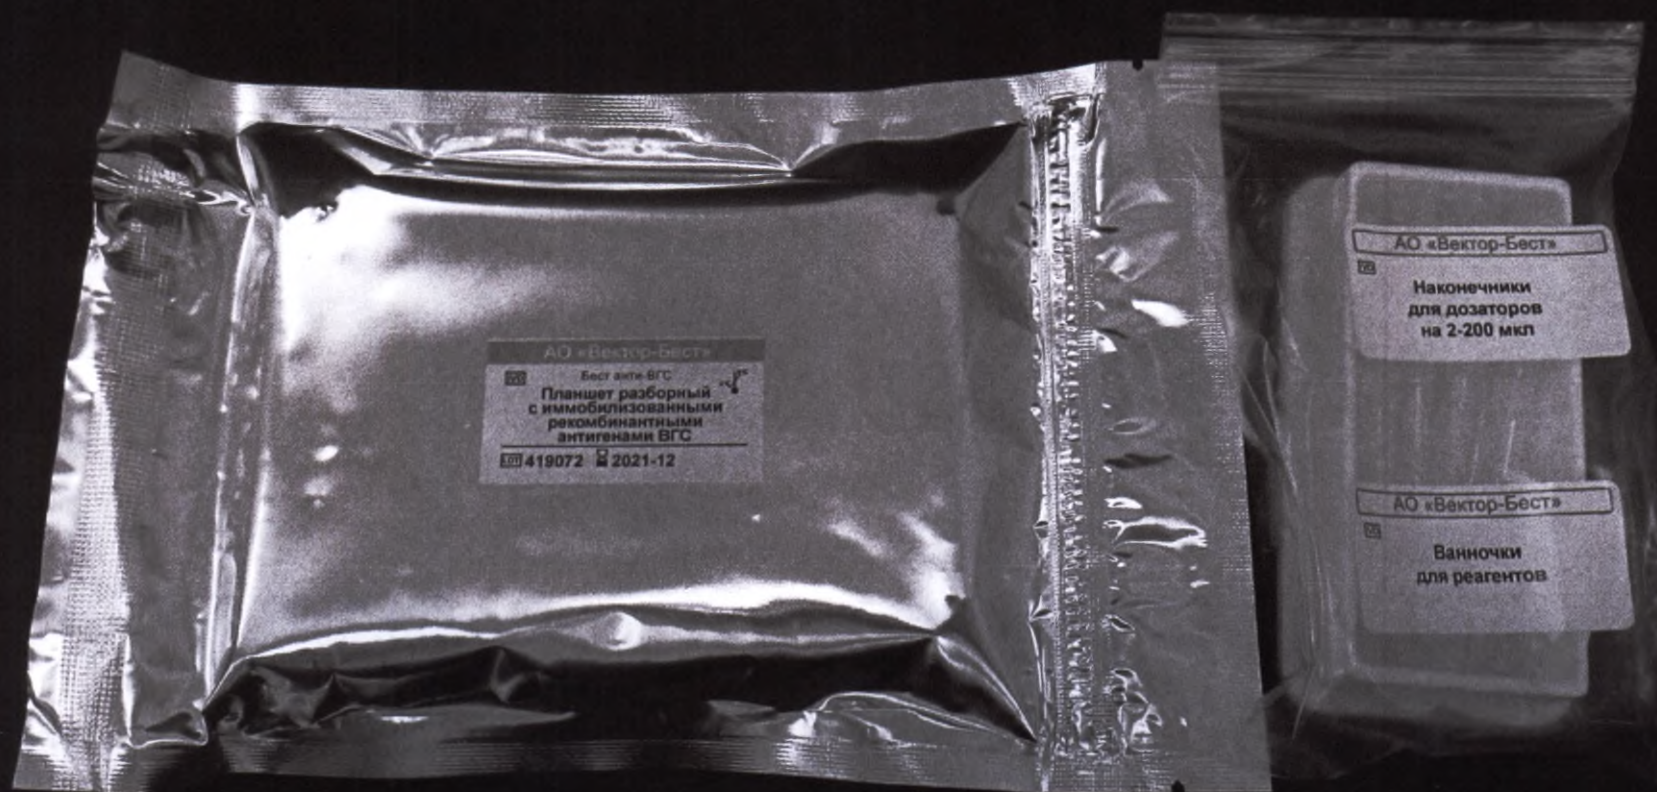

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС (комплект 3))» № 2


Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«17» 10 2019 г.

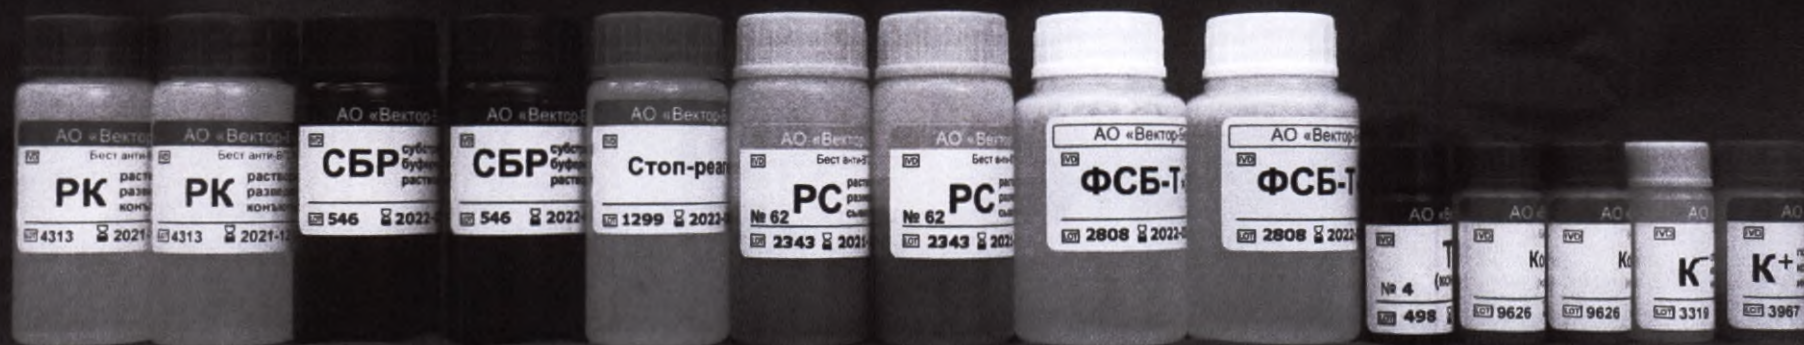

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС (комплект 3))» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
«11» 1.04 2019 г.

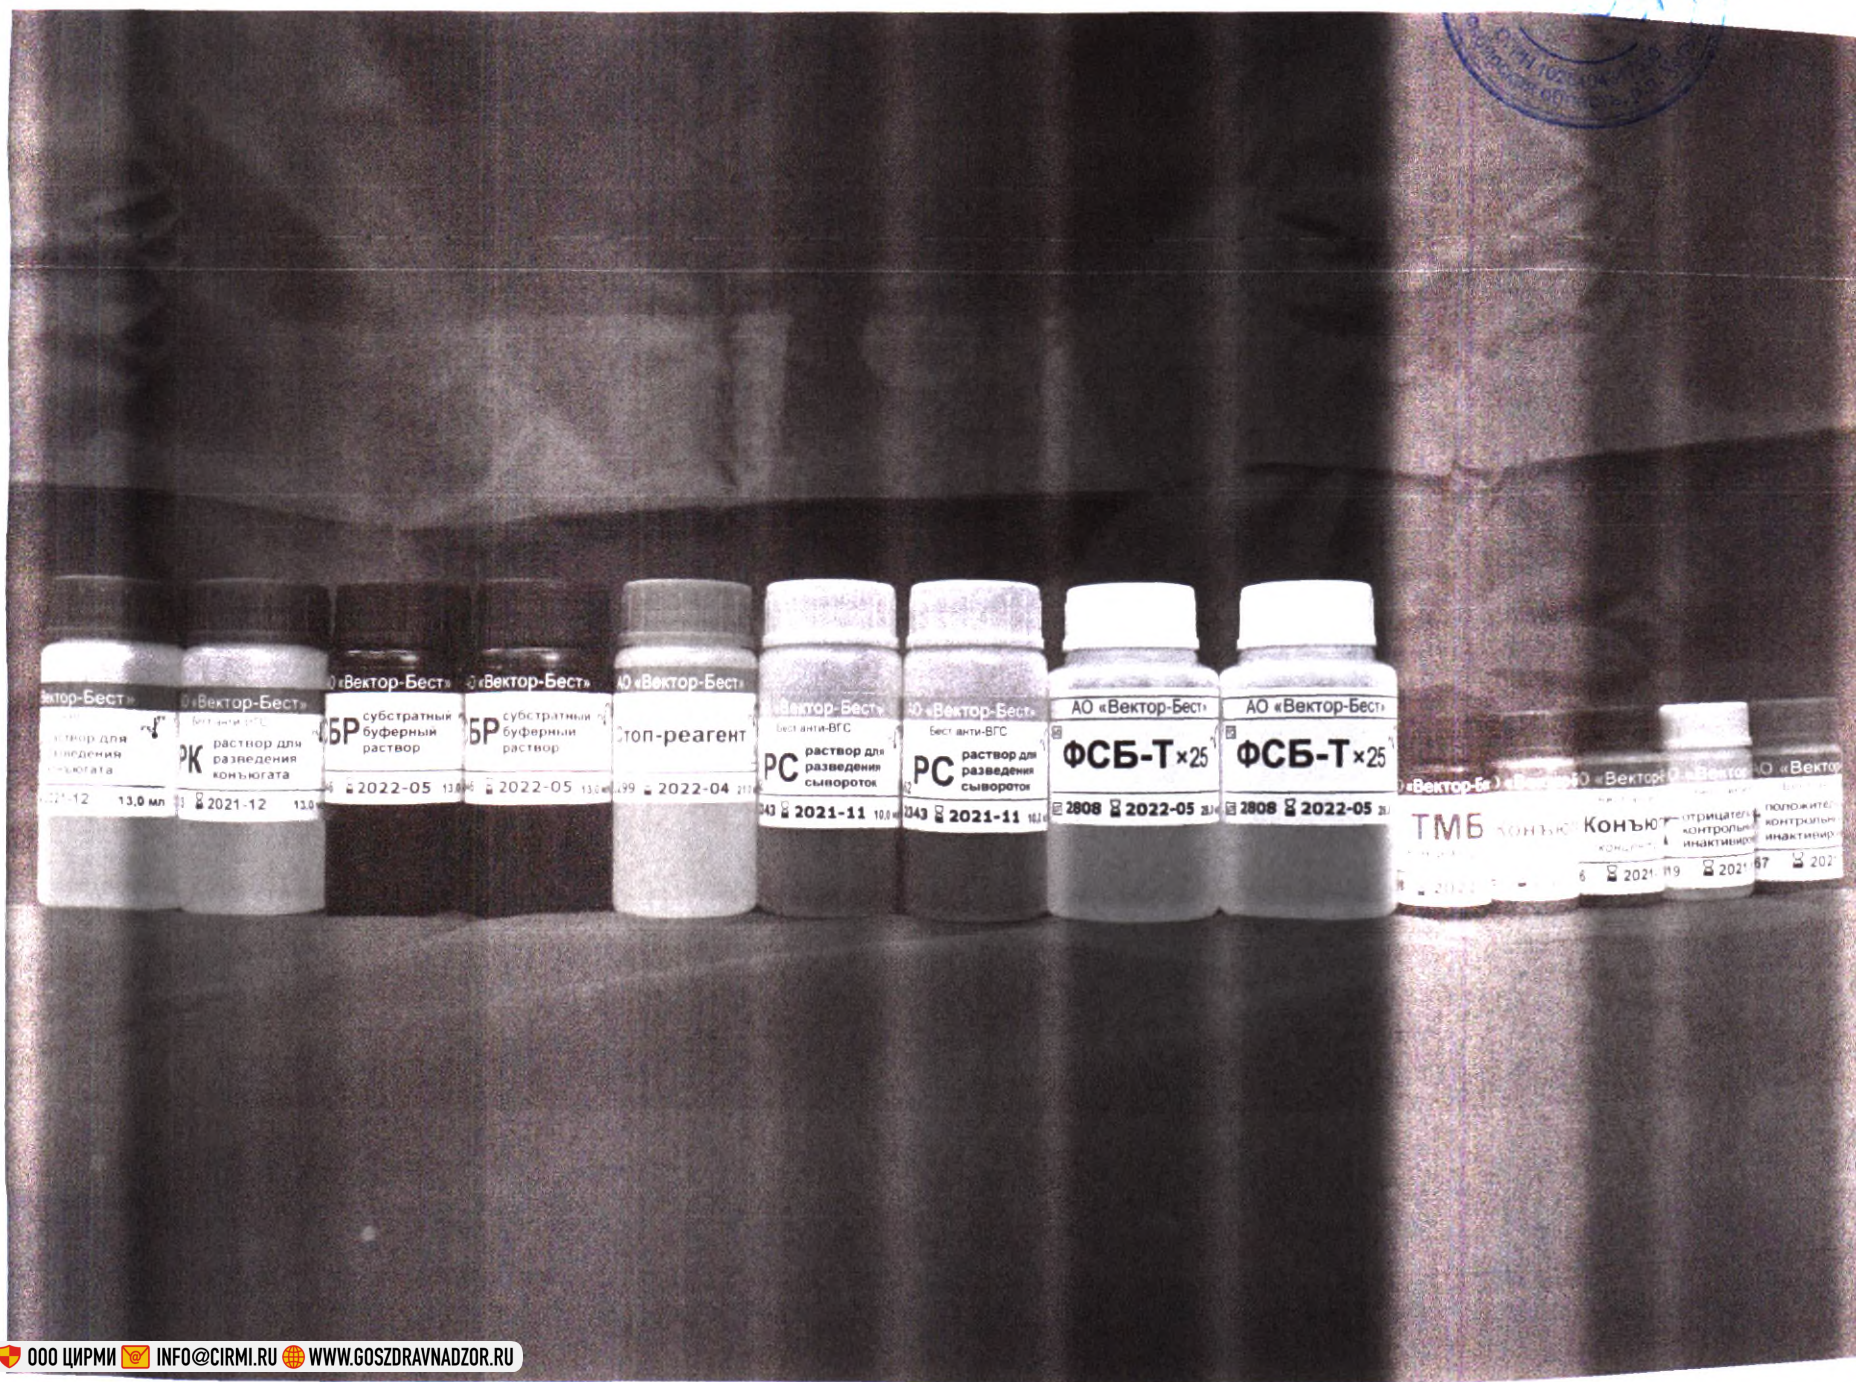

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС (комплект 3))» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2019 г.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС (комплект 4))»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Акционерное общество
«Вектор-Бест»
Хусаинов М.Д.
104 2019 г.




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС (комплект 4))» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
«11» 04 2019 г.
Акционерное общество
«Вектор-Бест»
ВЕКТОР
1025404341
Ростовская область, р.п.

ВЕКТОР

БЕСТ

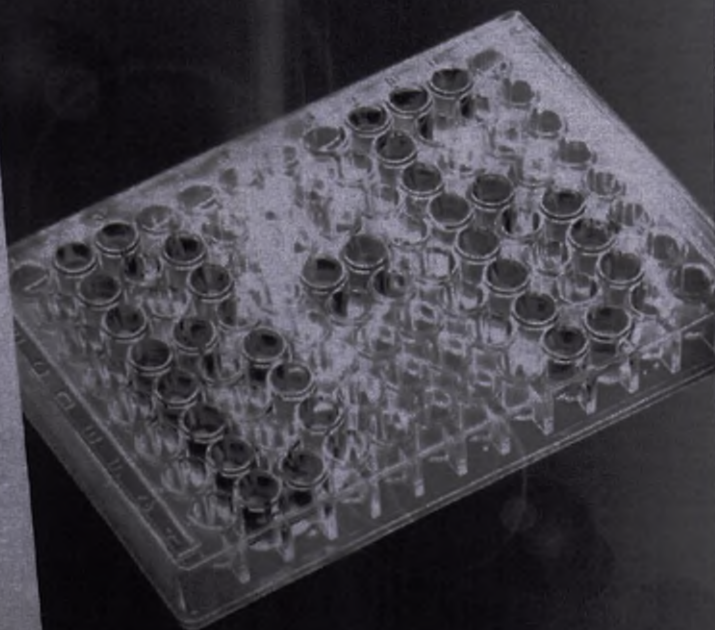

REF

D-0775

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов классов G и M
к вирусу гепатита С

Бест анти-ВГС (комплект 4)

LOT 4287

СОСТАВ:


LOT

1. Планшеты разборные с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС	5 шт.	419076
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,0 мл	3930
3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,0 мл	3319
4. Конъюгат, концентрат	3 фл. по 2,2 мл	9836
5. Раствор для разведения сывороток	3 фл. по 15,0 мл	2355
6. Раствор для разведения конъюгата	3 фл. по 20,0 мл	4310
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл. по 100,0 мл	2783
8. Субстратный буферный раствор	3 фл. по 20,0 мл	541
9. Тетраметилбензидин, концентрат	3 фл. по 1,5 мл	801
10. Стоп-реагент	3 фл. по 21,0 мл	1303
Принадлежности:		
Плёнка для заклеивания планшета	10 шт.	
Ванночки для реагента	2 шт.	
Наконечники для пипеток	16 шт.	


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС (комплект 4))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
04 2019 г.



ВЕКТОР
БЕСТ

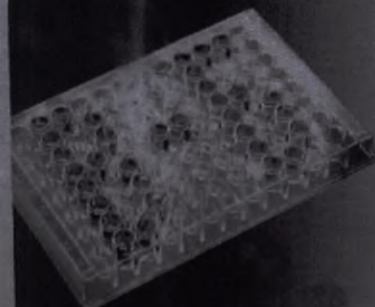

REF **D-0775**

Σ 480

LOT **4287**

ТУ 9398-482-23548172-2014

2019-06-24

ПУ № РЗН 2015/2352 от 17.03.2017

2021-06-24

Бест анти-ВГС
(комплект 4)




07752406210428700043

Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС (комплект 4))» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
«14» 04 2019 г.

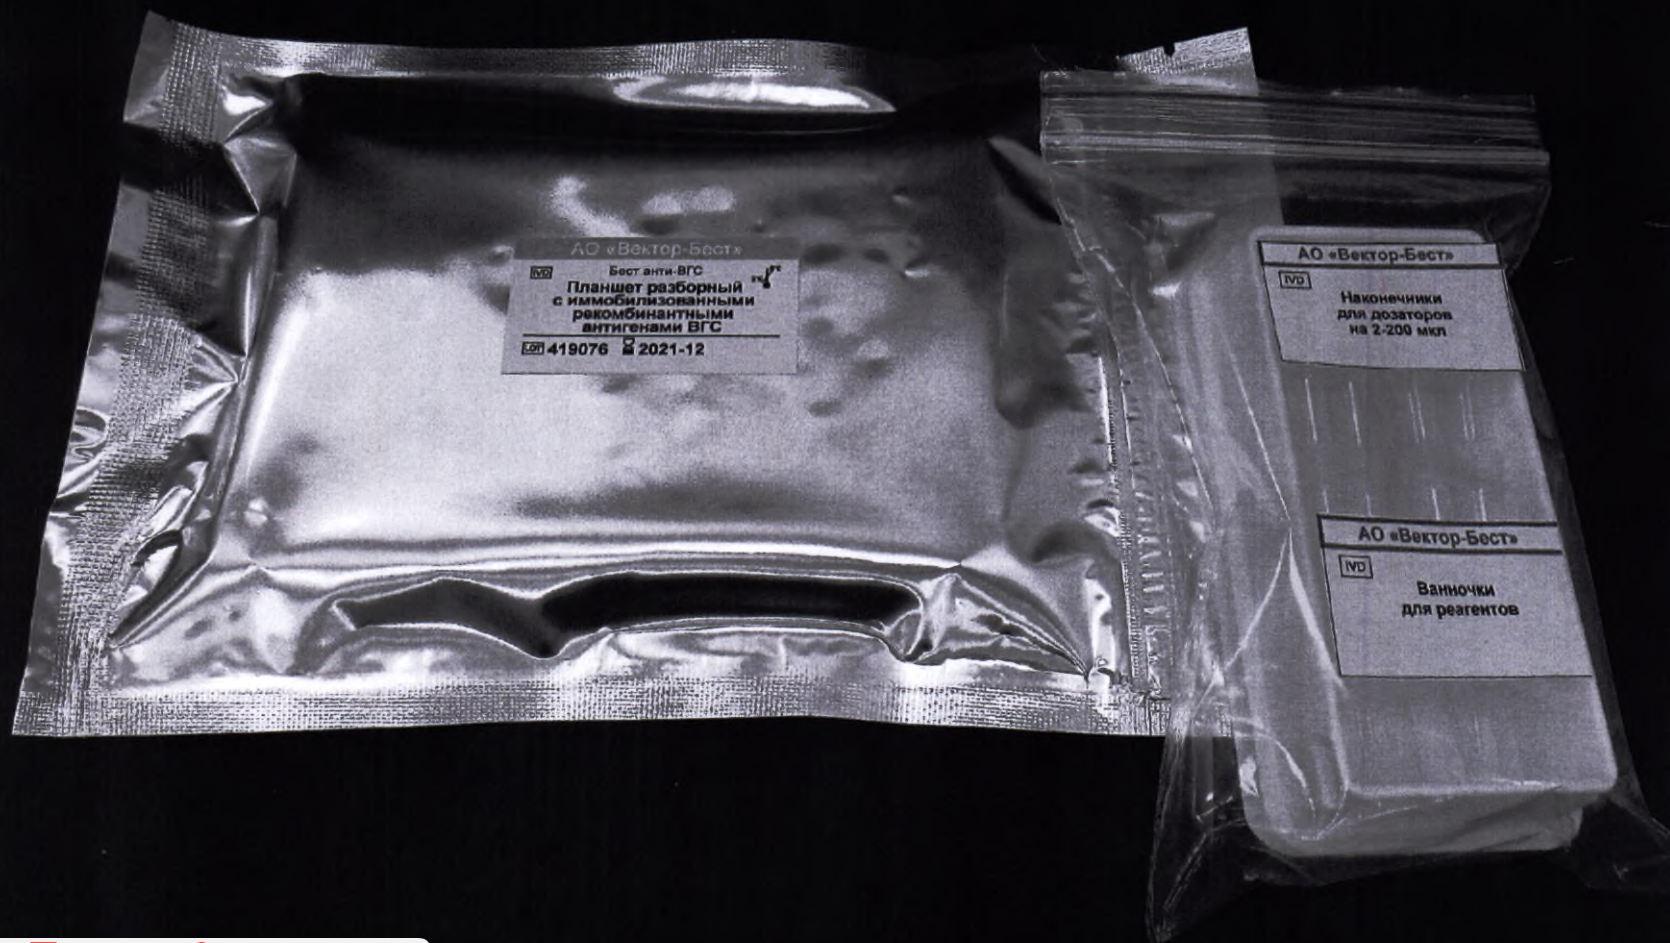


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС (комплект 4))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.


«04» 2019 г.

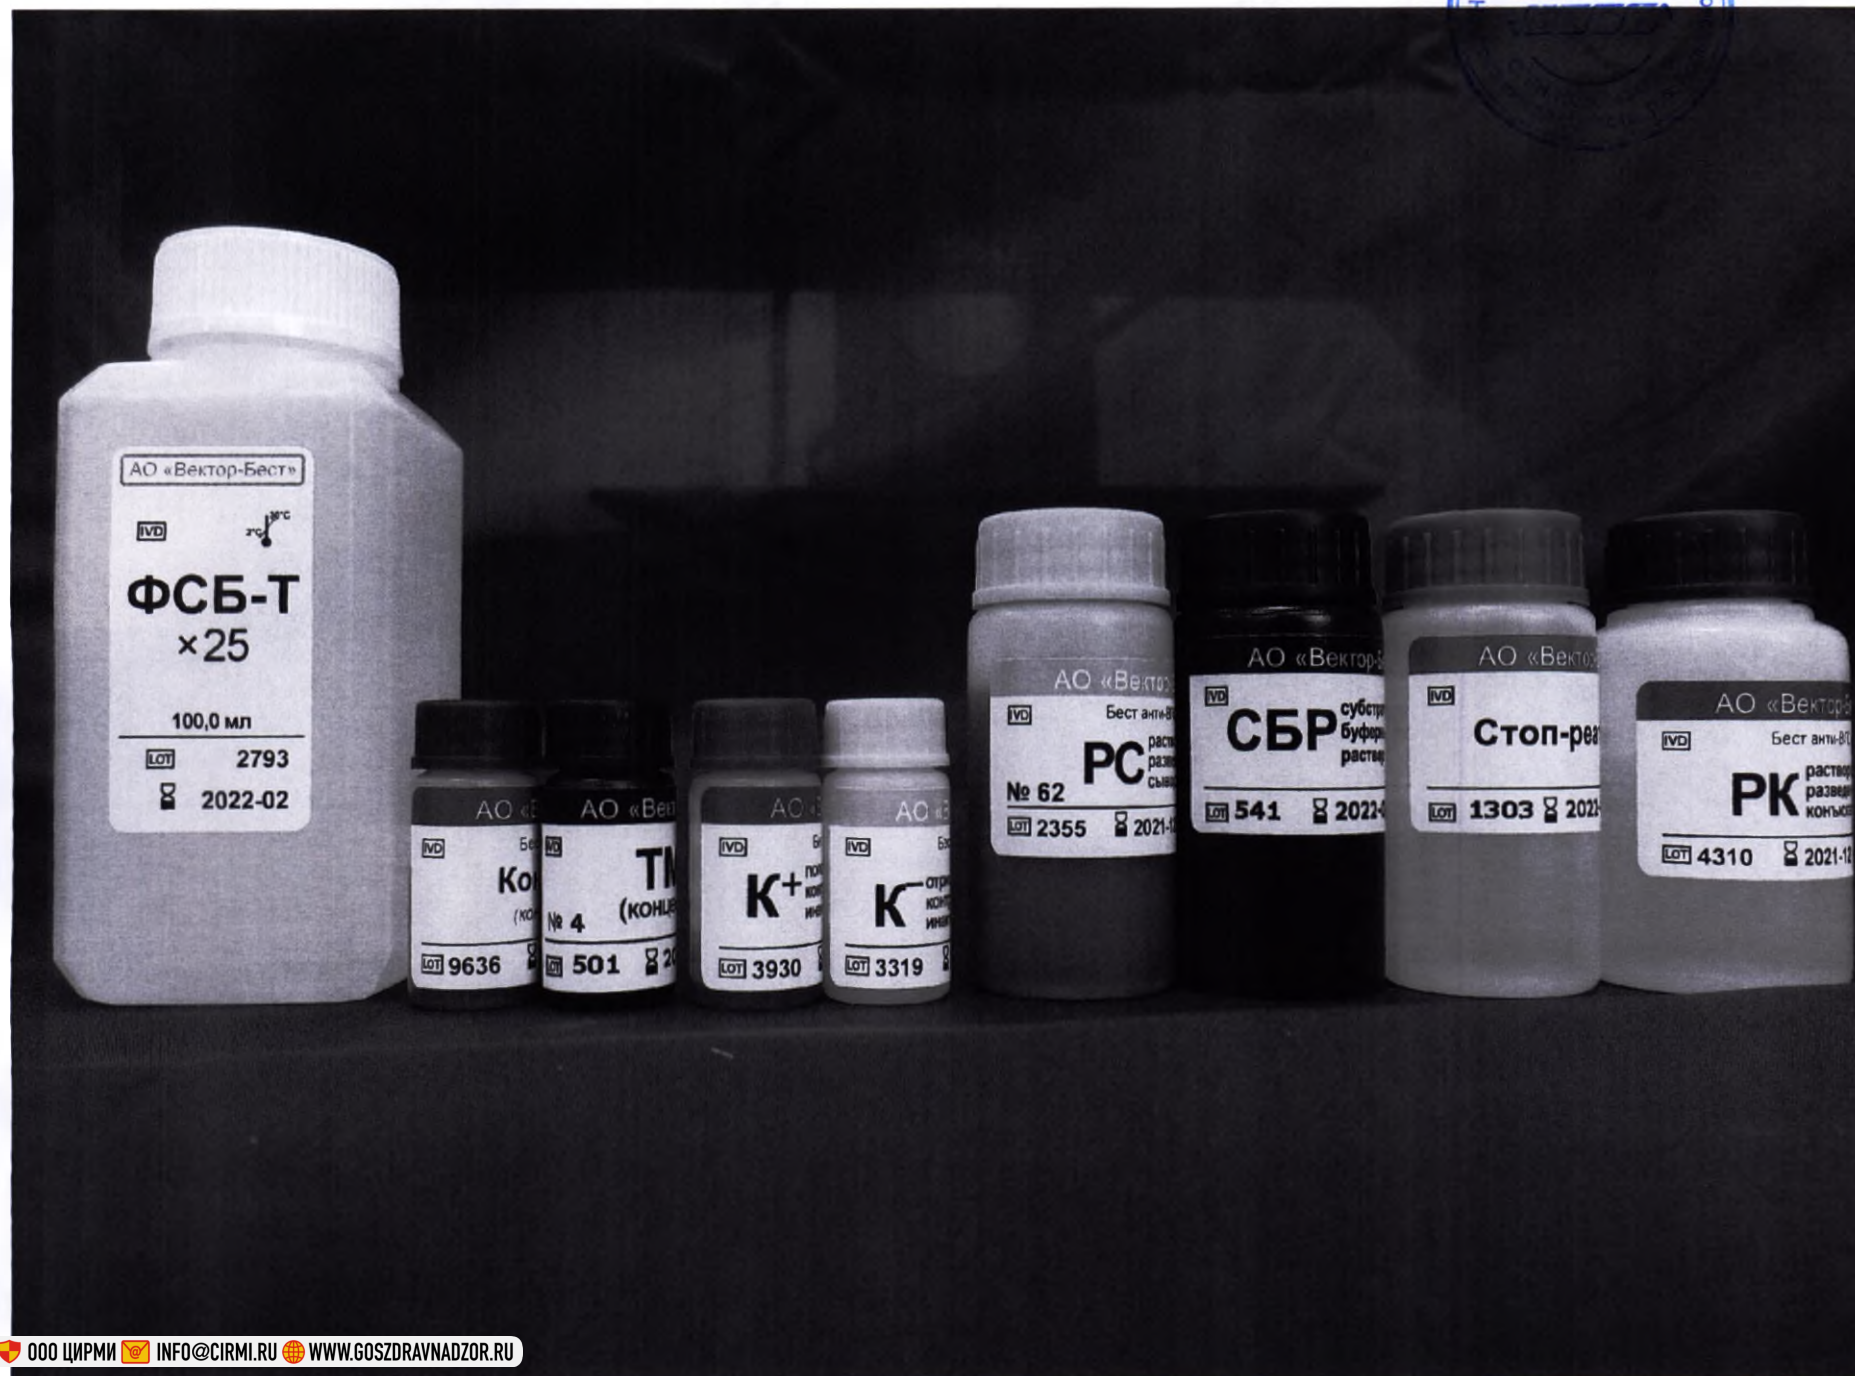

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС (комплект 4))» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
«11» 04 2019 г.

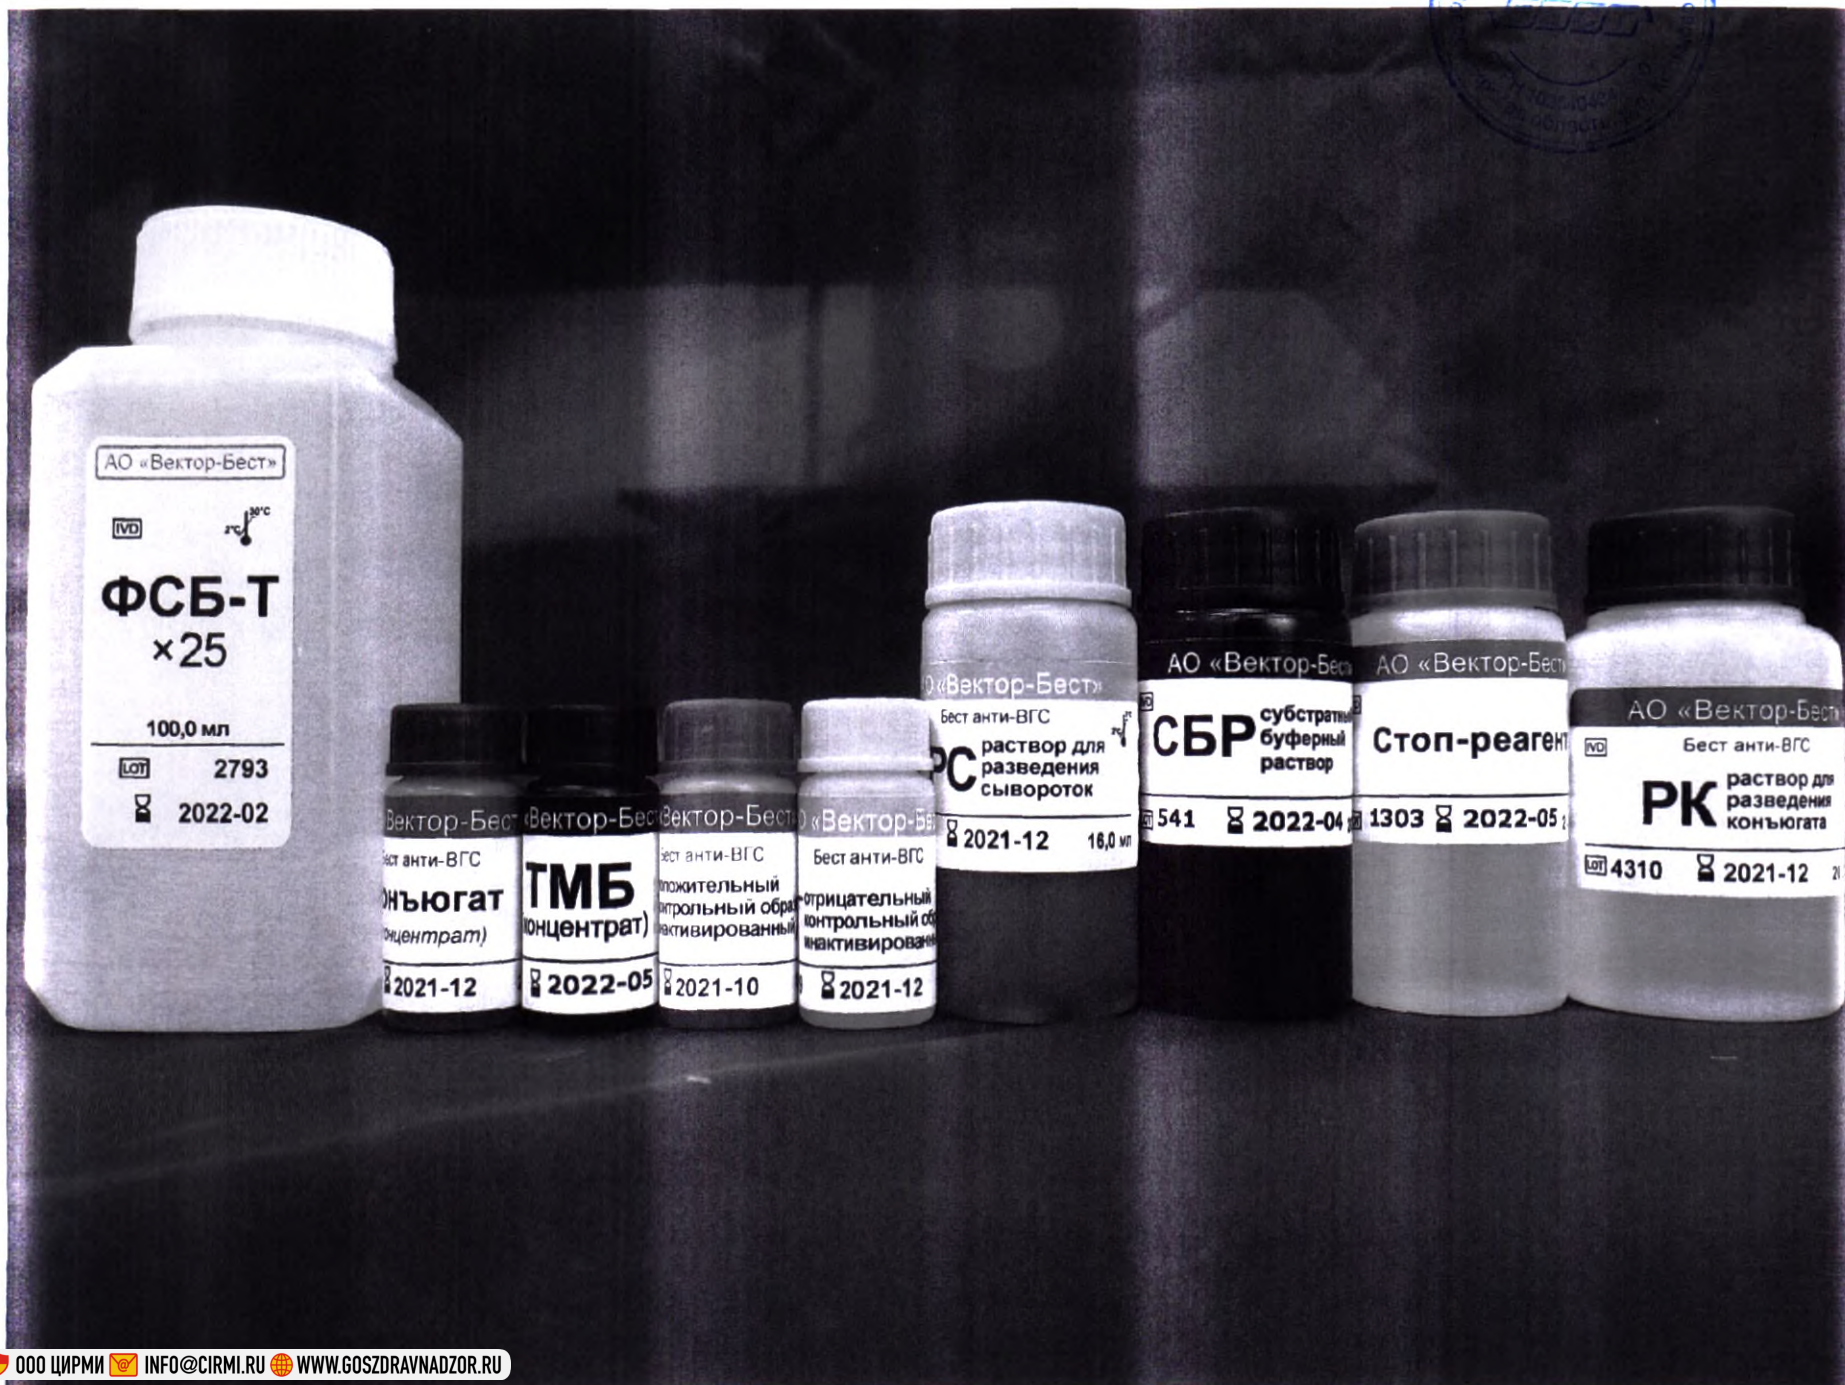

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС (комплект 4))» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



«04» 2019 г.

