

Общество с ограниченной ответственностью
«ПрофМедПром»

Столик инструментальный

СИ-01

Руководство по эксплуатации

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «ПрофМедПром»
Золотов Е.В.



Е.В. Золотов 2010г.

1 Назначение

Столик инструментальный СИ-01 (далее столик) предназначен для оснащения медицинских учреждений и служит для размещения на нем инструмента, материалов и медикаментов, применяемых в стоматологической практике, а также в кабинетах врачей, перевязочных, операционных, на постах медицинских сестер в отделениях больниц, в клиниках, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры не более:

длина – 580 мм, ширина – 390 мм, высота – 900 мм.

Масса – 9,5 кг.

Максимальная нагрузка на полку не более 5 кг.

Средний срок службы не менее 5 лет.

3 Комплектность

Стойка с колесными опорами – 2 шт.

Винт – 4 шт.

Рама – 2 шт.

Паспорт – 1 экз.

Стекло – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

Поддон – 1 шт.

Столик поставляется в разобранном виде.

4 Устройство и подготовка столика к работе



Столик представляет собой разборную конструкцию, состоящую из стоек с колесными опорами, рам, полки из стекла и поддона из нержавеющей стали. Рамы регулируются по высоте.

Освободите столик от упаковки и произведите его сборку. Зафиксируйте рамы на удобной для Вас высоте. В верхнюю раму вложите стеклянную полку, в нижнюю – металлический поддон.

Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфектантами, разрешенными к применению Минздравом РБ (салфетка должна быть отжата). После этого столик готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Столик может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытых хранилищах при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С;

относительная влажность до 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям нормативного документа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается равным 12 месяцам со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении столика на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
ЧПУП «Ратон-МедТех»

МП

Дата изготовления _____

Подписи лиц,
ответственных за приемку _____

----- Линия отреза -----

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники: Столик инструментальный
(наименование)

СИ - 01
(обозначение)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

примено 2/фв/мид
Ген. дир.
ООО "ПрофМедПром"
Золотов Е.В.



1. Введение
2. Описание объекта исследования
3. Методика исследования
4. Результаты исследования
5. Заключение

1. Введение
2. Описание объекта исследования
3. Методика исследования
4. Результаты исследования
5. Заключение

1. Введение
2. Описание объекта исследования
3. Методика исследования
4. Результаты исследования
5. Заключение

Общество с ограниченной ответственностью
«ПрофМедПром»

Столик инструментальный

СИ- 02

Руководство по эксплуатации

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «ПрофМедПром»
Золотов Е.В.



15 » сентября 2010г.

1 Назначение

Столик инструментальный СИ-02 (далее столик) предназначен для размещения на нем приборов и оборудования в процедурных, физиотерапевтических и других кабинетах медицинских и санаторно-курортных учреждений.

В связи с постоянной работой по совершенствованию столика, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры не более:

длина – 660 мм, ширина – 410 мм, высота – 860 мм

Масса столика не более 15 кг.

Максимальная нагрузка: на полку – не более 25 кг,

Средний срок службы не менее 5 лет.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: Столик* – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

* - поставляется в разобранном виде в составе:

стойка с колесными опорами – 2 шт.;

рама – 2 шт.;

полка – 2 шт.;

винт крепежный – 8 шт.;

4 Устройство и подготовка столика к работе

Столик представляет собой разборную конструкцию, состоящую из стоек с колесными опорами и рам, в которые вложены полки, выполненные из ламинированной диэлектрической плиты. Стойки и рамы связаны между собой резьбовыми соединениями.

Освободите столик от упаковки и произведите его сборку: совместите резьбовые отверстия верхней рамы с отверстиями стоек и закрепите раму винтами. Затем закрепите нижнюю раму. Вставьте полки в рамы.

Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфектантом, разрешенным к применению Минздравом РБ (салфетка должна быть отжата). После этого столик готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Столик может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования:

температура окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40 °С;

относительная влажность до 80 % при 25 °С.

Условия хранения в отапливаемых вентилируемых хранилищах при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40 °С;

относительная влажность до 80 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении столика на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном.

Адрес изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
Частное предприятие «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 68 35 73, 68 36 47

Дата изготовления _____

МП

Подписи лиц,
ответственных за приемку _____

----- Линия отреза -----

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят.
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники: Столик инструментальный
(наименование)

СИ - 02
(обозначение)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)



Итого 2 (два) листа
 000. 000. 000
 30.000.000.000

5 Транспортирование и хранение

Столики могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытых хранилищах при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность до 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие столиков требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается равным 12 месяцам со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении столика на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19, корп. 18
ЧПУП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 68 35 73, 68 36 47

Дата изготовления _____

Подписи лиц,
ответственных за приемку _____

МП

Столик инструментальный


СИ-03

Руководство по эксплуатации



Свердловская
Генеральный директор
ООО «ПрофМедПром»
Зотов Е.В.

Зотов Е.В., «15» сентября 2010г.

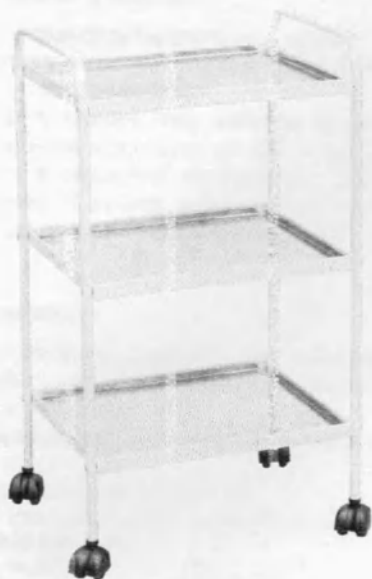

----- Линия отреза -----

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Изделие медицинской техники: Столик инструментальный
(наименование)

СИ - 03
(обозначение)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

**КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Гарантийный талон изъят
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

1 Назначение

Столик инструментальный СИ-03 (далее столик) предназначен для размещения на нем инструмента, материалов и медикаментов в кабинетах врачей, перевязочных, операционных, на постах медицинских сестер в отделениях больниц, в клиниках, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры не более:

длина – 510 мм, ширина – 390 мм, высота – 890 мм

Размер поддона – 455 x 375 x 12 мм

Расстояние между полками – 300 мм

Масса столика не более 12 кг.

Максимальная нагрузка на поддон – не более 8 кг

Средний срок службы не менее 5 лет.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: Столик* – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

* - поставляется в разобранном виде в составе:

рама – 3 шт.

стойка с колесными опорами – 2 шт.;

поддон – 3 шт.;

винт крепежный – 12 шт.

4 Устройство столика и указания по сборке и эксплуатации

Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса на колесных опорах и трех легкоъемных поддонов. Полимерное покрытие каркаса, наносимое методом порошкового напыления, устойчиво к механическим и химическим воздействиям. Поддоны выполнены из нержавеющей стали.

Сборку столика производите в следующем порядке:

- 1) освободите столик от упаковки, снимите защитную пленку с поддонов (при наличии);
- 2) соберите каркас, для чего совместите резьбовые отверстия верхней рамы с отверстиями стоек и закрепите раму винтами. Затем закрепите среднюю и нижнюю рамы;
- 3) установите поддоны на собранном каркасе;
- 4) проверьте винтовые соединения.

Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, разрешенным к применению Минздравом РБ (салфетка должна быть отжата). После этого столик готов к эксплуатации.

В связи с постоянной работой по совершенствованию столика, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

примено 2 (два) листа
Тех. зип.
ООО "ПроМедПром"
Завод Е.Ф.



5 Транспортирование и хранение

Столики могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытых хранилищах при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность до 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие столиков требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается равным 12 месяцам со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении столика на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
Частное предприятие «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приемке

Дата изготовления _____

Подписи лиц,
ответственных за приемку _____


МП

Общество с ограниченной ответственностью
«ПрофМедПром»

Столик инструментальный

СИ-04

Руководство по эксплуатации

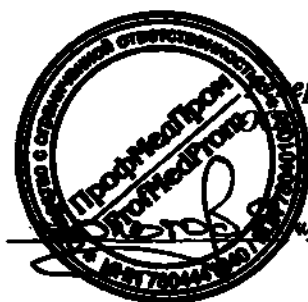

Утверждаю
Генеральный директор
«ПрофМедПром»
Золотов Е.В.

15 мая 2010 г.



----- Линия отреза -----

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Изделие медицинской техники: Столик инструментальный
(наименование)

СИ - 04
(обозначение)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

**КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Гарантийный талон изъят _____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

1 Назначение

Столик инструментальный СИ-04 (далее столик) предназначен для размещения на нем инструмента, материалов и медикаментов в кабинетах врачей, перевязочных, операционных, на постах медицинских сестер в отделениях больниц, в клиниках, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры не более:

длина – 845 мм, ширина – 575 мм, высота – 870 мм

Расстояние между полками – 400 мм

Масса столика не более 15 кг.

Максимальная распределенная нагрузка на поддон – не более 15 кг

Средний срок службы не менее 5 лет.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: Столик* – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

* - поставляется в разобранном виде в составе:

стойка с колесными опорами	– 2 шт.;
труба со втулками	– 4 шт.;
поддон	– 2 шт.;
винт крепежный	– 8 шт.;
ключ	– 1 шт.

По согласованию с заказчиком столик может поставляться в собранном виде.

4 Устройство столика и указания по сборке и эксплуатации


Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса на колесных опорах и поддонов. Полимерное покрытие каркаса, наносимое методом порошкового напыления, устойчиво к механическим и химическим воздействиям. Поддоны выполнены из нержавеющей стали.

Сборку столика (при поставке в разобранном виде) производите в следующем порядке:

- 1) освободите столик от упаковки, снимите защитную пленку с поддонов (при наличии);
- 2) соберите каркас, соединив винтами с помощью ключа стойки с трубами (через втулки, установленные в трубах изготовителем);
- 3) установите верхний и нижний поддоны на собранном каркасе;
- 4) проверьте винтовые соединения.

Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, разрешенным к применению Минздравом РБ (салфетка должна быть отжата). После этого столик готов к эксплуатации.

В связи с постоянной работой по совершенствованию столика, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем

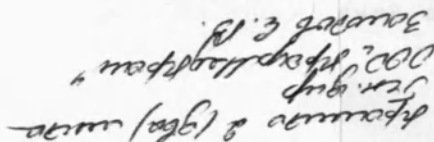



Общество с ограниченной ответственностью
«ПрофМедПром»

Столик инструментальный

СИ- 05

Руководство по эксплуатации



Утверждаю
Генеральный директор
ООО «ПрофМедПром»
Золотов Е.В.

«15» сентября 2010г.

1 Назначение

Столик инструментальный СИ-05 (далее столик) предназначен для размещения на нем инструмента, материалов и медикаментов в кабинетах врачей, операционных и перевязочных в клиниках и поликлиниках, на постах медицинских сестер в отделениях больниц и других медицинских учреждений.

В связи с постоянной работой по совершенствованию столика, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры не более:

длина – 660 мм, ширина – 410 мм, высота – 860 мм

Масса столика не более 10 кг.

Максимальная нагрузка: на полку – не более 10 кг,

Средний срок службы не менее 5 лет.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: Столик* – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

* - поставляется в разобранном виде в составе:

стойка с колесными опорами – 2 шт.;

рама – 2 шт.;

поддон – 2 шт.;

винт крепежный – 8 шт.;

4 Устройство и подготовка столика к работе

Столик представляет собой разборную конструкцию, состоящую из стоек с колесными опорами и рам, в которые вложены легкоъемные металлические поддоны. Стойки и рамы связаны между собой резьбовыми соединениями.

Освободите столик от упаковки и произведите его сборку: совместите резьбовые отверстия верхней рамы с отверстиями стоек и закрепите раму винтами. Затем закрепите нижнюю раму. Вставьте поддоны в рамы.

Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфектантом, разрешенным к применению Минздравом РБ (салфетка должна быть отжата). После этого столик готов к эксплуатации.



5 Транспортирование и хранение

Столик может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования:

температура окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40 °С;

относительная влажность до 80 % при 25 °С.

Условия хранения в отапливаемых вентилируемых хранилищах при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40 °С;

относительная влажность до 80 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении столика на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном.

Адрес изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
Частное предприятие «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приемке

Дата изготовления _____

МП

Подпись лиц,
ответственных за приемку _____

----- Линия отреза -----

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники: Столик инструментальный
(наименование)

СИ - 05

(обозначение)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

Исходные данные

№ п/п

Наименование

Единица измерения

Количество

Дата

Подпись

М.П.



применяется (гла) 2 мм А
 Ген. дир.
 ООО «ПрофМедПром»
 Золотов Е. В.

5 Транспортирование и хранение

Столик может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытых хранилищах при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность до 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается равным 12 месяцам со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении столика на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
Частное предприятие «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приемке

Дата изготовления _____

Подписи лиц,
ответственных за приемку _____

МП

Общество с ограниченной ответственностью
«ПрофМедПром»

Столик инструментальный


СИ-06

Руководство по эксплуатации



Утверждаю
Генеральный директор
ООО «ПрофМедПром»
Золотов Е.В.

«15» сентября 2010г.

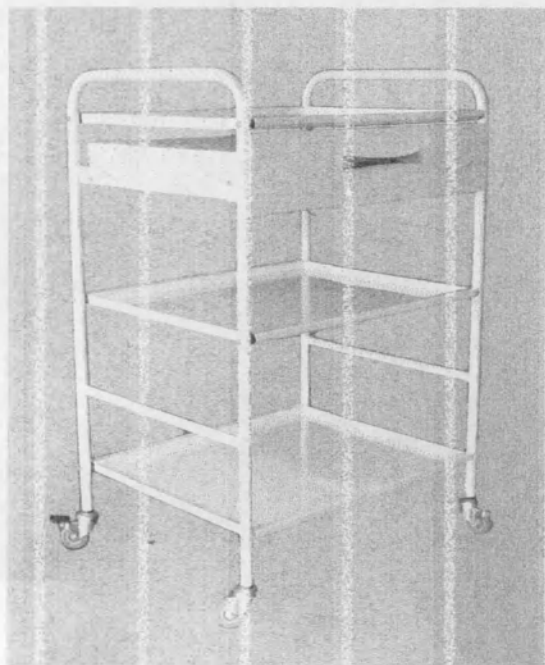

----- Линия отреза -----

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Изделие медицинской техники: **Столик инструментальный**
(наименование)

СИ - 06
(обозначение)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

**КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Гарантийный талон изъят
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

1 Назначение

Столик инструментальный СИ-06 (далее столик) предназначен для размещения инструмента, материалов, медикаментов в кабинетах врачей, перевязочных, операционных, на постах медицинских сестер в отделениях больницы, в клиниках, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры столика: длина – 580 мм,
ширина – 470 мм,
высота – 860 мм

Размеры рабочих поверхностей полок, мм – 540 x 430

Размеры ящика, мм – 510 x 450

Диаметр колесных опор – 50 мм

Масса столика не более 15 кг.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: Столик* – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Коробка упаковочная – 2 шт.

* - поставляется в разобранном виде в составе:

стойка с колесными опорами	– 2 шт.;
труба со втулками	– 6 шт.;
полка	– 3 шт.;
ящик	– 1 шт.;
ручка	– 1 шт.;
винт крепежный	– 12 шт.;
винт	– 2 шт.;
ключ	– 1 шт.

4 Устройство столика и указания по сборке и эксплуатации

Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса, съемных поддонов и выдвижного ящика. Установлен на самоориентирующиеся колесные опоры, две из которых оборудованы стопорным механизмом. Полимерное покрытие столика, наносимое методом порошкового напыления, устойчиво к механическим и химическим воздействиям.

Сборку столика производите в следующем порядке:

- 1) освободите от упаковки столик и ящик, упакованный отдельно;
- 2) соедините винтами ручку с ящиком;
- 3) соберите каркас, соединив винтами с помощью ключа стойки с трубами через втулки, установленные в трубах изготовителем, следующим образом:
 - соедините стойки с трубами, не зажимая винты до упора 0,5-1 мм;
 - вставьте ящик в направляющие, задвиньте его до упора. При необходимости выровняйте положение ящика одновременным нажатием на стойки в диагональном направлении (с передней стороны столика это стойка, к которой прилегает передняя панель ящика);
 - зажмите винты до упора;
- 4) установите поддоны на собранном каркасе;

Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, разрешенным к применению Минздравом (салфетка должна быть отжата). После этого столик готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Столики могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытых хранилищах при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность до 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие столиков требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается равным 12 месяцам со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении столика на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
Частное предприятие «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приемке

Дата изготовления _____

Подписи лиц,
ответственных за приемку _____

МП

Общество с ограниченной ответственностью
«ПрофМедПром»

Столик инструментальный

СИ-07

Руководство по эксплуатации

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «ПрофМедПром»
Золотов Е.В.



«15» сентября 2010г.



----- Линия отреза -----

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Изделие медицинской техники: Столик инструментальный
(наименование)

СИ - 07
(обозначение)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

**КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Гарантийный талон изъят
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

1 Назначение

Столик инструментальный СИ-07 (далее столик) предназначен для размещения на нем инструмента, материалов и медикаментов в кабинетах врачей, перевязочных, операционных, на постах медицинских сестер в отделениях больницы, в клиниках, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры не более:

длина – 600 мм, ширина – 440 мм, высота – 870 мм

Расстояние между полками – 400 мм

Масса столика не более 10 кг.

Максимальная нагрузка на поддон – не более 10 кг

Средний срок службы не менее 5 лет.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: Столик* – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

* - поставляется в разобранном виде в составе:

стойка с колесными опорами	– 2 шт.;
труба со втулками	– 4 шт.;
поддон	– 2 шт.;
винт крепежный	– 8 шт.;
ключ	– 1 шт.

По согласованию с заказчиком столик может поставаться в собранном виде.

4 Устройство столика и указания по сборке и эксплуатации

Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса на колесных опорах и поддонов. Полимерное покрытие каркаса, наносимое методом порошкового напыления, устойчиво к механическим и химическим воздействиям. Поддоны выполнены из нержавеющей стали.

Сборку столика (при поставке в разобранном виде) производите в следующем порядке:

- 1) освободите столик от упаковки, снимите защитную пленку с поддонов (при наличии);
- 2) соберите каркас, соединив винтами с помощью ключа стойки с трубами (через втулки, установленные в трубах изготовителем);
- 3) установите верхний и нижний поддоны на собранном каркасе;
- 4) проверьте винтовые соединения.

Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, разрешенным к применению Минздравом РБ (салфетка должна быть отжата). После этого столик готов к эксплуатации.

В связи с постоянной работой по совершенствованию столика, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем



Ирина Владимировна
Ирина Владимировна
Ирина Владимировна

Общество с ограниченной ответственностью
«ПрофМедПром»

Столик инструментальный

СИ- 08

Руководство по эксплуатации

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «ПрофМедПром»
А.А. Матвеев Е.В.



1 Назначение

Столик инструментальный СИ-08 (далее столик) предназначен для размещения на нем инструмента, материалов и медикаментов в кабинетах врачей, операционных и перевязочных в клиниках и поликлиниках, на постах медицинских сестер в отделениях больниц и других медицинских учреждений.

В связи с постоянной работой по совершенствованию столика, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры не более:

длина – 660 мм, ширина – 410 мм, высота – 860 мм

Масса столика не более 10 кг.

Максимальная нагрузка: на полку – не более 10 кг,

Средний срок службы не менее 5 лет.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: Столик* – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

* - поставляется в разобранном виде в составе:

стойка с колесными опорами – 2 шт.;

рама – 2 шт.;

поддон – 1 шт.;

стекло – 1 шт.;

винт крепежный – 8 шт.;

4 Устройство и подготовка столика к работе

Столик представляет собой разборную конструкцию, состоящую из стоек с колесными опорами и рам, в которые вложены легкосъемный металлический поддон и полка из стекла. Стойки и рамы связаны между собой резьбовыми соединениями.

Освободите столик от упаковки и произведите его сборку: совместите резьбовые отверстия верхней рамы с отверстиями стоек и закрепите раму винтами. Затем закрепите нижнюю раму. Вставьте стекло и металлический поддон в рамы.

Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфектантом, разрешенным к применению Минздравом РБ (салфетка должна быть отжата). После этого столик готов к эксплуатации.



5 Транспортирование и хранение

Столик может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования:

температура окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40 °С;

относительная влажность до 80 % при 25 °С.

Условия хранения в отапливаемых вентилируемых хранилищах при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40 °С;

относительная влажность до 80 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении столика на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном.

Адрес изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
Частное предприятие «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приемке

Дата изготовления _____

МП

Подписи лиц,
ответственных за приемку _____

----- Линия отреза -----

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники: Столик инструментальный
(наименование)

СИ - 08

(обозначение)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)




Общество с ограниченной ответственностью
«ПрофМедПром»

Столик инструментальный

СИ- 09

Руководство по эксплуатации

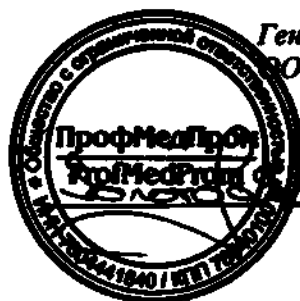

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «ПрофМедПром»
Золотов Е.В.

Е.В. Золотов 15 сентября 2010г.

1 Назначение

Столик инструментальный СИ-09 (далее столик) предназначен для размещения на нем инструмента, материалов и медикаментов в кабинетах врачей, операционных и перевязочных в клиниках и поликлиниках, на постах медицинских сестер в отделениях больниц и других медицинских учреждений.

В связи с постоянной работой по совершенствованию столика, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры не более:

длина – 660 мм, ширина – 410 мм, высота – 860 мм

Масса столика не более 10 кг.

Максимальная нагрузка: на полку – не более 10 кг,

Средний срок службы не менее 5 лет.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: Столик* – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

* - поставляется в разобранном виде в составе:

стойка с колесными опорами – 2 шт.;

рама – 2 шт.;

стекло – 2 шт.;

винт крепежный – 8 шт.;

4 Устройство и подготовка столика к работе

Столик представляет собой разборную конструкцию, состоящую из стоек с колесными опорами и рам, в которые вложены полки из стекла. Стойки и рамы связаны между собой резьбовыми соединениями.

Освободите столик от упаковки и произведите его сборку: совместите резьбовые отверстия верхней рамы с отверстиями стоек и закрепите раму винтами. Затем закрепите нижнюю раму. Вставьте стеклянные полки в рамы.

Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфектантом, разрешенным к применению Минздравом РБ (салфетка должна быть отжата). После этого столик готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Столик может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования:

температура окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40 °С;

относительная влажность до 80 % при 25 °С.

Условия хранения в отапливаемых вентилируемых хранилищах при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40 °С;

относительная влажность до 80 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении столика на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном.

Адрес изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
Частное предприятие «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приемке

Дата изготовления _____

МП

Подпись лиц,
ответственных за приемку _____

----- Линия отреза -----

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники: Столик инструментальный
(наименование)

СИ - 09
(обозначение)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

1. Целью исследования является...

2. Задачи исследования...

3. Методы исследования...

4. Результаты исследования...

5. Выводы...

Исследовательский центр	
Адрес: ...	
Телефон: ...	
E-mail: ...	
Дата: ...	
Исследователь: ...	
Подпись: ...	
Печать: ...	

1. Целью исследования является...

2. Задачи исследования...

3. Методы исследования...

4. Результаты исследования...

5. Выводы...

Красно 2(два) июля
 Кн. д.р.
 ООО "ПроМедПром"
 Заведов. е.р.



5 Транспортирование и хранение

Столик может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытых хранилищах при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность до 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается равным 12 месяцам со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении столика на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
Частное предприятие «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приемке

Дата изготовления _____

Подписи лиц,
ответственных за приемку _____

МП

**Общество с ограниченной ответственностью
«ПрофМедПром»**


Столик инструментальный СИ-10

Руководство по эксплуатации



**Утверждаю
Генеральный директор
ООО «ПрофМедПром»
Золотов Е.В.**

«В» 11 мая 2010г.

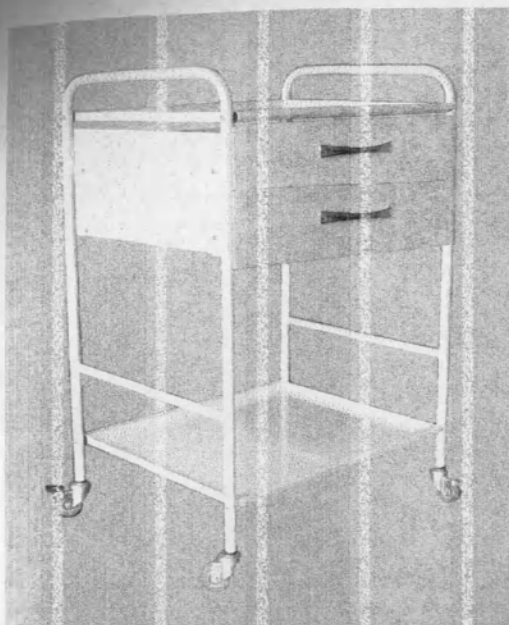

----- Линия отреза -----

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Изделие медицинской техники: Столик инструментальный
(наименование)

СИ - 06
(обозначение)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

**КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Гарантийный талон изъят
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

1 Назначение

Столик инструментальный СИ-10 (далее столик) предназначен для размещения инструмента, материалов, медикаментов в кабинетах врачей, перевязочных, операционных, на постах медицинских сестер в отделениях больницы, в клиниках, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры столика не более: длина — 580 мм,
ширина — 465 мм,
высота — 855 мм

Размеры рабочих поверхностей полок, мм — 540 x 430

Размеры ящика, мм — 510 x 450

Диаметр колесных опор — 50 мм

Масса столика не более 20 кг.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: Столик* — 1 шт.
Паспорт — 1 шт.
Коробка упаковочная — 2 шт.

* - поставляется в разобранном виде в составе:

стойка с колесными опорами	— 2 шт.;
труба со втулками	— 4 шт.;
полка	— 2 шт.;
ящик	— 2 шт.;
ручка	— 2 шт.;
винт крепежный	— 8 шт.;
винт	— 4 шт.;
ключ	— 1 шт.

4 Устройство столика и указания по сборке и эксплуатации

Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса, съемных поддонов и выдвижных ящиков. Установлен на самоориентирующиеся колесные опоры, две из которых оборудованы стопорным механизмом. Полимерное покрытие столика, наносимое методом порошкового напыления, устойчиво к механическим и химическим воздействиям.

Сборку столика производите в следующем порядке:

- 1) освободите от упаковки столик и ящики, упакованные отдельно;
- 2) соедините винтами ручки с ящиками;
- 3) соберите каркас, соединив винтами с помощью ключа стойки с трубами через втулки, установленные в трубах изготовителем, следующим образом:
 - соедините стойки с трубами, не зажимая винты до упора 0,5-1 мм;
 - вставьте верхний ящик в направляющие, задвиньте его до упора. При необходимости выровняйте положение ящика одновременным нажатием на стойки в диагональном направлении (с передней стороны столика это стойка, к которой прилегает передняя панель ящика);
 - вставьте второй ящик;
 - зажмите винты до упора;
- 4) установите поддоны на собранном каркасе;

Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, разрешенным к применению Минздравом (салфетка должна быть отжата). После этого столик

1. Назначение
 2. Технические характеристики
 3. Комплектация
 4. Условия эксплуатации
 5. Гарантийные обязательства

1. Технические характеристики
 2. Комплектация
 3. Условия эксплуатации
 4. Гарантийные обязательства

1. Технические характеристики
 2. Комплектация
 3. Условия эксплуатации
 4. Гарантийные обязательства

1. Технические характеристики
 2. Комплектация
 3. Условия эксплуатации
 4. Гарантийные обязательства

1. Технические характеристики
 2. Комплектация
 3. Условия эксплуатации
 4. Гарантийные обязательства

1. Технические характеристики
 2. Комплектация
 3. Условия эксплуатации
 4. Гарантийные обязательства

1. Технические характеристики
 2. Комплектация
 3. Условия эксплуатации
 4. Гарантийные обязательства

1. Технические характеристики
 2. Комплектация
 3. Условия эксплуатации
 4. Гарантийные обязательства

1. Технические характеристики
 2. Комплектация
 3. Условия эксплуатации
 4. Гарантийные обязательства

Примено 2 (два) листа
 Тех. дир.
 ООО "ПрофМедПром"
 Завед. Е. В.
 Золотая



5 Транспортирование и хранение

Столики могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытых хранилищах при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность до 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие столиков требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается равным 12 месяцам со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении столика на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
ЧПУП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приемке

Дата изготовления _____

Подписи лиц,
ответственных за приемку _____

МП

Общество с ограниченной ответственностью
«ПрофМедПром»

Столик инструментальный СИ-11

Руководство по эксплуатации

Утверждаю
Генеральный директор
«ПрофМедПром»
Волотов Е.В.
15» сентября 2010г.





-----Линия отреза-----

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Изделие медицинской техники: Столик инструментальный
(наименование)

СИ - 11
(обозначение)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

**КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Гарантийный талон изъят _____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

1 Назначение

Столик инструментальный СИ-11 (далее столик) из нержавеющей стали предназначен для размещения на нем инструмента, материалов и медикаментов в операционных, перевязочных, кабинетах врачей, на постах медицинских сестер в отделениях больниц, в клиниках, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры не более:

длина – 600 мм, ширина – 440 мм, высота – 870 мм

Расстояние между полками – 400 мм

Масса столика не более 13 кг.

Максимальная нагрузка на поддон – не более 10 кг

Средний срок службы не менее 5 лет.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: Столик* – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

* - поставляется в разобранном виде в составе:

стойка с колесными опорами	– 2 шт.;
труба со втулками	– 4 шт.;
поддон	– 2 шт.;
винт крепежный	– 8 шт.;
ключ	– 1 шт.

По согласованию с заказчиком столик может поставляться в собранном виде.

4 Устройство столика и указания по сборке и эксплуатации

Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию из нержавеющей стали, выполненную в виде каркаса и легкоъемных поддонов. Столик установлен на колесные опоры, две из которых имеют тормозное устройство.

Сборку столика (при поставке в разобранном виде) производите в следующем порядке:

- 1) освободите столик от упаковки, снимите защитную пленку с поддонов (при наличии);
- 2) соберите каркас, соединив винтами с помощью ключа стойки с трубами (через втулки, установленные в трубах изготовителем);
- 3) установите верхний и нижний поддоны на собранном каркасе;
- 4) проверьте винтовые соединения.

Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, разрешенным к применению Минздравом РБ (салфетка должна быть отжата). После этого столик готов к эксплуатации.

В связи с постоянной работой по совершенствованию столика, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

09.06.2020 2/9/20/2020-
 Тен. групп
 ООО "Проф.мед.пром"
 Заваров Е. В.



5 Транспортирование и хранение

Столики могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытых хранилищах при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность до 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие столиков требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается равным 12 месяцам со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении столика на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
ЧПУП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приемке

Дата изготовления _____

Подписи лиц,
ответственных за приемку _____

МП

Общество с ограниченной ответственностью
«ПрофМедПром»

Столик инструментальный

СИ-12

Руководство по эксплуатации

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «ПрофМедПром»
Александров Е.В.



Александров Е.В. 2010г.



----- Линия отреза -----

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Изделие медицинской техники: **Столик инструментальный**
(наименование)

СИ - 12
(обозначение)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

**КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Гарантийный талон изъят
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

1 Назначение

Столик инструментальный СИ-12 (далее столик) из нержавеющей стали предназначен для размещения на нем инструмента, материалов и медикаментов в операционных, перевязочных, кабинетах врачей, на постах медицинских сестер в отделениях больниц, в клиниках, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры не более:

длина – 845 мм, ширина – 575 мм, высота – 870 мм

Расстояние между полками – 400 мм

Масса столика не более 15 кг.

Максимальная распределенная нагрузка на поддон – не более 15 кг

Средний срок службы не менее 5 лет.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: Столик* – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

* - поставляется в разобранном виде в составе:

стойка с колесными опорами	– 2 шт.;
труба со втулками	– 4 шт.;
поддон	– 2 шт.;
винт крепежный	– 8 шт.;
ключ	– 1 шт.

По согласованию с заказчиком столик может поставляться в собранном виде.

4 Устройство столика и указания по сборке и эксплуатации

Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию из нержавеющей стали, выполненную в виде каркаса и легкоъемных поддонов. Столик установлен на колесные опоры, две из которых имеют тормозное устройство.

Сборку столика (при поставке в разобранном виде) производите в следующем порядке:

- 1) освободите столик от упаковки, снимите защитную пленку с поддонов (при наличии);
- 2) соберите каркас, соединив винтами с помощью ключа стойки с трубами (через втулки, установленные в трубах изготовителем);
- 3) установите верхний и нижний поддоны на собранном каркасе;
- 4) проверьте винтовые соединения.

Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, разрешенным к применению Минздравом РБ (салфетка должна быть отжата). После этого столик готов к эксплуатации.

В связи с постоянной работой по совершенствованию столика, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

