

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «Сирона Денталь Системс»**



М.В. Кротенко


"10" февраля 2017 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Аппарат рентгеновский интраоральный HELIODENT Plus с
принадлежностями, производства SIRONA Dental Systems GmbH
(СИРОНА Дентал Системс ГмбХ), Германия**


СОДЕРЖАНИЕ


Аппарат рентгеновский интраоральный Heliodent Plus с принадлежностями	
Аппарат рентгеновский интраоральный Heliodent Plus	3
1. Трубка рентгеновская.	4
2. Пульт управления.	5
3. Пульт дистанционного управления.	6
4. Тубус.	7
5. Консоль с соединительной панелью	8
II. Принадлежности:	
1. Тест фантом для контроля параметров рентгеновского излучения.	9
2. Тест фантом для проверки стабильности параметров датчика XIOS XG.	10
3. Тест фантом для проверки стабильности параметров датчика XIOS Plus.	11
4. Тест фантом для проверки стабильности параметров универсального датчика XIOS.	12
5. Четырехгранный удлинитель тубуса до фокусного расстояния от кожи 300 мм (12").	13
6. Ограничитель поля излучения белый, размер 0 (1,8 x 2,4 см).	14
7. Ограничитель поля излучения черный, размер 1 (2 x 3 см).	15
8. Ограничитель поля излучения синий, размер 2 (3 x 4 см).	16
9. Эксплуатационная документация: инструкция по эксплуатации, технический осмотр, требования к установке	17
Приложение №1	18

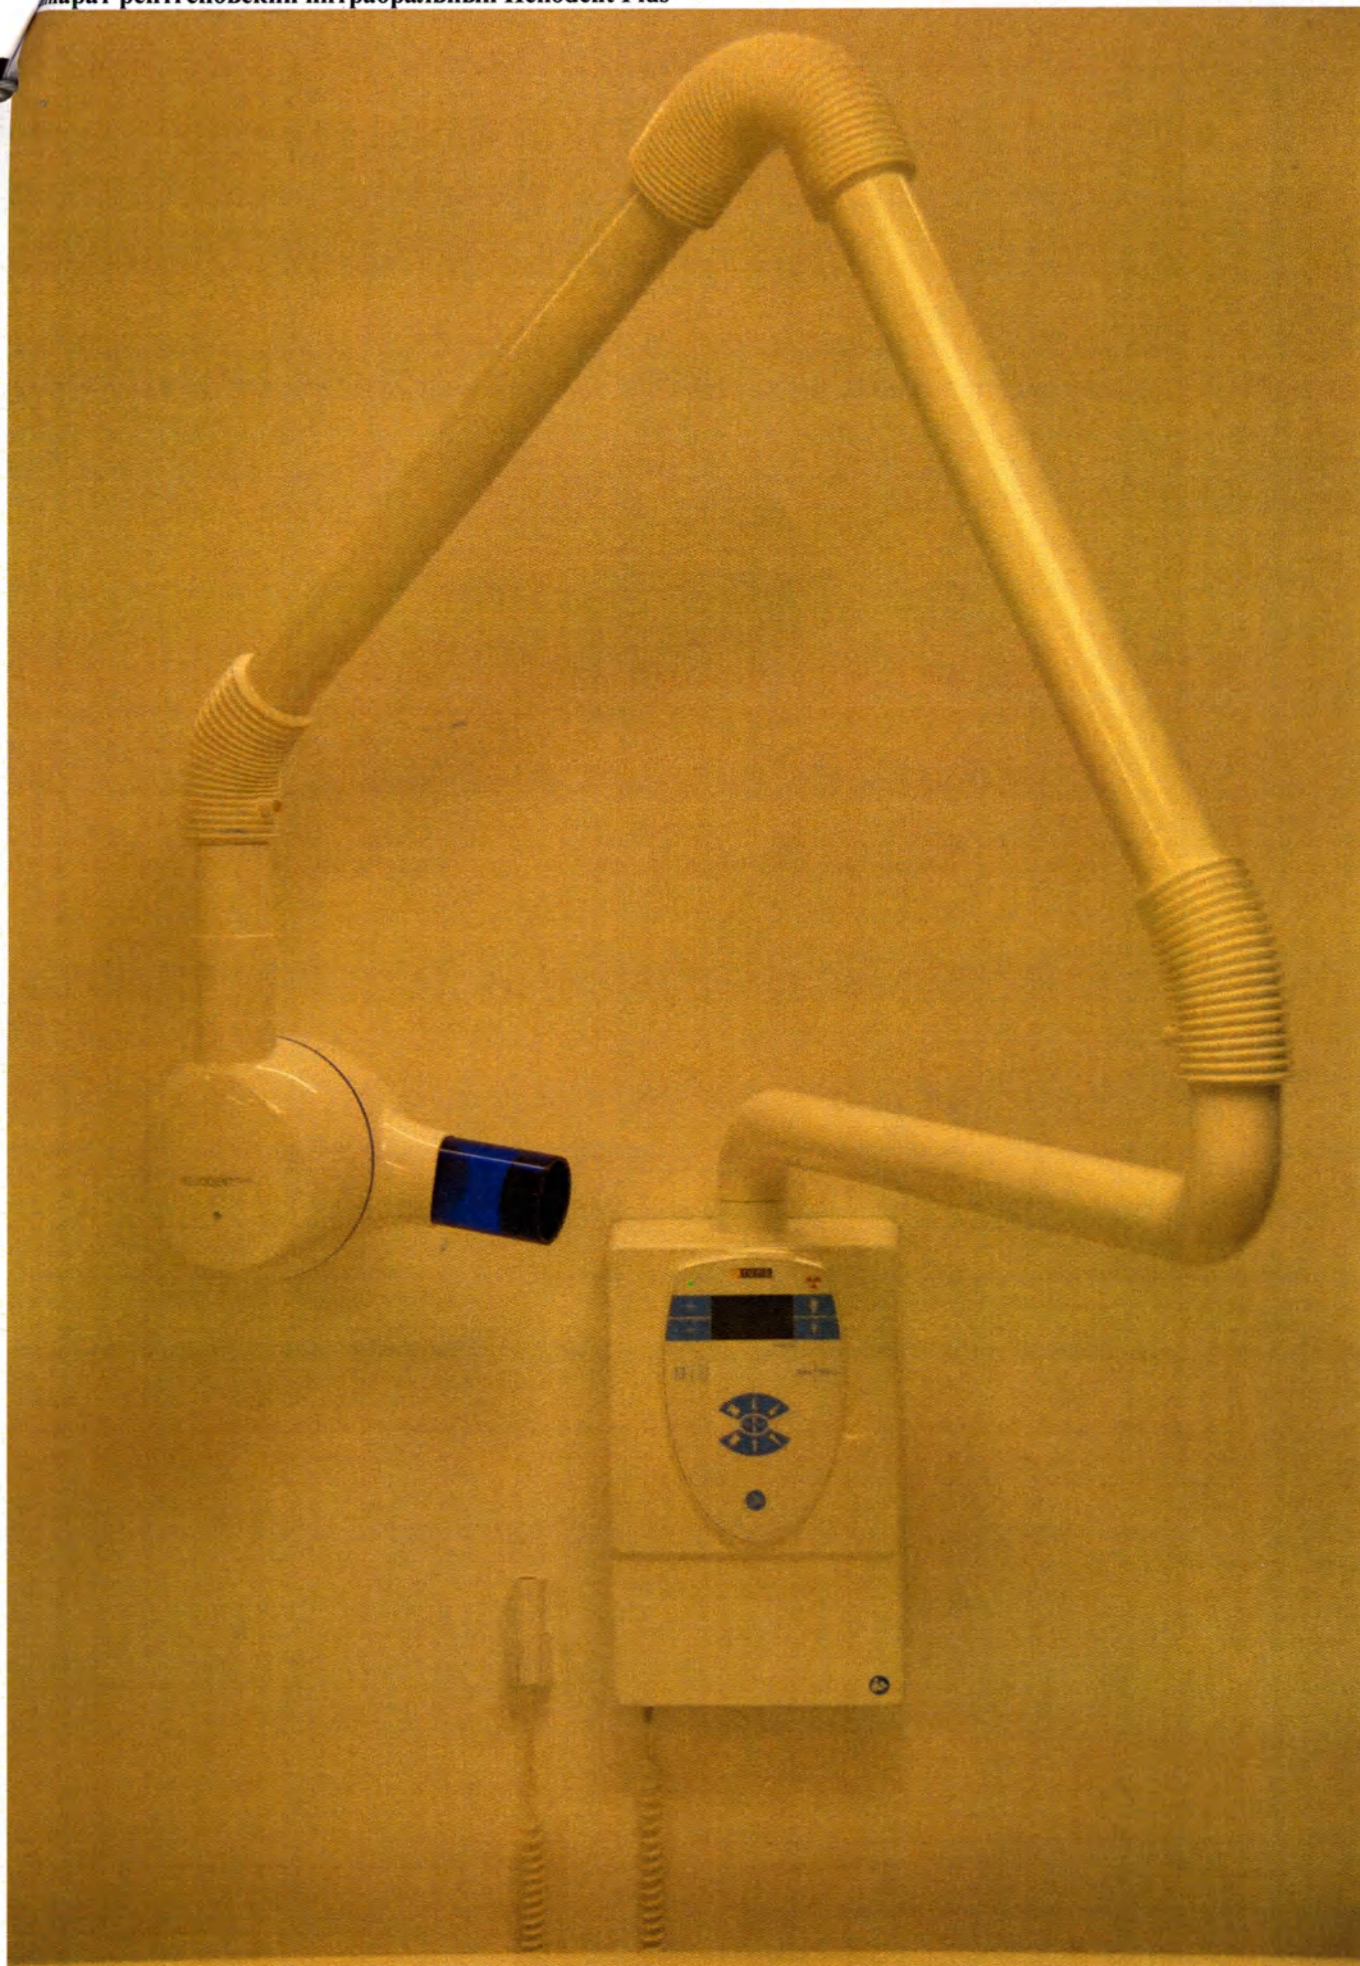



1. Трубка рентгеновская.



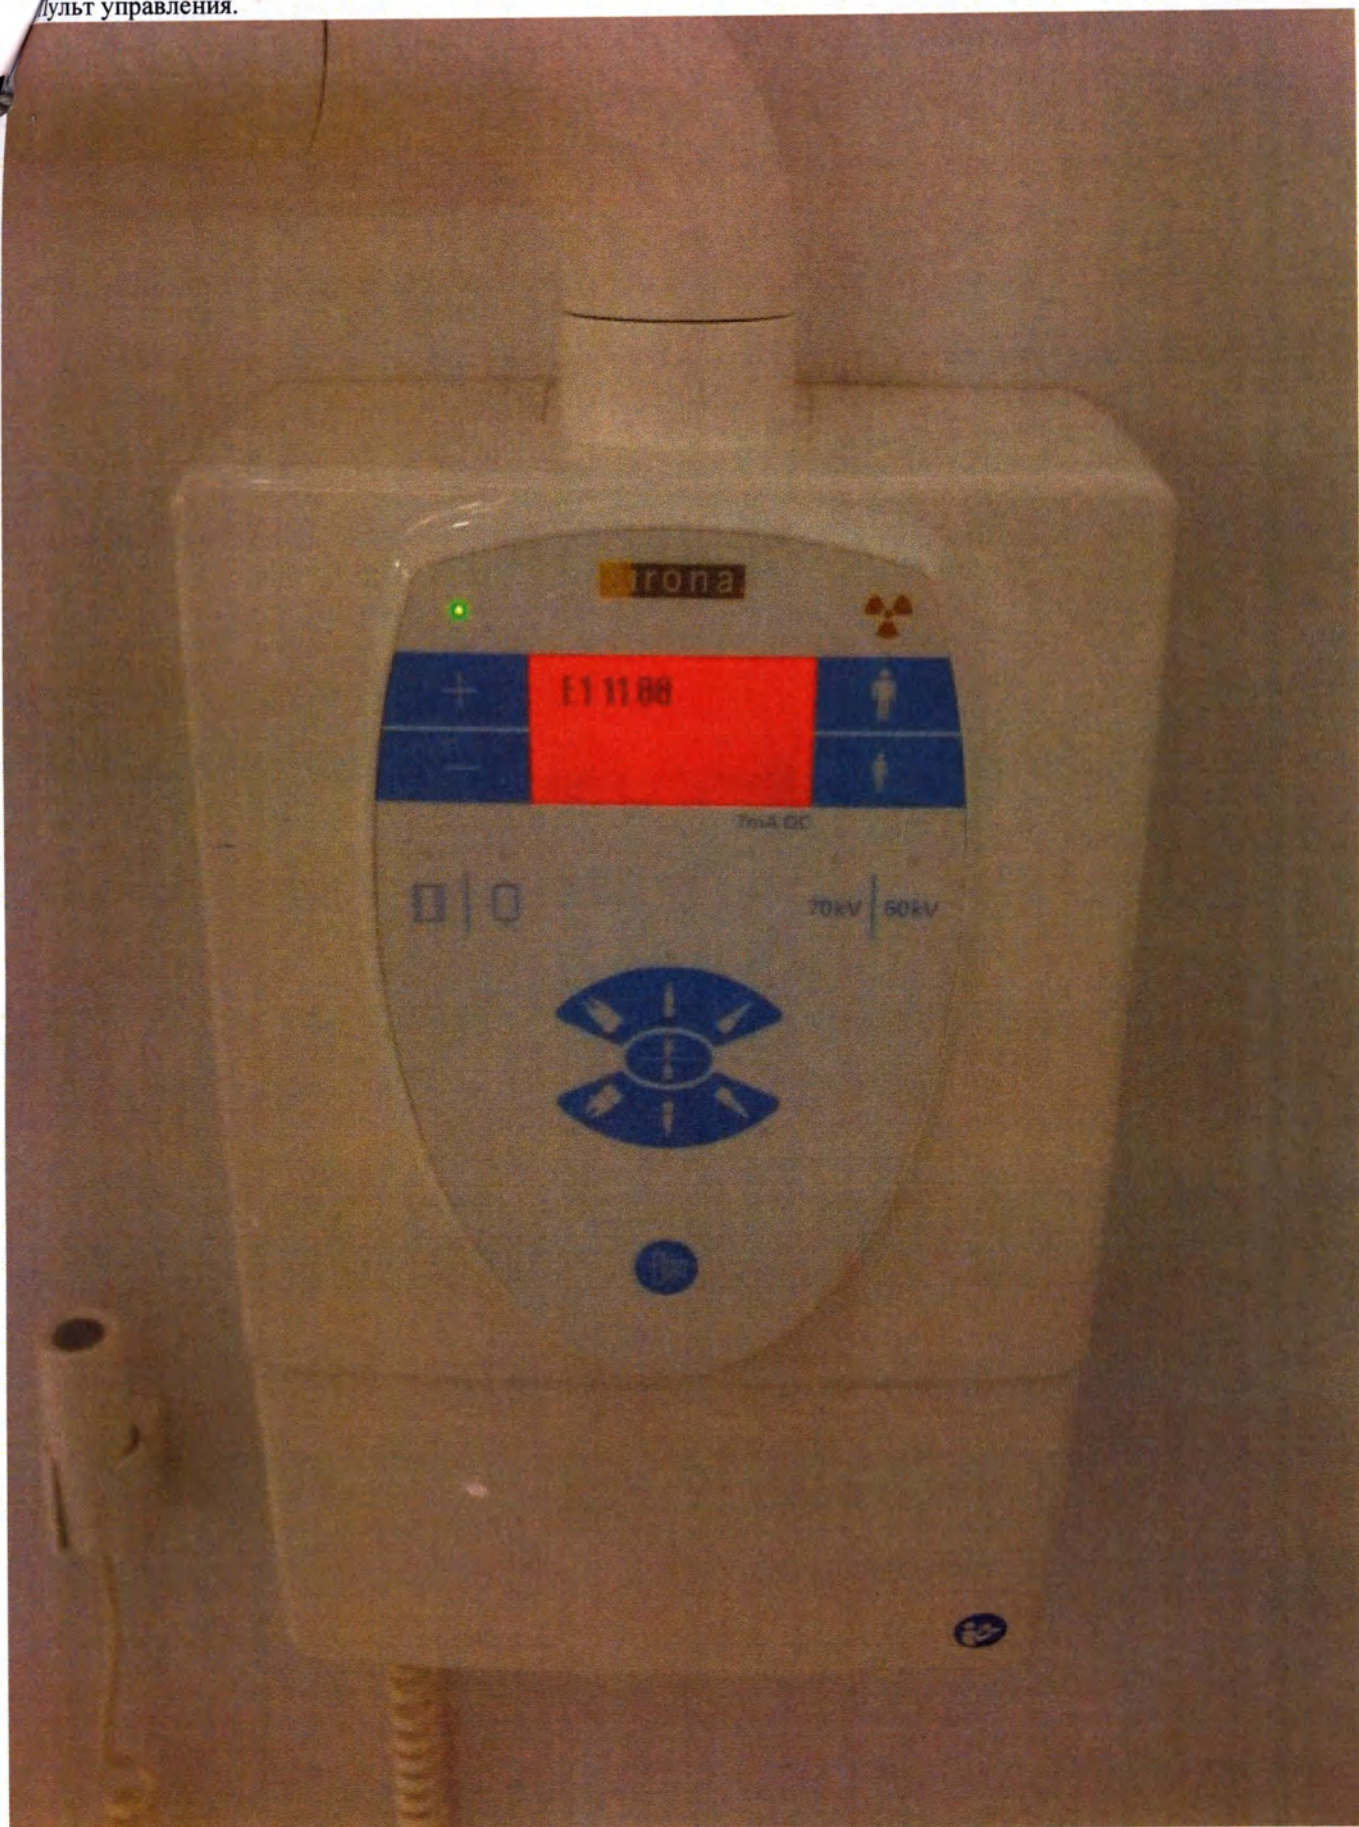

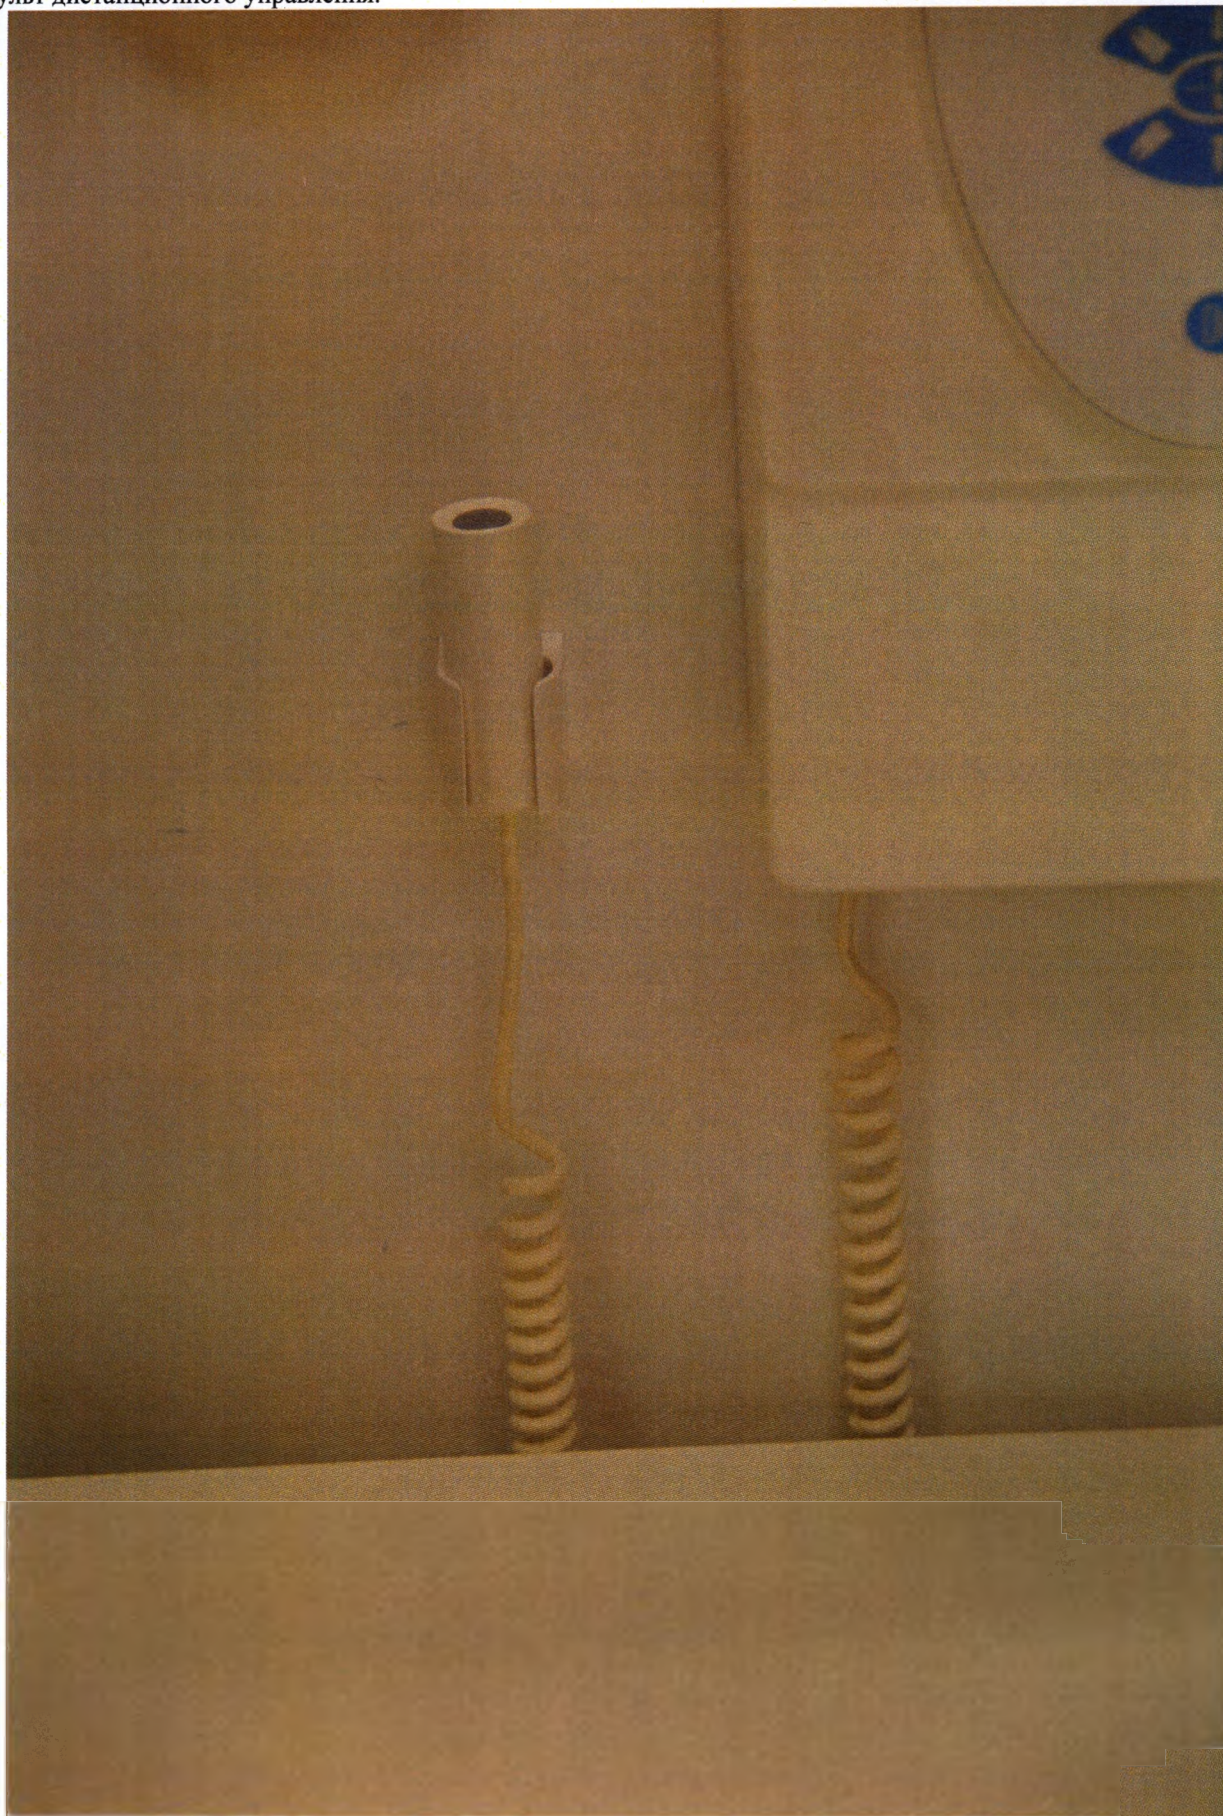

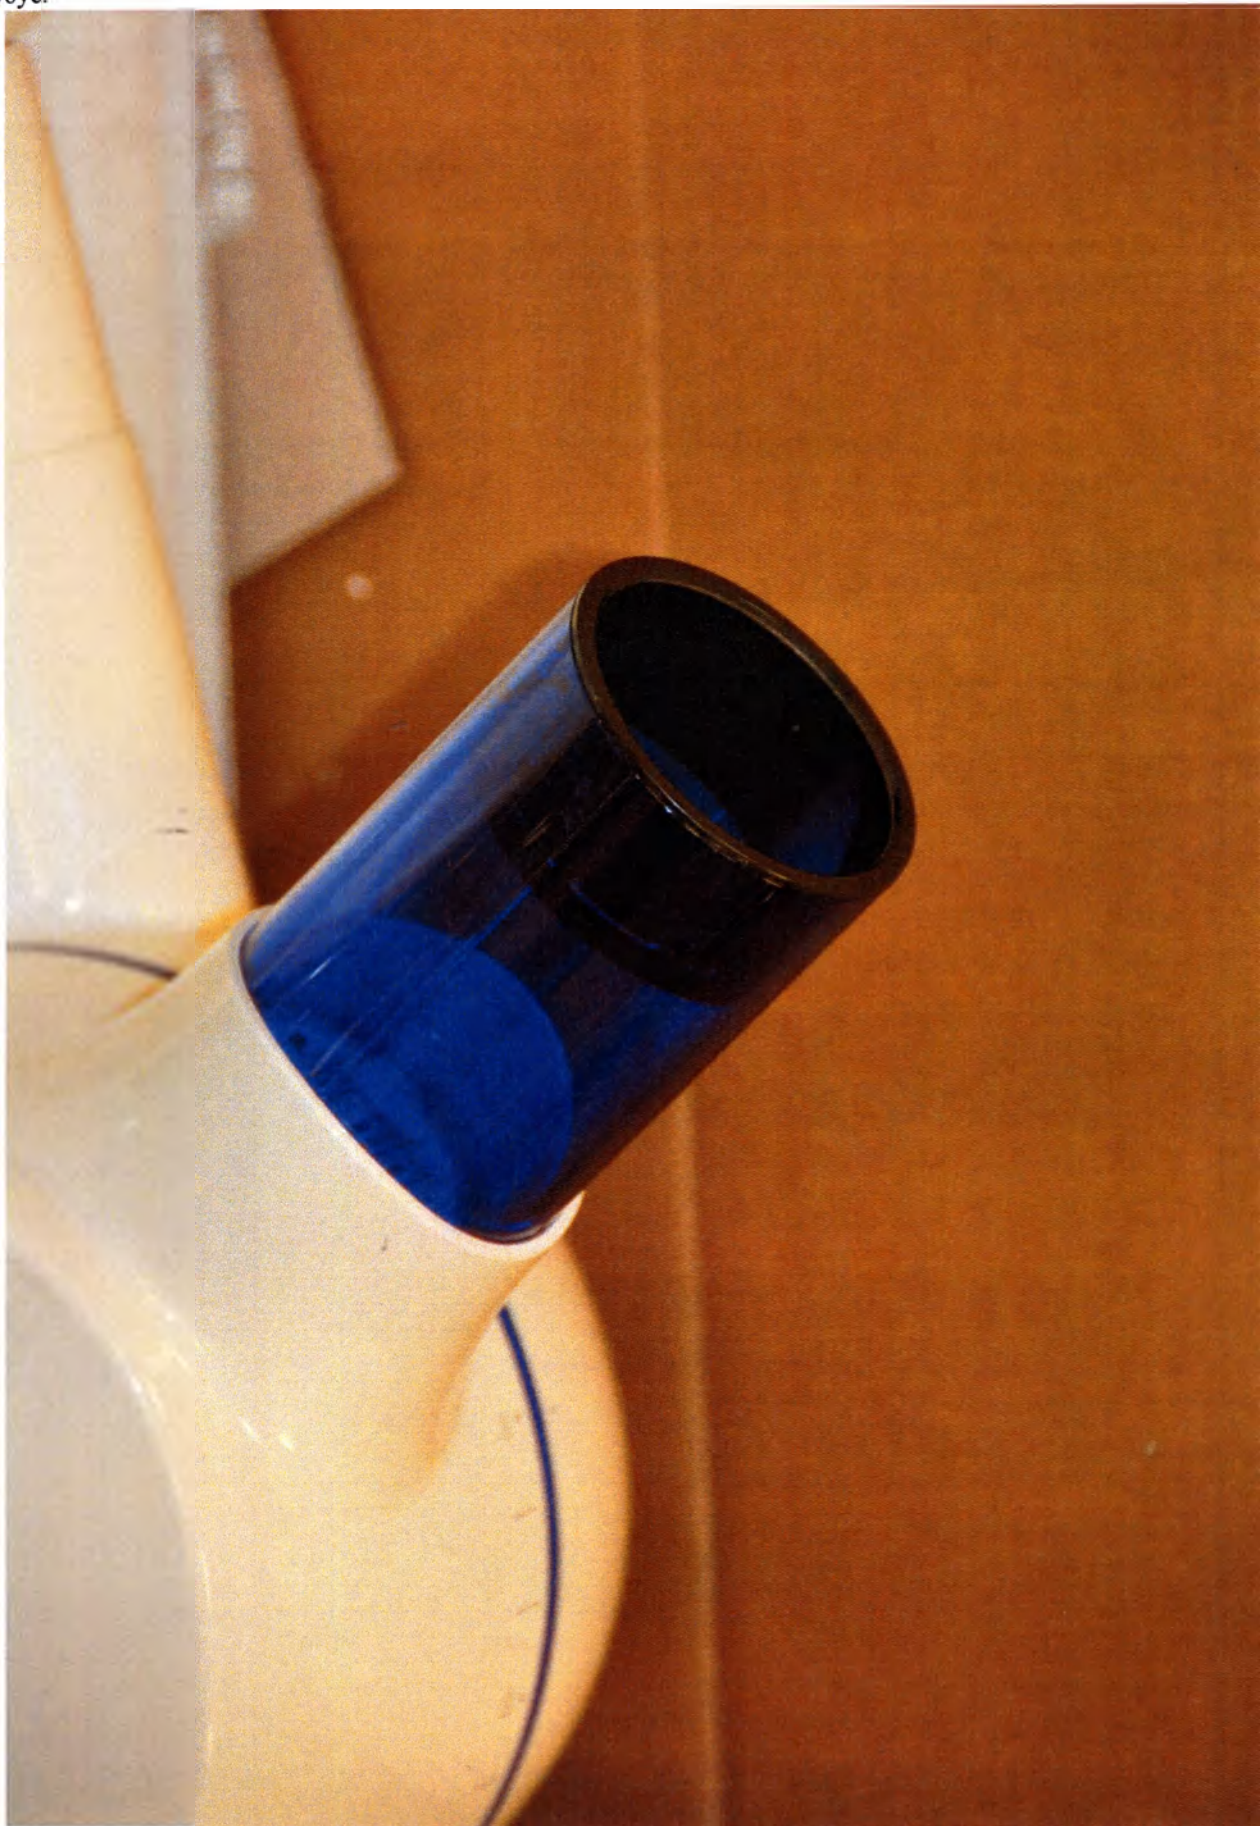

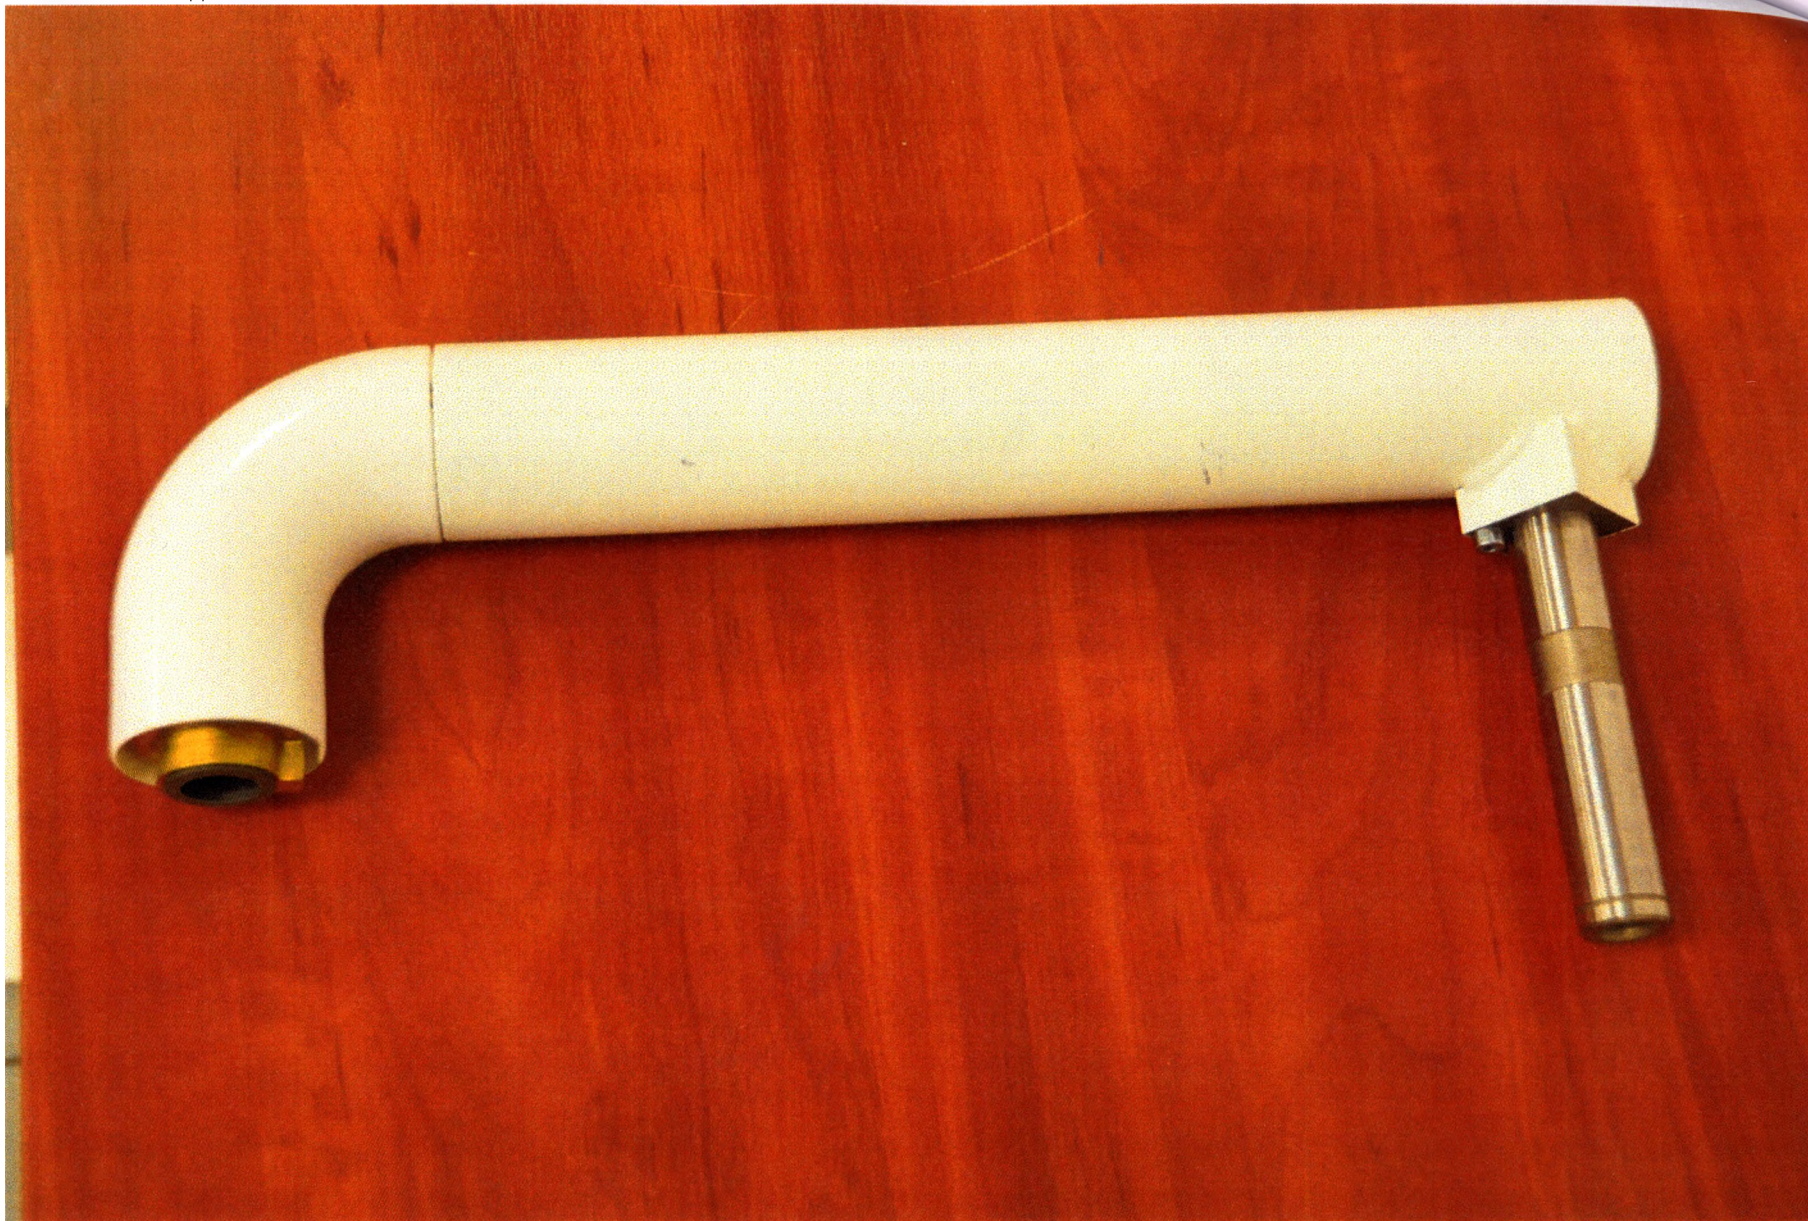







3. Тест фантом для проверки стабильности параметров датчика XIOS Plus.




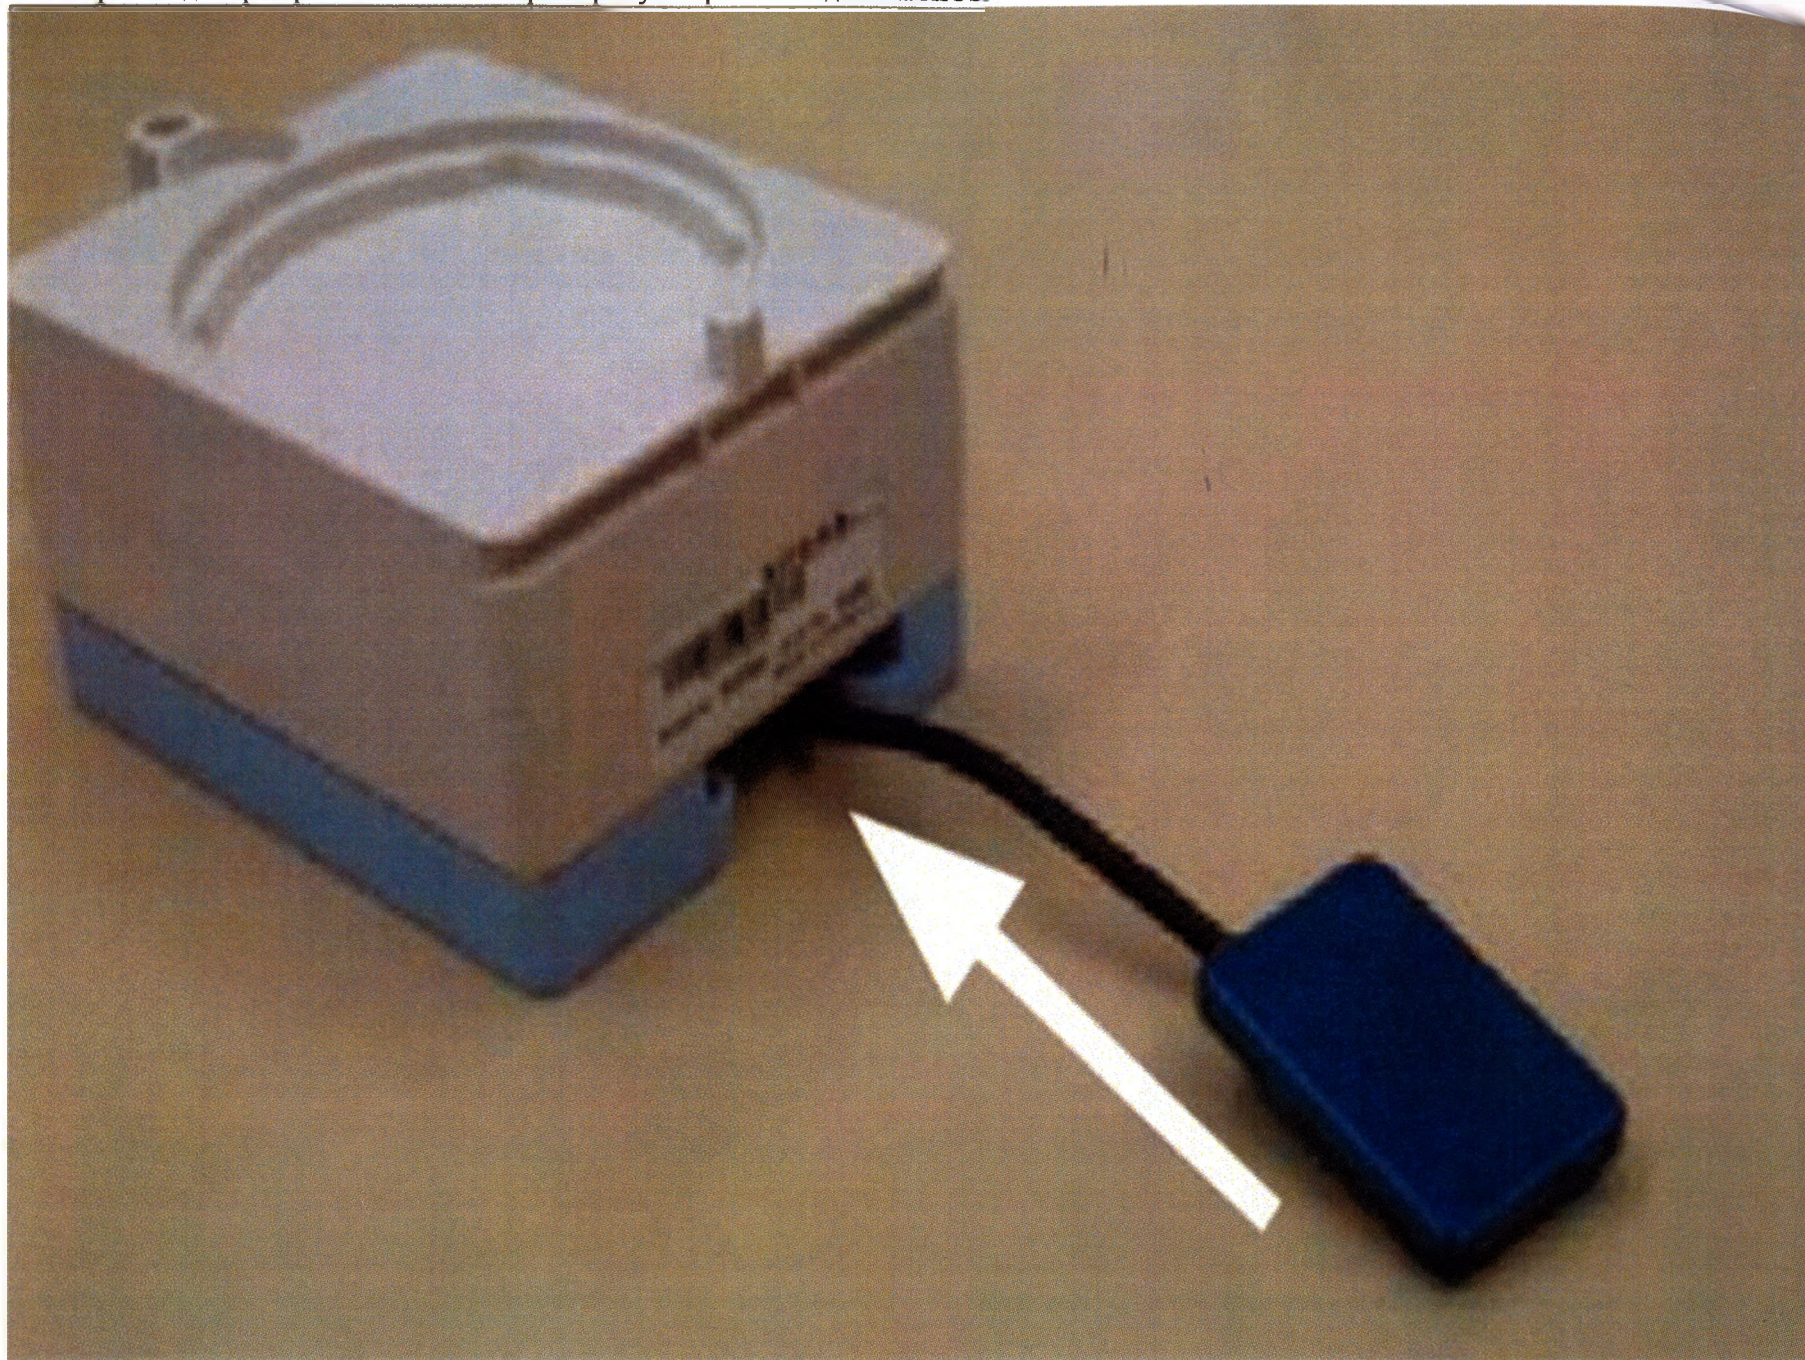

5. Четырехгранный удлинитель тубуса до фокусного расстояния от кожи 300 мм (12").

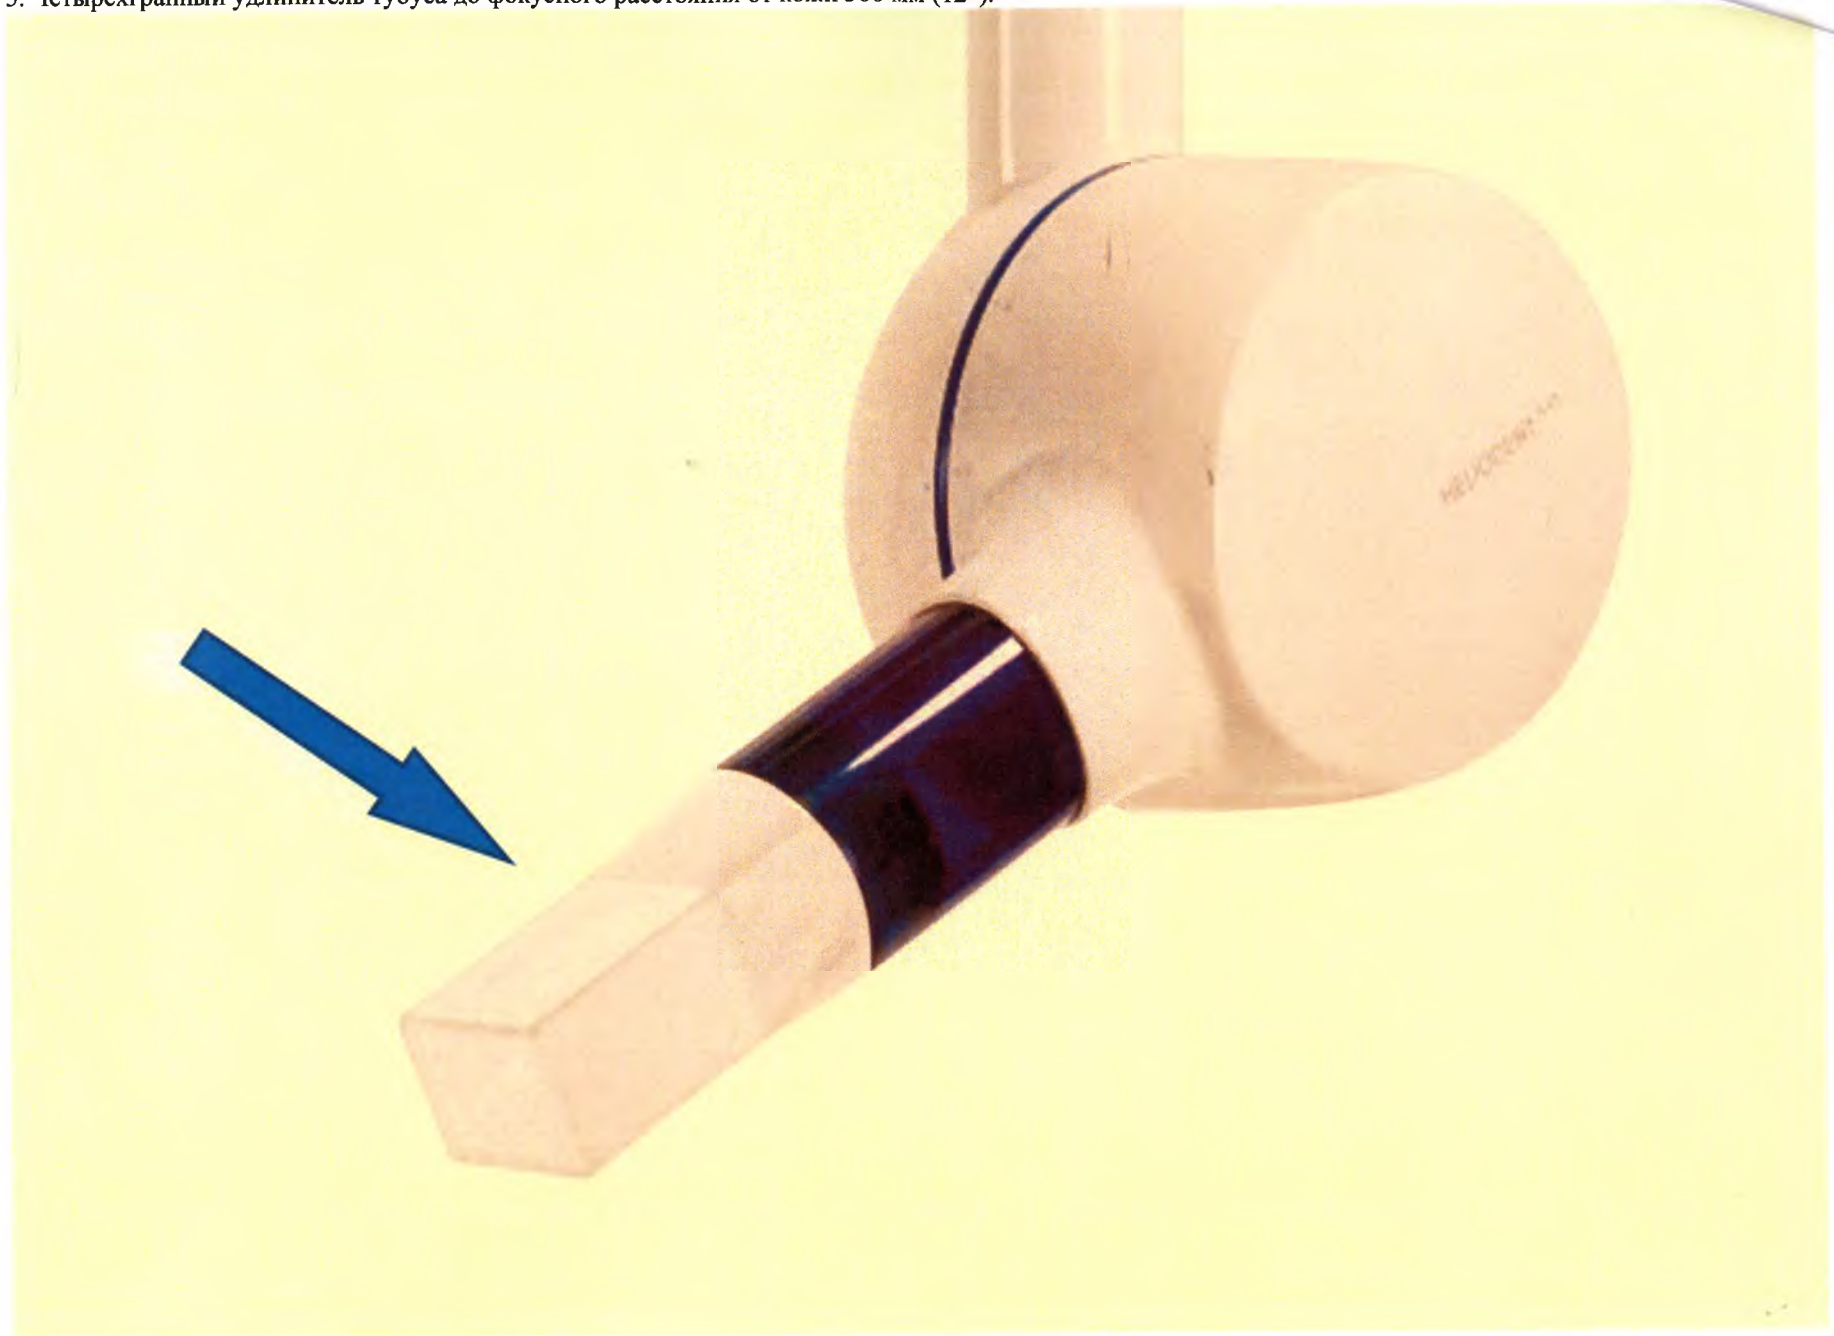


6. Ограничитель поля излучения белый, размер 0 (1,8 x 2,4 см).

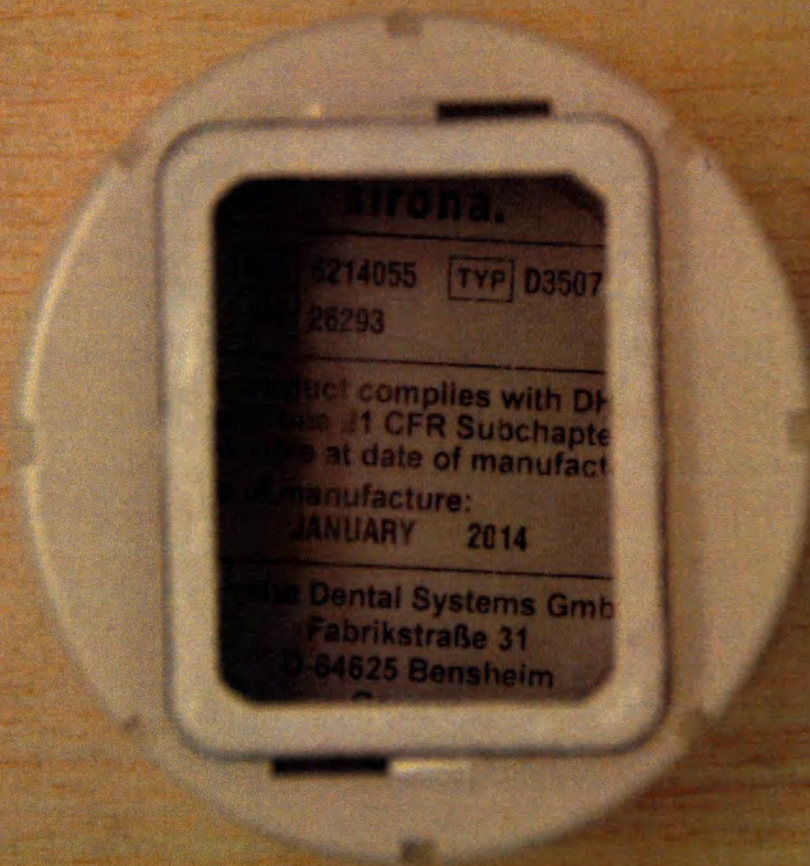

7. Ограничитель поля излучения черный, размер 1 (2 x 3 см).



8. Ограничитель поля излучения синий, размер 2 (3 x 4 см).

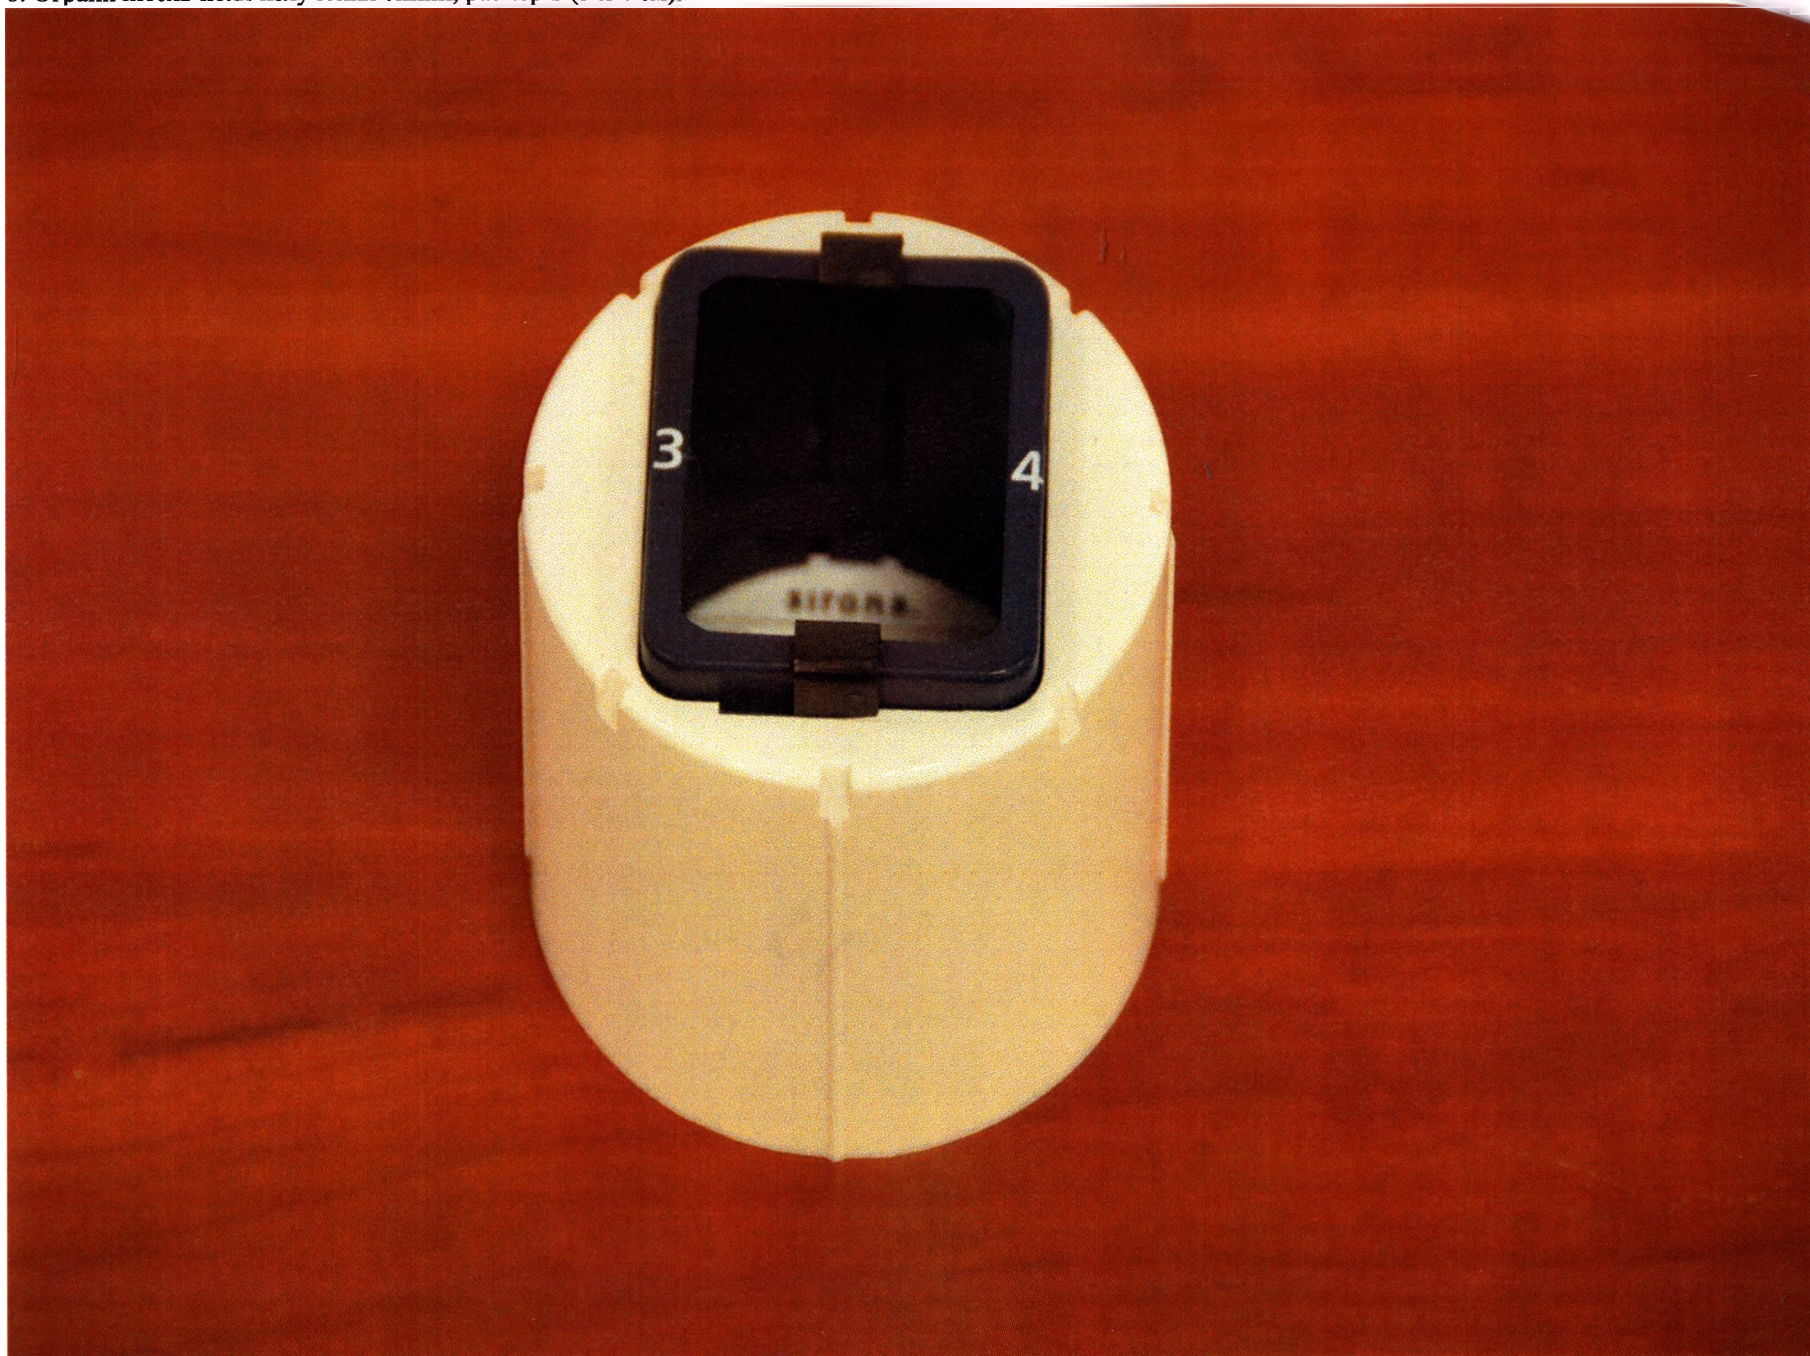

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Аппарат рентгеновский интраоральный HELIODENT ^{Plus} с
принадлежностями, производства SIRONA Dental Systems
GmbH (СИРОНА Дентал Системе ГмбХ), Германия

2017

Аппарат рентгеновский интраоральный Heliodent Plus с принадлежностями:

1. Трубка рентгеновская.
2. Пульт управления.
3. Пульт дистанционного управления.
4. Тубус.
5. Консоль с соединительной панелью.

Принадлежности:

1. Тест фантом для контроля параметров рентгеновского излучения.
2. Тест фантом для проверки стабильности параметров датчика XIOS XG.
3. Тест фантом для проверки стабильности параметров датчика XIOS Plus.
4. Тест фантом для проверки стабильности параметров универсального датчика XIOS.
5. Четырехгранный удлинитель тубуса до фокусного расстояния от кожи 300 мм (12").
6. Ограничитель поля излучения белый, размер 0 (1,8 x 2,4 см).
7. Ограничитель поля излучения черный, размер 1 (2 x 3 см).
8. Ограничитель поля излучения синий, размер 2 (3 x 4 см).
9. Эксплуатационная документация: инструкция по эксплуатации, технический осмотр, требования к установке.

Генеральный директор

(должность)



(подпись)

М.В. Кротенко

(И.О.Фамилия)

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью _____ лист (ов)

М.В. Кротенко

