



« 11 » 04 2019 г.

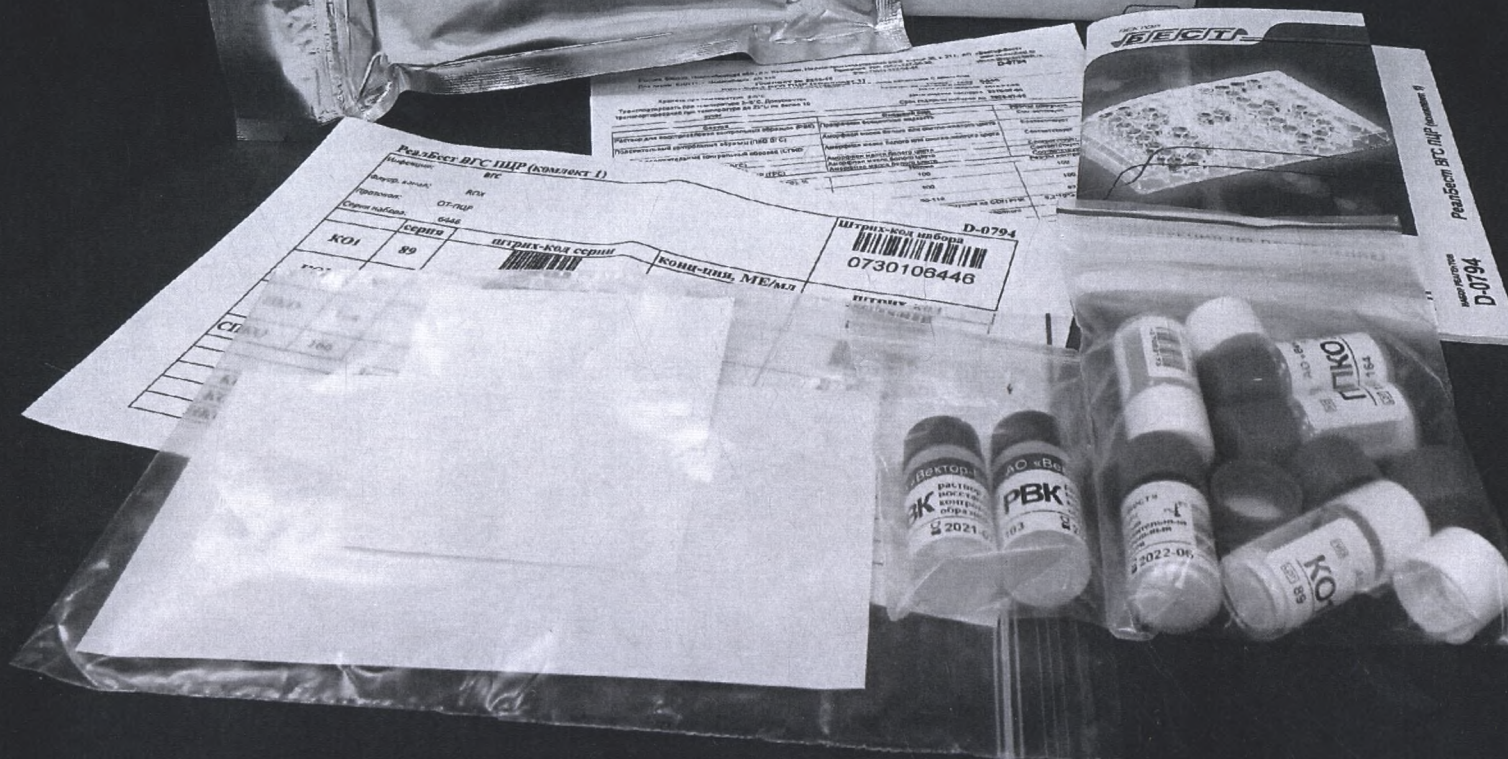



ВЕКТОР

БЕСТ

REF

D-0794

набор реагентов для выявления
и количественного определения
РНК вируса гепатита С методом
ОТ-ПЦР в реальном времени

РеалБест ВГС ПЦР (комплект 1)

LOT 6446

СОСТАВ:

LOT

1. Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР	96 пр.	6446
2. Слабый положительный контрольный образец	1 фл.	166
3. Положительный контрольный образец	2 фл.	164
4. Калибровочный образец КО1	1 фл.	89
5. Калибровочный образец КО2	1 фл.	89
6. Раствор для восстановления контрольных образцов	2 фл. по 4 мл	103

Принадлежности:

Оптическая плёнка

1,5 листа

ТУ 9398-199-23548172-2009
ПУ № ФСР 2010/07201 от 25.03.2017



04

2019 г.

ВЕКТОР


БЕСТ

REF

D-0794

LOT

6446



IVD



2019-07-05

2020-07-05


**РеалБест ВГС ПЦР
(комплект 1)**




07940507200644600021




Для профессионального применения

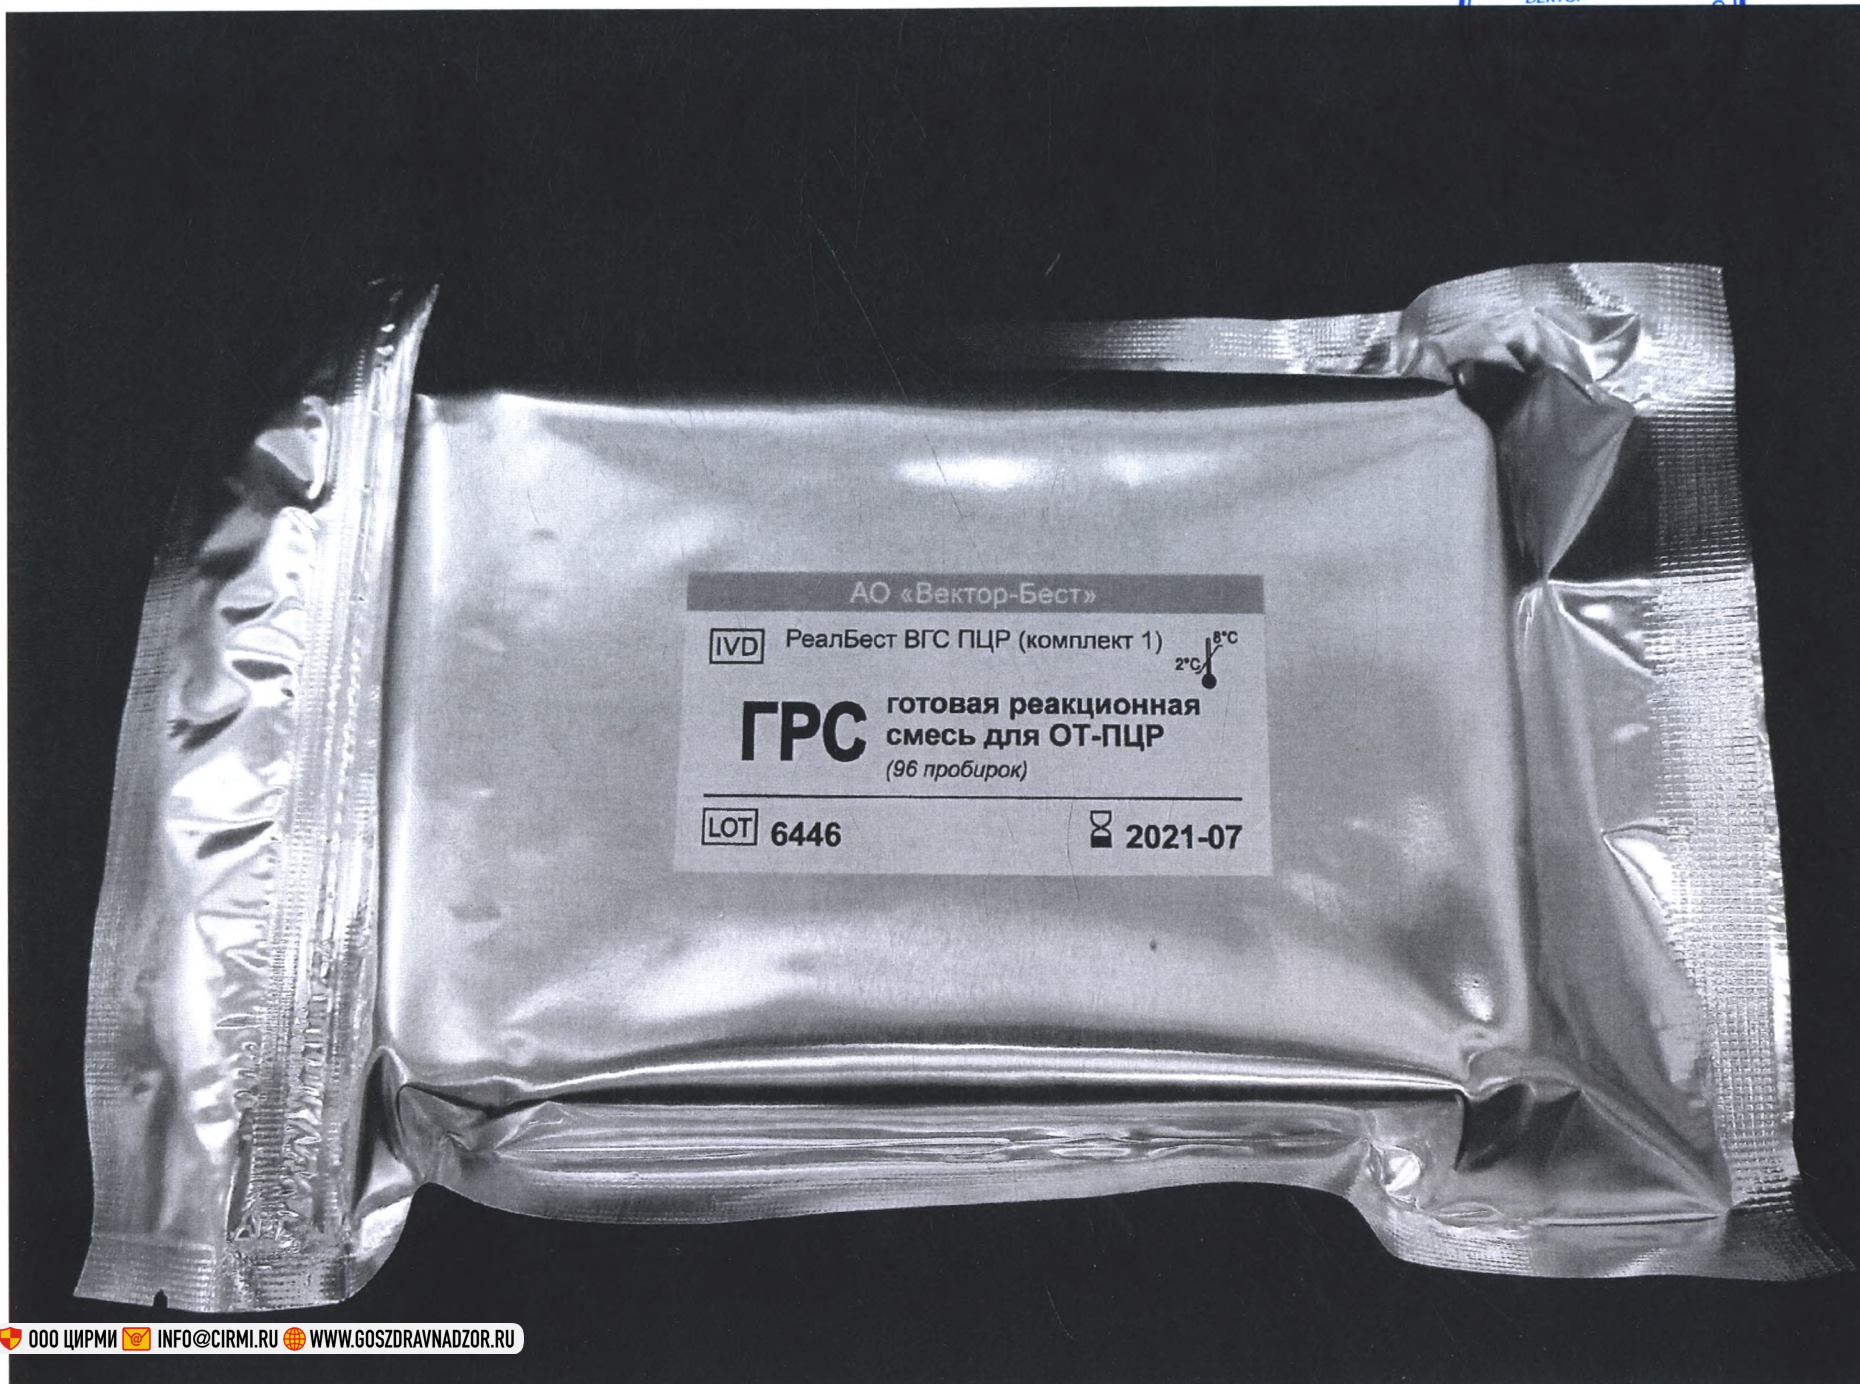

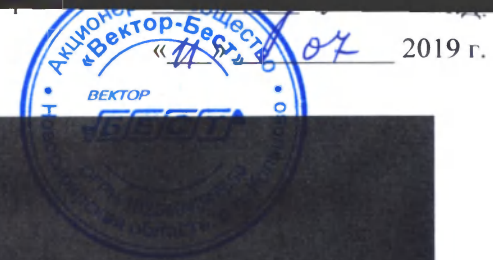




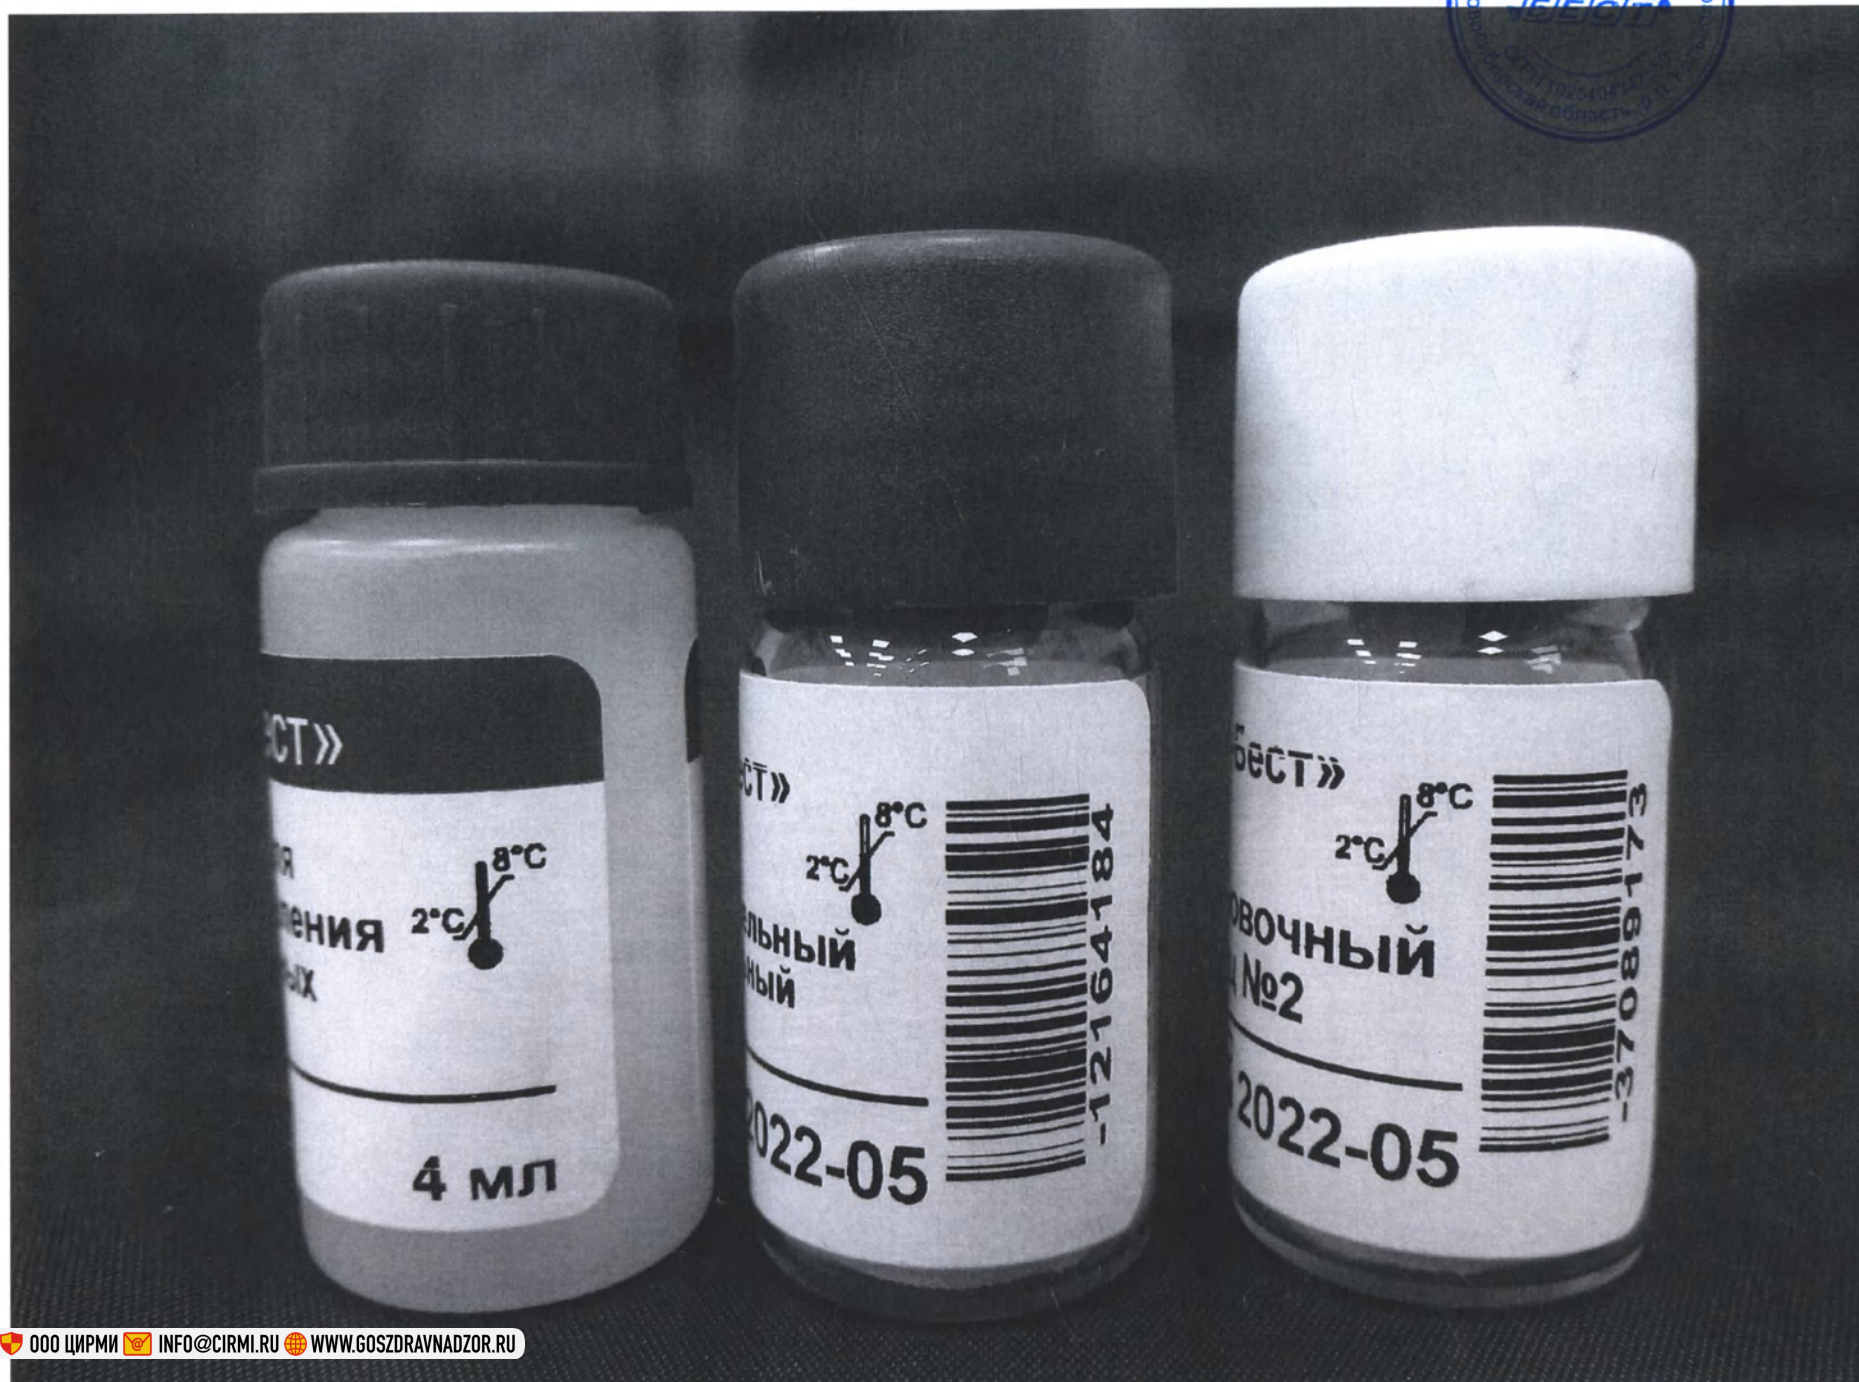

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в реальном времени (РеалБест ВГС ПЦР (комплект 2))»

АО «Вектор-Бест» 107 2019 г.

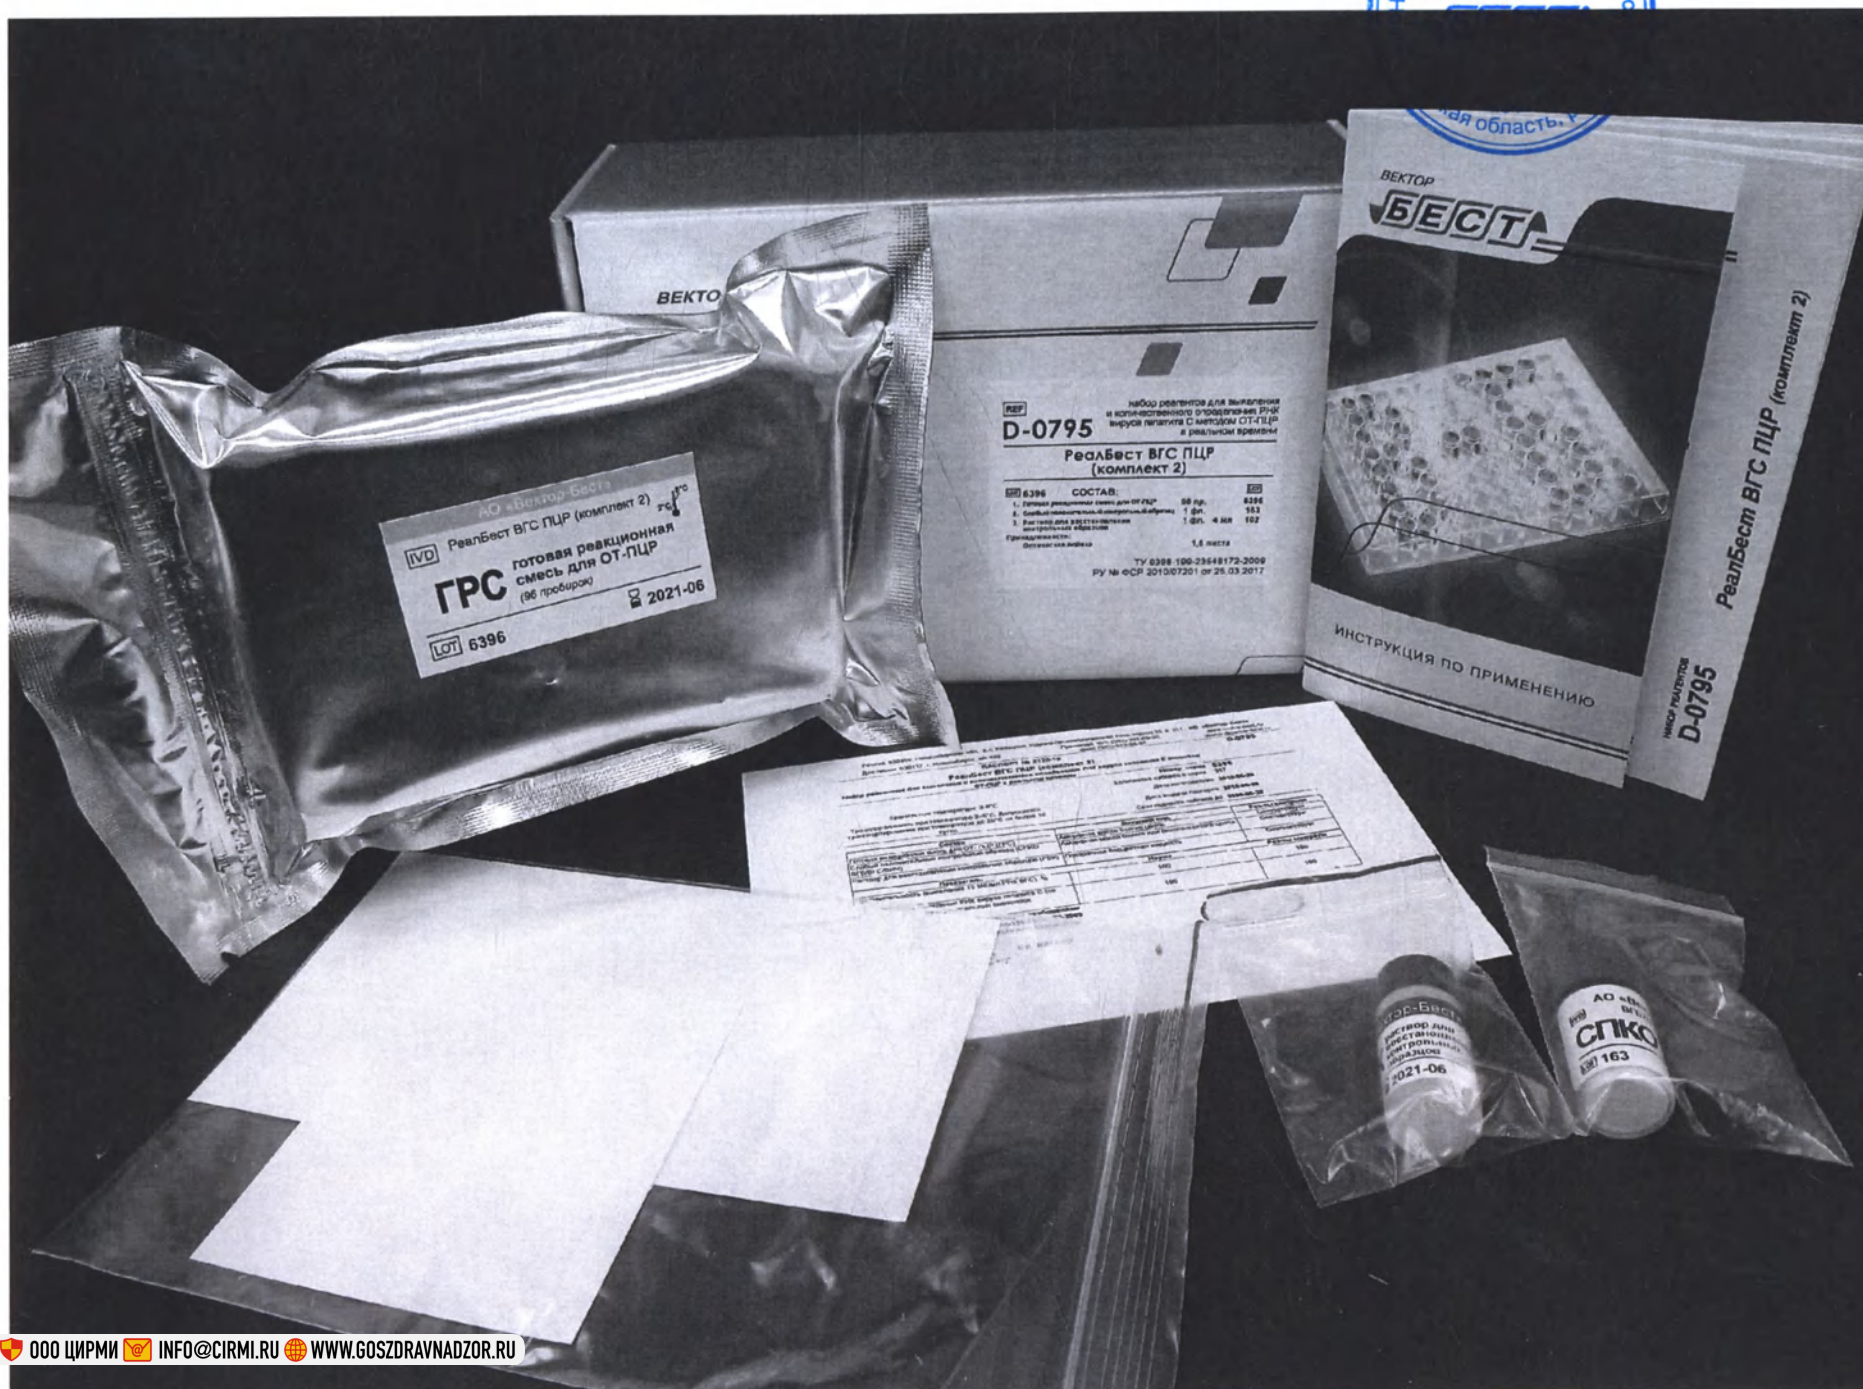



ВЕКТОР
БЕСТ

REF

D-0795

набор реагентов для выявления
и количественного определения РНК
вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР
в реальном времени

**РеалБест ВГС ПЦР
(комплект 2)**

LOT 6396

СОСТАВ:

LOT

- | | | |
|--|------------|------|
| 1. Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР | 96 пр. | 6396 |
| 2. Слабый положительный контрольный образец | 1 фл. | 163 |
| 3. Раствор для восстановления контрольных образцов | 1 фл. 4 мл | 102 |

Принадлежности:

Оптическая плёнка

1,5 листа

ТУ 9398-199-23548172-2009
РУ № ФСР 2010/07201 от 25.03.2017




ВЕКТОР

БЕСТ

REF **D-0795**

LOT **6396**



IVD

Σ 96



2019-06-28

2020-06-28


**РеалБест ВГС ПЦР
(комплект 2)**





07952806200639600321



Для профессионального применения

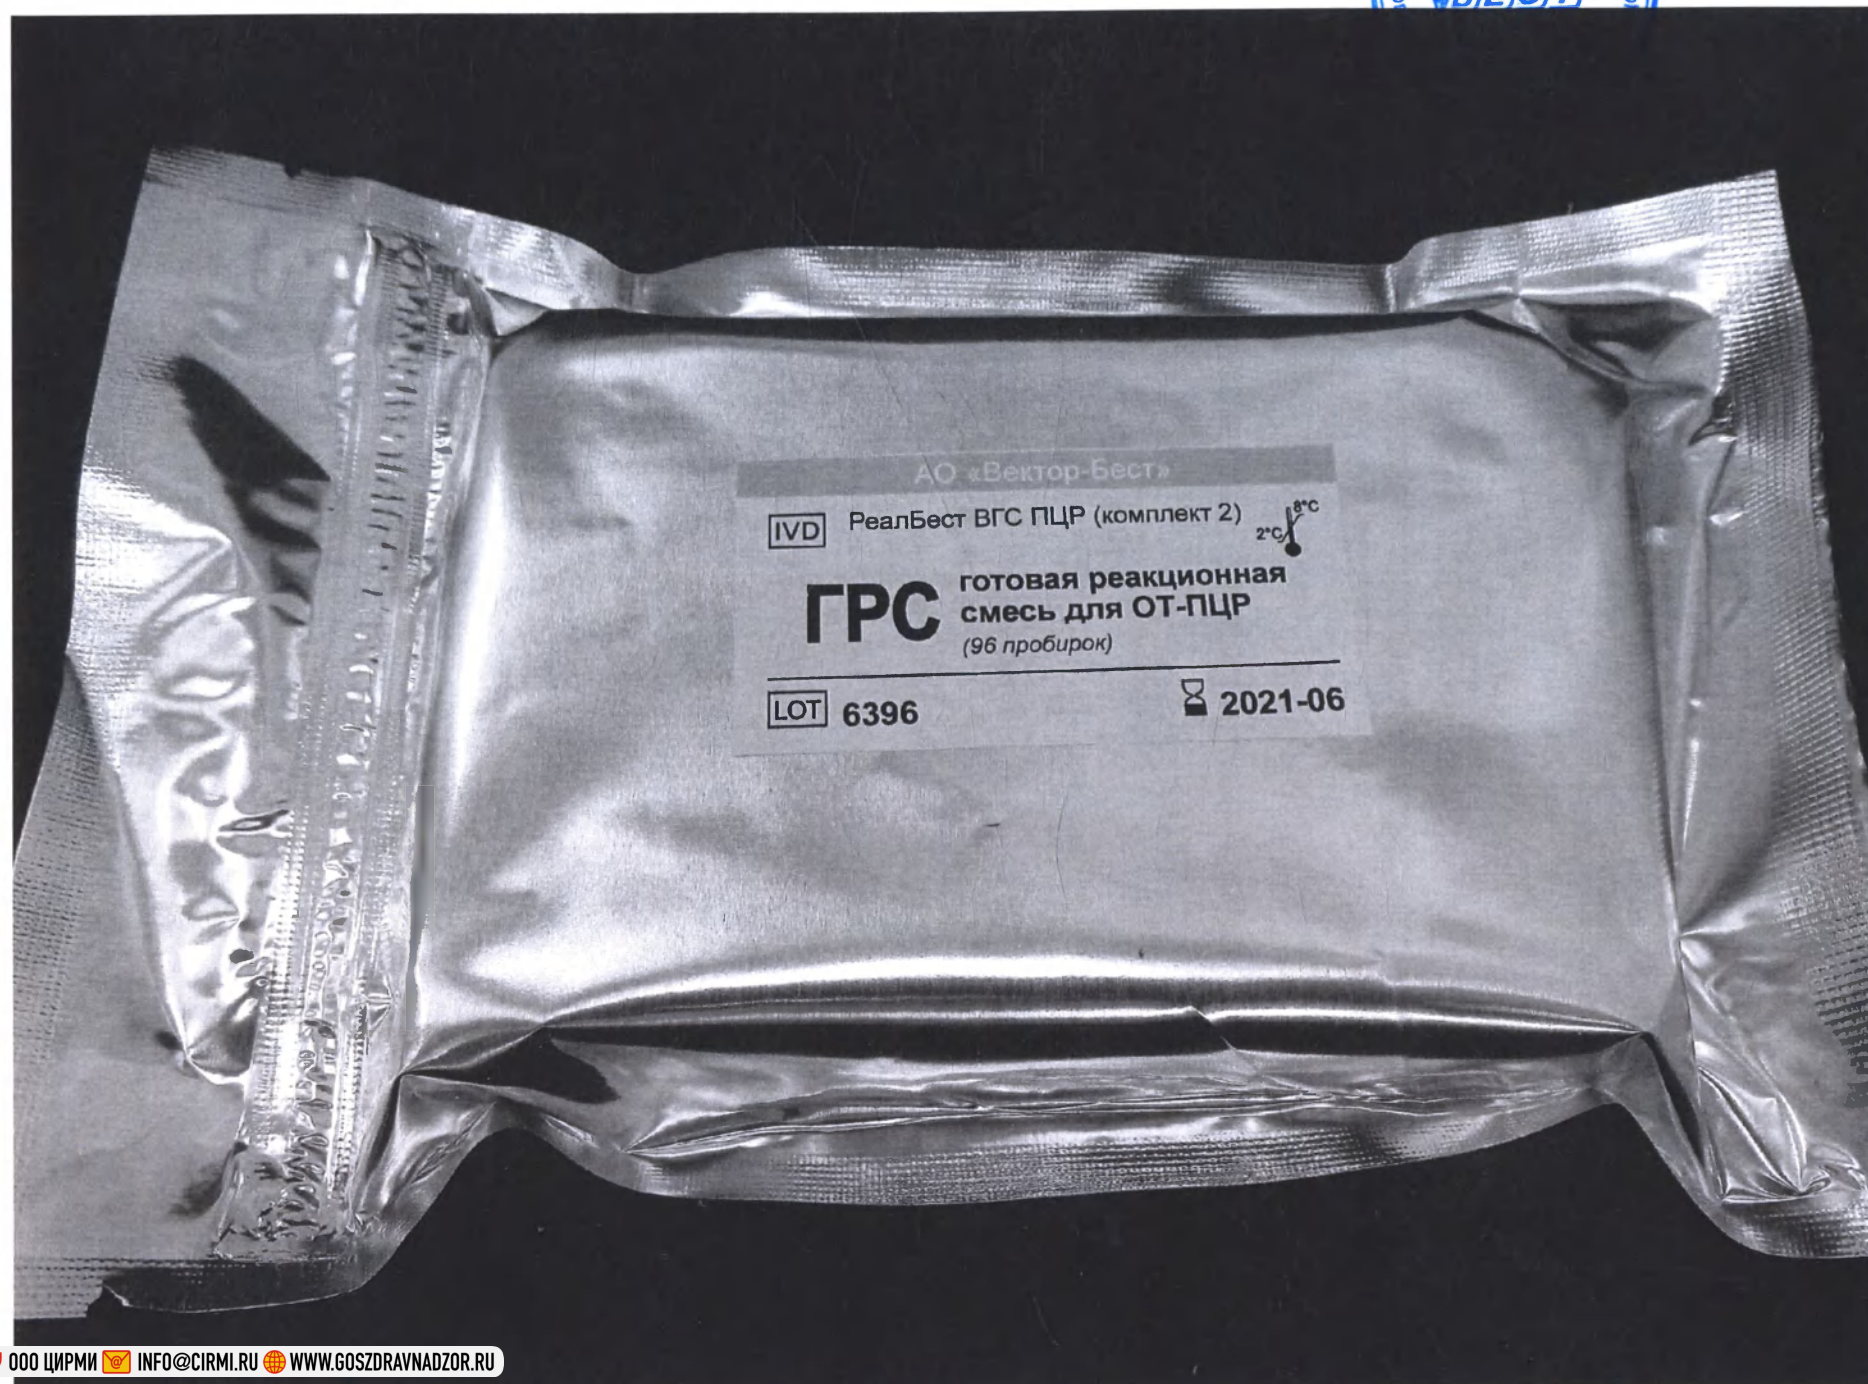

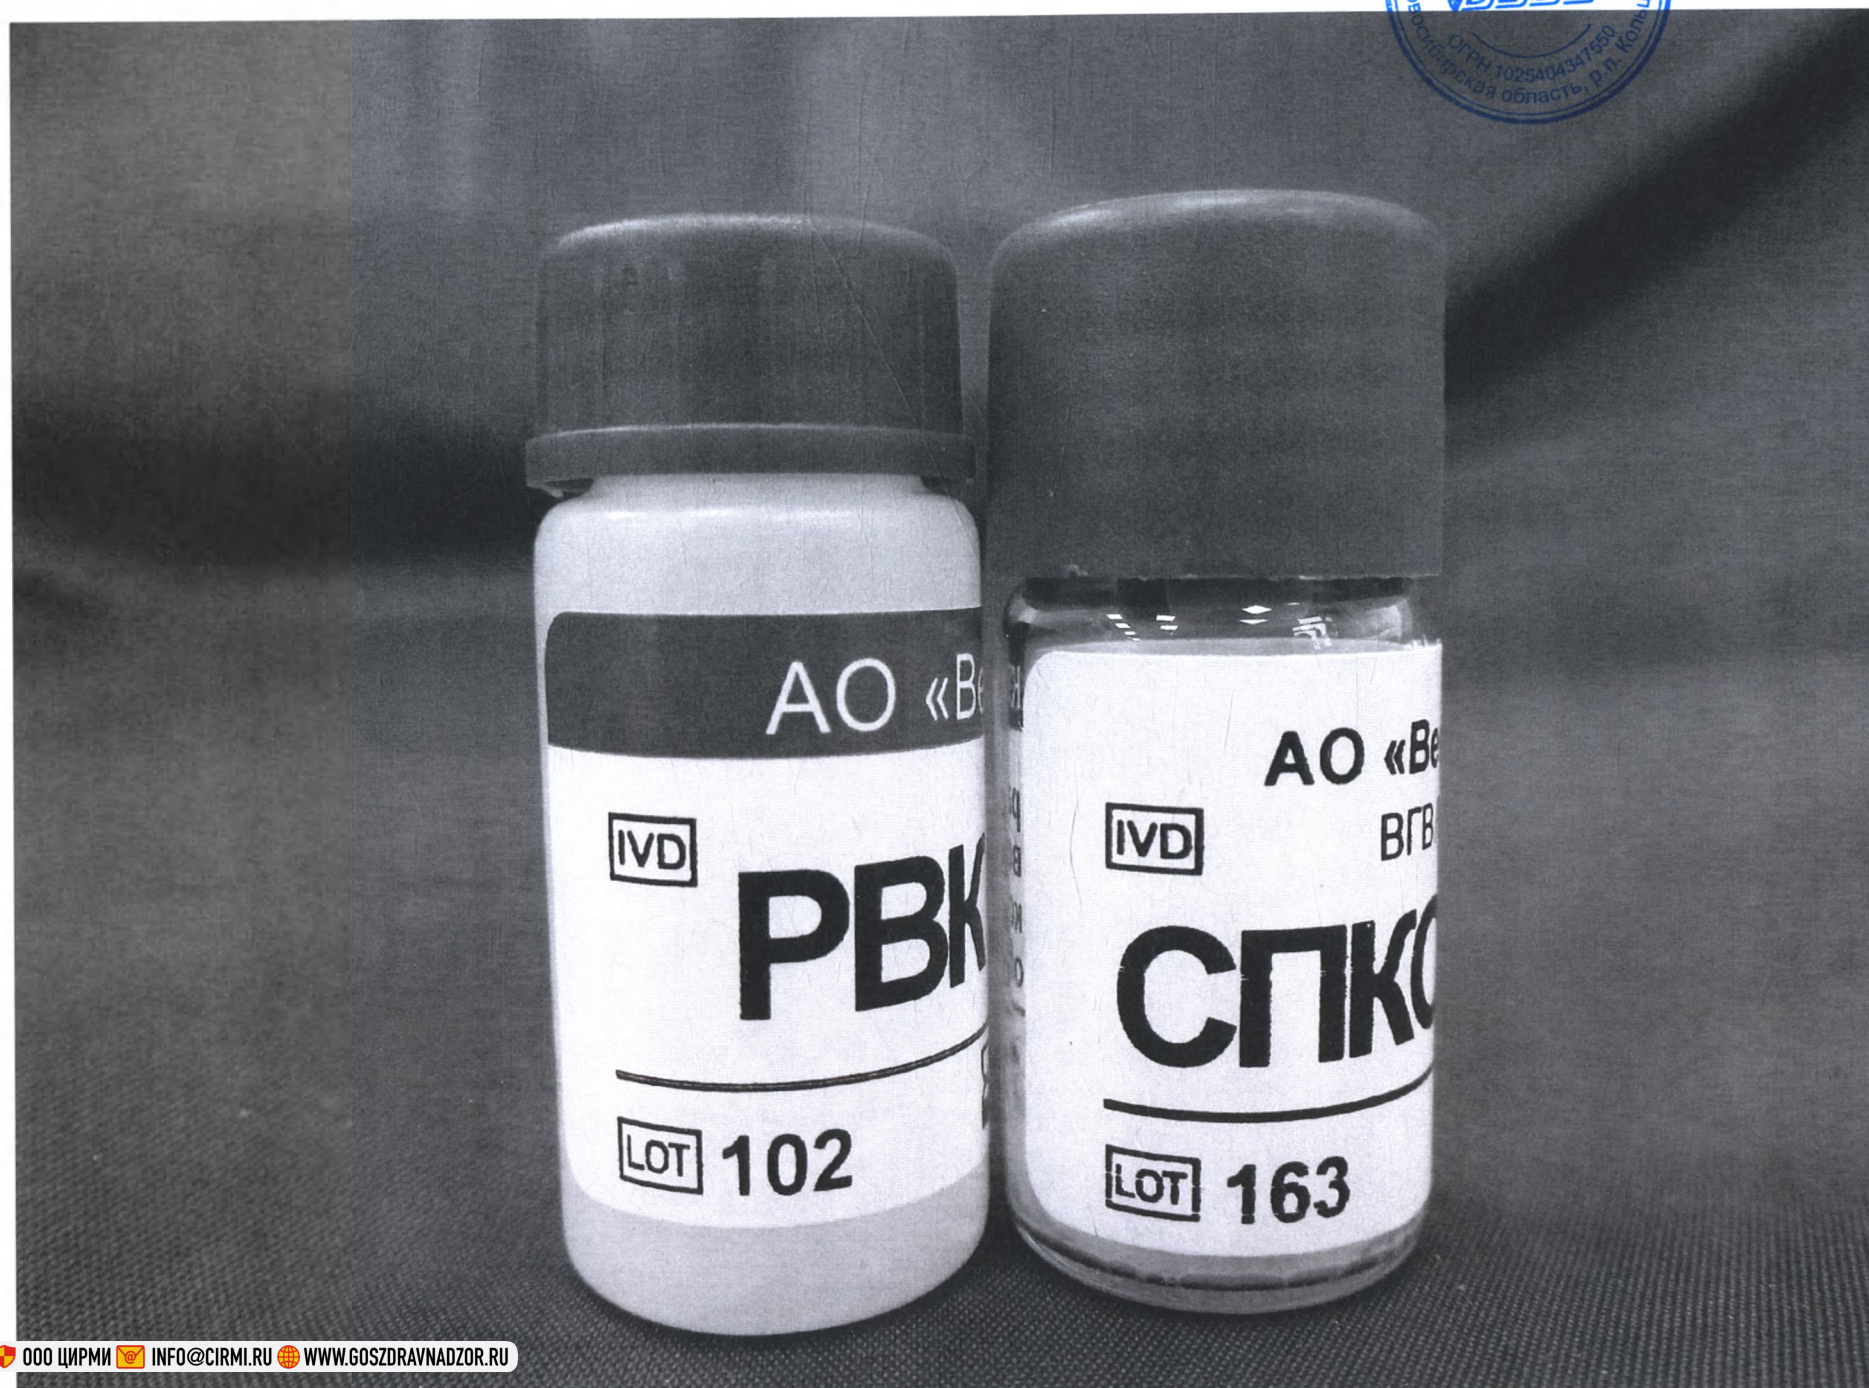

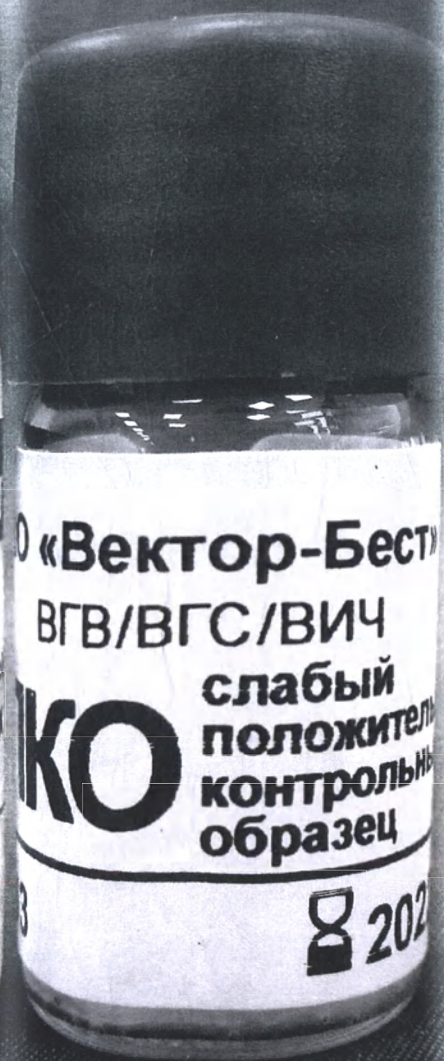

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в реальном времени (РеалБест ВГС ПЦР (комплект 2))» № 4

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» 07 2019 г.

