

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С для автоматических ИФА-анализаторов (Бест анти-ВГС-авто (комплект 1))»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____
« 06 » Фев 2020 г.





БЕКТОР

БЕСТ



REF

D-0770

набор реагентов для иммуноферментного
выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С
для автоматических ИФА-анализаторов

**Бест анти-ВГС-авто
(комплект 1)**

LOT 4295

СОСТАВ:

LOT

1. Планшеты разборные с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС	2 шт.	419083
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	2 фл. по 1,0 мл	3967
3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	2 фл. по 1,0 мл	3319
4. Конъюгат, концентрат	2 фл. по 2,2 мл	9681
5. Раствор для разведения сывороток	2 фл. по 16,0 мл	2355
6. Раствор для разведения конъюгата	2 фл. по 20,0 мл	4310
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	3 фл. по 28,0 мл	2811
8. Субстратный буферный раствор	2 фл. по 20,0 мл	541
9. Тетраметилбензидин, концентрат	2 фл. по 1,5 мл	504
10. Стоп-реагент	2 фл. по 21,0 мл	1303

Принадлежности:

Самоклеющиеся этикетки со штрих-кодами для реагентов

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С для автоматических ИФА-анализаторов (Бест анти-ВГС-авто (комплект 1))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

06 ФЕВ

2020 г.

BEKTOP

БЕСТ



REF **D-0770**

Σ 192

LOT **4295**

ТУ 9398-498-23548172-2014

РУ № РЗН 2015/2674 от 24.03.2017

2019-07-15

2021-07-15

Бест анти-ВГС-авто
(комплект 1)

IVD




07701507210429500167

Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С для автоматических ИФА-анализаторов (Бест анти-ВГС-авто (комплект 1))» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
«06» _____ 2020 г.

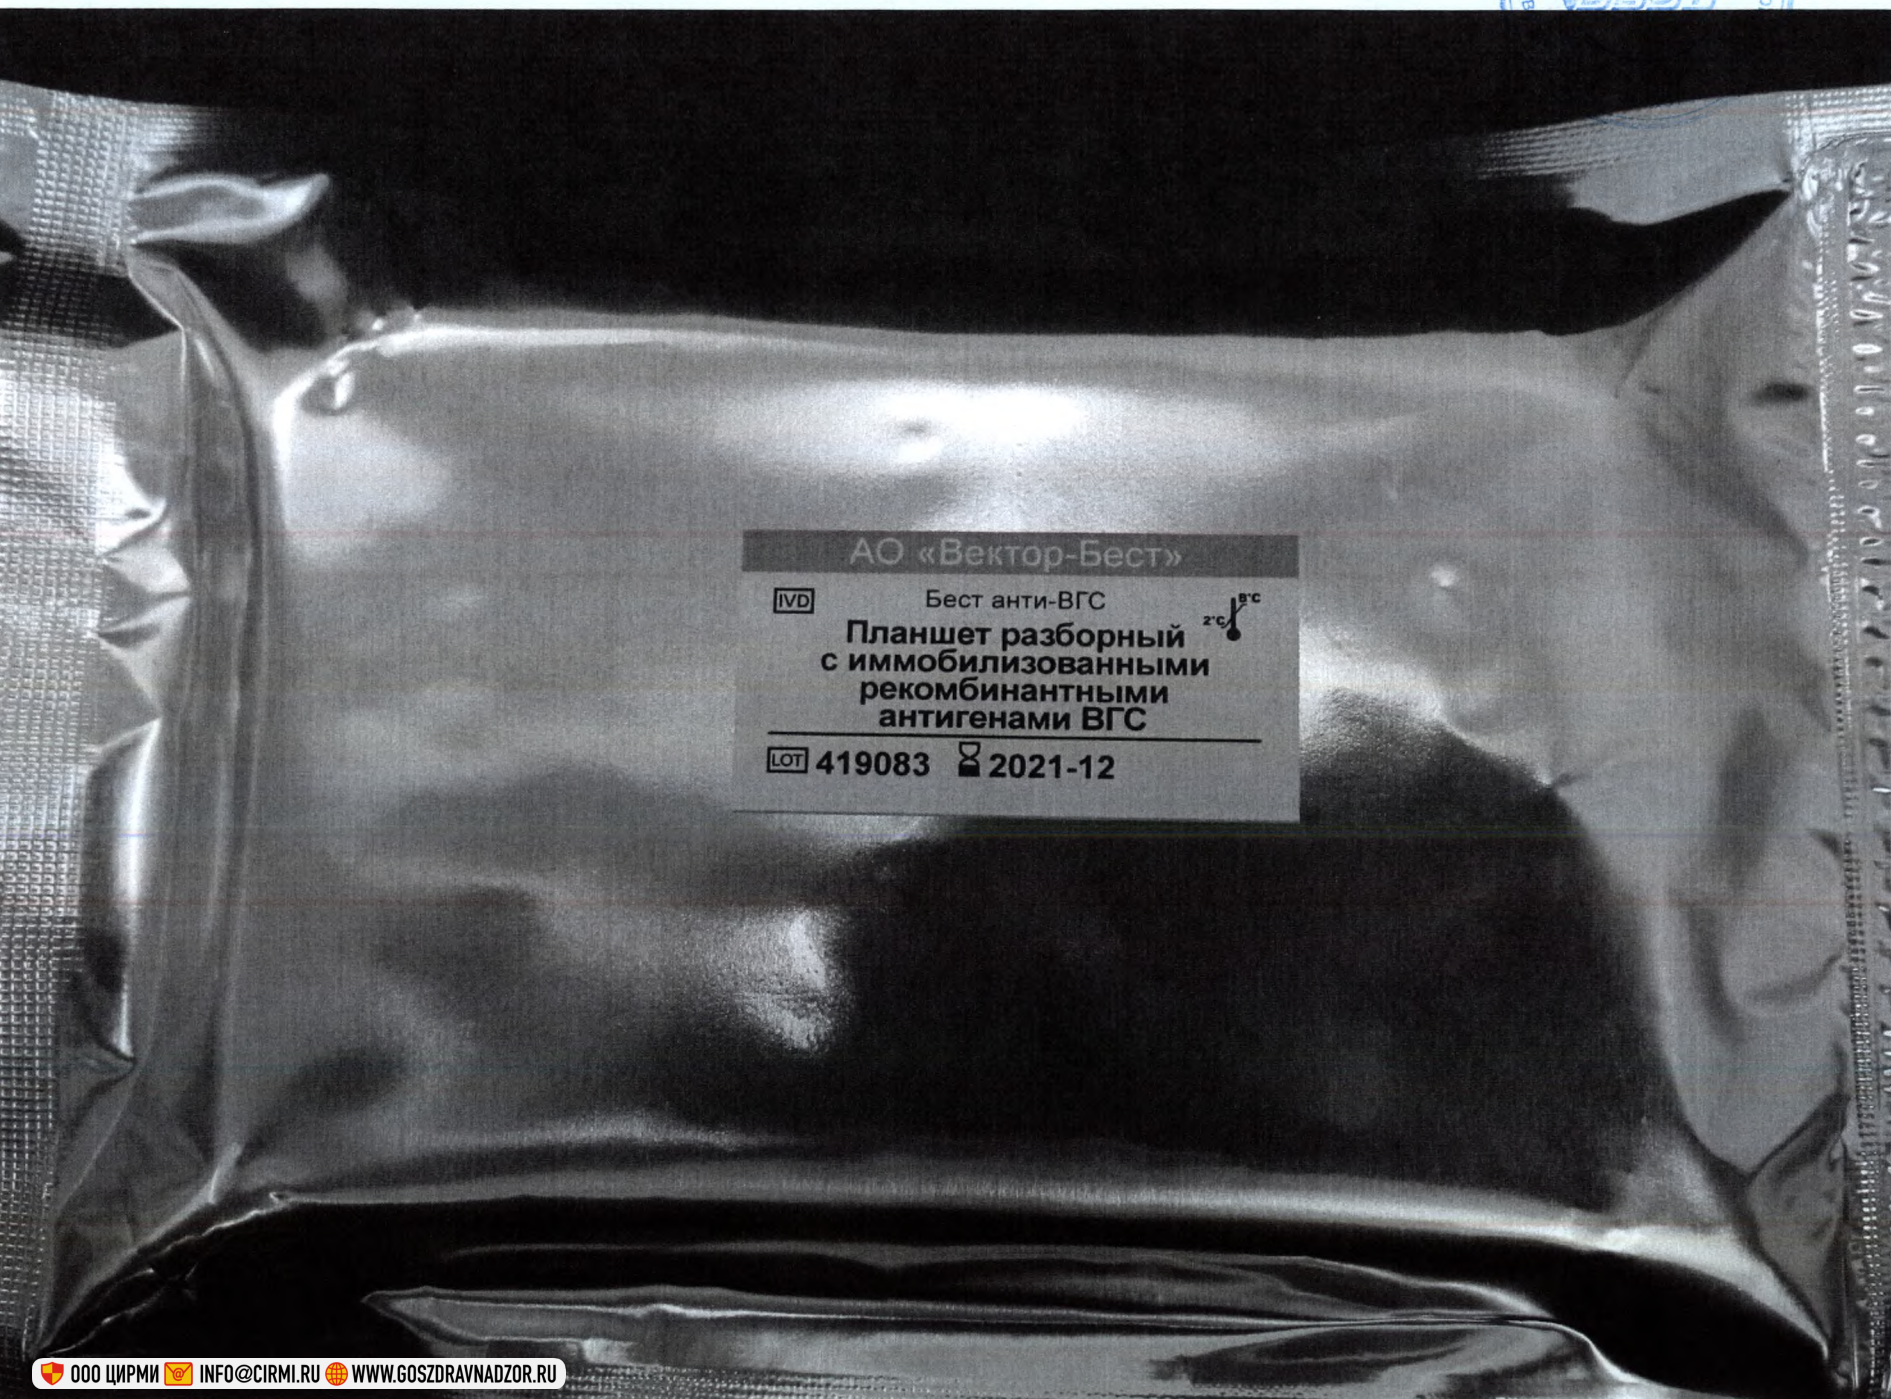


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С для автоматических ИФА-анализаторов (Бест анти-ВГС-авто (комплект 1))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
«06» _____ 2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С для автоматических ИФА-анализаторов (Бест анти-ВГС-авто (комплект 1))» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
«06 Фев» _____ 2020 г.

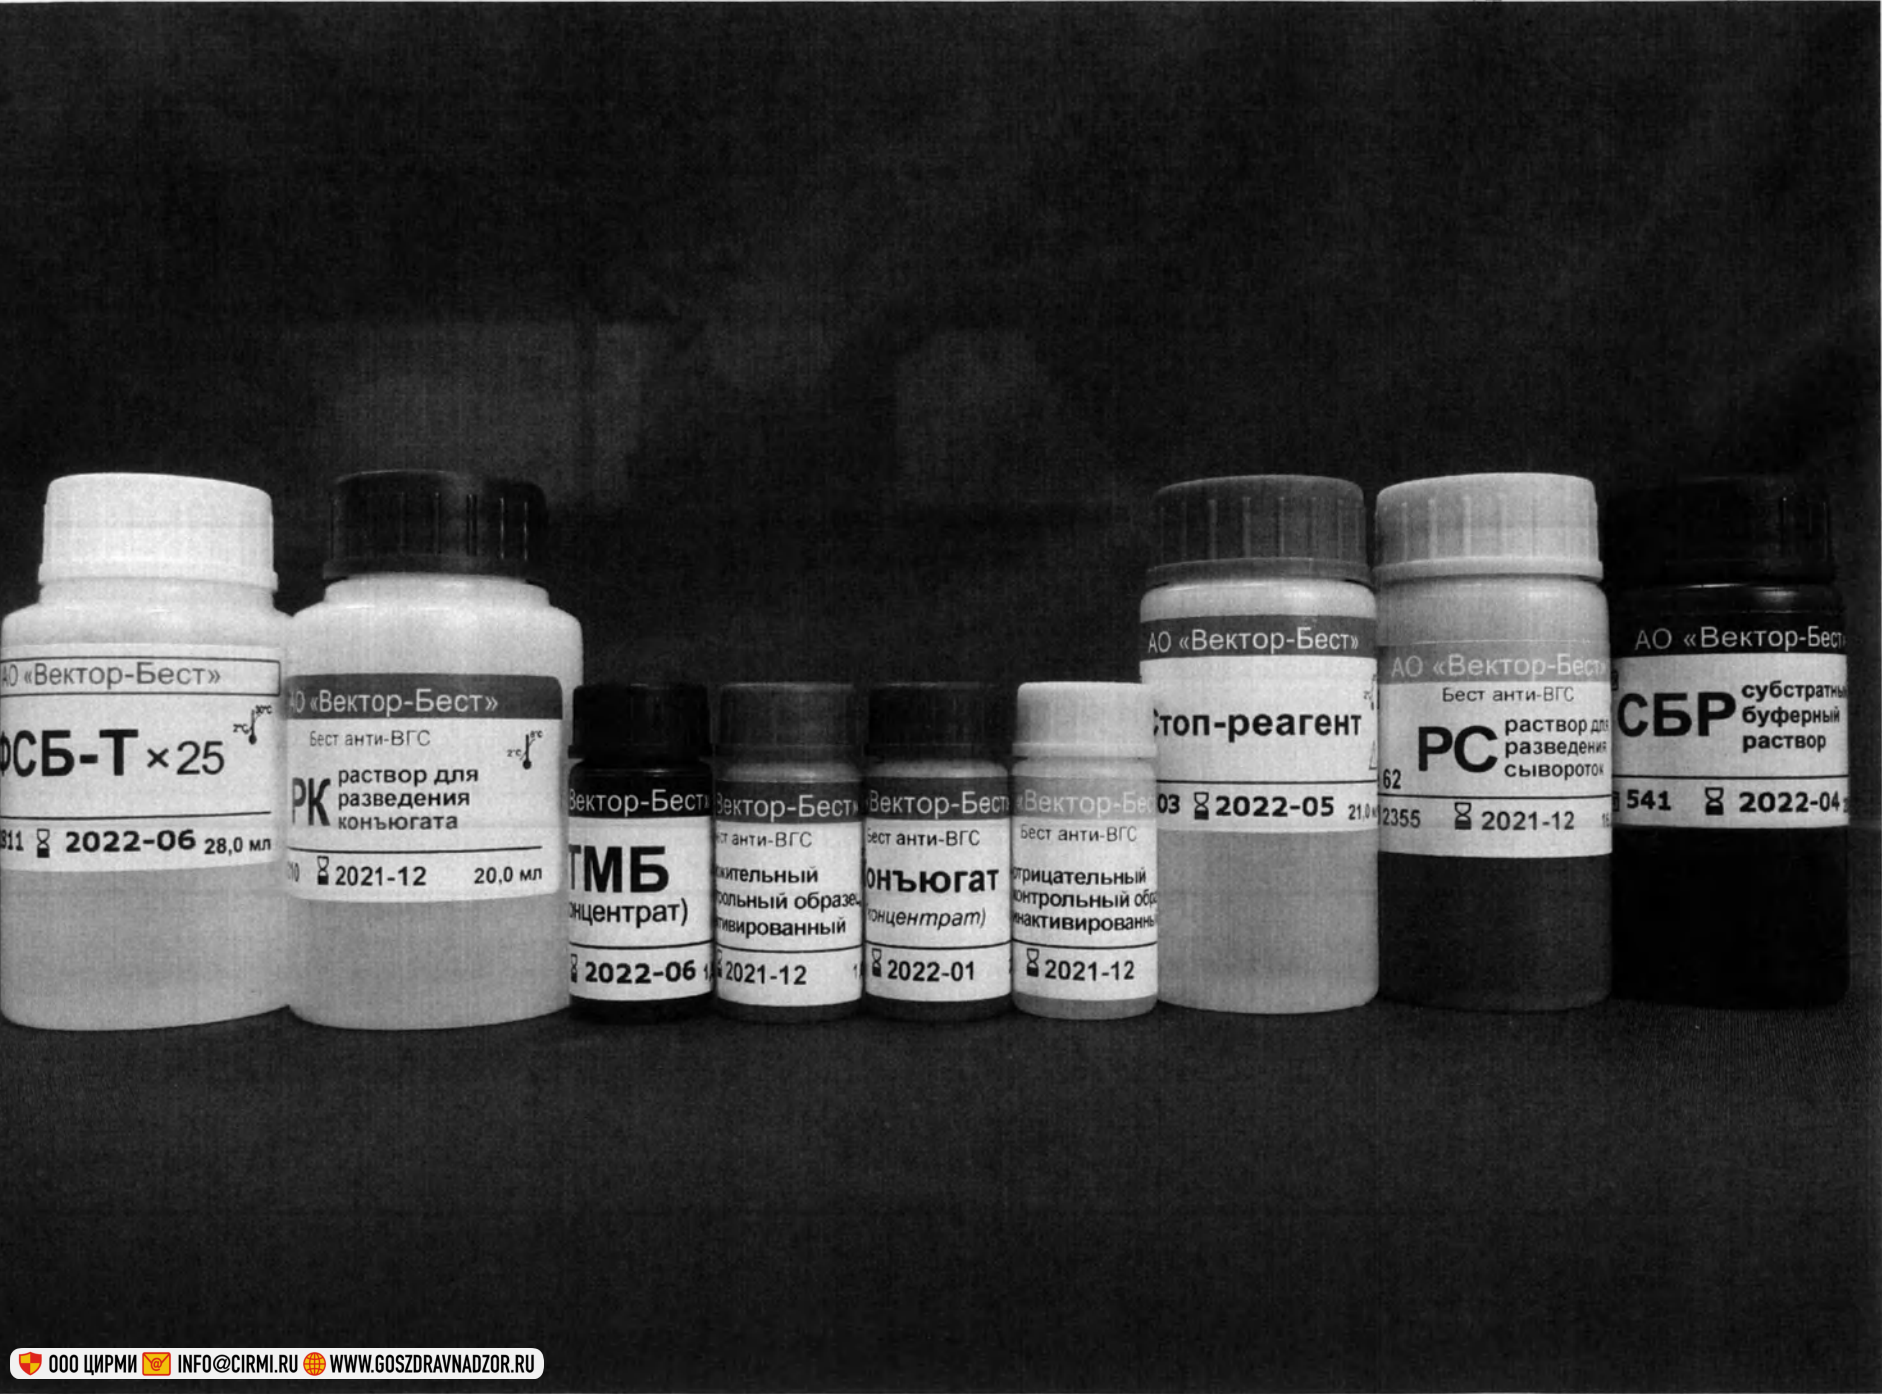

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С для автоматических ИФА-анализаторов (Бест анти-ВГС-авто (комплект 1))» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»





2020 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С для автоматических ИФА-анализаторов (Бест анти-ВГС-авто (комплект 2/Чароит))» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
«06» ФЕВ _____ 2020 г.

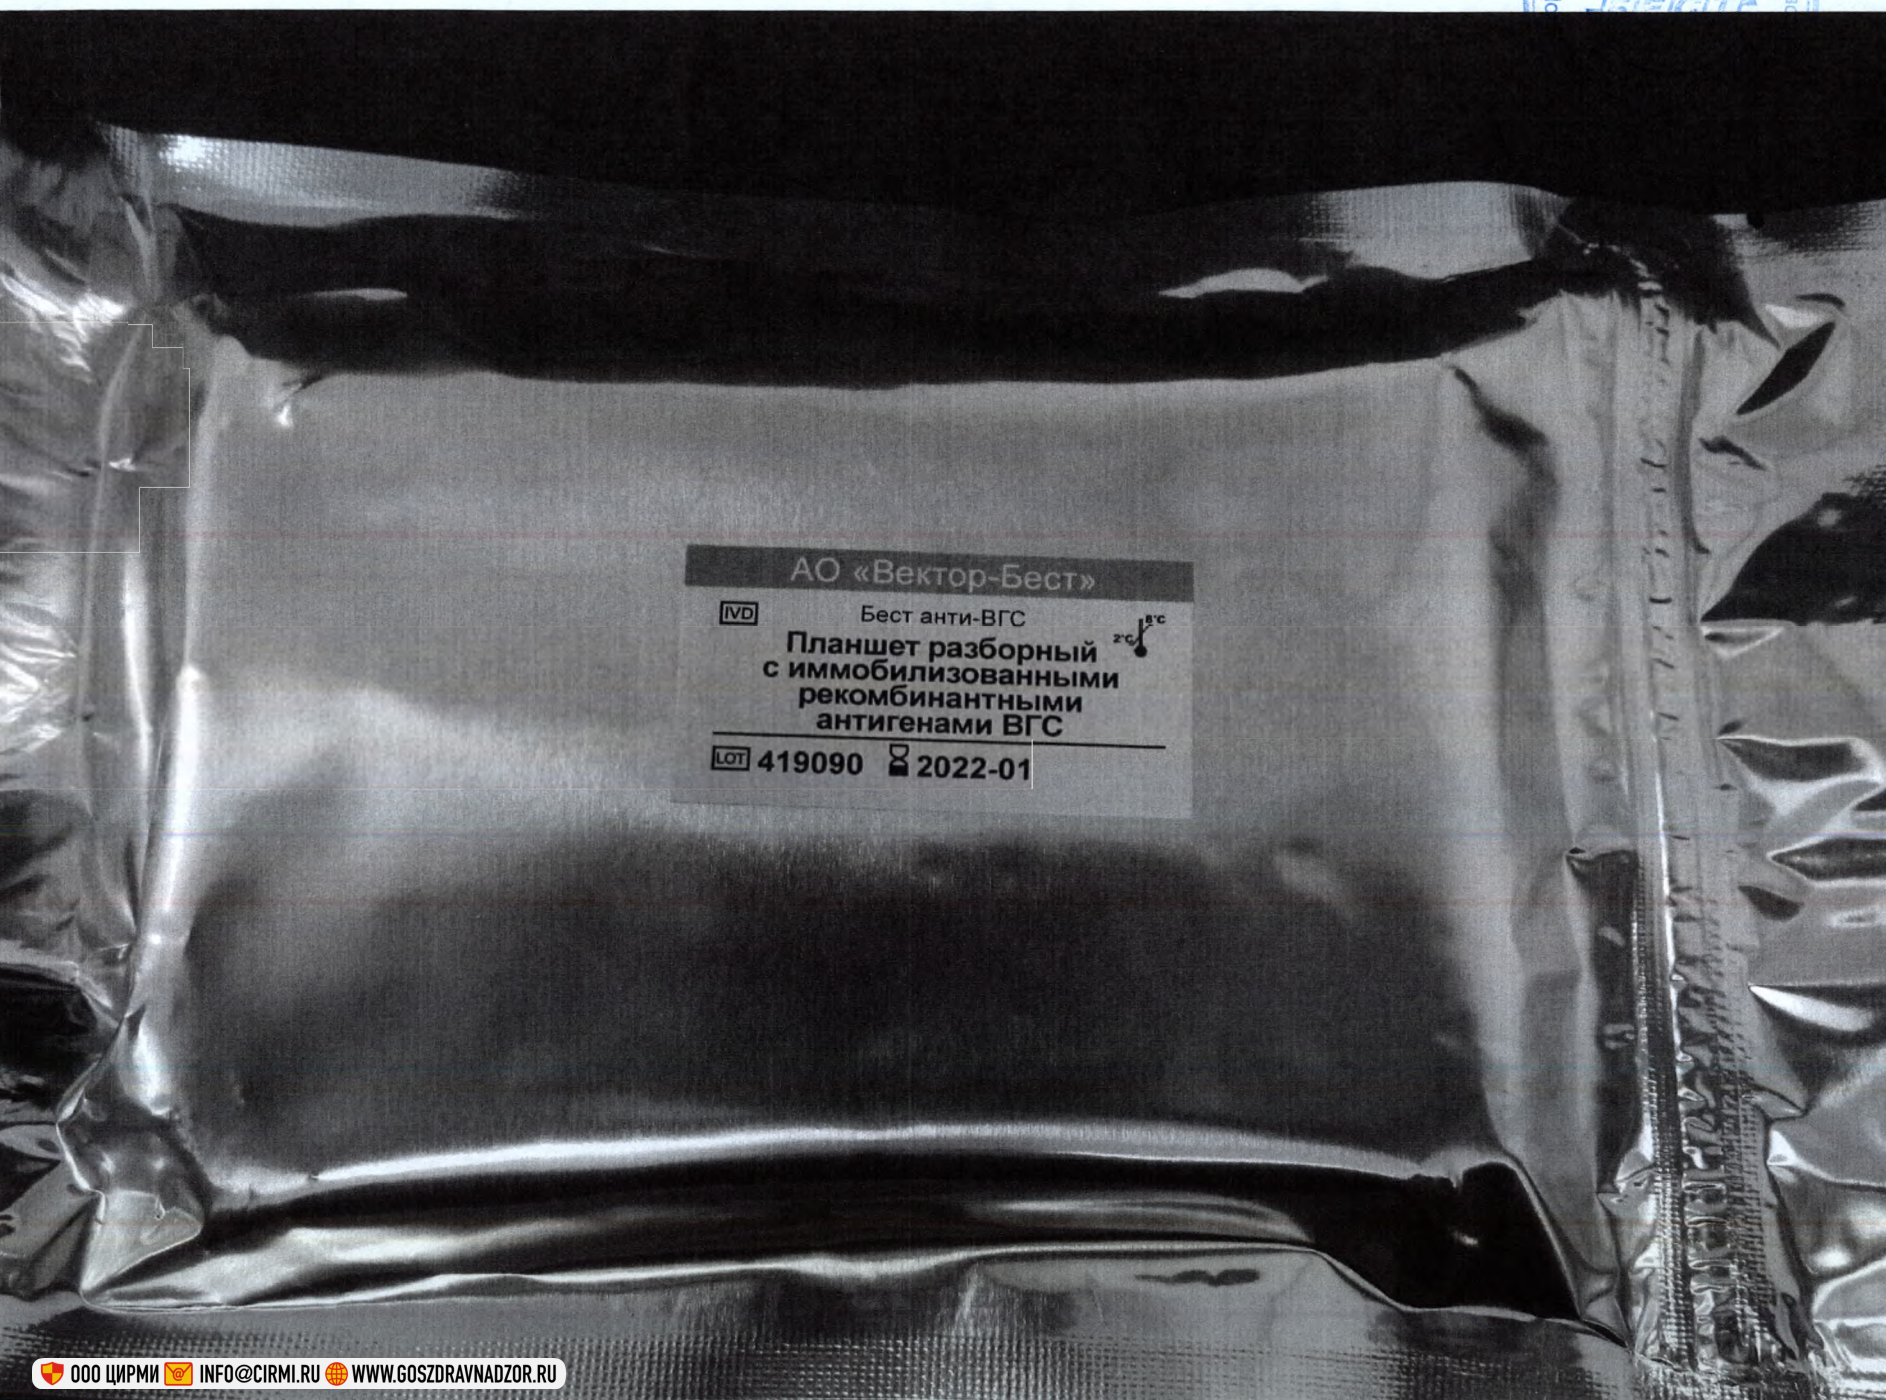

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С для автоматических ИФА-анализаторов (Бест анти-ВГС-авто (комплект 2/Чароит))»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ 2020 г.

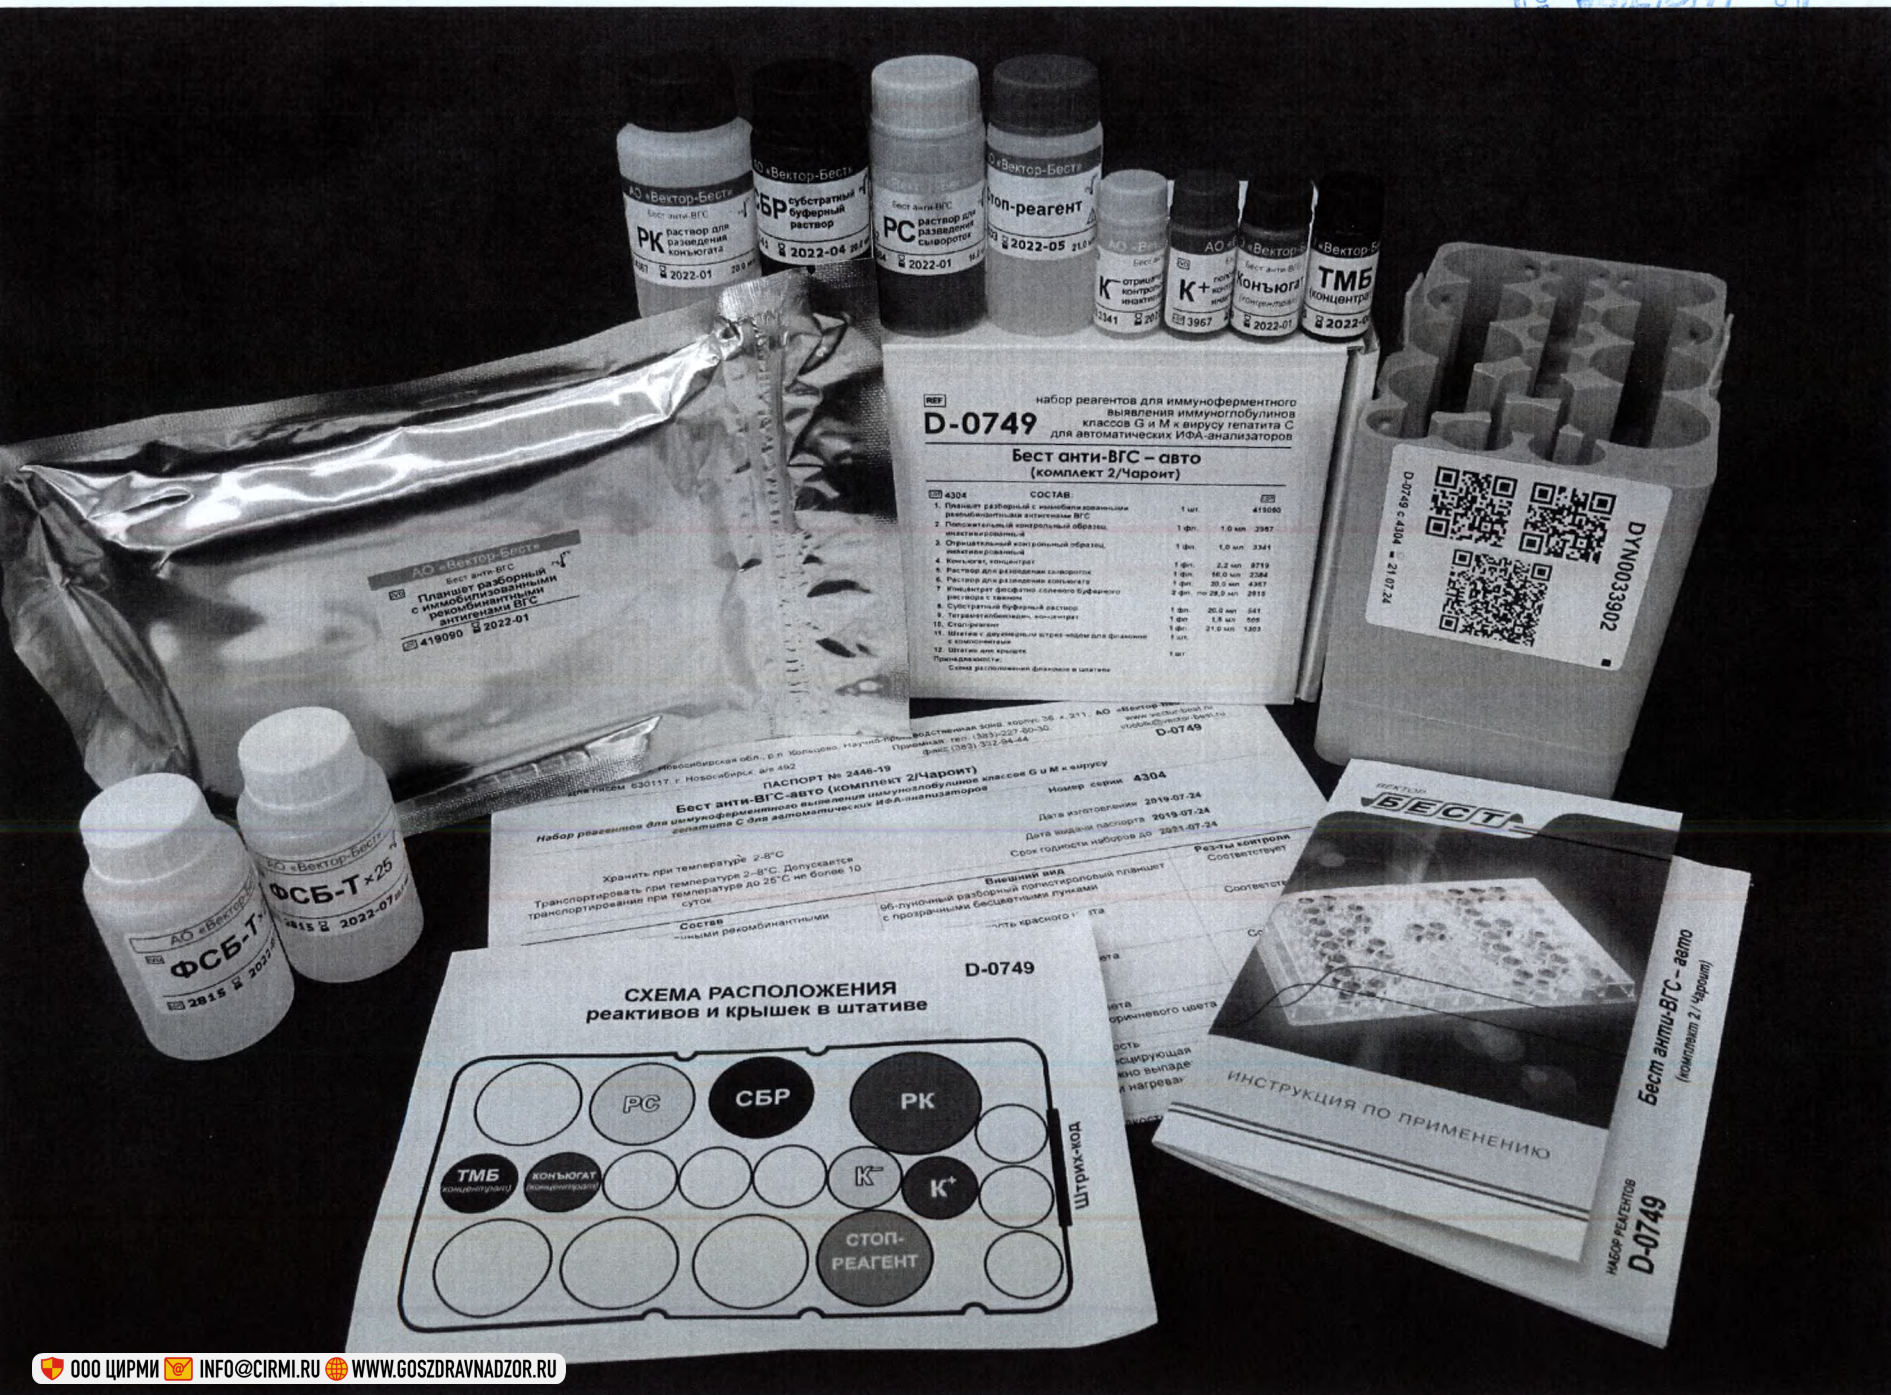



REF

D-0749

набор реагентов для иммуноферментного
выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С
для автоматических ИФА-анализаторов

**Бест анти-ВГС – авто
(комплект 2/Чароит)**

LOT 4304

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС	1 шт.		419090
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл.	1,0 мл	3967
3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл.	1,0 мл	3341
4. Конъюгат, концентрат	1 фл.	2,2 мл	9719
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	16,0 мл	2384
6. Раствор для разведения конъюгата	1 фл.	20,0 мл	4367
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл. по 28,0 мл		2815
8. Субстратный буферный раствор	1 фл.	20,0 мл	541
9. Тетраметилбензидин, концентрат	1 фл.	1,5 мл	505
10. Стоп-реагент	1 фл.	21,0 мл	1303
11. Штатив с двухмерным штрих-кодом для флаконов с компонентами	1 шт.		
12. Штатив для крышек	1 шт.		

Принадлежности:

Схема расположения флаконов в штативе

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С для автоматических ИФА-анализаторов (Бест анти-ВГС-авто (комплект 2/Чароит))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

«06 ФЕВ»

2020 г.

REF **D-0749**

Σ₉₆

LOT

4304

ТУ 9398-498-23548172-2014

ПУ № РЗН 2015/2674 от 24.03.2017



2019-07-24



2021-07-24

Бест анти-ВГС – авто
(комплект 2/Чароит)

IVD




07492407210430400005

Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С для автоматических ИФА-анализаторов (Бест анти-ВГС-авто (комплект 2/Чароит))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
«06» ФЕВ _____ 2020 г.

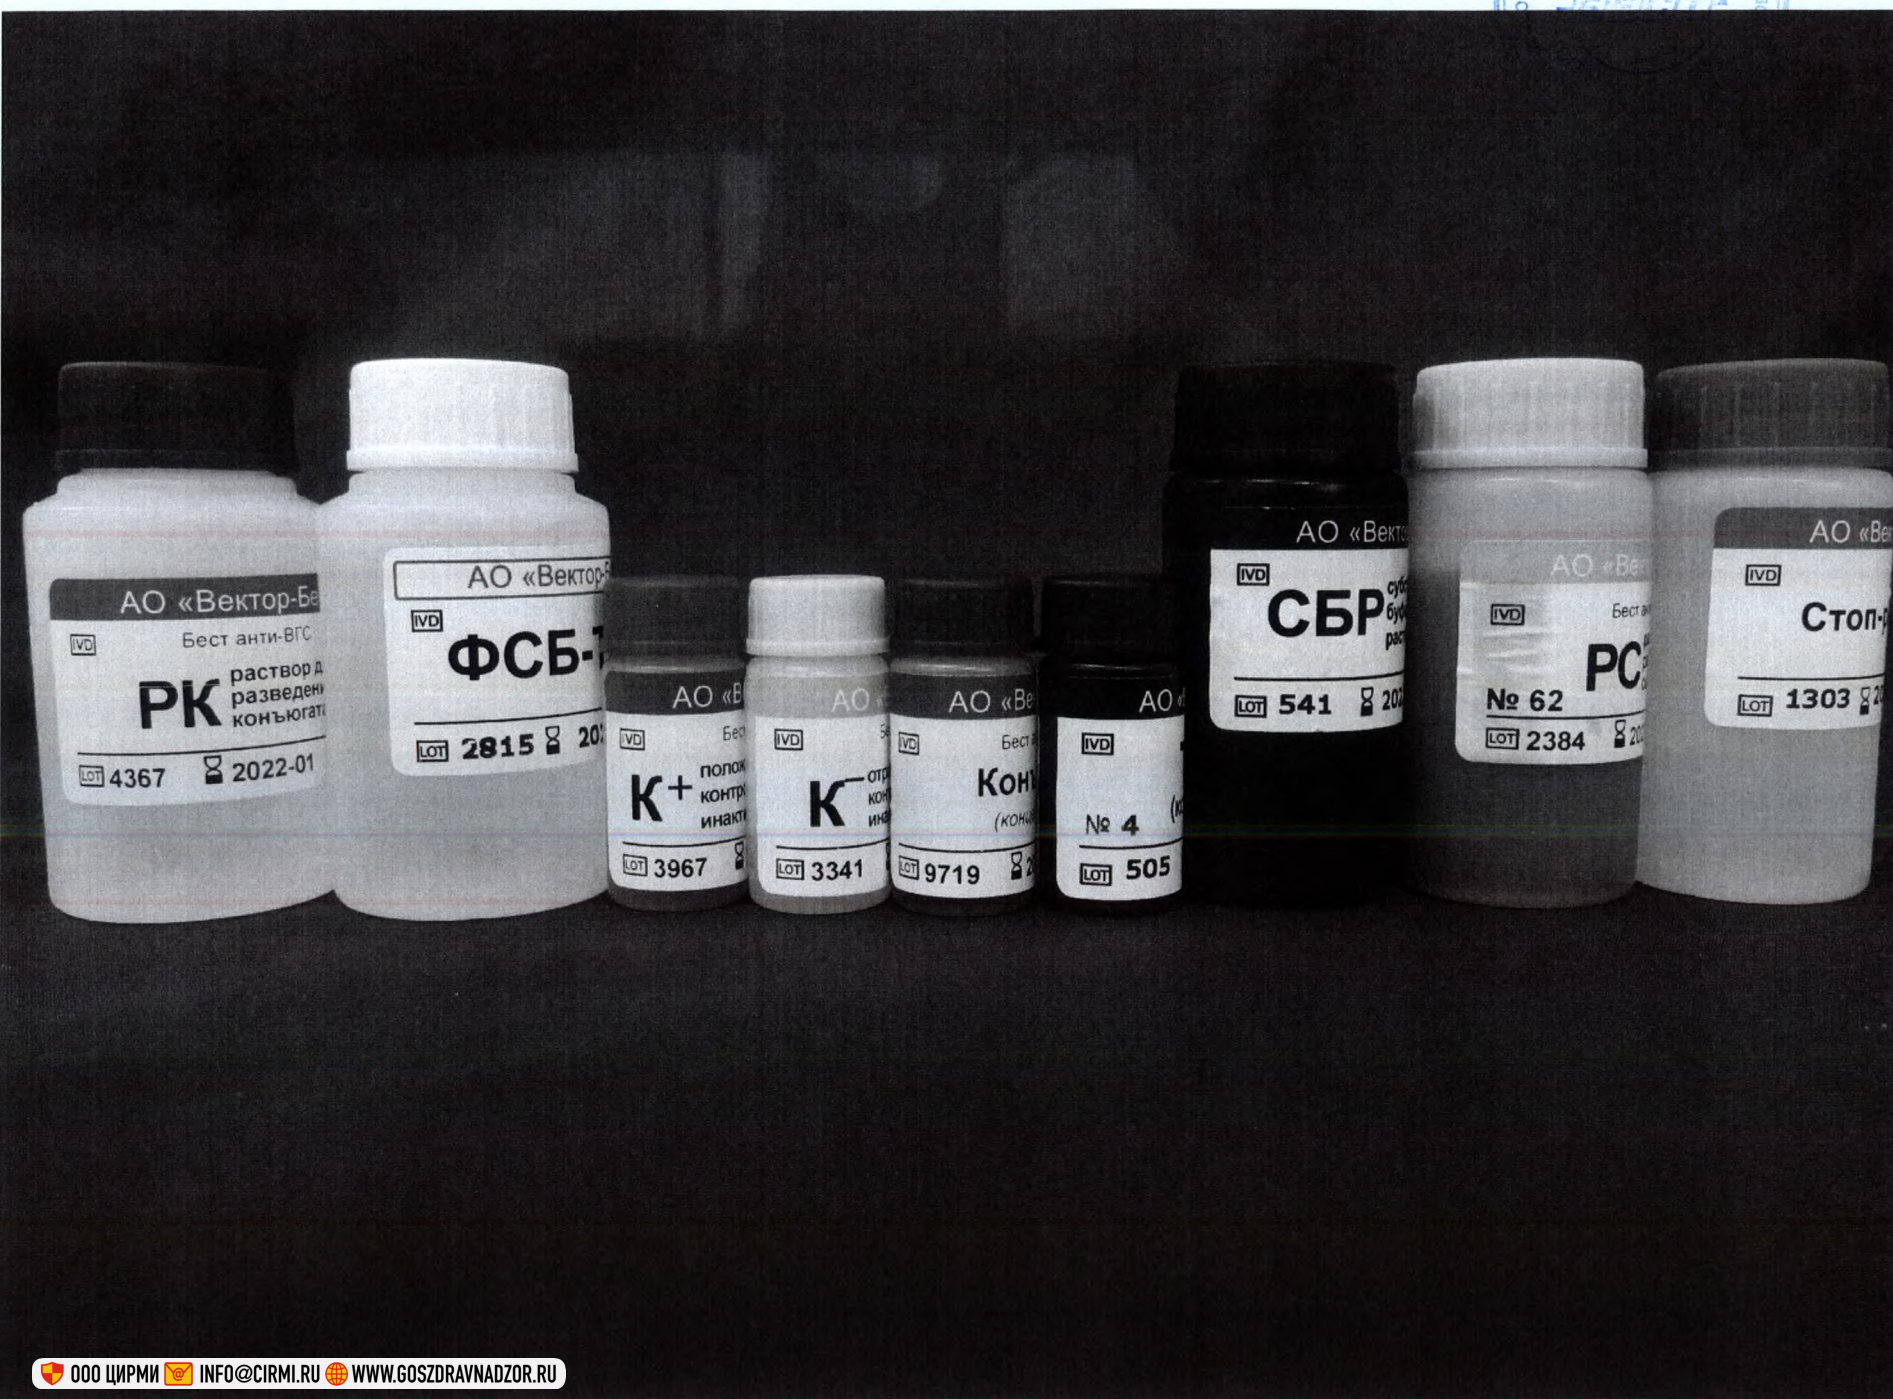

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С для автоматических ИФА-анализаторов (Бест анти-ВГС-авто (комплект 2/Чароит))» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

«06»

ФЕВ

2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С для автоматических ИФА-анализаторов (Бест анти-ВГС-авто (комплект 2/Чароит))» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
«06.07» _____ 2020 г.

