


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену *CagA Helicobacter pylori* (*Helicobacter pylori*-CagA-антитела-ИФА-БЕСТ)»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
04 2019 г.

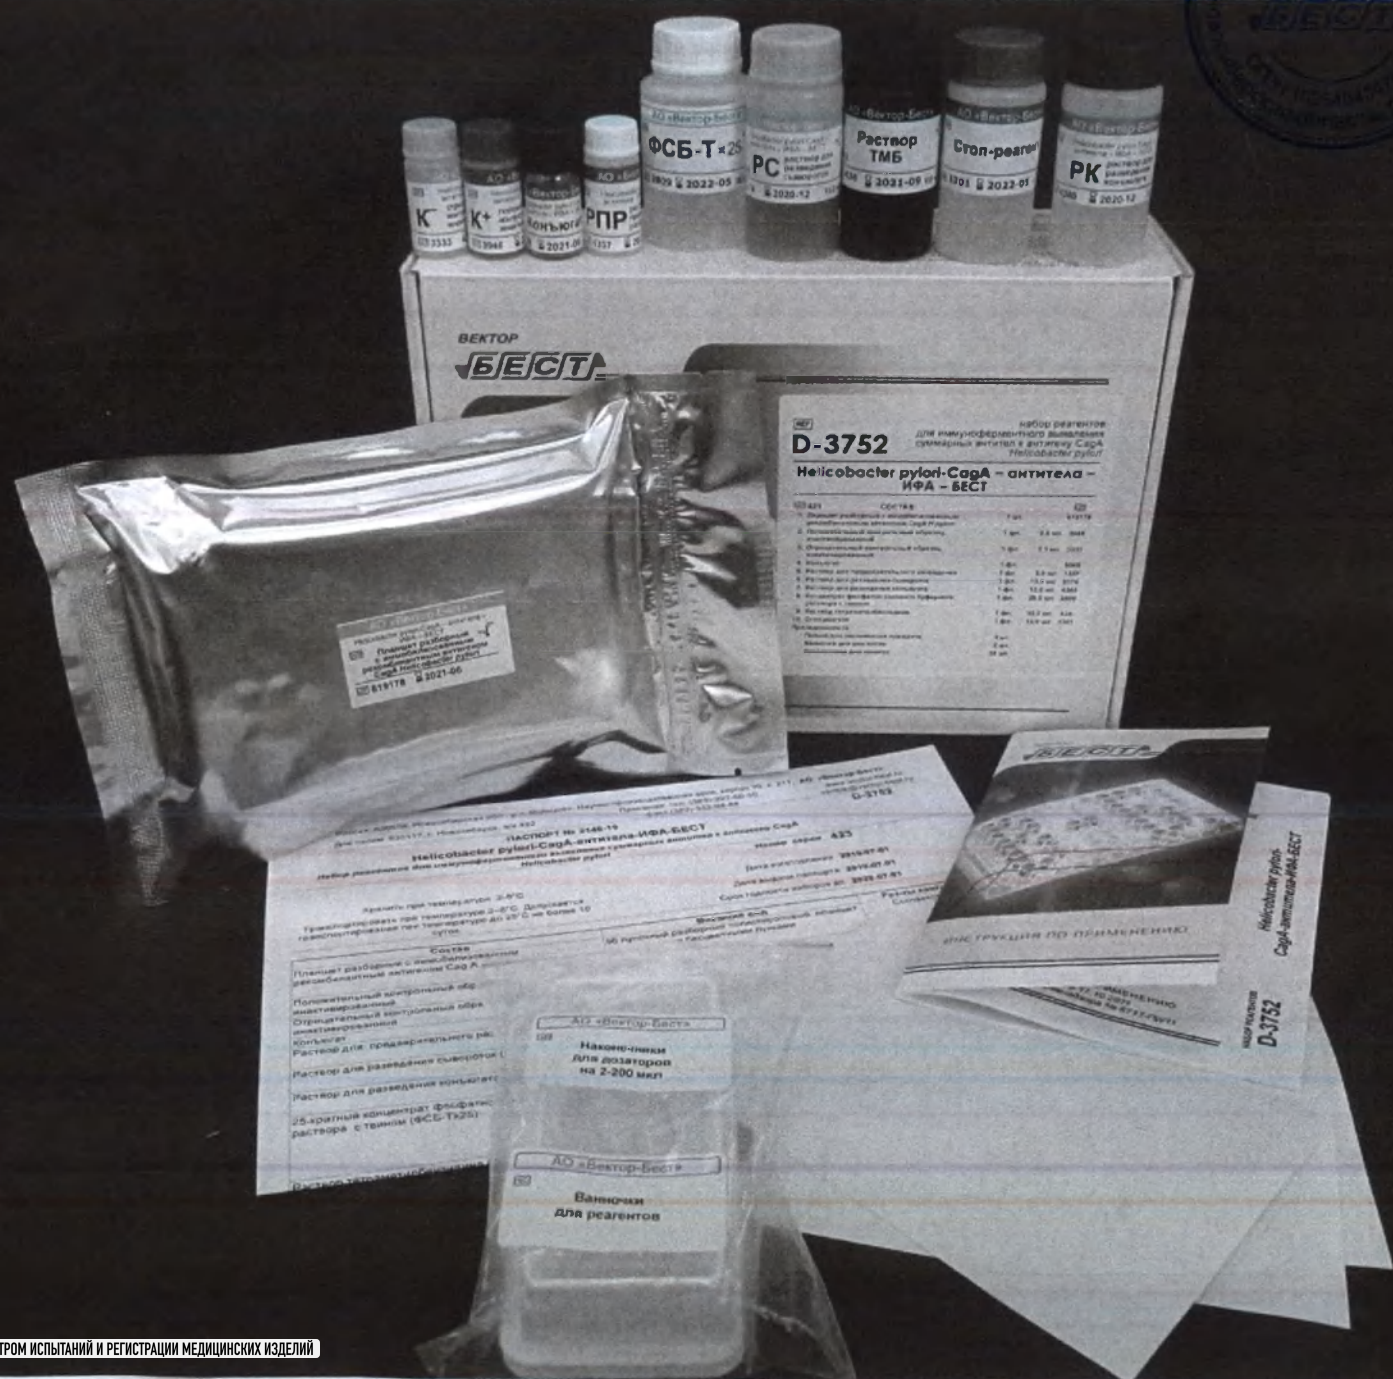

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену *CagA Helicobacter pylori* (*Helicobacter pylori*-CagA-антитела-ИФА-БЕСТ)» № 1


Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.



«11» 07 2019 г.

ВЕКТОР

БЕСТ

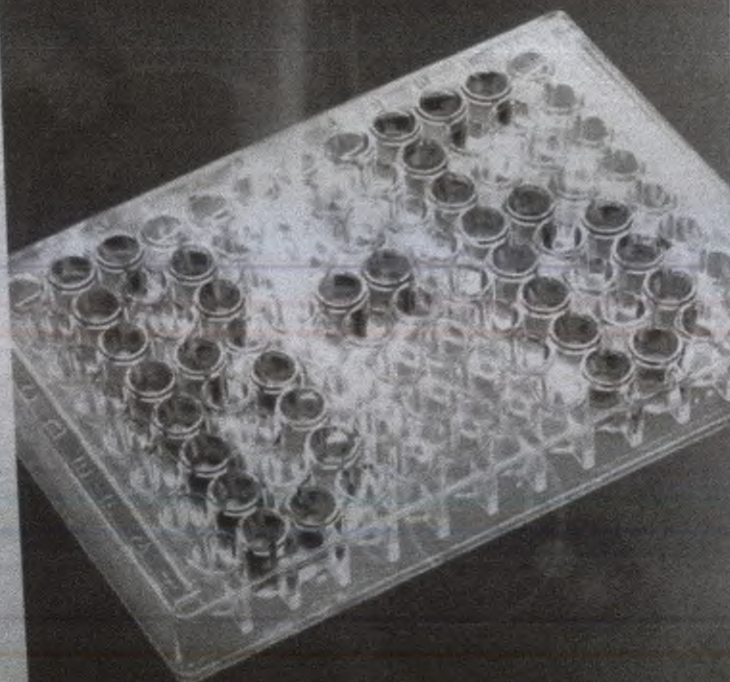

REF

D-3752

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
суммарных антител к антигену *CagA*
Helicobacter pylori

***Helicobacter pylori*-CagA – антитела –
ИФА – БЕСТ**

LOT 423

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном <i>CagA H. pylori</i>	1 шт.	619178
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 0,5 мл	3946
3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,0 мл	3333
4. Конъюгат	1 фл.	9648
5. Раствор для предварительного разведения	1 фл. 3,0 мл	1337
6. Раствор для разведения сывороток	1 фл. 13,0 мл	2374
7. Раствор для разведения конъюгата	1 фл. 13,0 мл	4340
8. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 28,0 мл	2809
9. Раствор тетраметилбензидина	1 фл. 13,0 мл	436
10. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл	1301

Принадлежности:

Плёнка для заклеивания планшета	3 шт.
Ванночки для реагентов	2 шт.
Наконечники для пипеток	16 шт.

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA *Helicobacter pylori* (*Helicobacter pylori*-CagA-антитела-ИФА-БЕСТ)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

2019 г.

БЕКТОР
БЕСТ

REF

D-3752

Σ 12×8

LOT

423

ТУ 9398-292-23548172-2011

ПУ № ФСР 2011/12129 от 25.03.2017



2019-07-01



2020-07-01

**Helicobacter pylori-CagA – антитела –
ИФА – БЕСТ**

IVD



37520107200042300529

Для профессионального применения


Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену *CagA Helicobacter pylori* (*Helicobacter pylori*-CagA-антитела-ИФА-БЕСТ)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

07 2019 г.

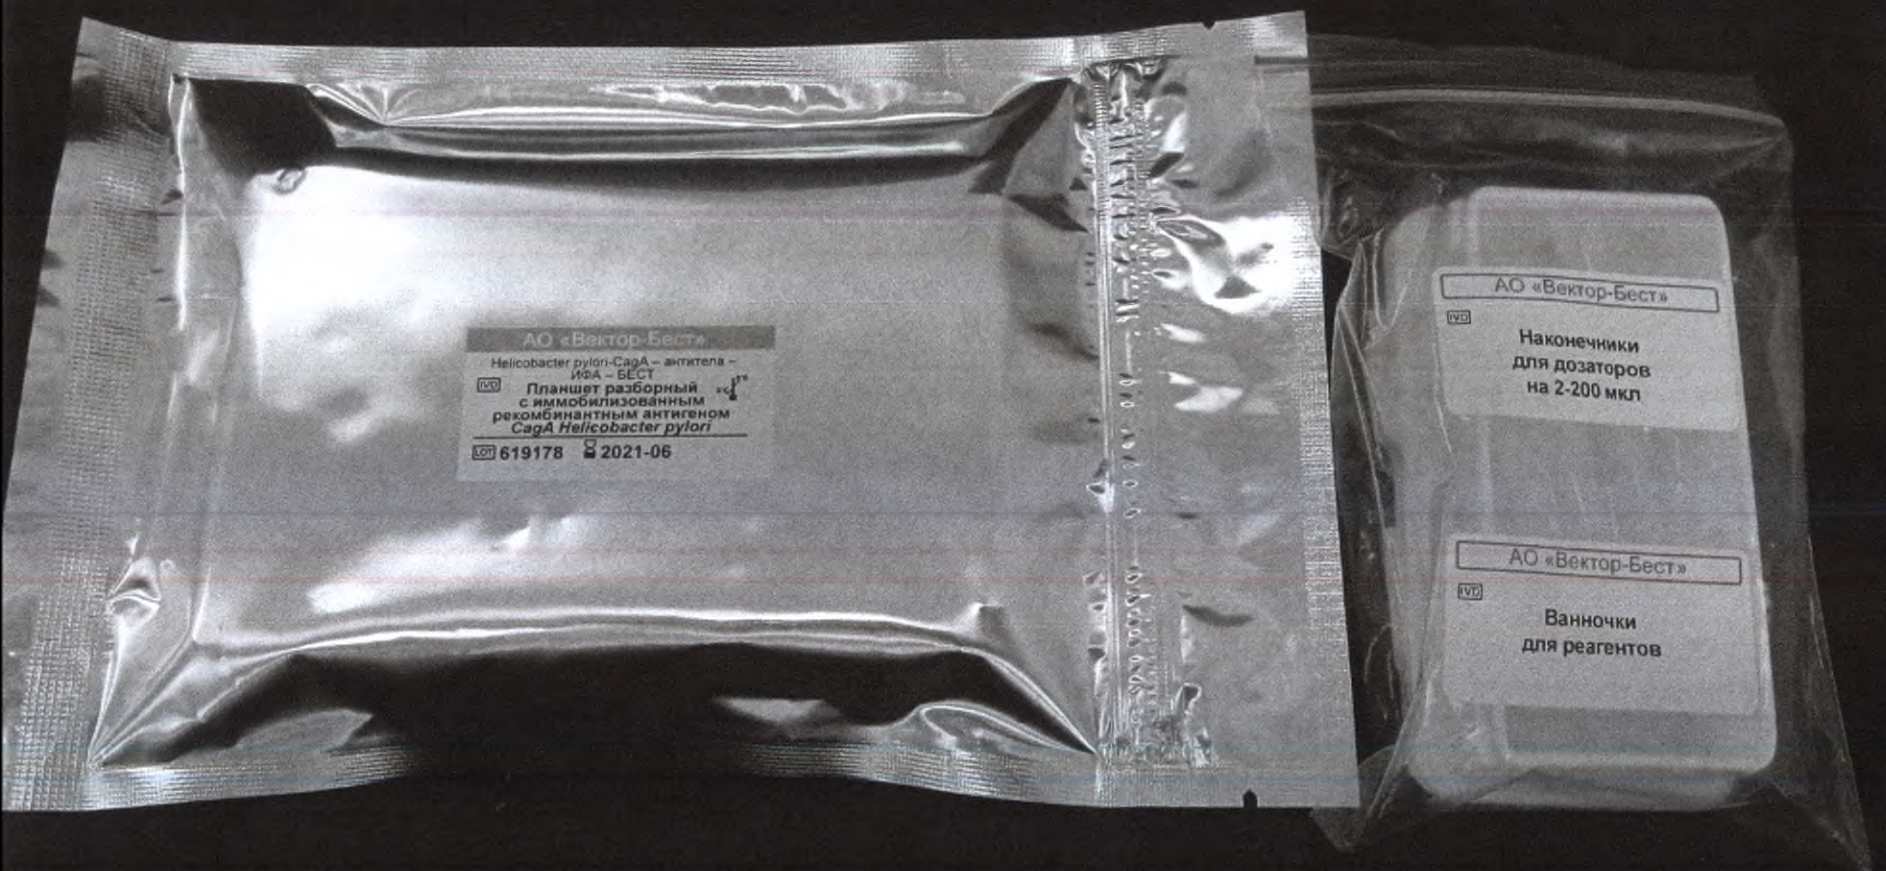


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену *CagA Helicobacter pylori* (*Helicobacter pylori*-CagA-антитела-ИФА-БЕСТ)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
Хусаинов М.Д.
07 2019 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену *CagA Helicobacter pylori* (*Helicobacter pylori*-CagA-антитела-ИФА-БЕСТ)» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
Хусаинов М.Д.
«15» 04 2019 г.

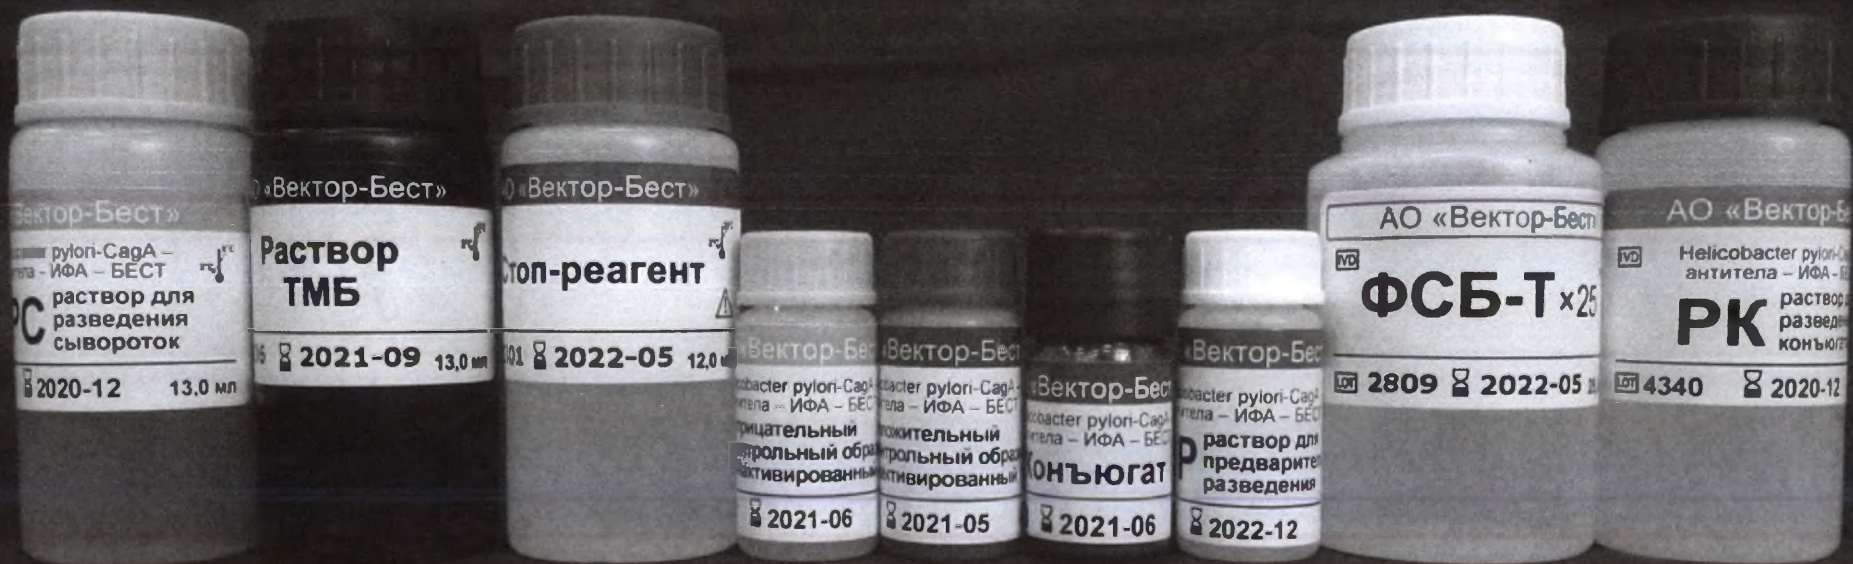

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori (Helicobacter pylori-CagA-антитела-ИФА-БЕСТ)» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

