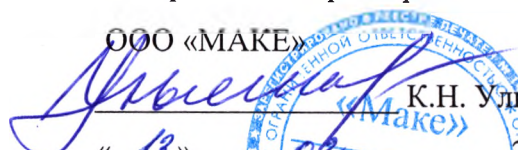


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «МАКЕ»

  
« 13 » 02 2017 г.

К.Н. Ульянова

2017 г.




## ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Аппарат искусственной вентиляции легких Servo Ventilator в  
исполнении Servo-air с принадлежностями**

**производства компании MAQUET CRITICAL CARE AB**


(Маке Критикал Кэа АБ)

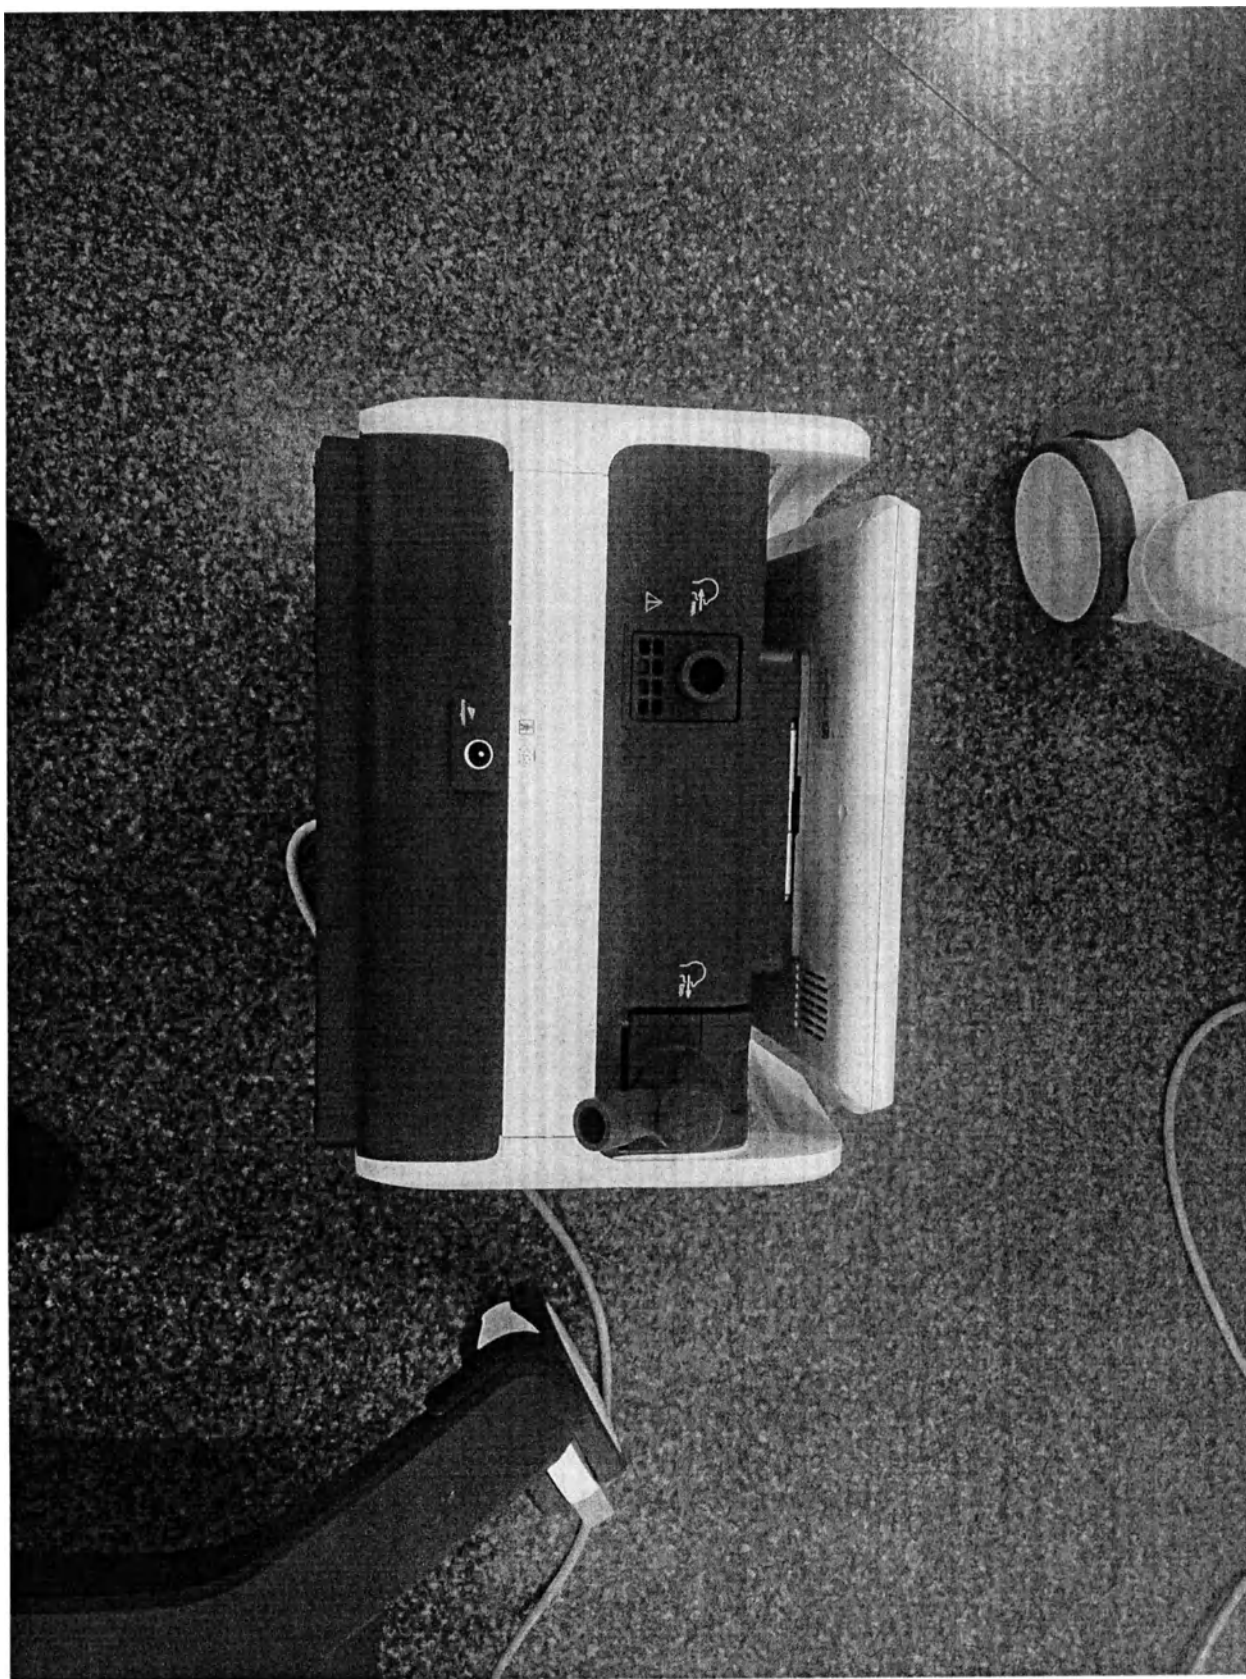



# MAQUET

## GETINGE GROUP

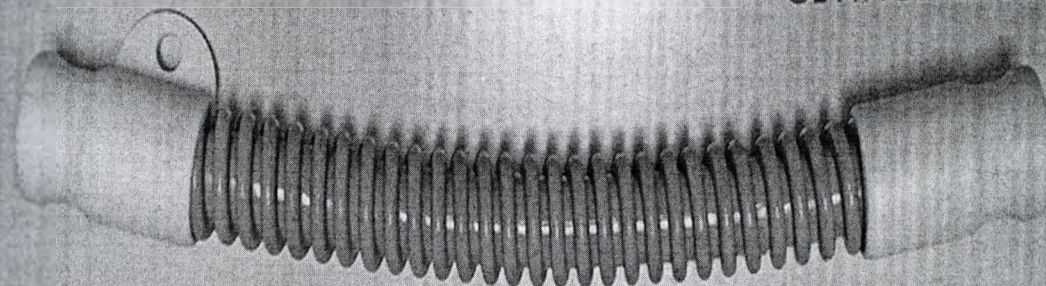

Автоматический Протест-Трубка (Автоматический Протест-Трубка) - это устройство, которое используется для тестирования качества воды. Оно состоит из ручки, трубки и пробирки. Ручка имеет кнопку, которая нажимается, чтобы начать тест. Трубка вставляется в пробирку, и вода из пробирки попадает в трубку. Когда вода достигает определенной отметки, трубка автоматически выключается, и вода останавливается. Это позволяет легко и быстро проверить качество воды.

Важно помнить, что использование этого устройства требует определенных навыков. Перед использованием необходимо внимательно прочитать инструкцию. Также важно использовать только качественные материалы и инструменты. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалисту. Это поможет избежать ошибок и получить точные результаты тестирования.


Важно помнить, что использование этого устройства требует определенных навыков. Перед использованием необходимо внимательно прочитать инструкцию. Также важно использовать только качественные материалы и инструменты. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалисту. Это поможет избежать ошибок и получить точные результаты тестирования.










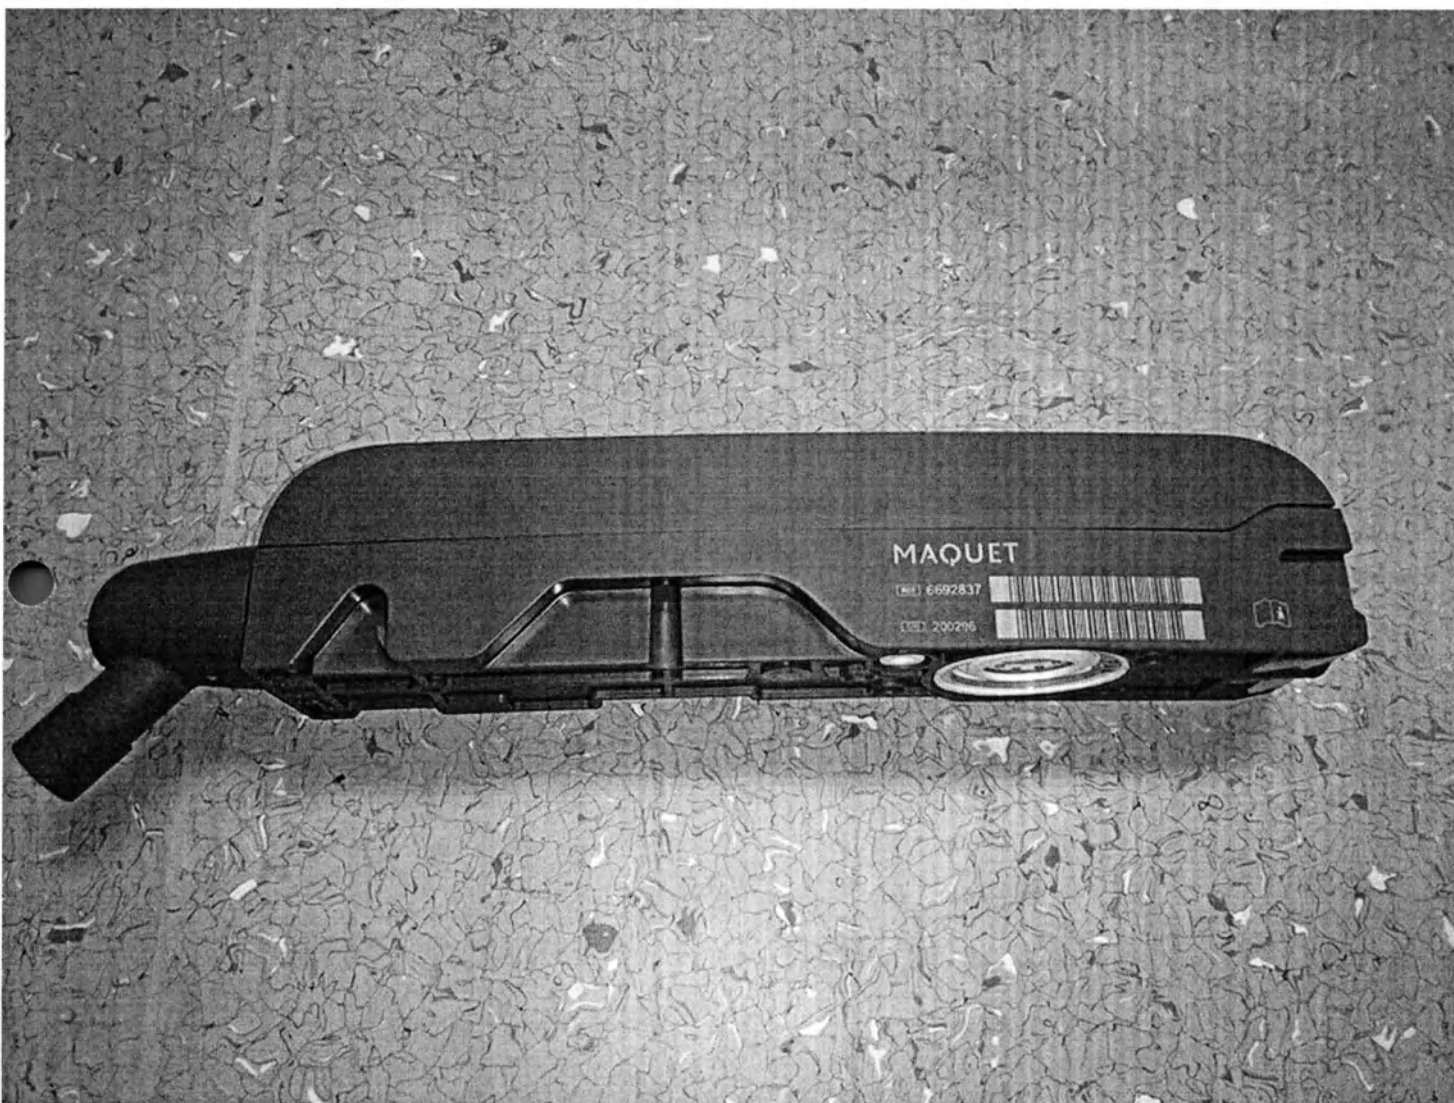






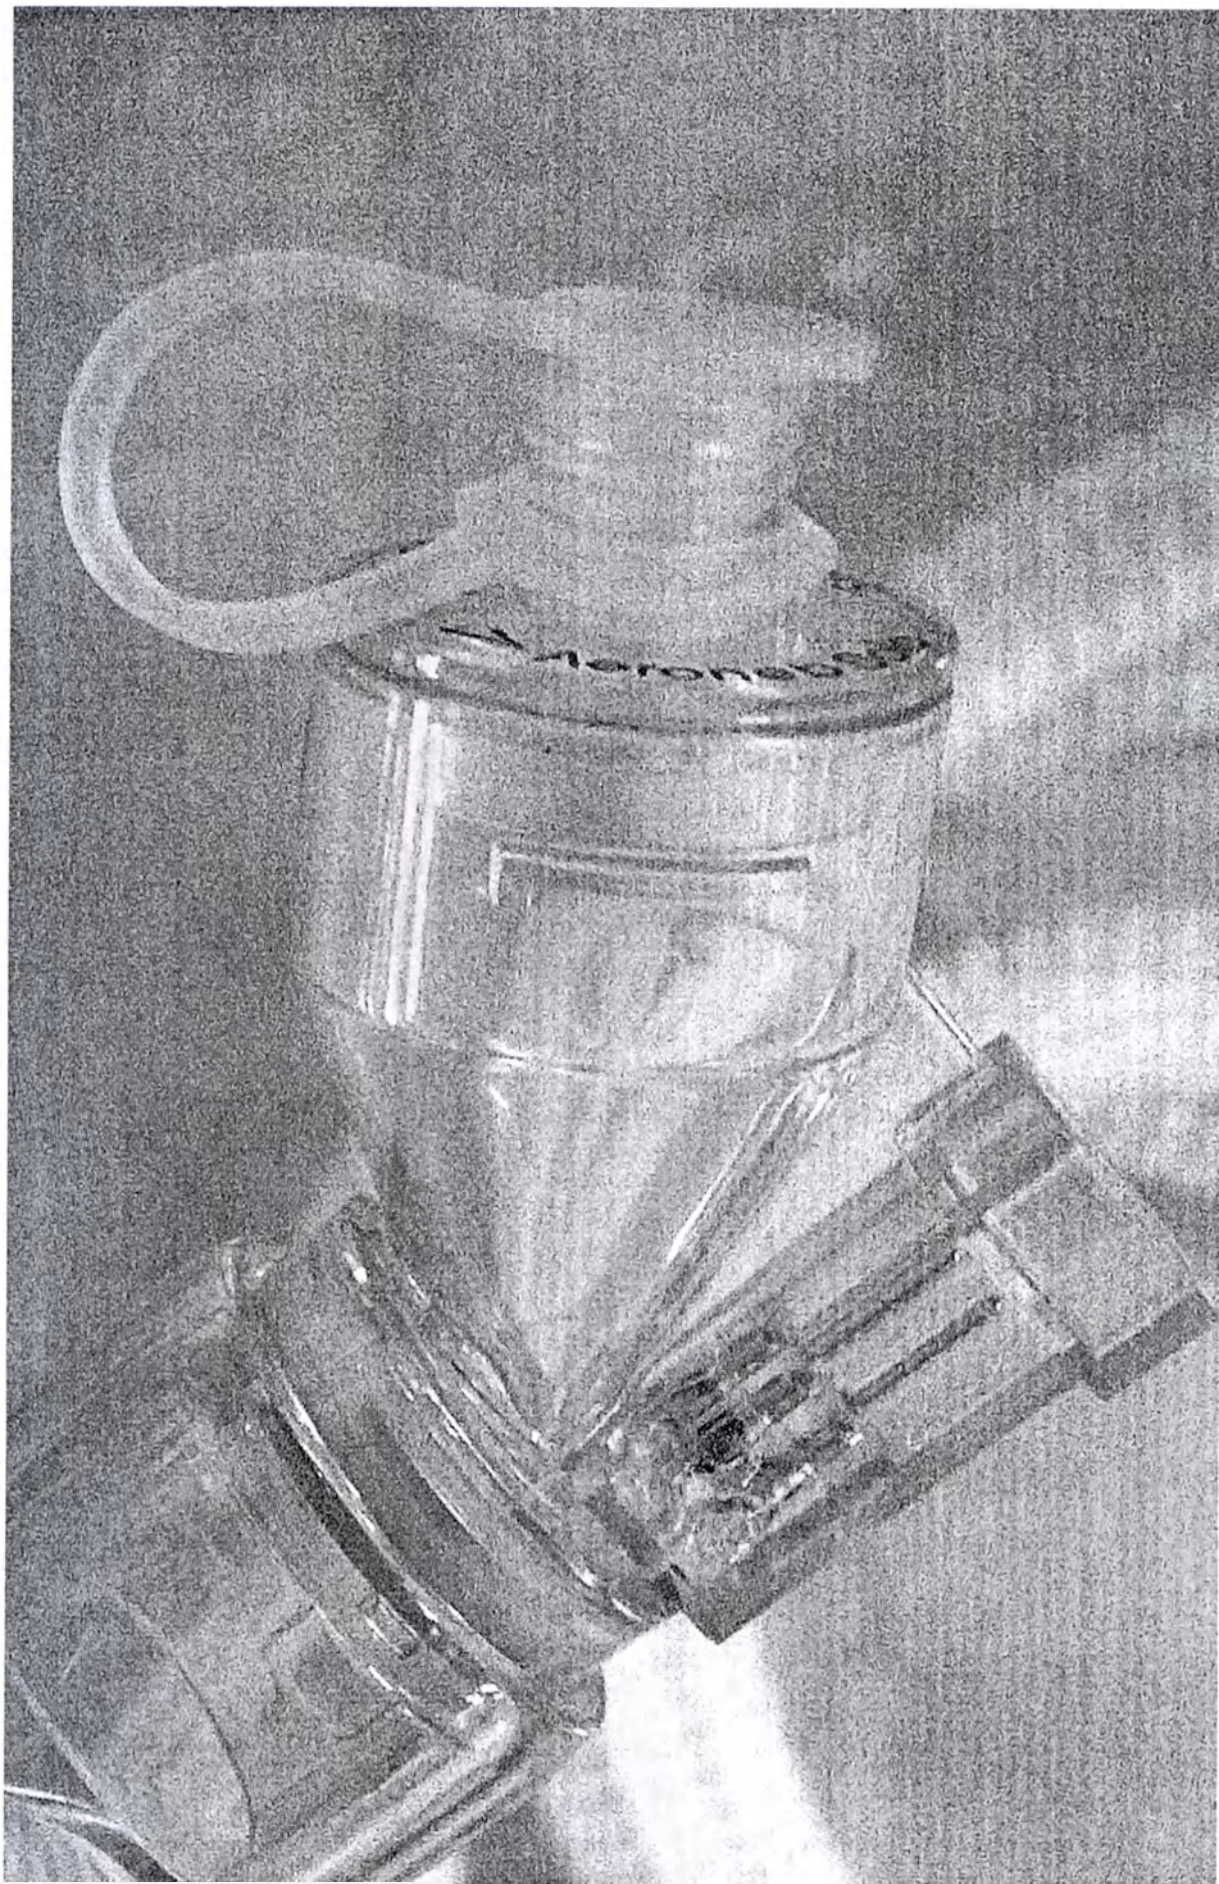








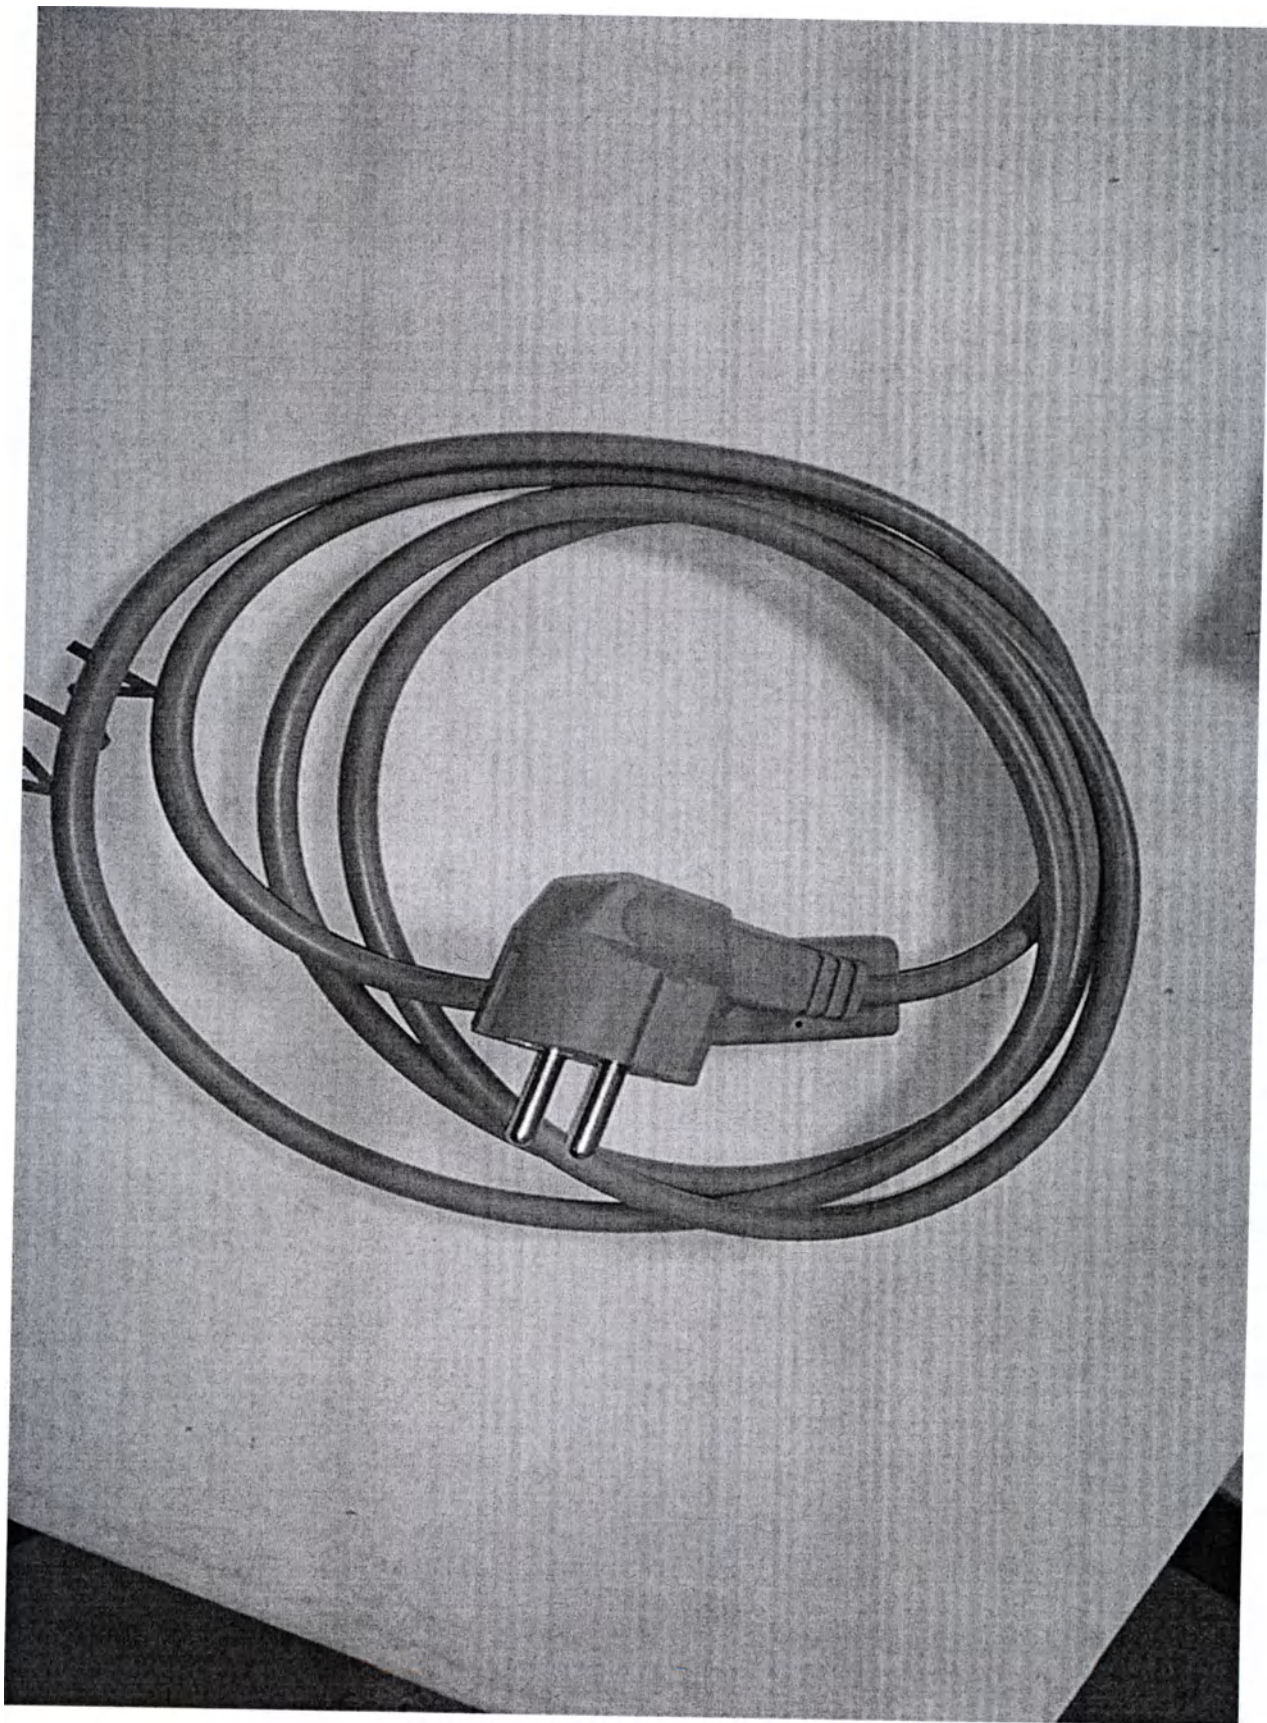




Шланг пациента с набором для подсоединения взрослый

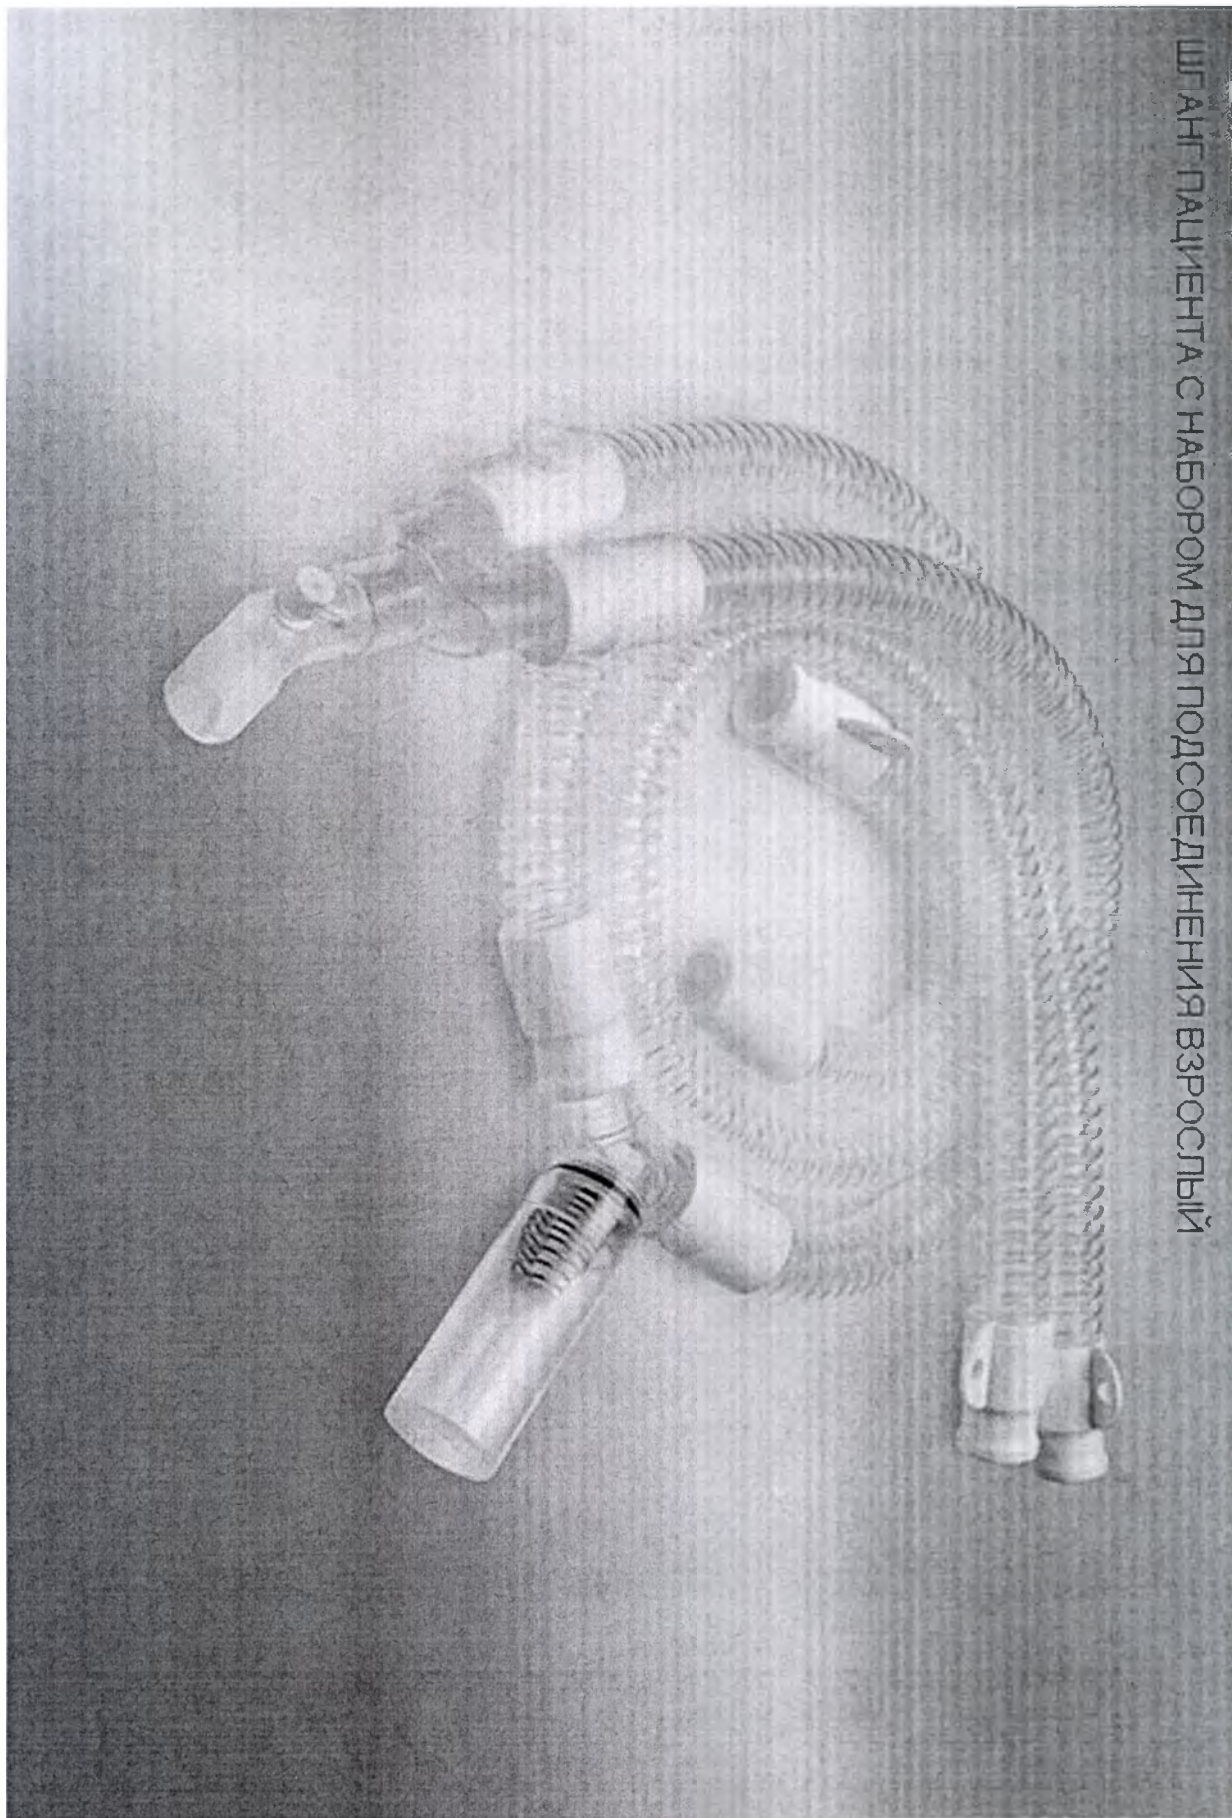



Датчик капнографический с нулевой и референтной ячейкой

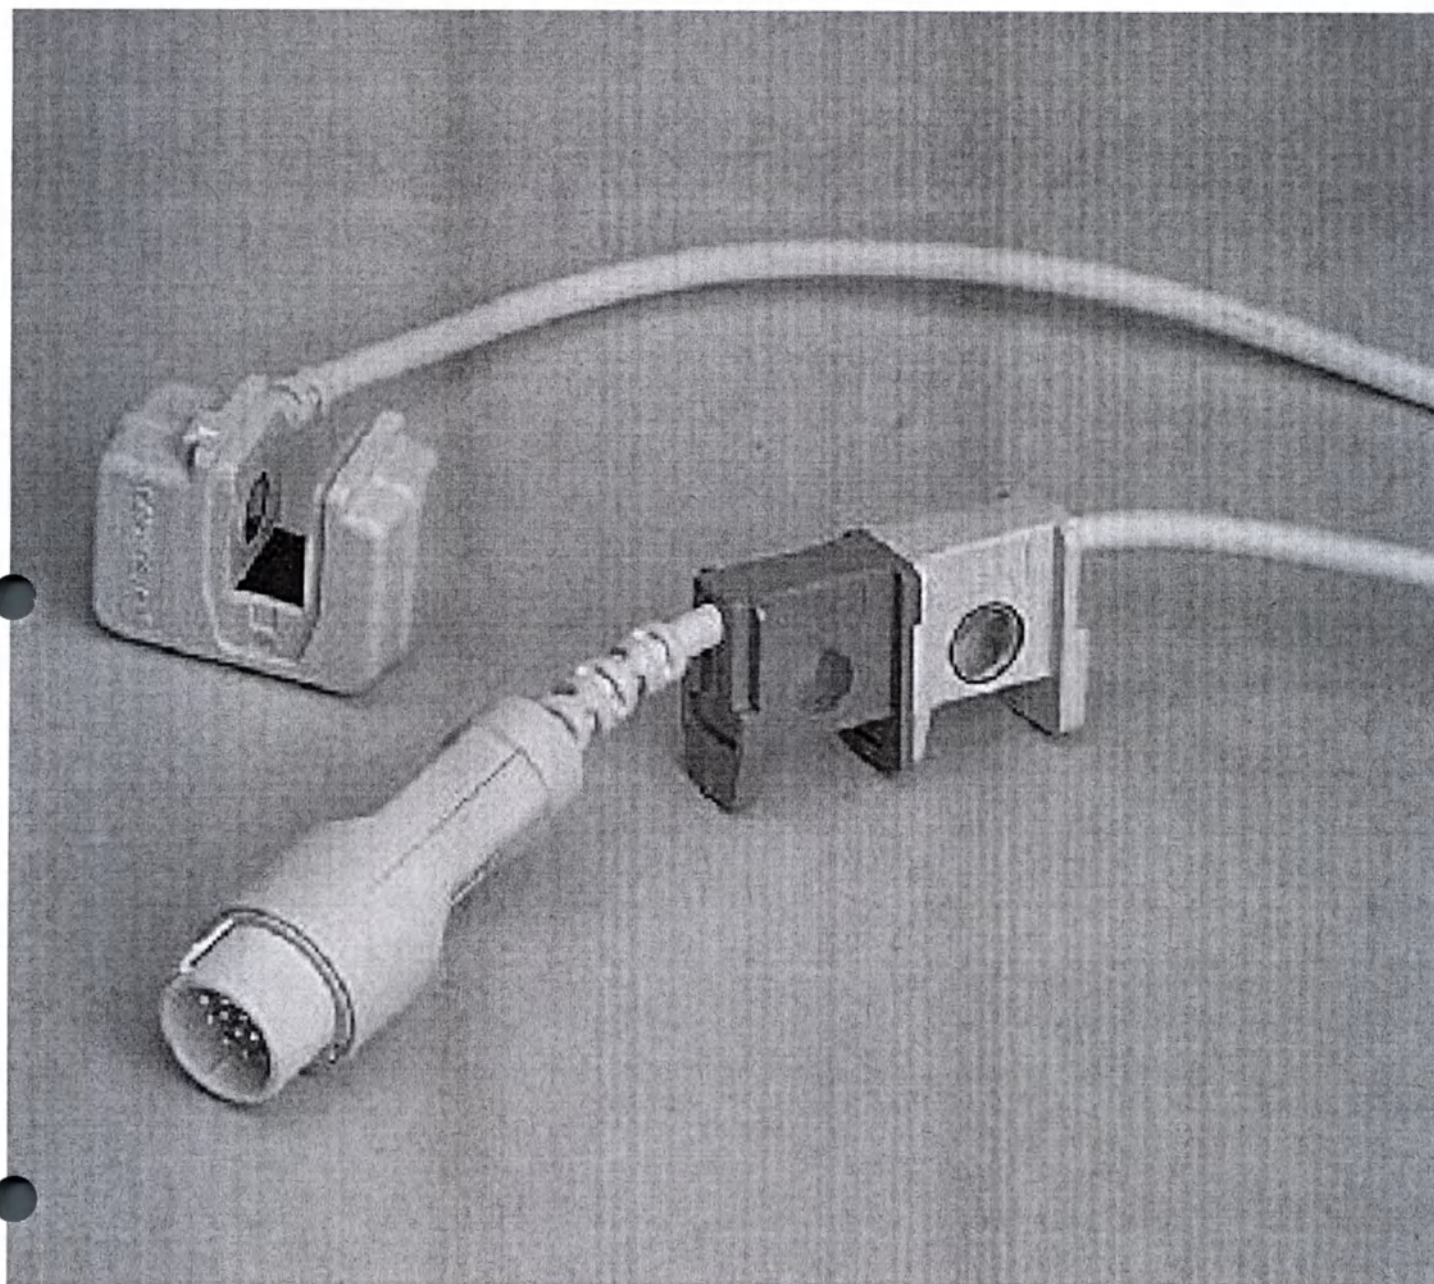



# Адаптер датчика капнографического для взрослых






Адаптер датчика капнографического педиатрический





## Шланг кислородный

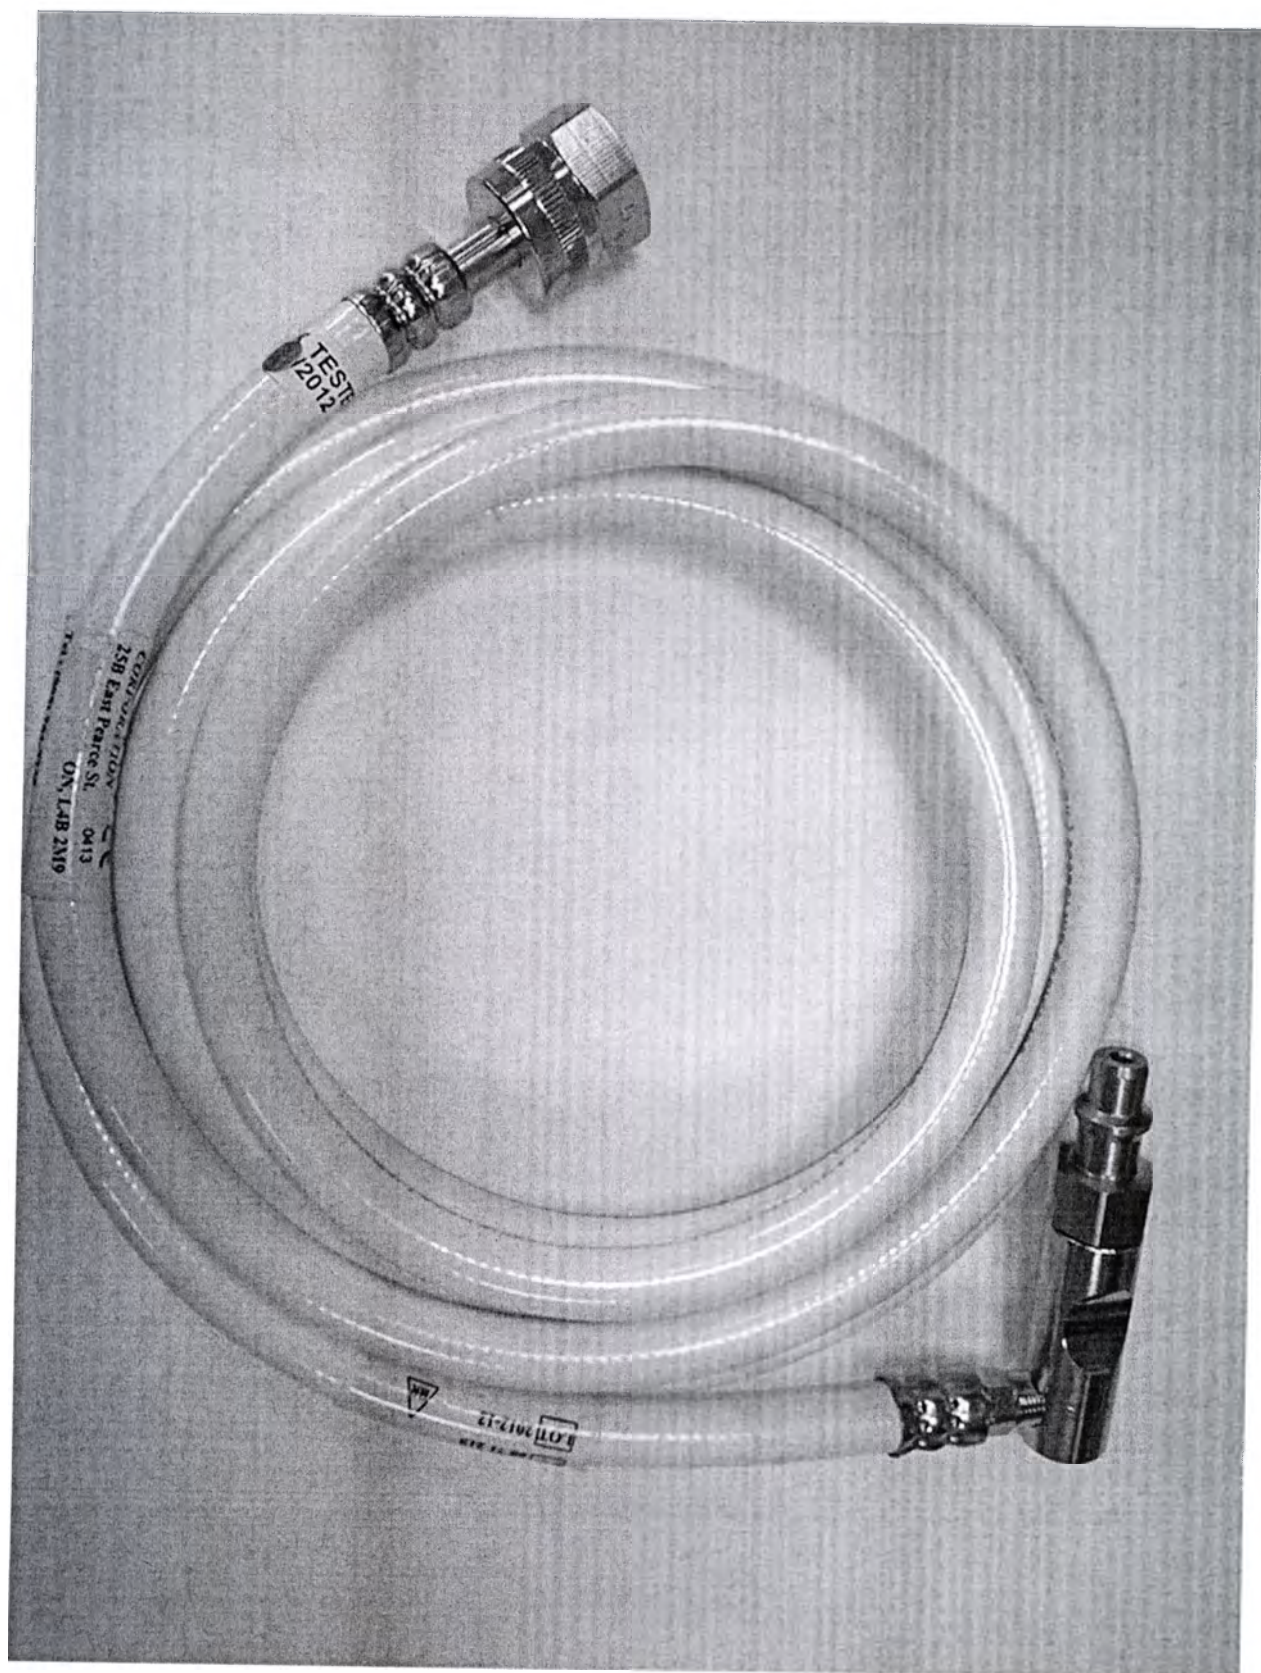






Небулайзер многоразовый




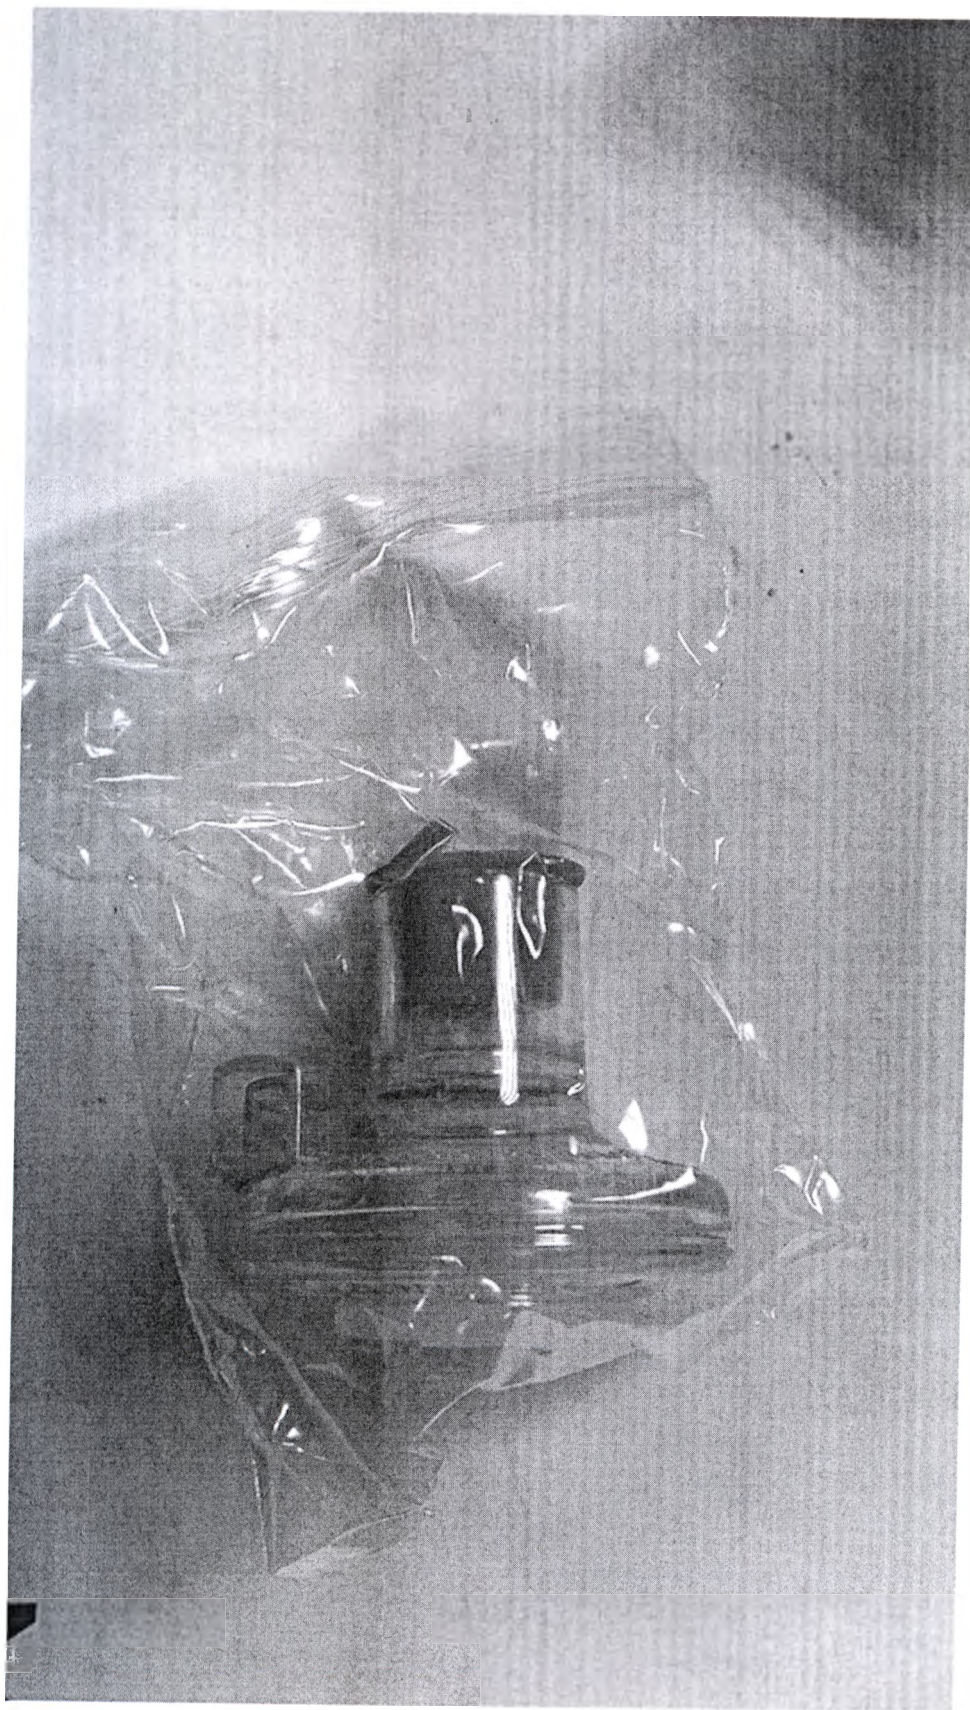








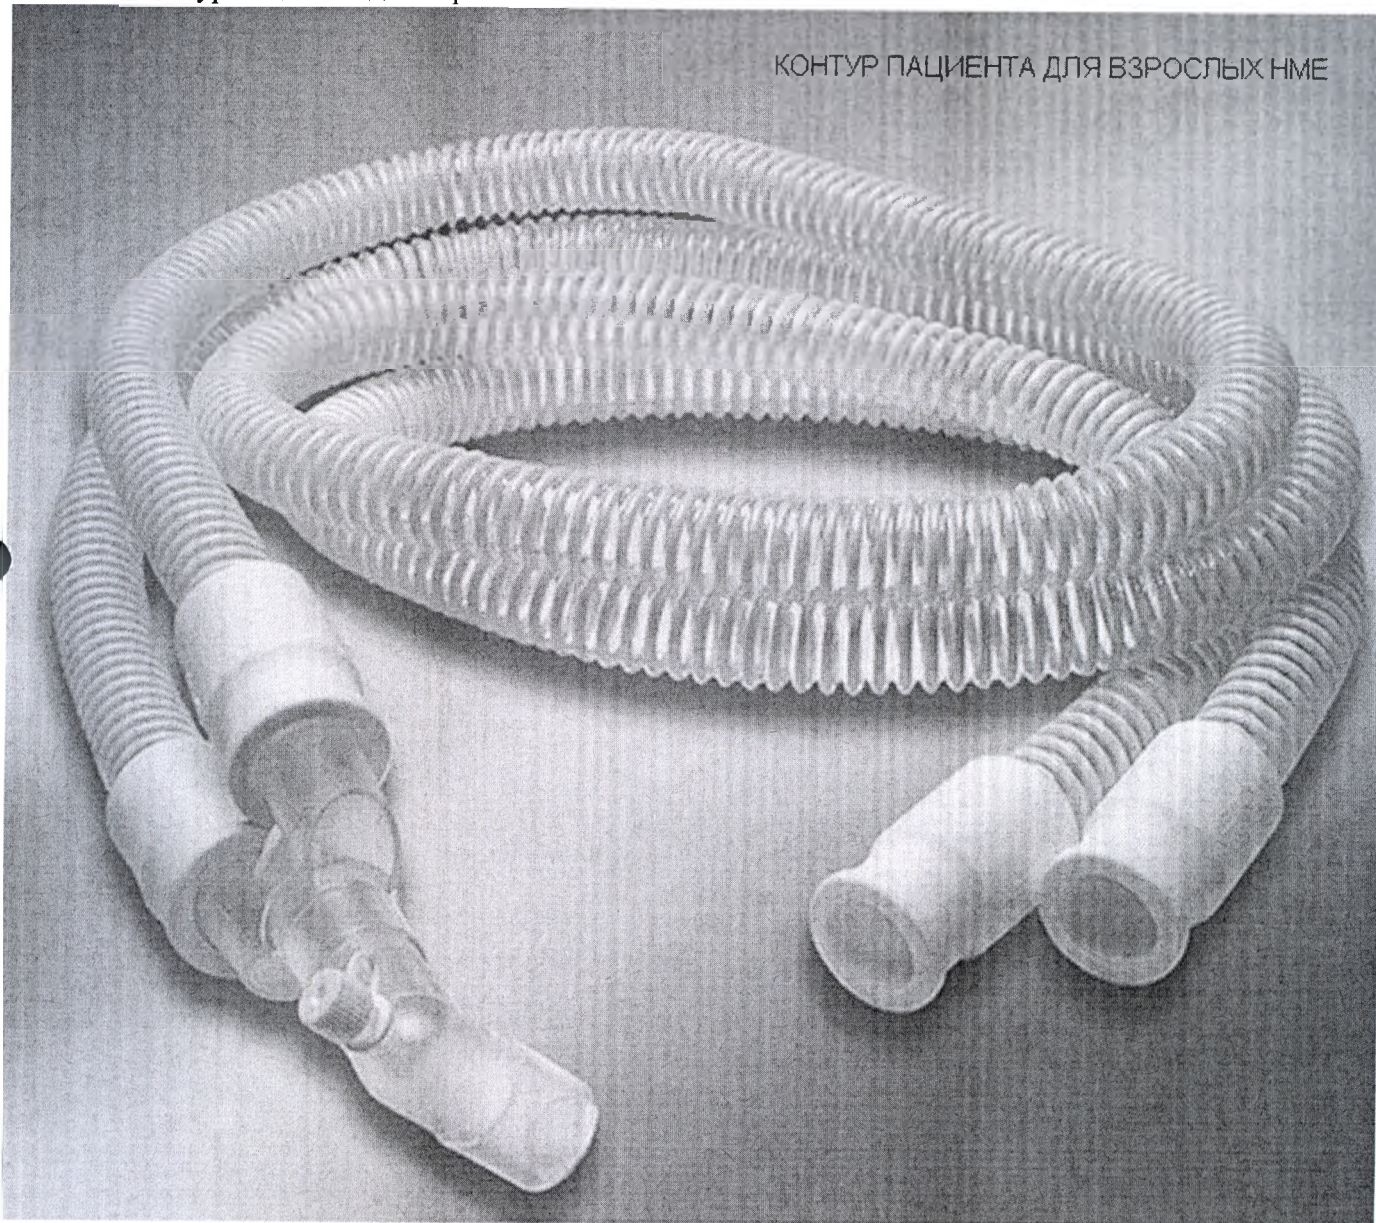




## Контур пациента педиатрический НМЕ

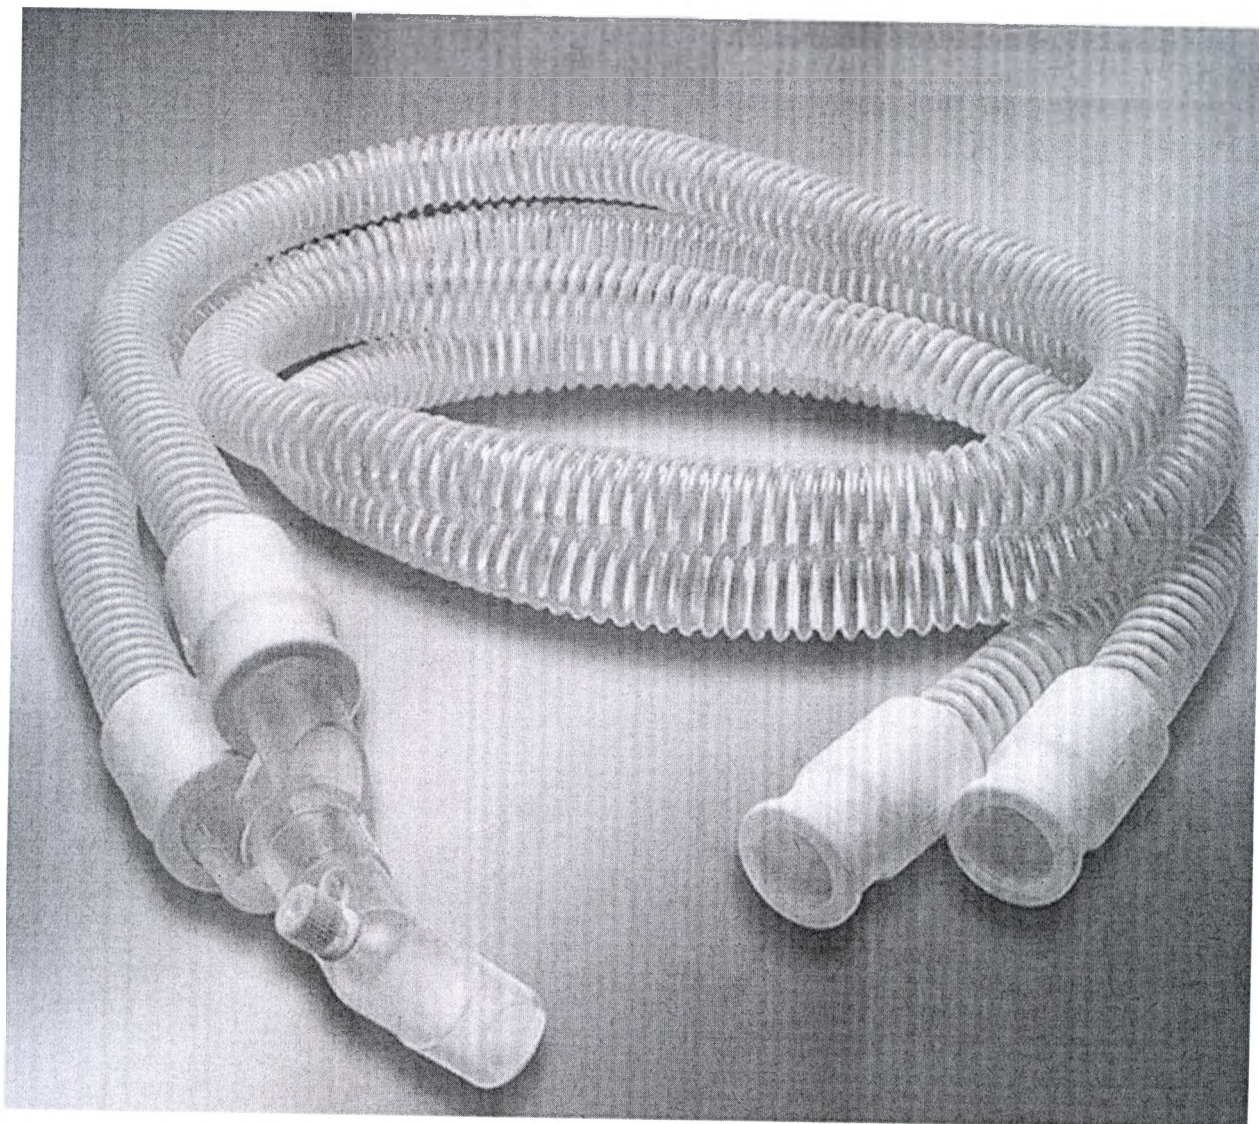




## Шланг пациента с набором для подсоединения взрослый

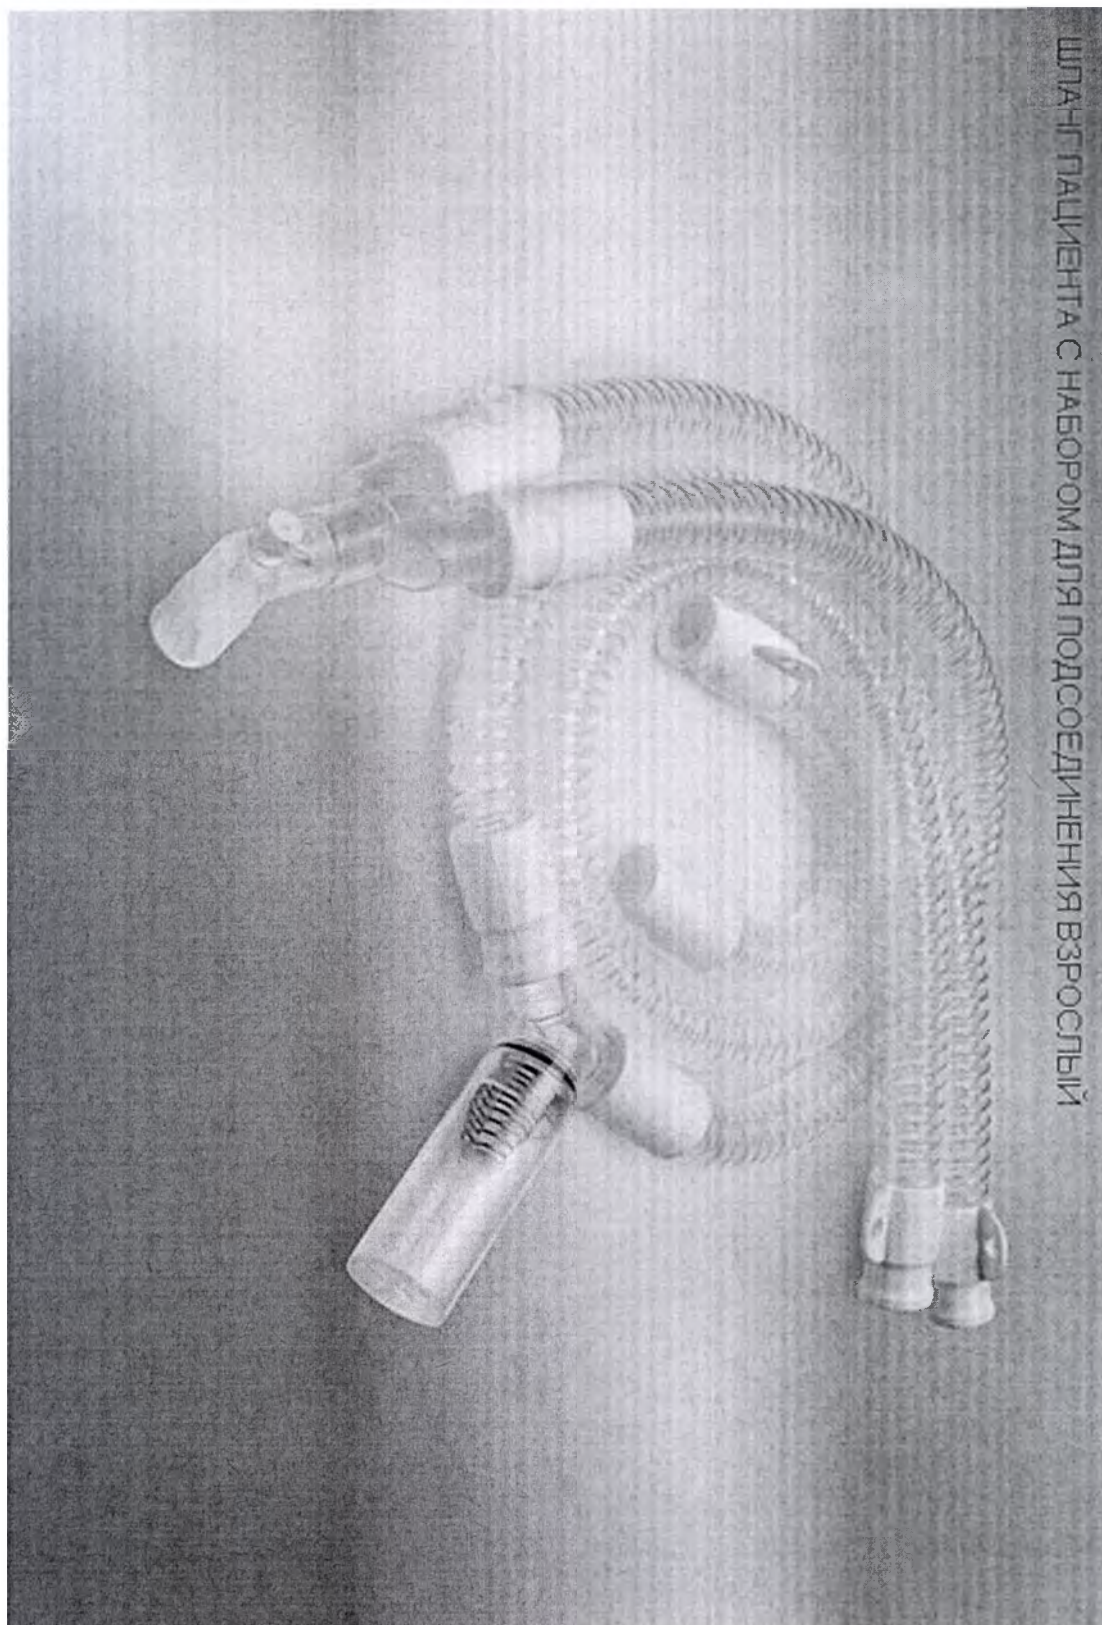




## Шланг пациента с набором для подсоединения педиатрический

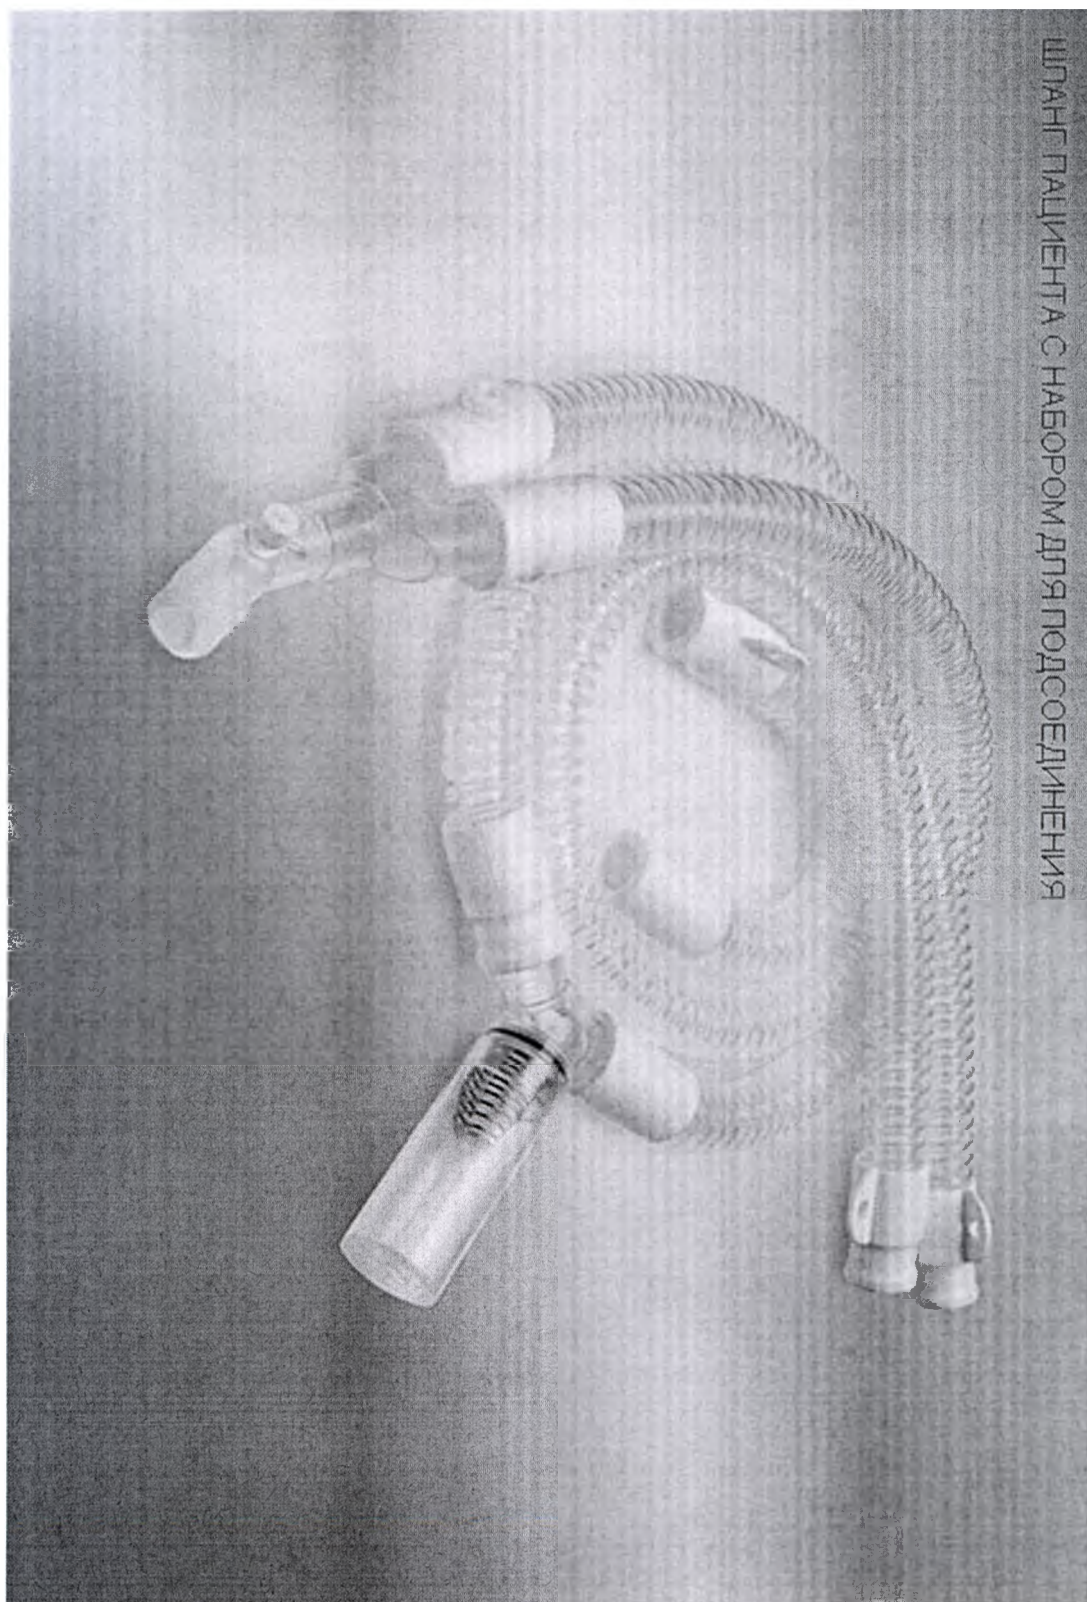




## Шланг для увлажнителя с подогревом для взрослых

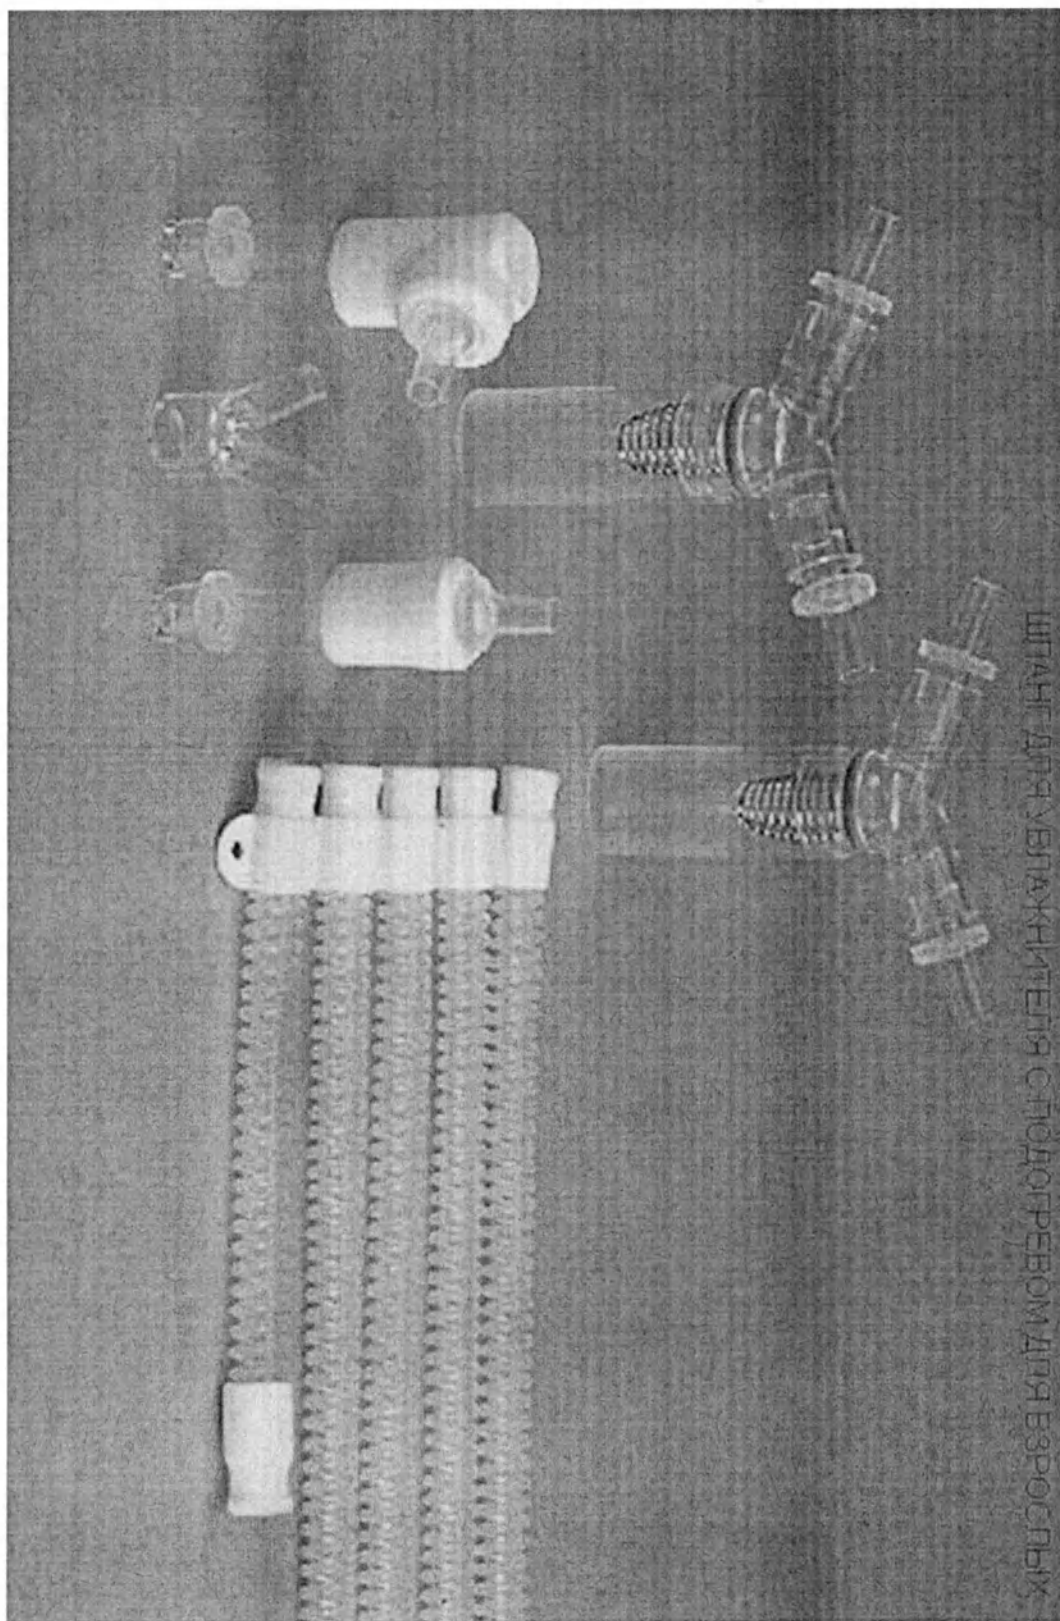




# Шланг для увлажнителя с подогревом педиатрический

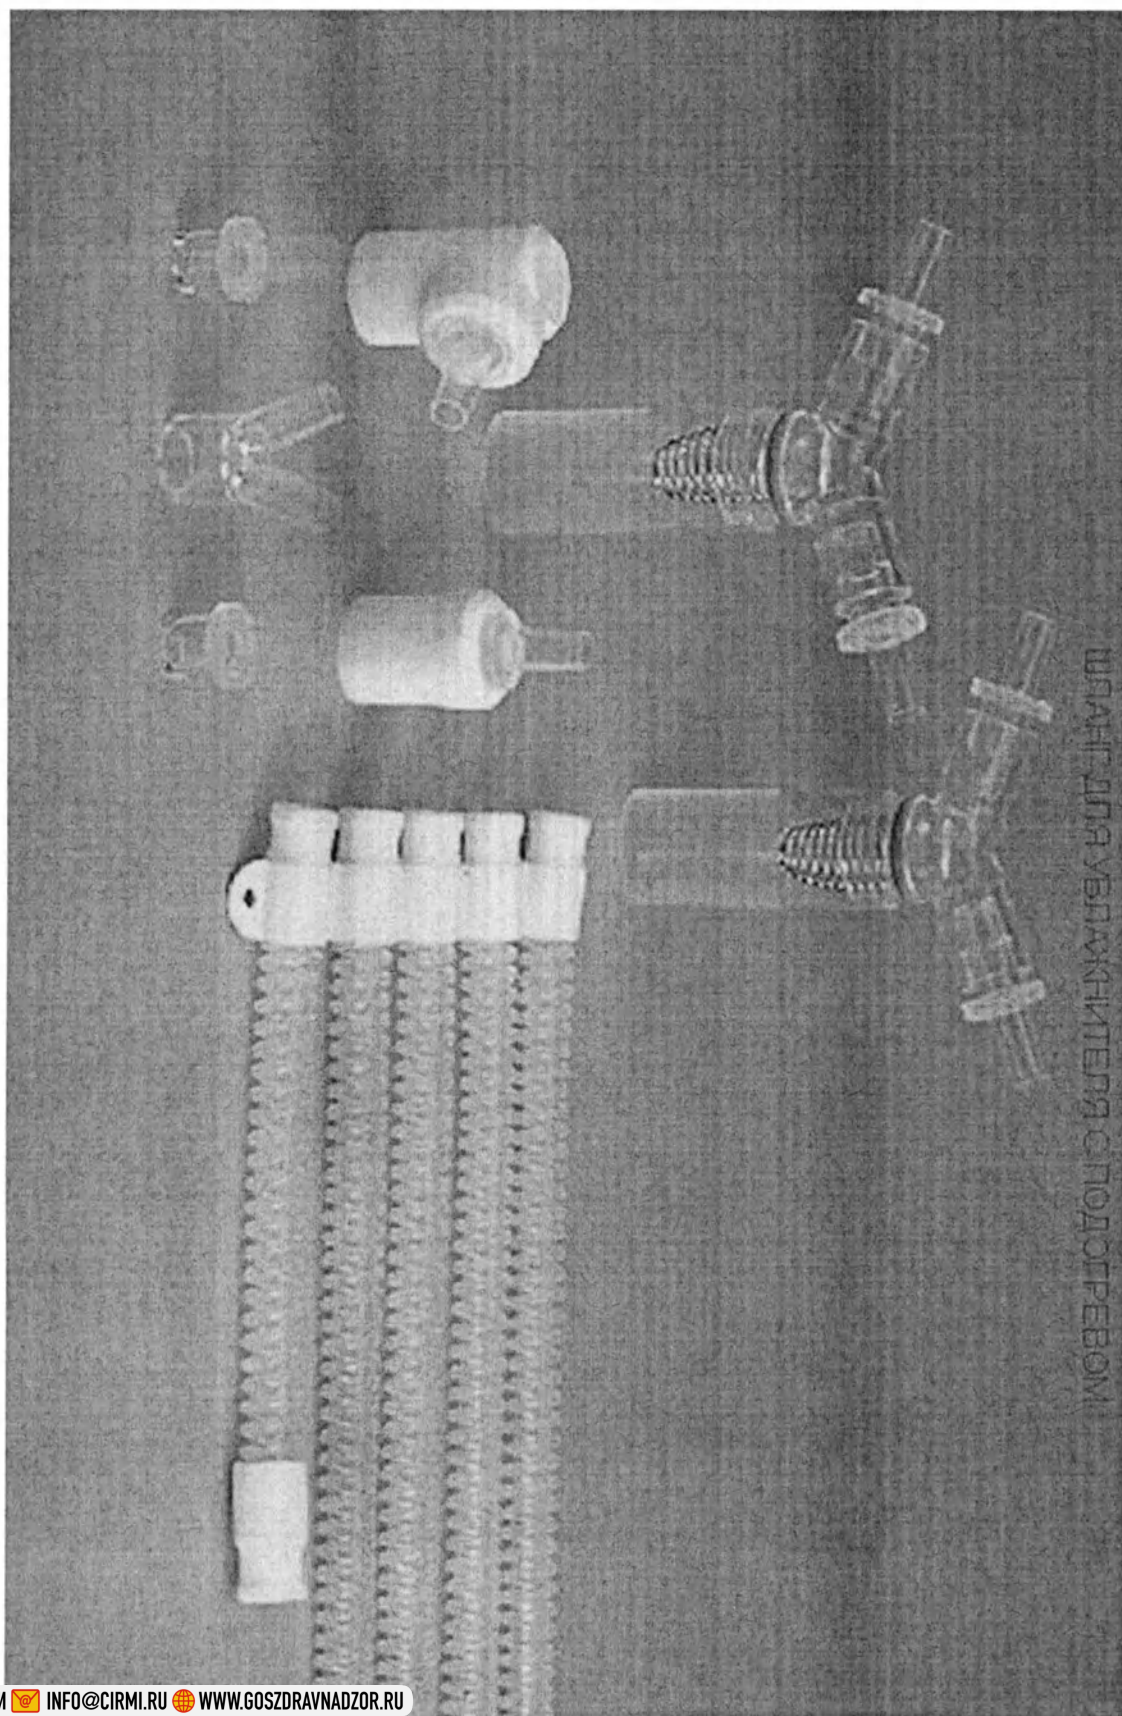



Контур пациента одноразовый взрослый, педиатрический с подогревом контура выдоха и без него, производства Fisher&Paykel Healthcare Ltd.

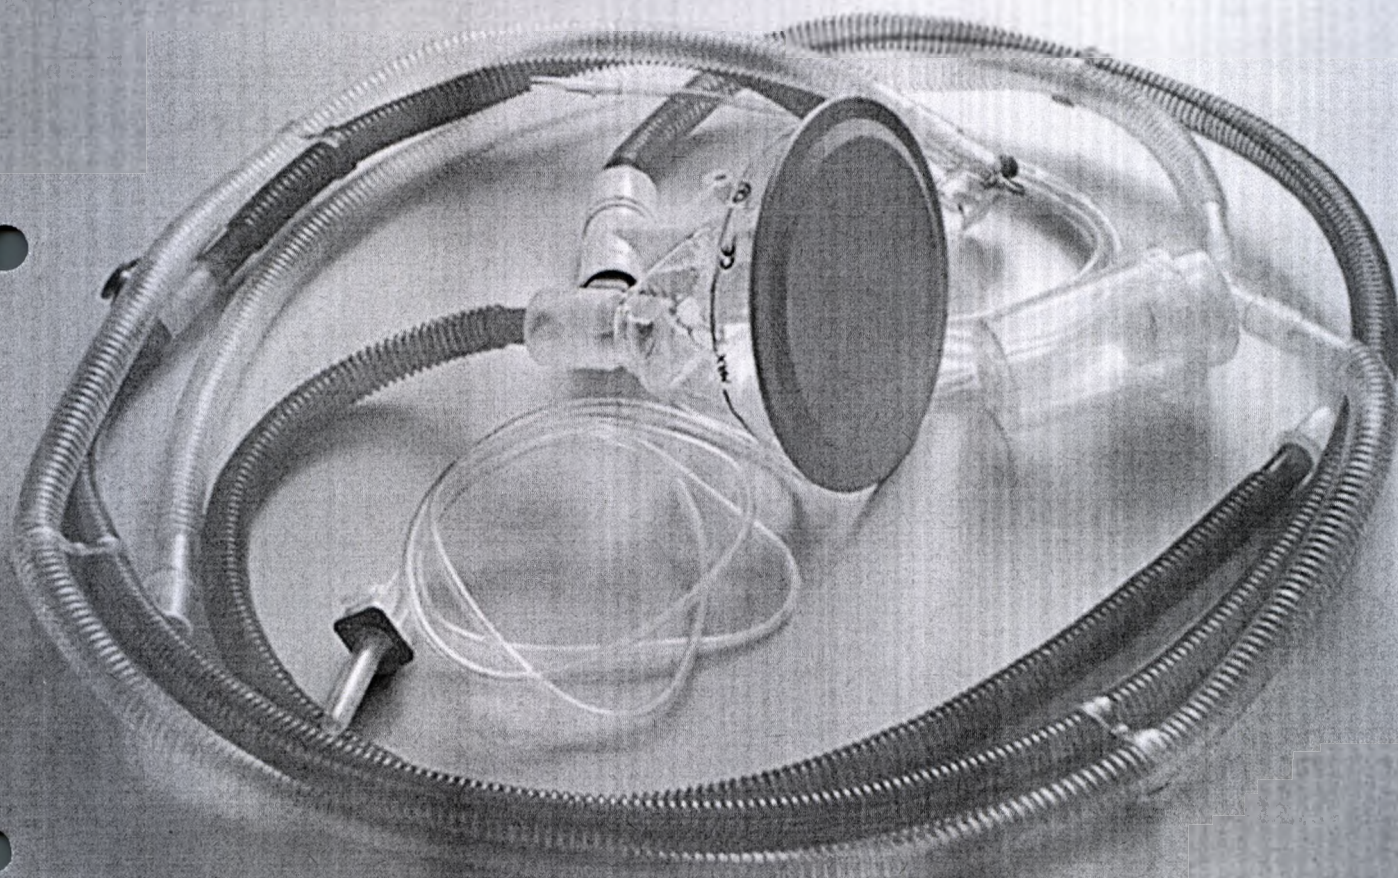




## Увлажнитель с подогревом






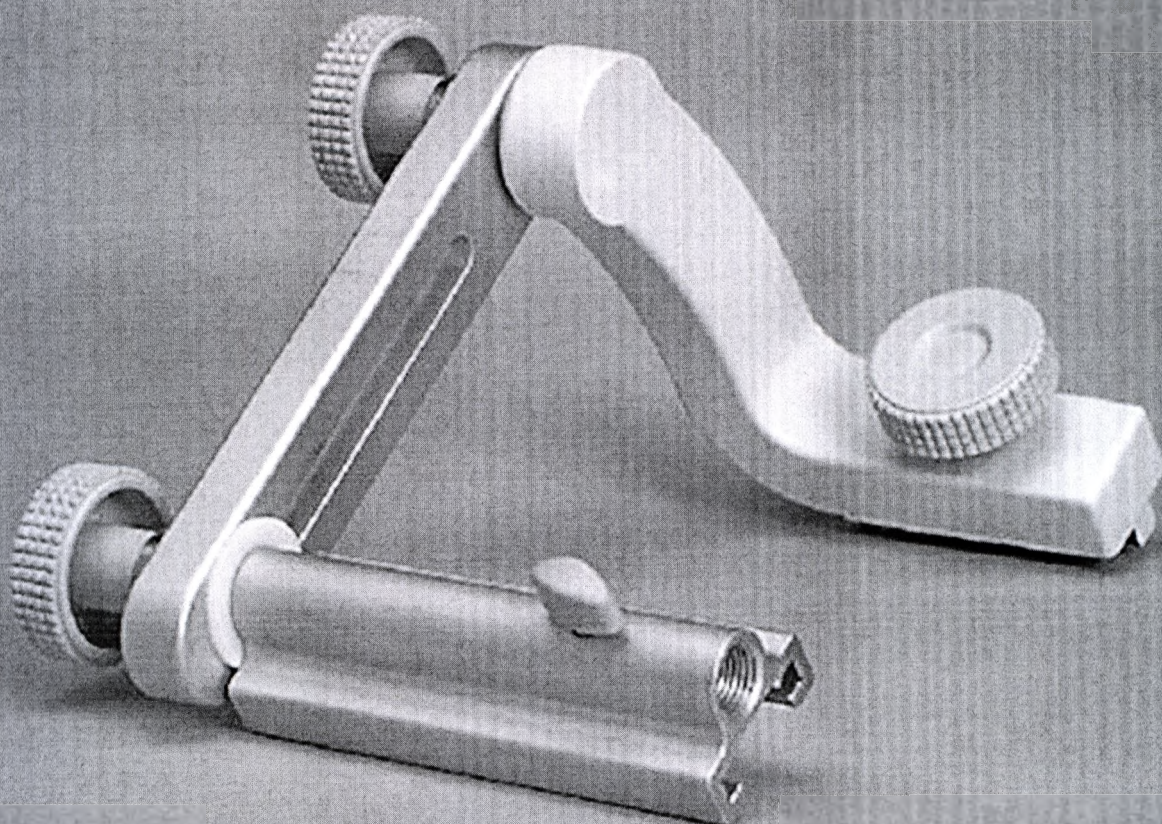




# ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ПОТОКА УВЛАЖНИТЕЛЯ

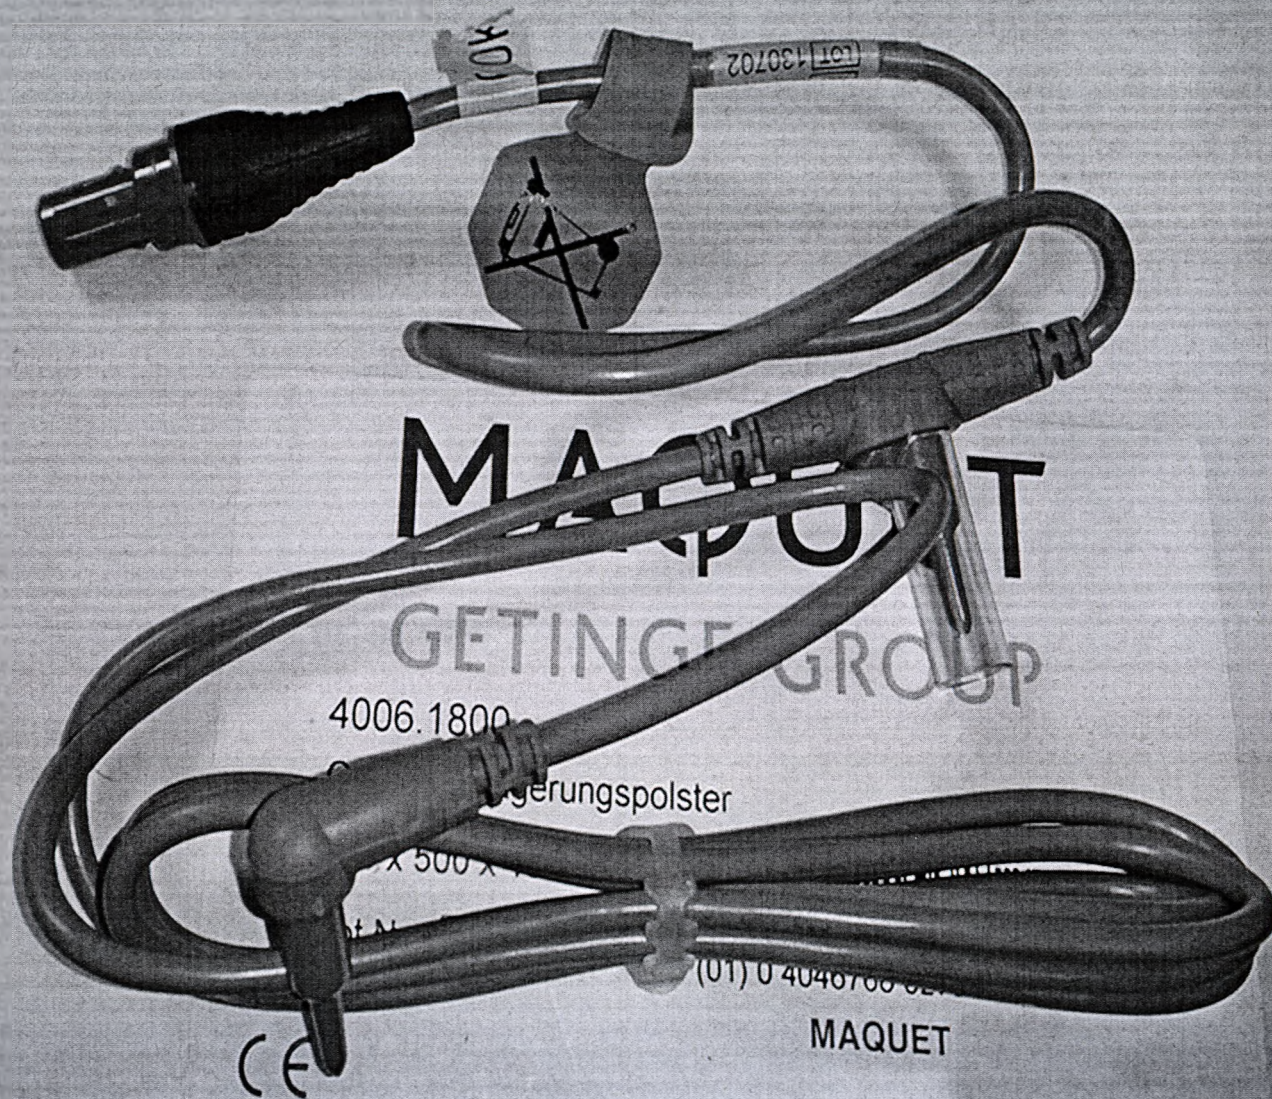




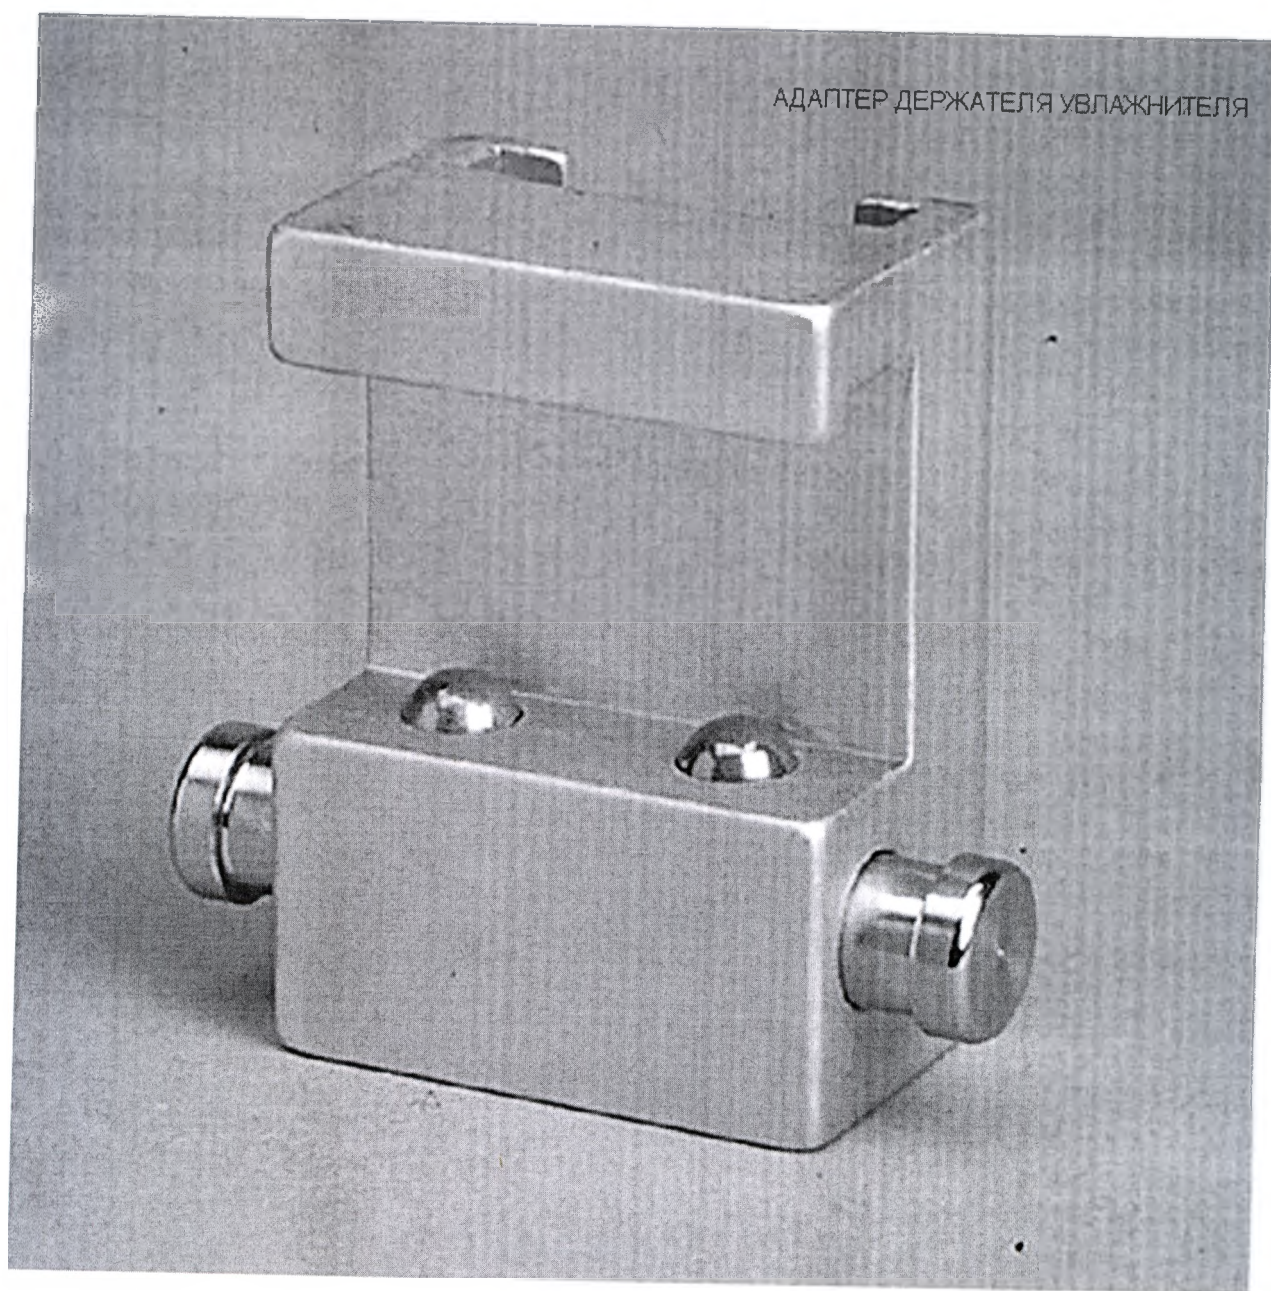





Кабель соединительный увлажнителя с двумя или тремя разъемами

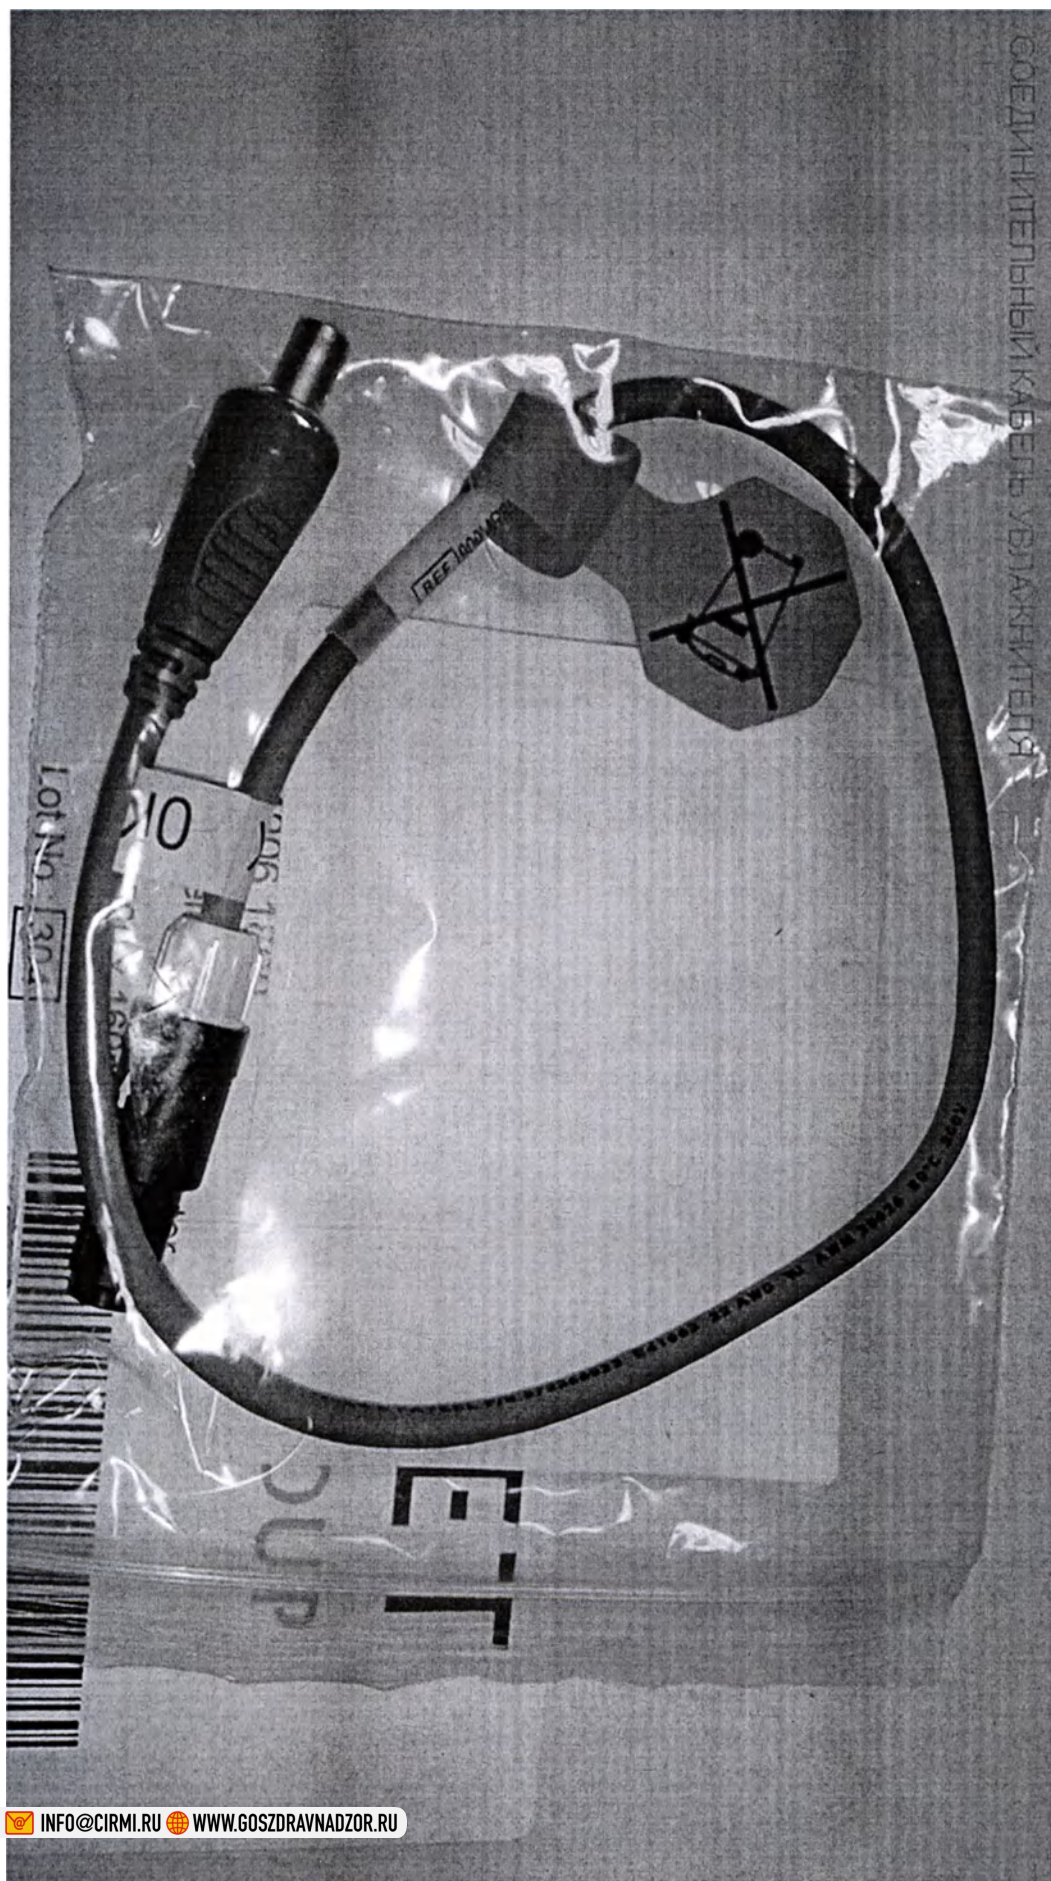



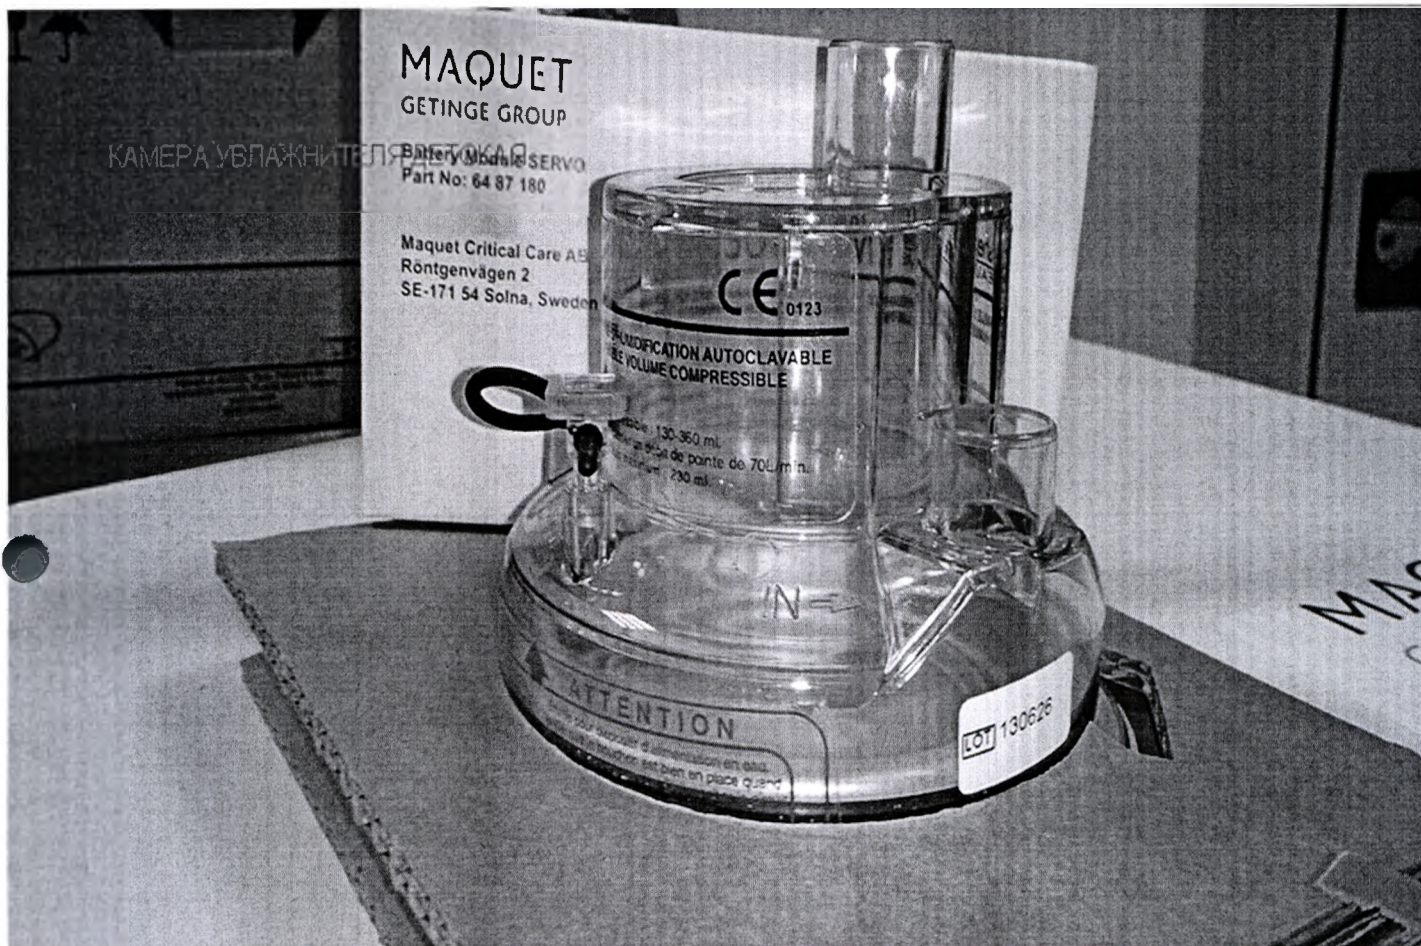




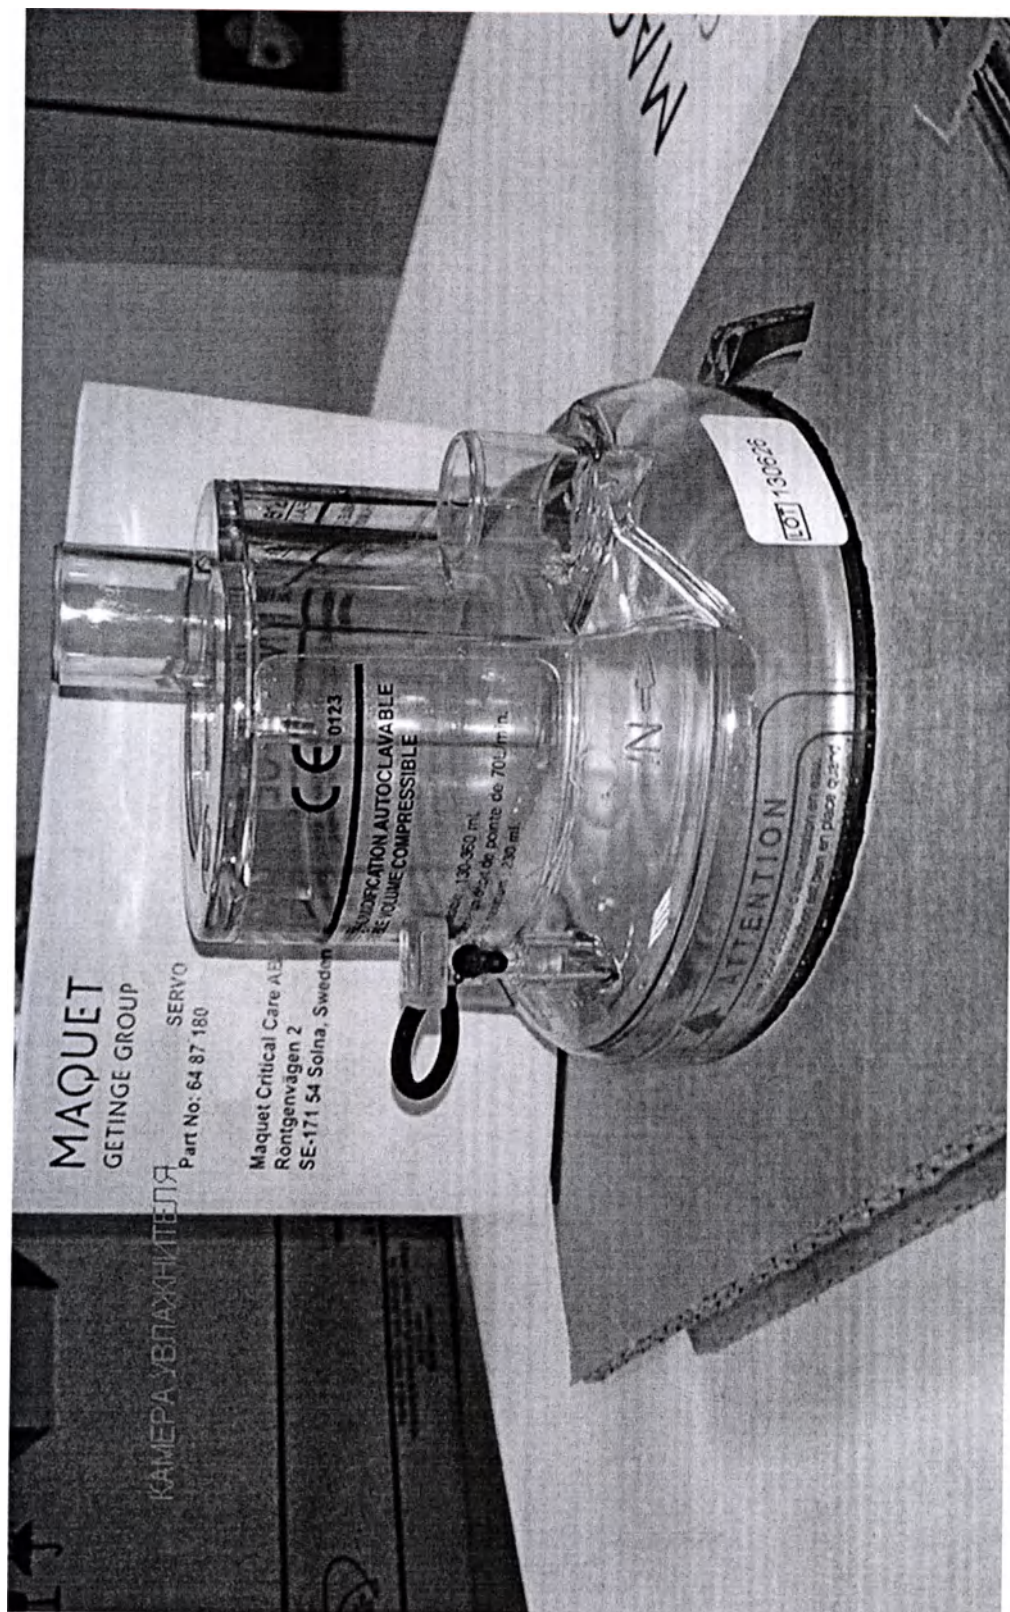




МАСКА ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ МНОГОЦВЕТНАЯ

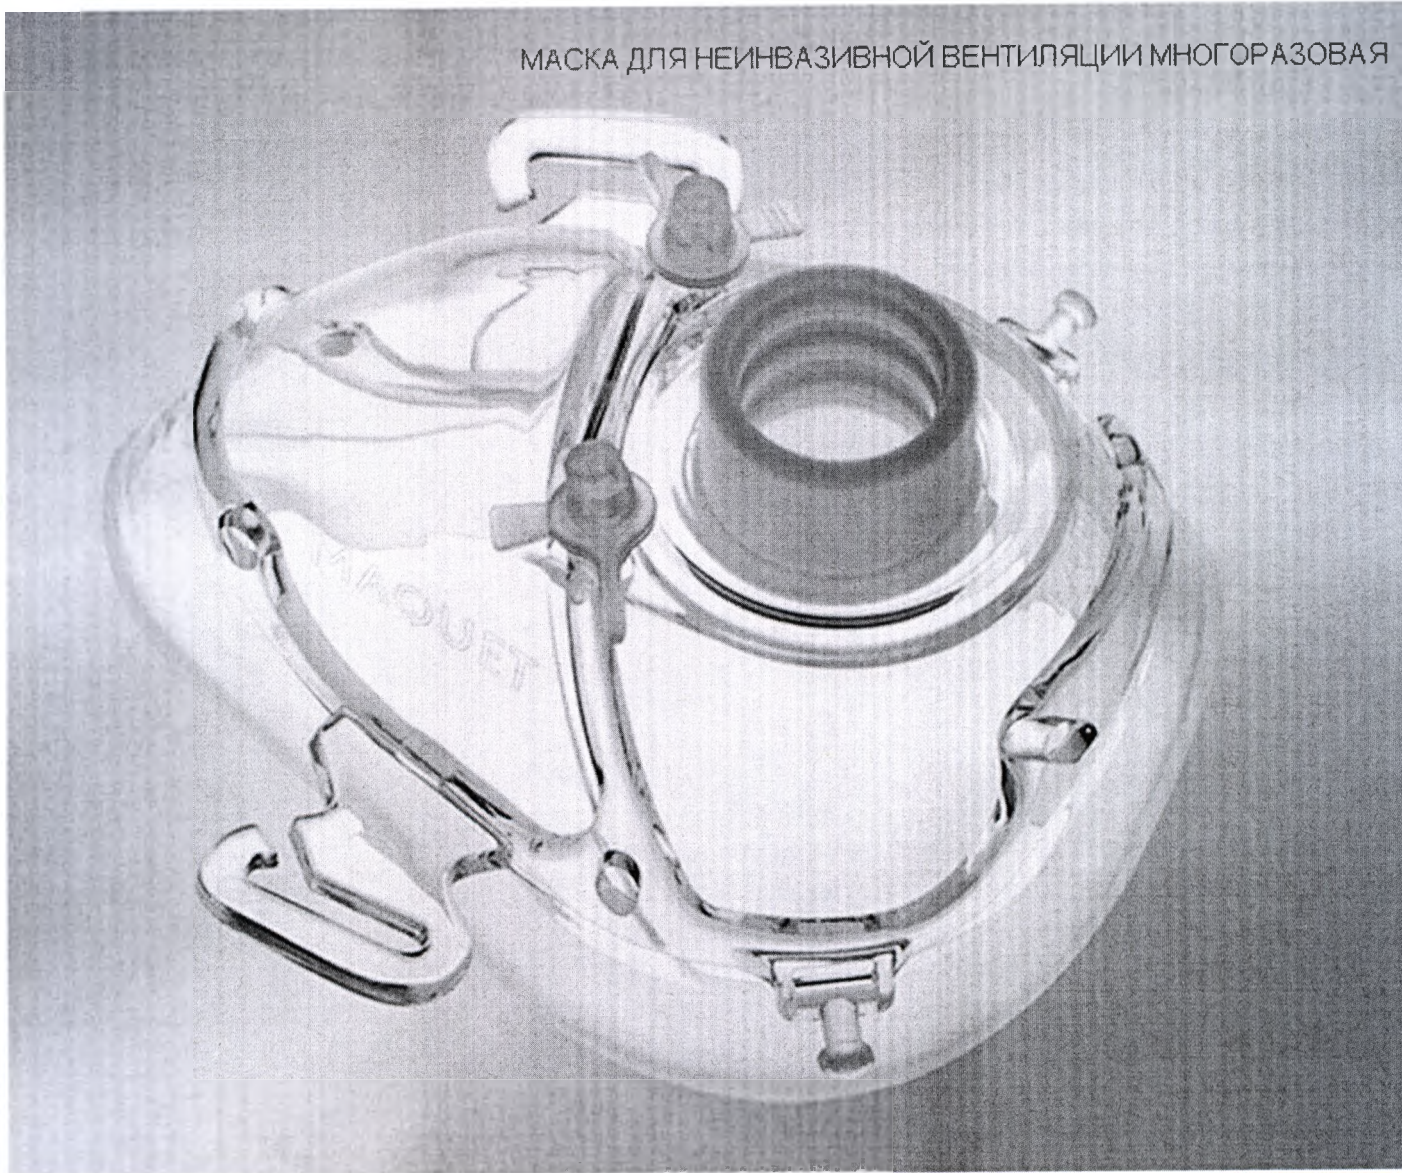




МАСКА ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ОДНОРАЗОВАЯ

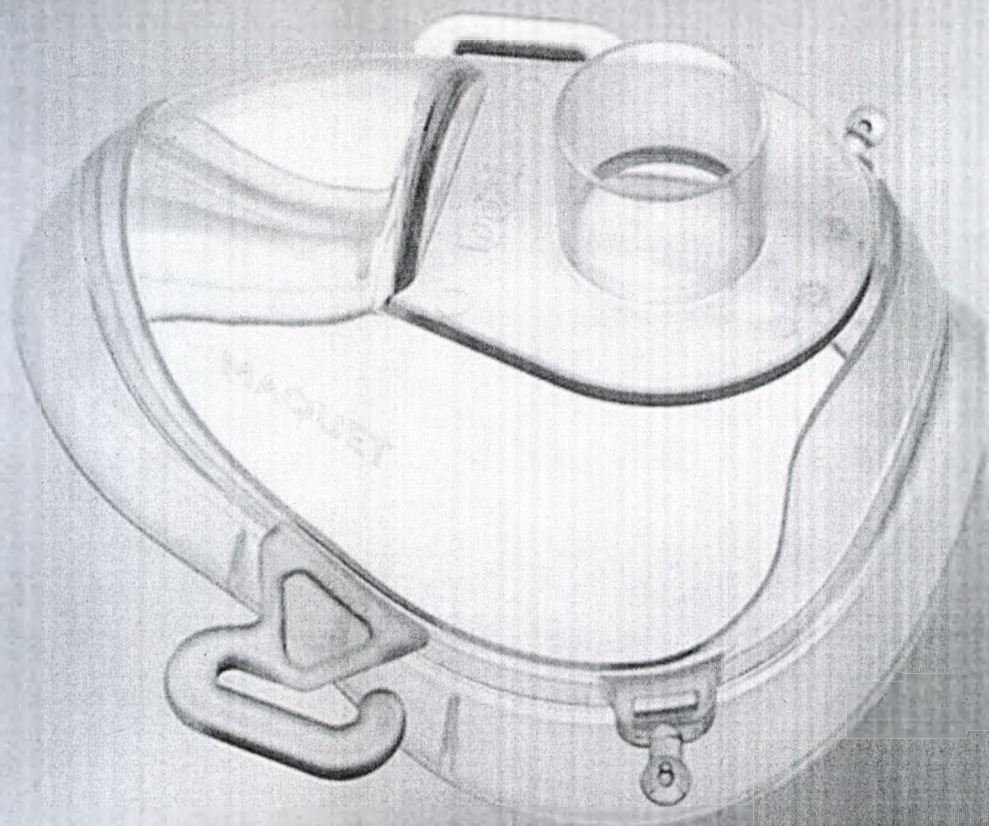



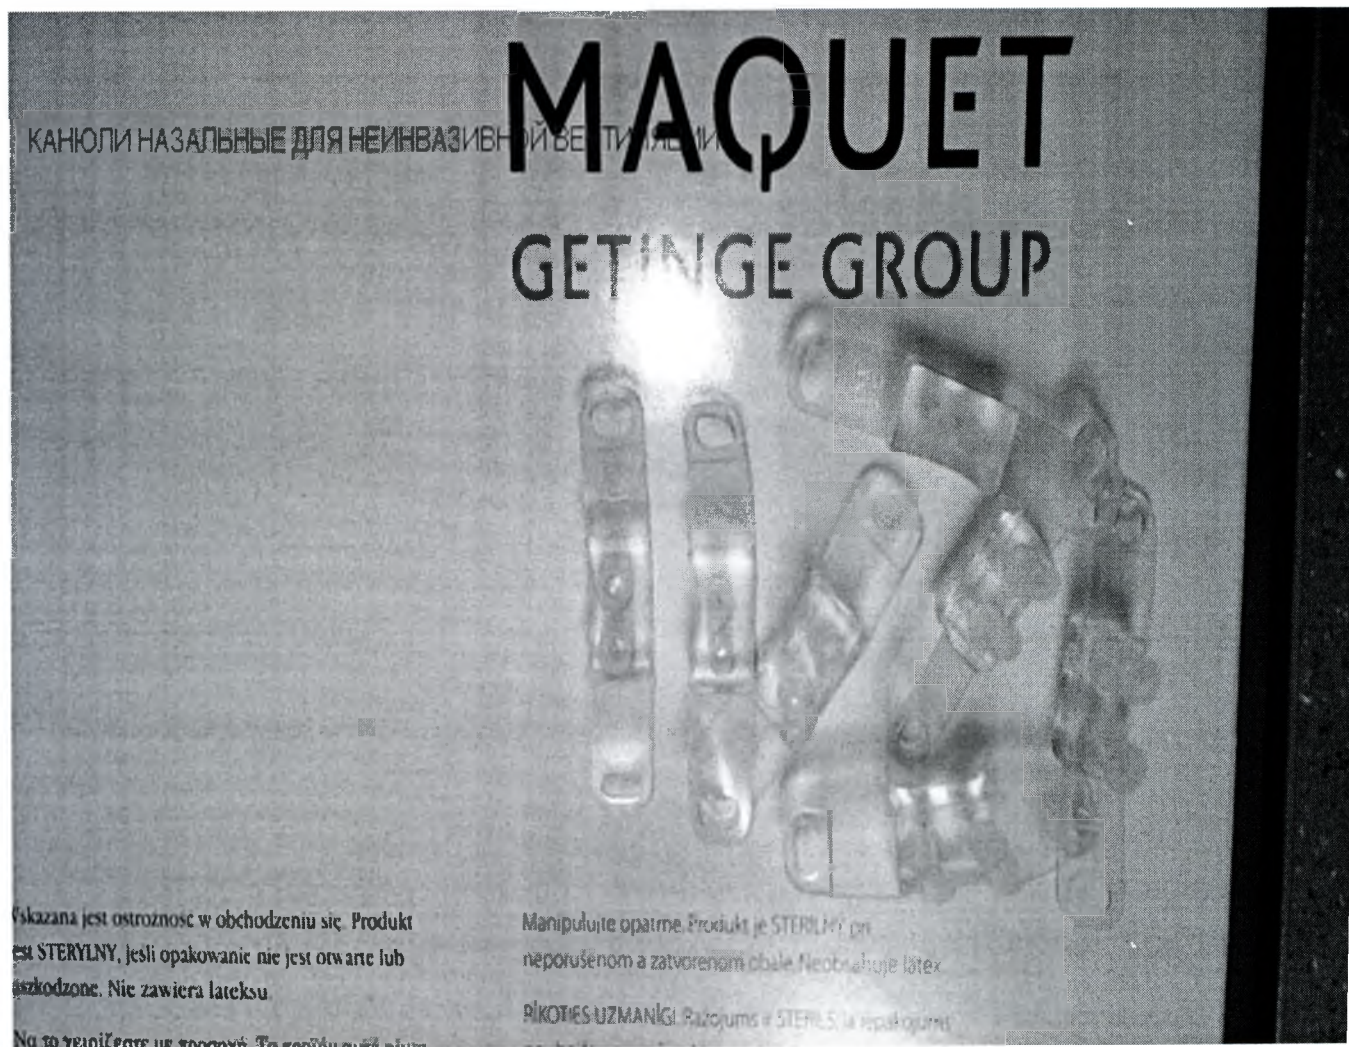




МАСКИ НАЗАЛЬНЫЕ ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

# MAQUET

## GETINGE GROUP

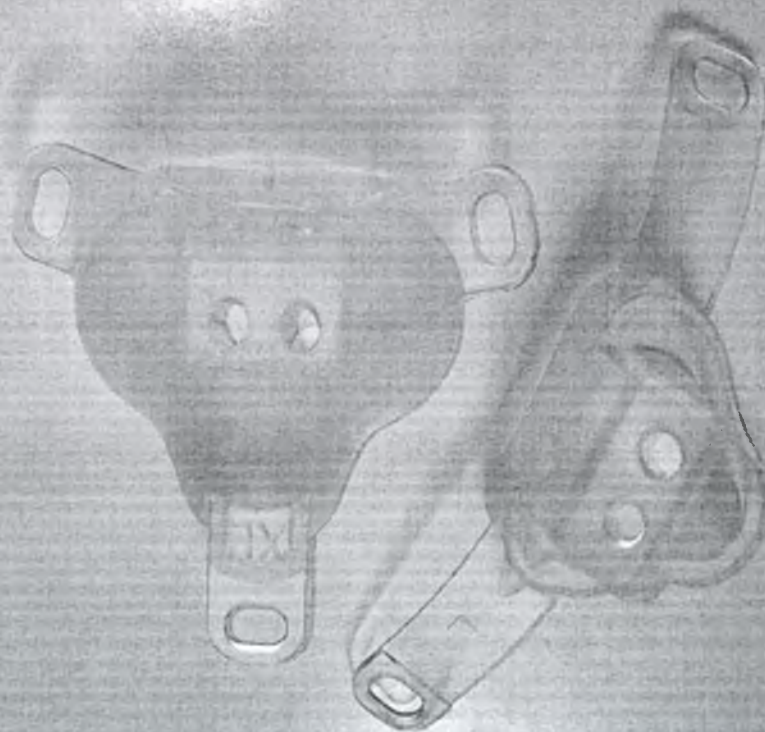


Uważaj! Jest ostrożność w obchodzeniu się. Produkt


Manipulacja centralnym punktem

Маски назальные для неинвазивной вентиляции




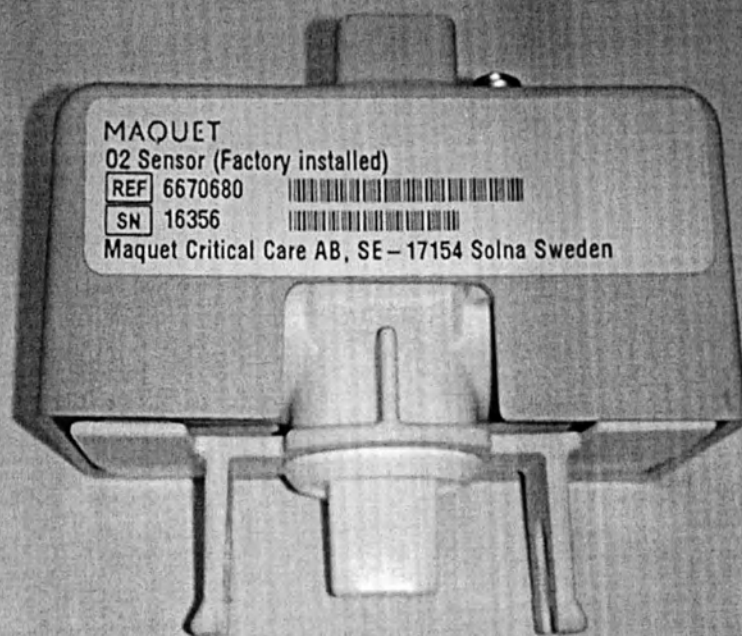



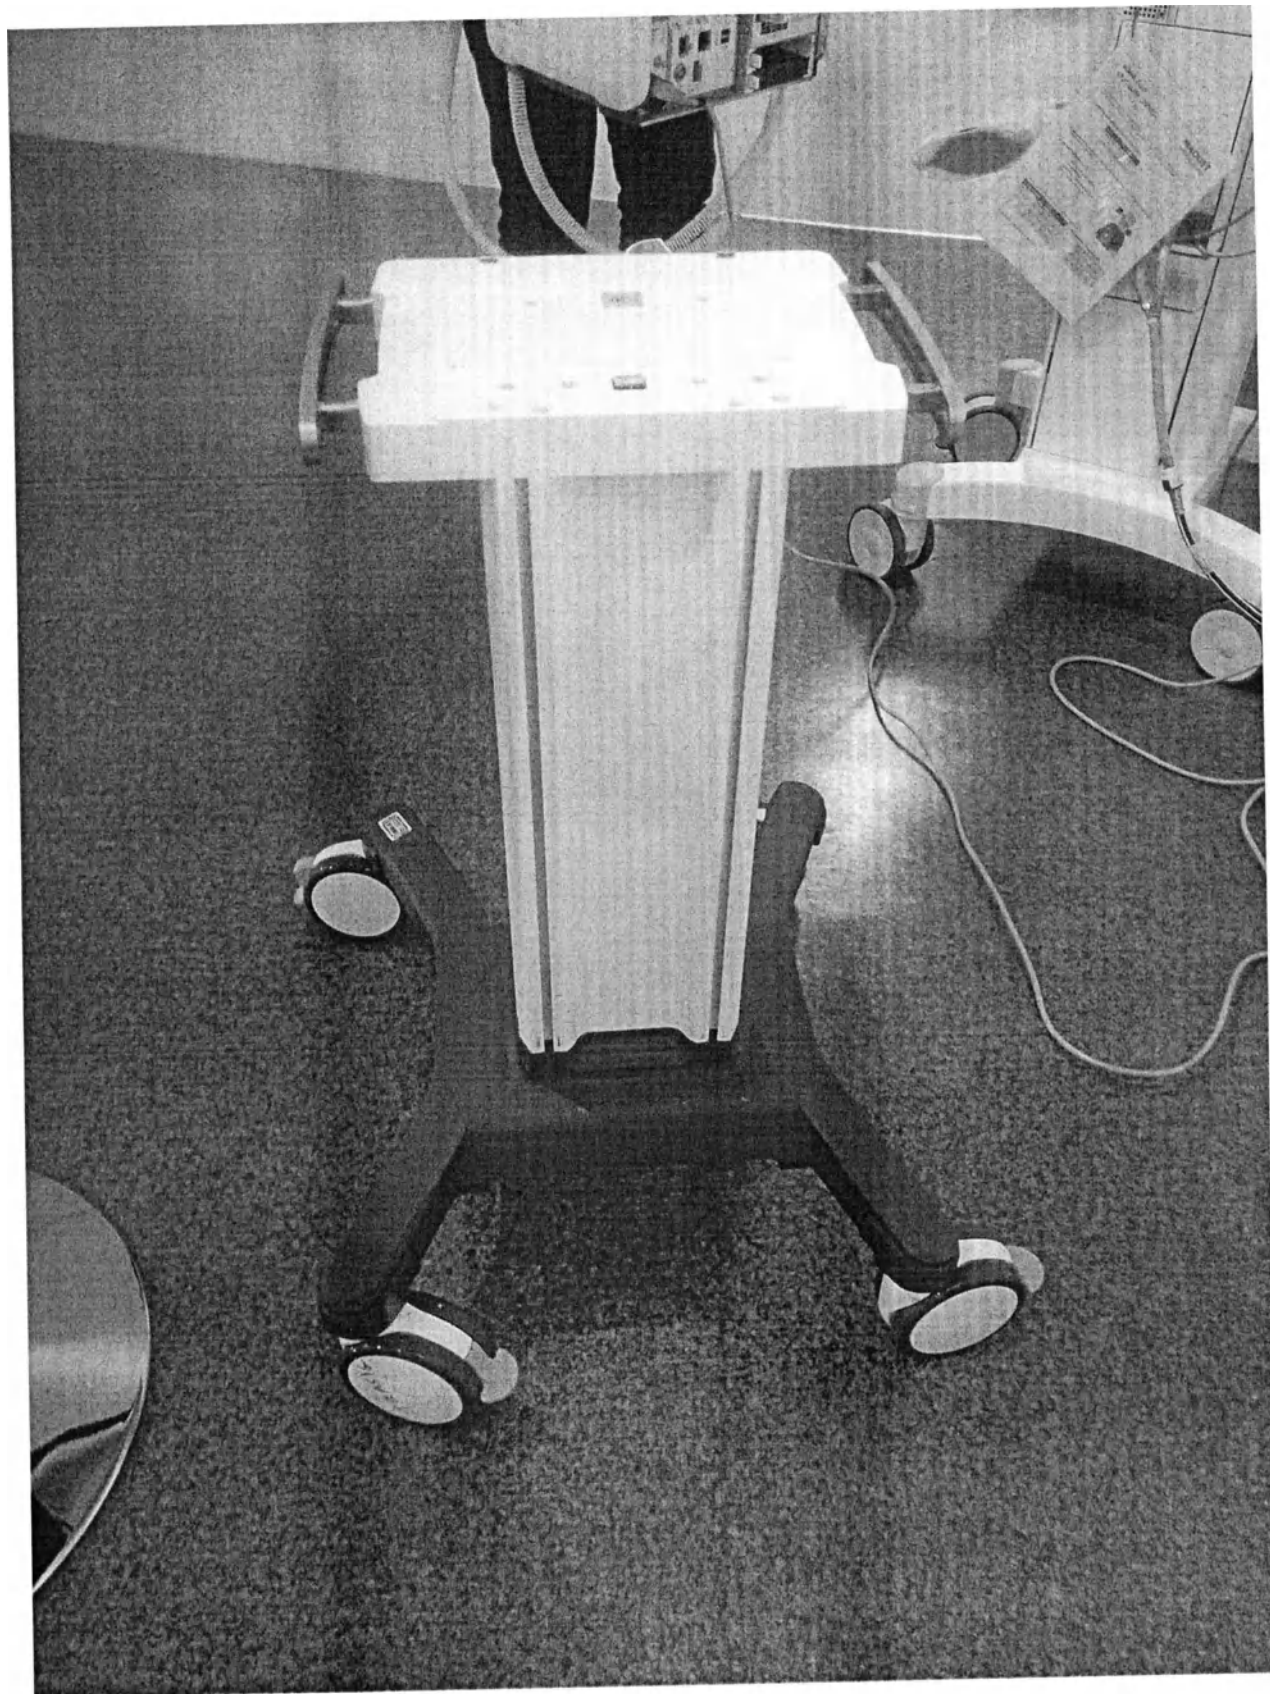




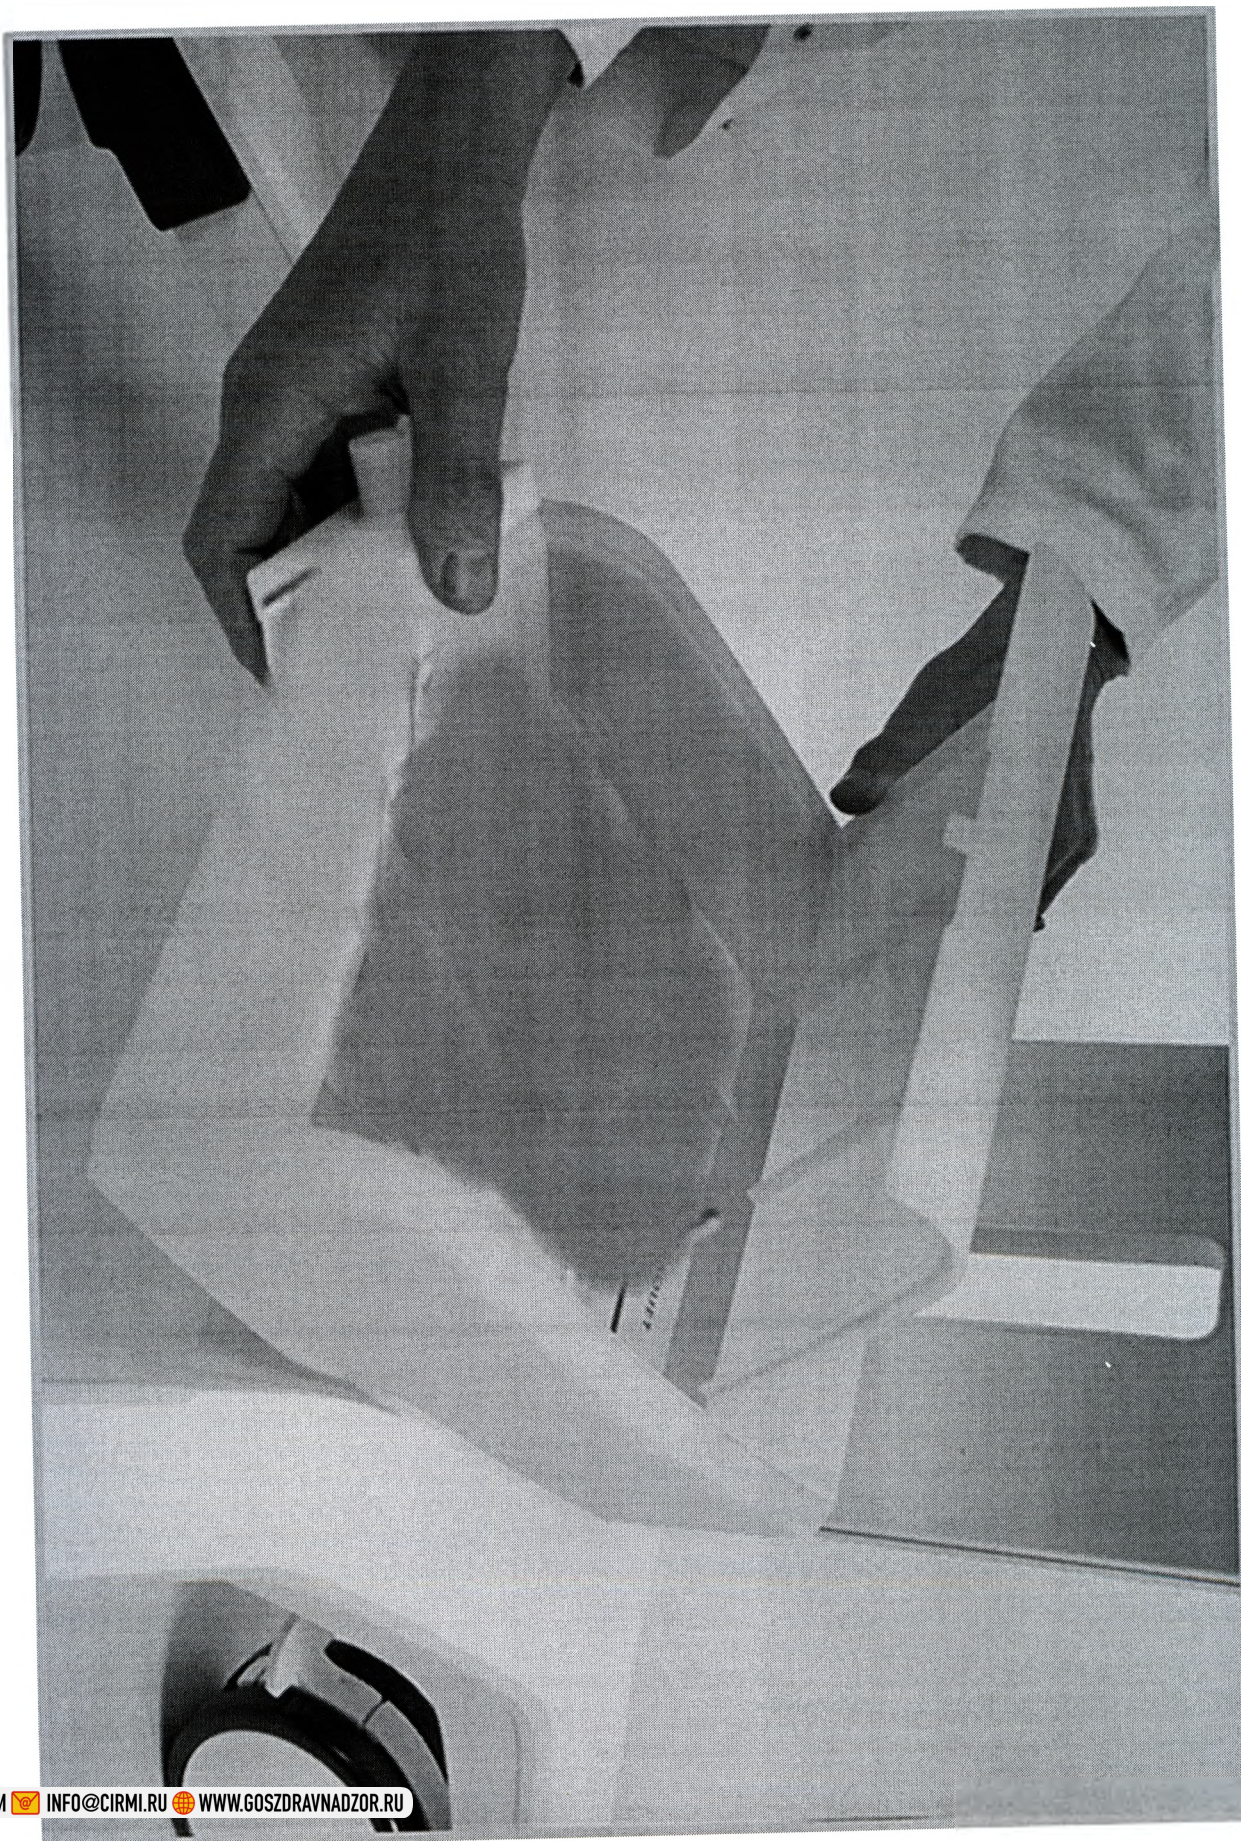



## Держатель шлангов

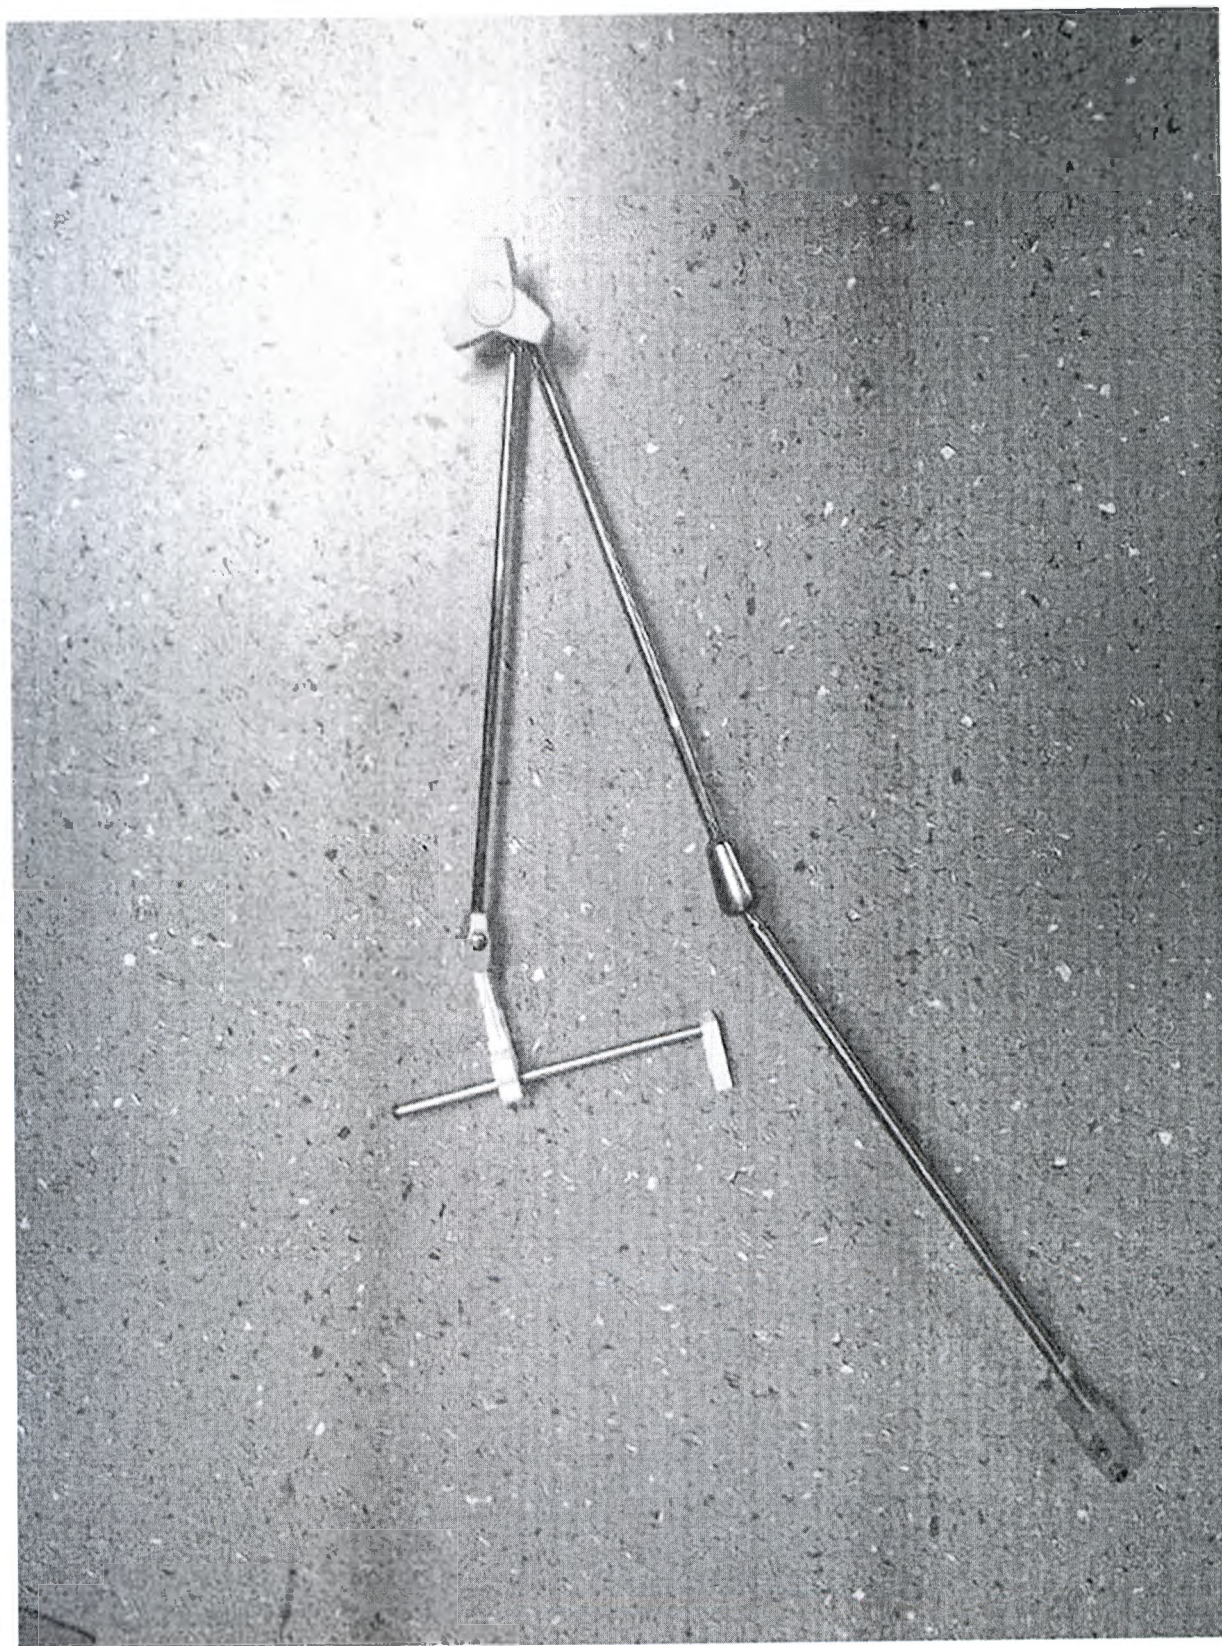




Площадка специальная для крепления аппарата на подвесе






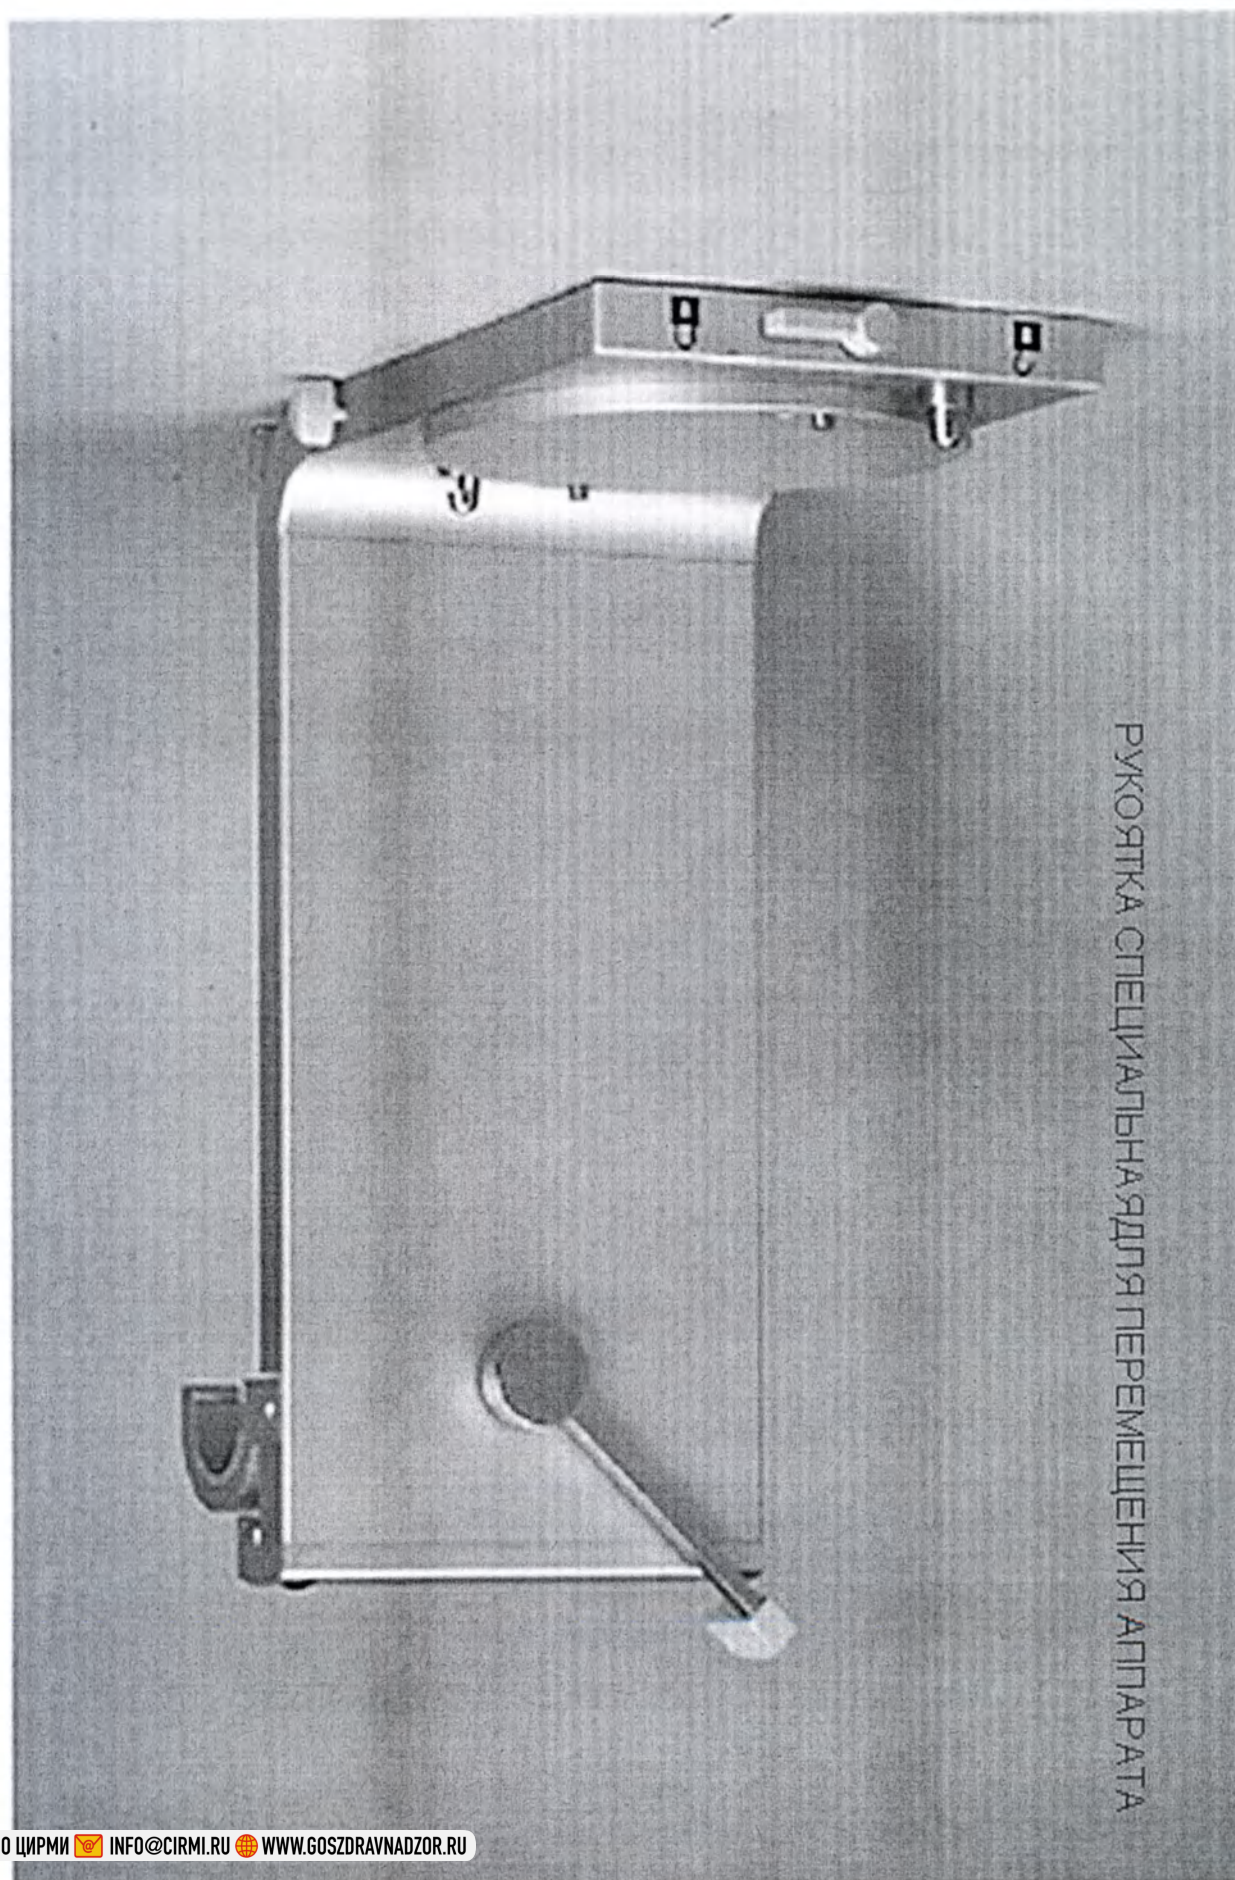

РУКОЯТКА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АППАРАТА



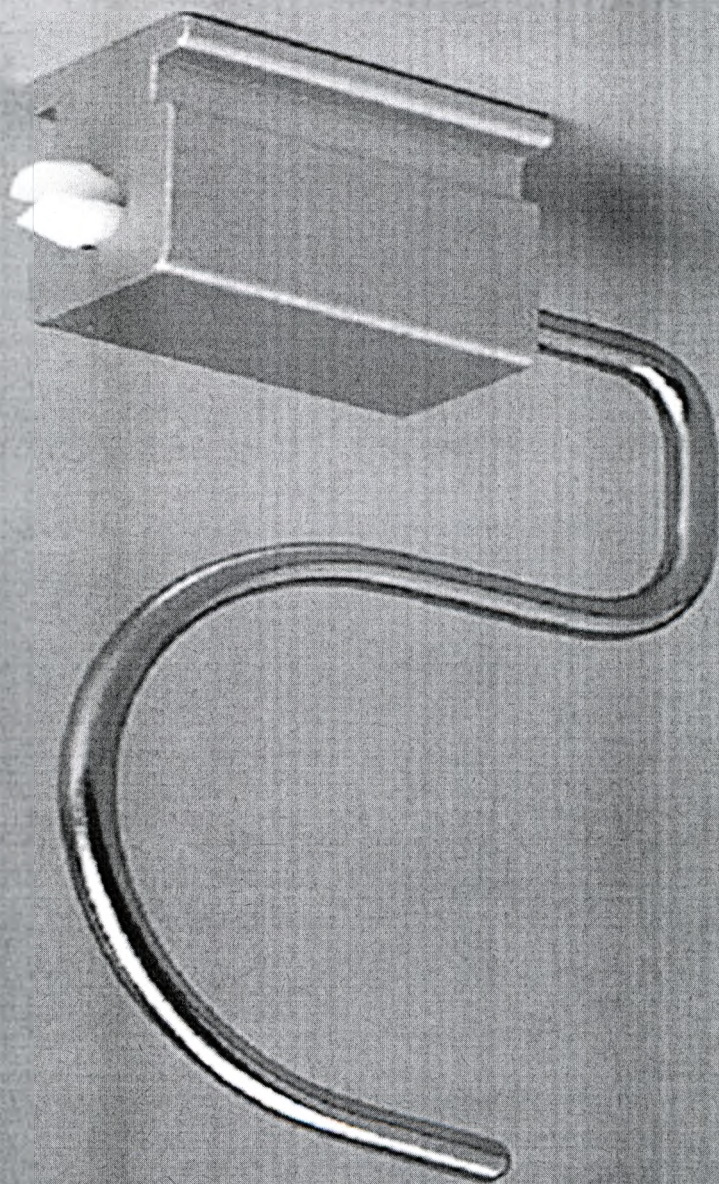

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ




## Комплект для размещения газовых баллонов






Трубка - удлинитель для небулайзера

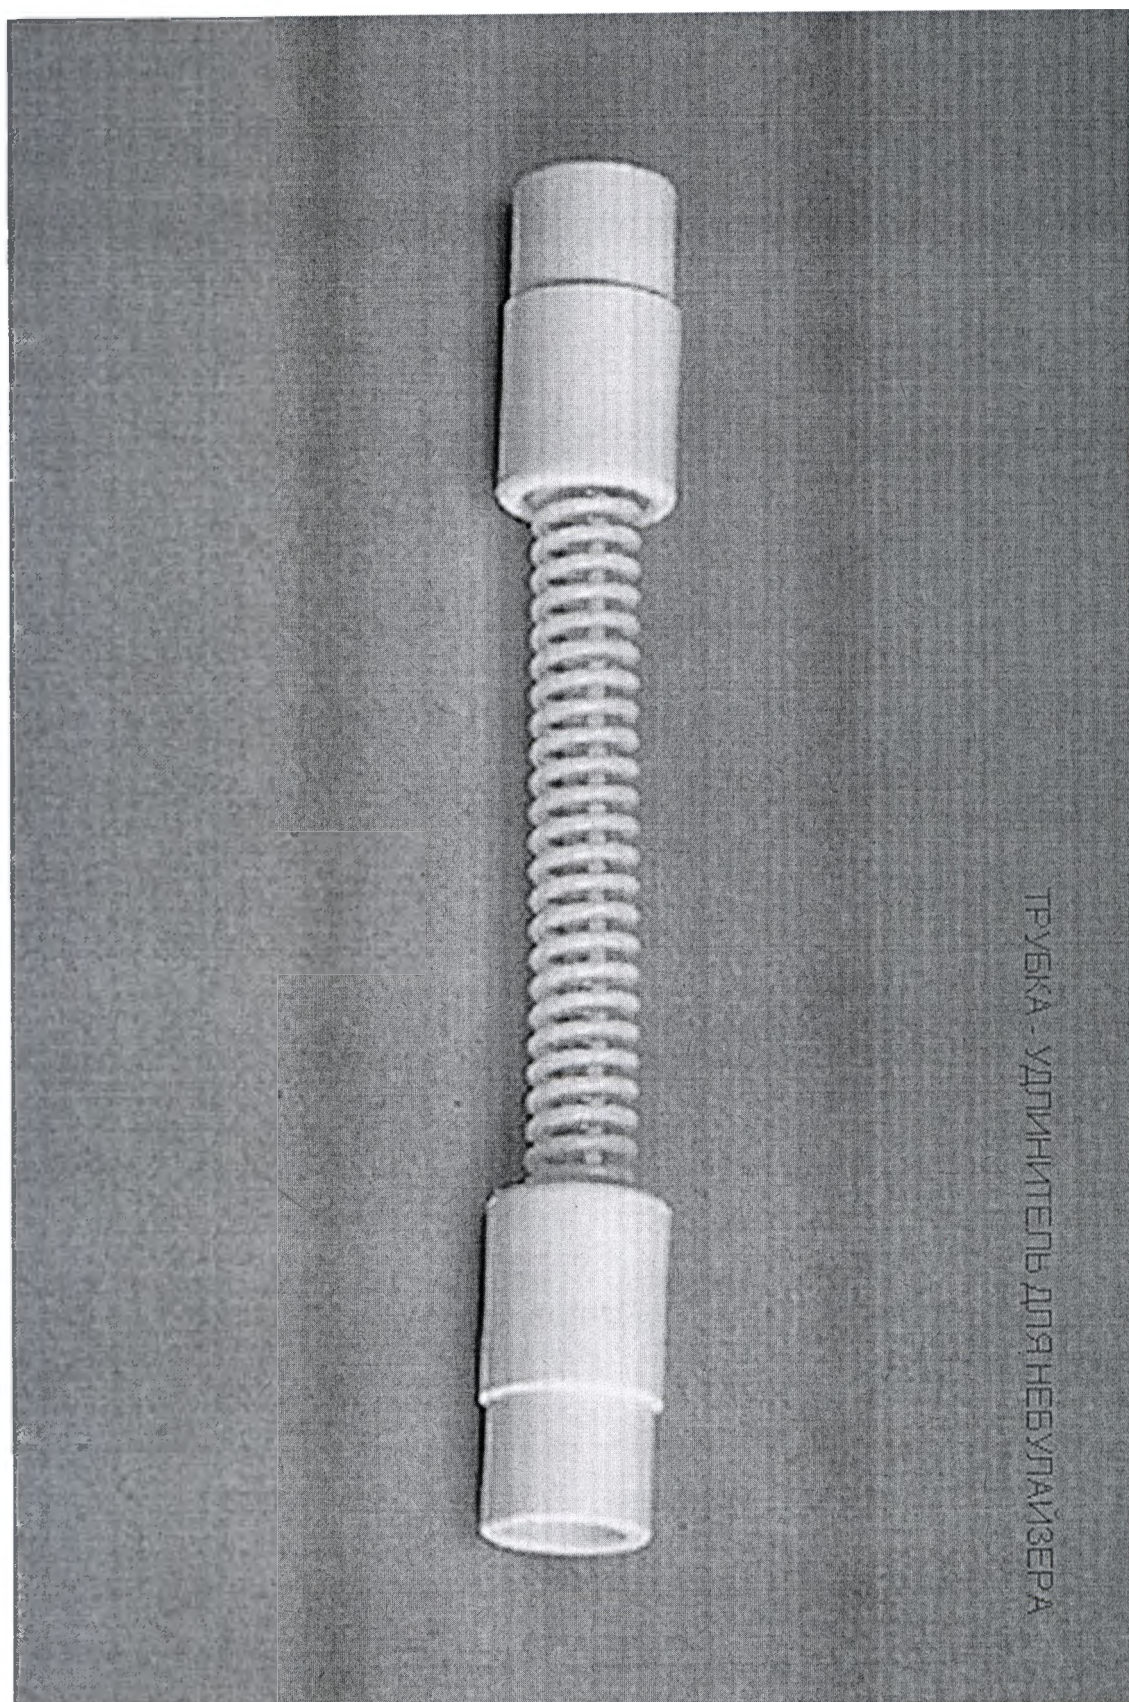




## Фильтр выдоха

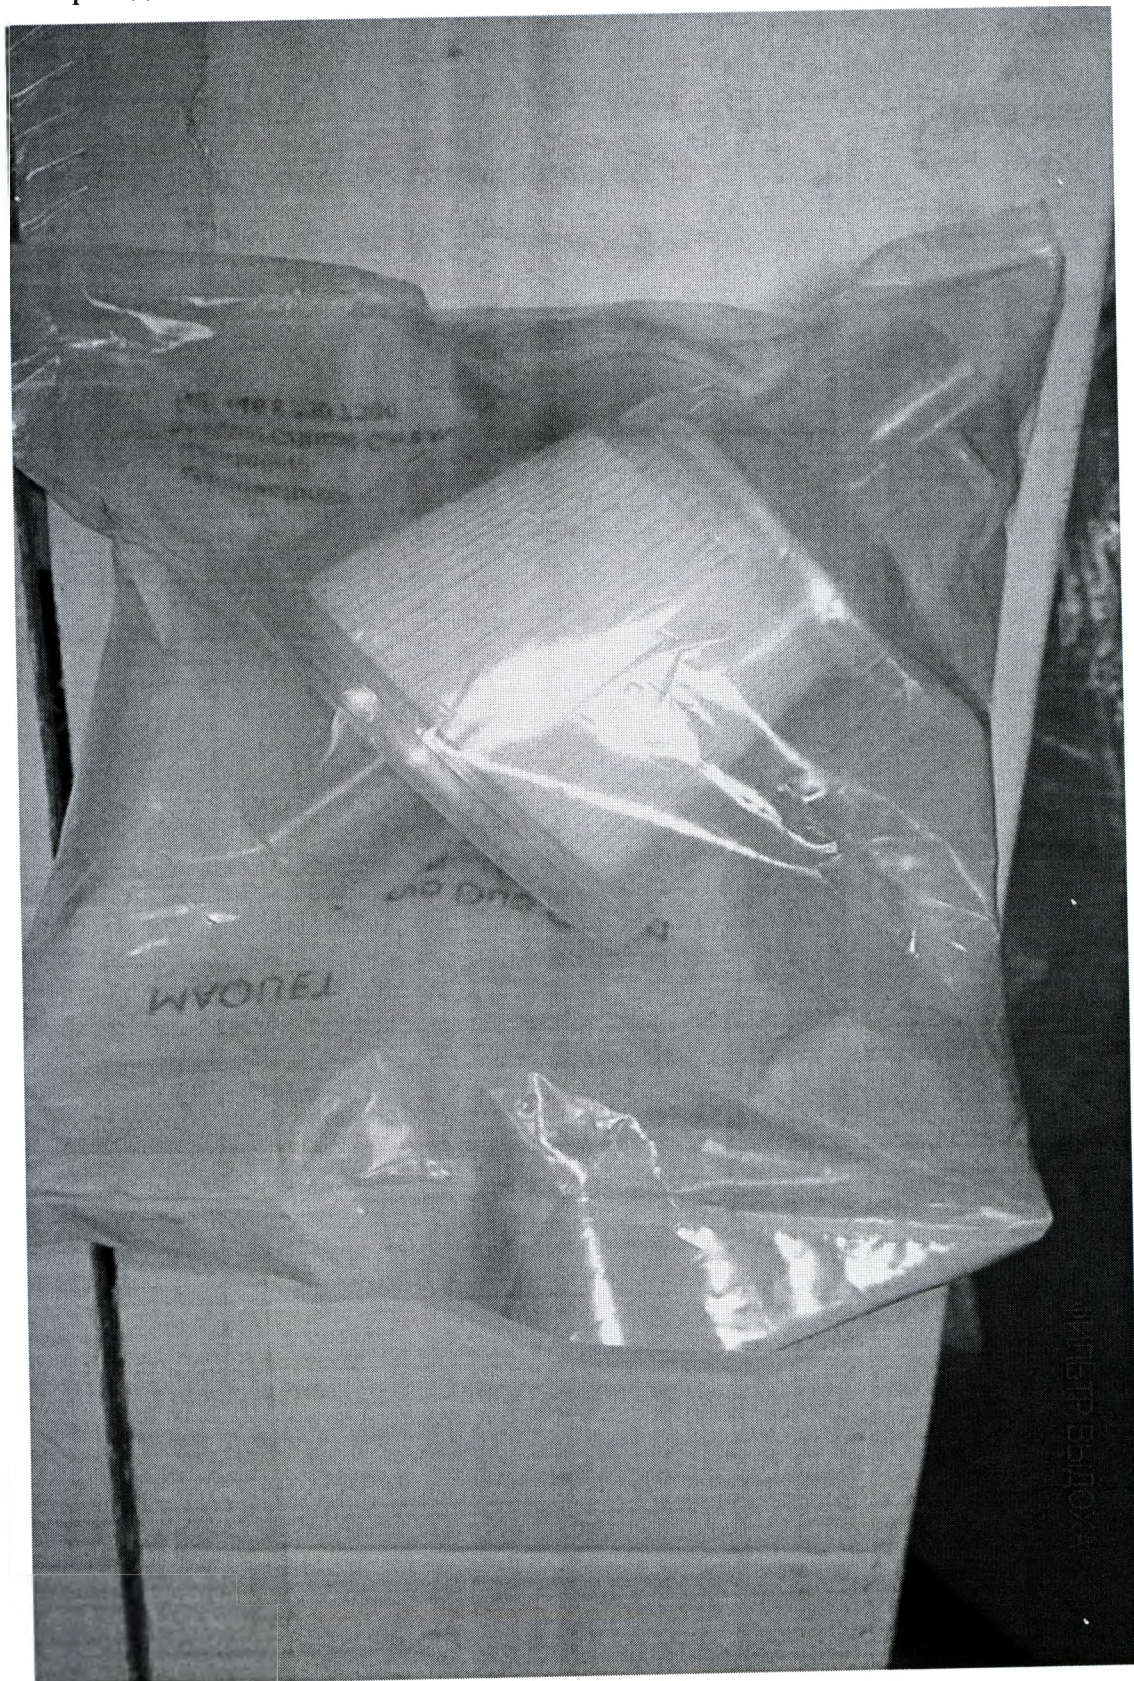



## Пластиковый термокорпус

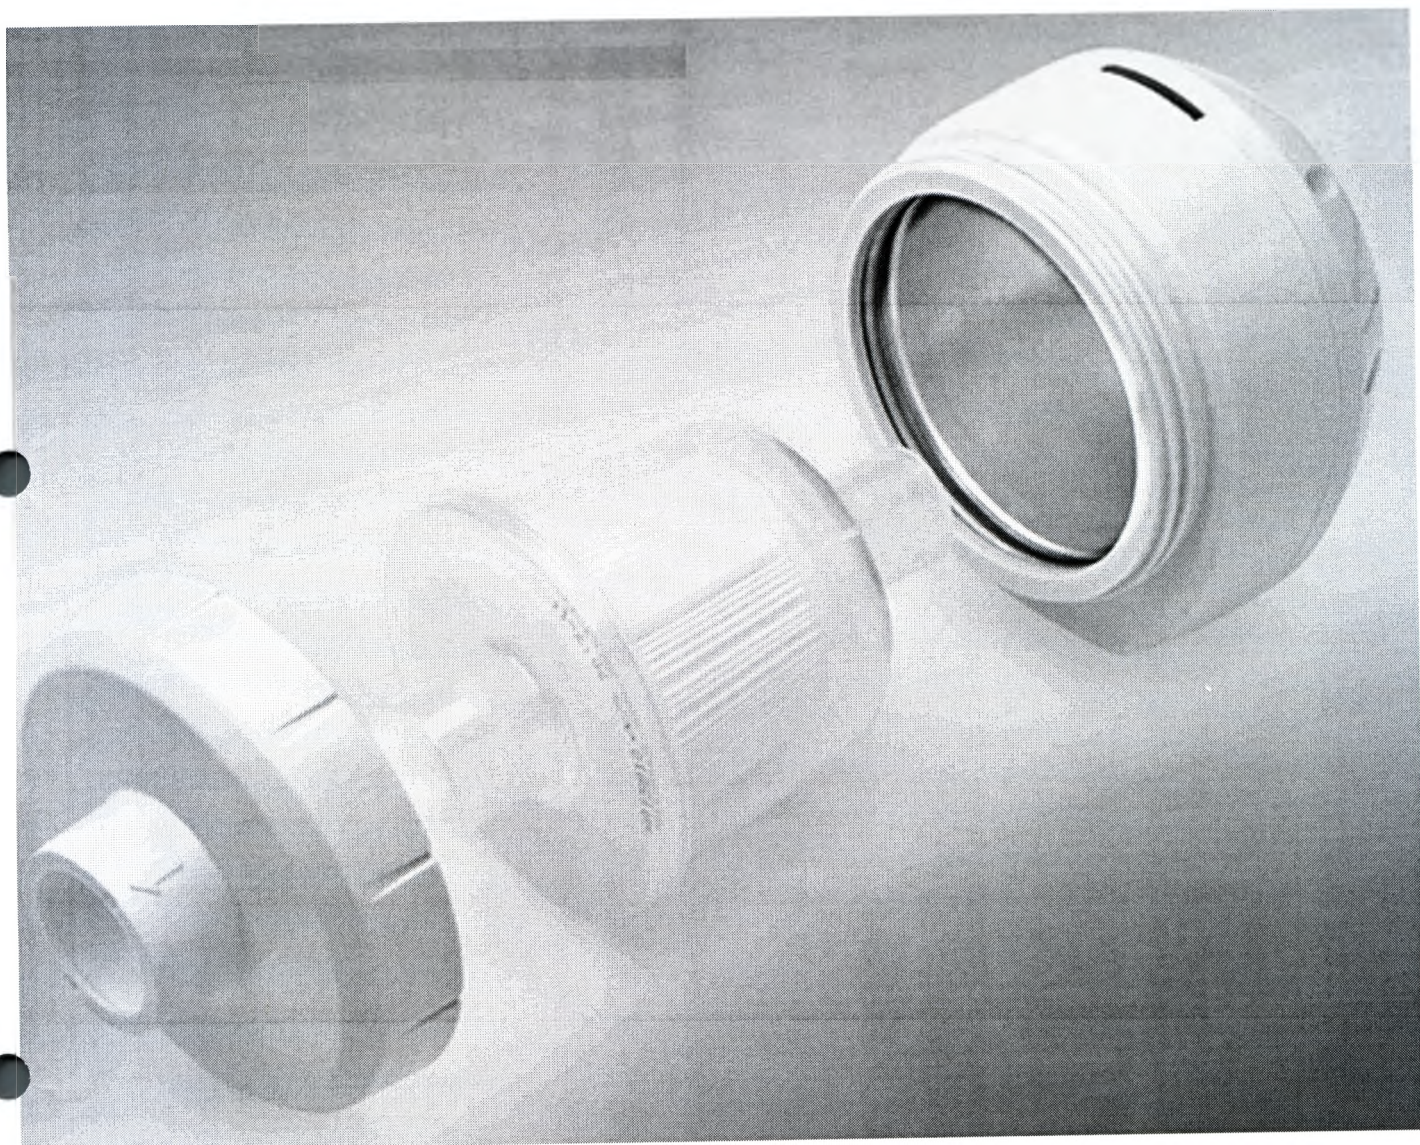















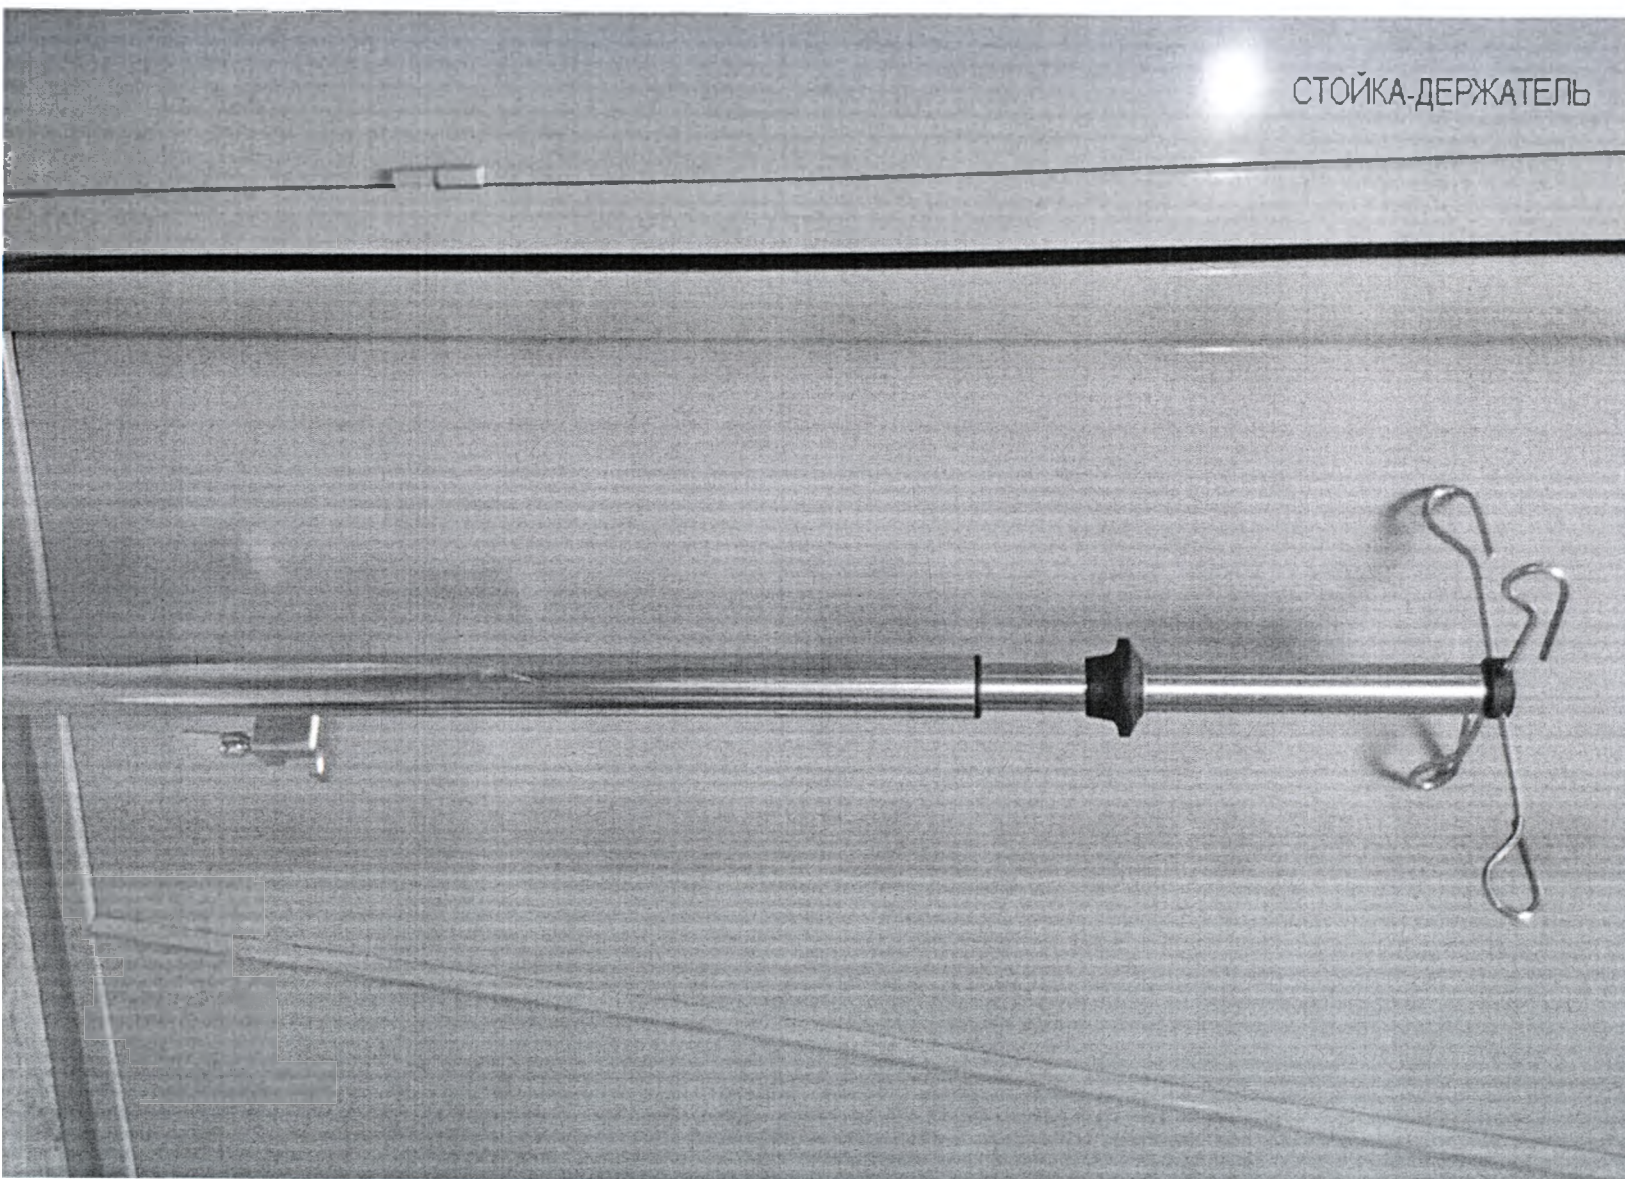



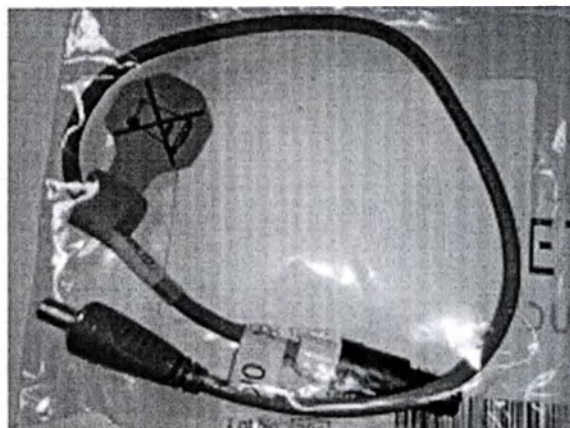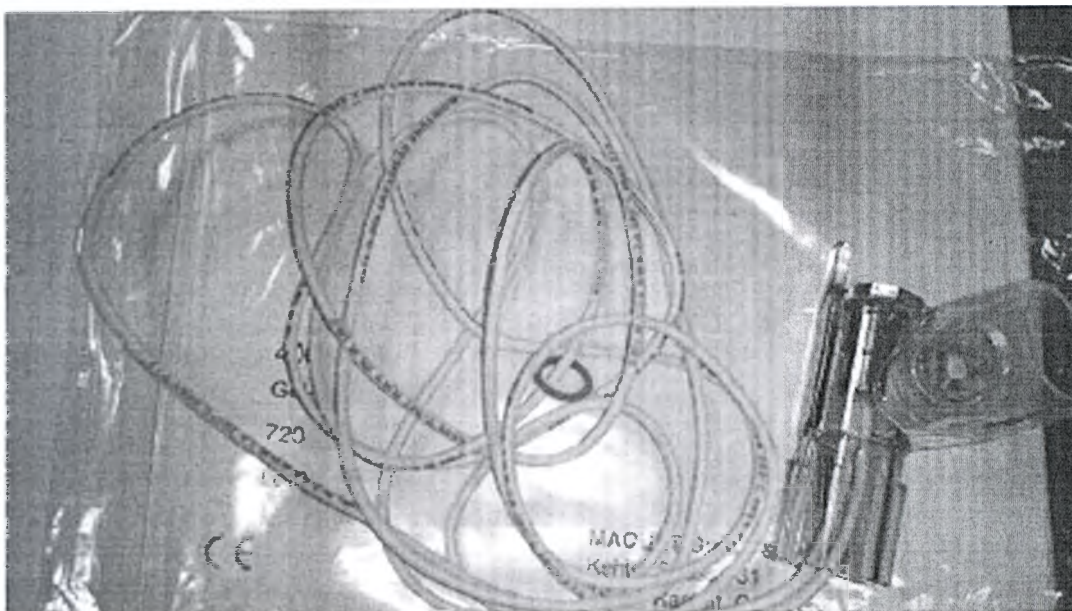



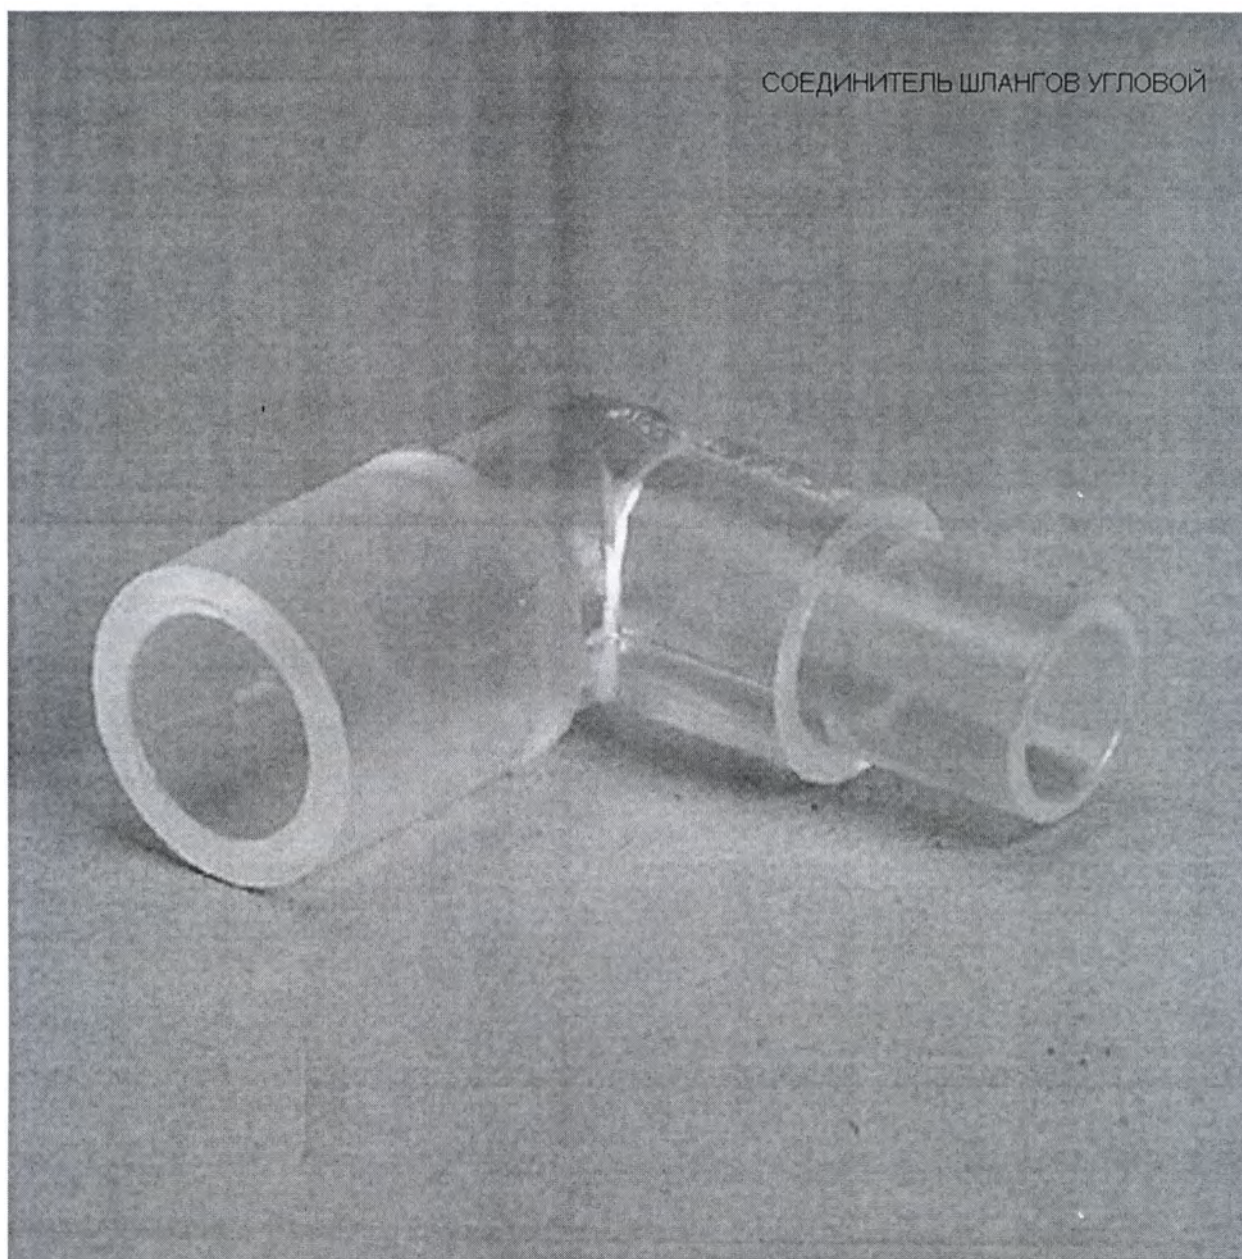



# НАГОТОВНИКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АДАПТЕРА

Handle with care. Product STEALTH packaging is undamaged or damaged. Product contents no longer

Margaret and son, Producer STEVE L. KEMBLER present  
 the award-winning musical "Santo & Gratia"

Mantén con cuidado Producto ESTERIL y el envase está cerrado y libre de daños. Libre de agua.

Manuseie com cuidado Produto ESTEIL, pois  
contém esterilizante e não deve ser usado sem latex.

Verschleiß handhaben. Das Produkt ist STEIF, solange die Packung ungeöffnet und unberührt ist. Lassen Sie

Trattare con cura il prodotto SILENTE, a conferimento  
integrato e integrato. Non conservare l'acqua.

but when a bird sings of orange, it is Zander here, the great green heron.

Wskazana jest obojętność  
jest STERYLNY, jeśli opak  
nie uszkodzone. Nie zawiera

ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΜΕΝΟ ΕΙΣ  
ΑΝΟΙΧΤΗ Η ΒΡΟΧΗΤΗ ΣΤΗ


取り扱いには十分注意を要し、包装に破れや傷がある場合は使用しないで下さい。天然ゴムを使用しない。

AL SARGAL ELIGITS (part 7)  
je pakuše nepredstavu  
lykovo

WZADOK: OPI  
předpokládá  
neobsluhuje  
přiznání výrobce je třeba  
přiznání výrobce je třeba


MAQUET  
GETTING GROUP



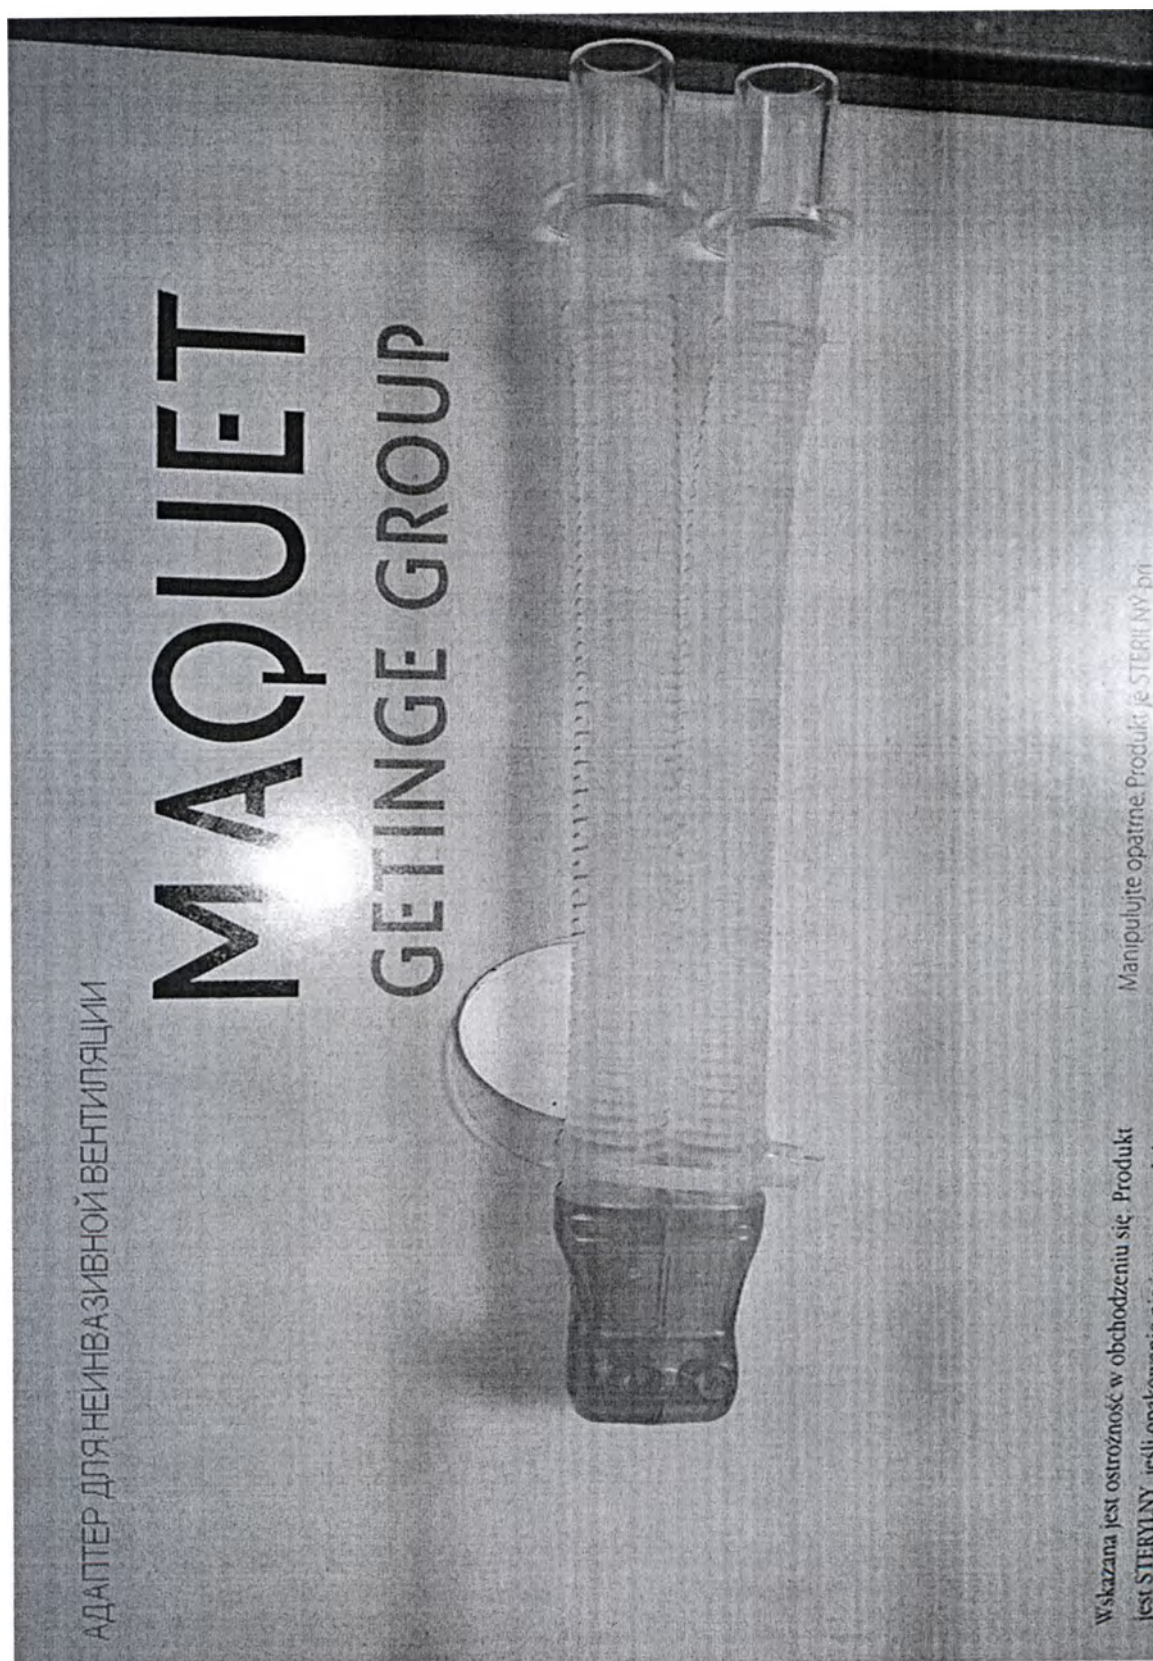






Ячейка кислородная

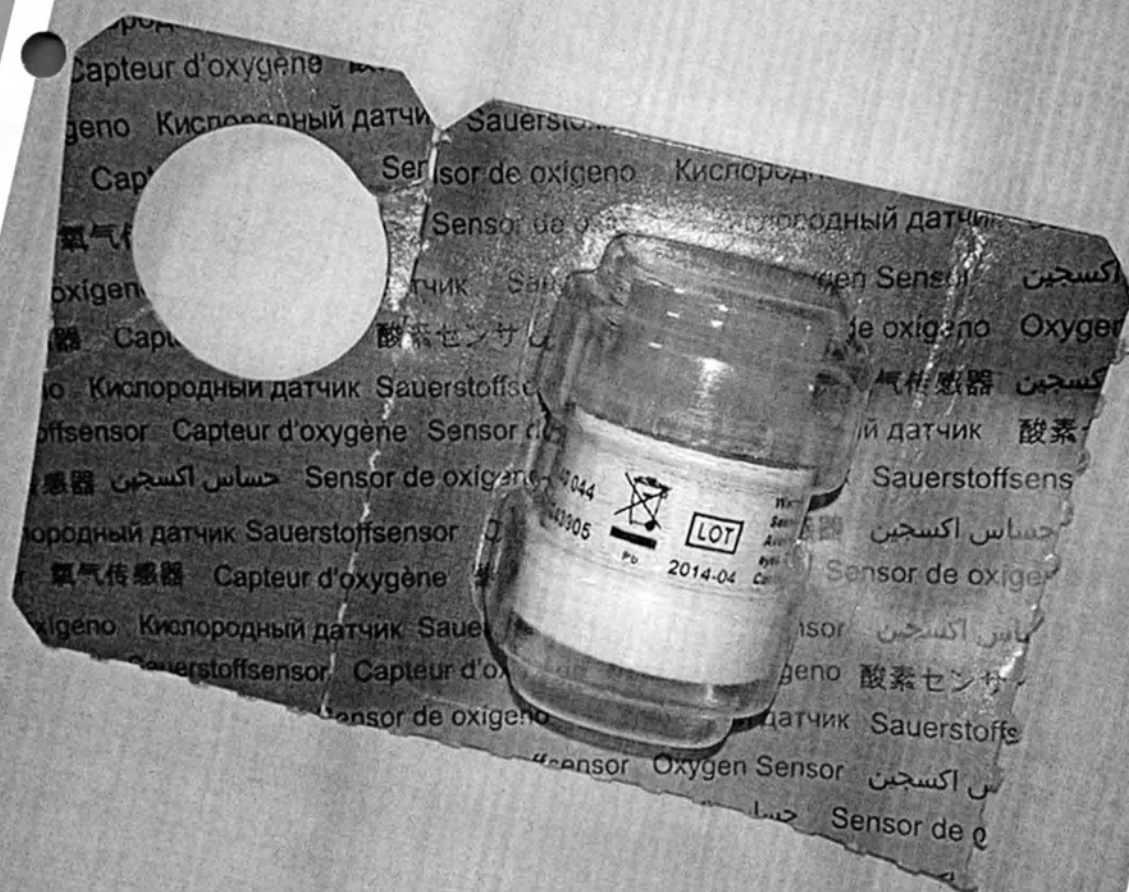


ЯЧЕЙКА КИСЛОРОДНАЯ



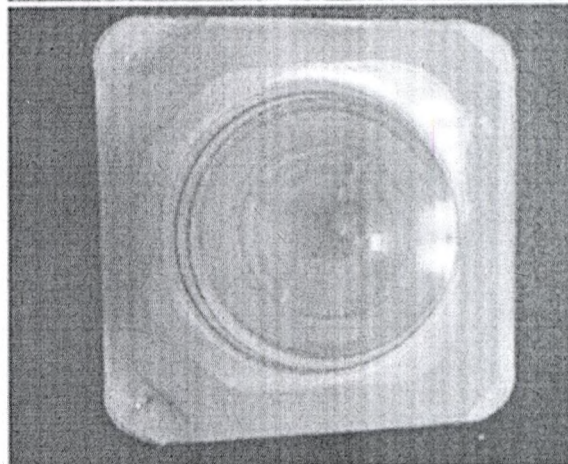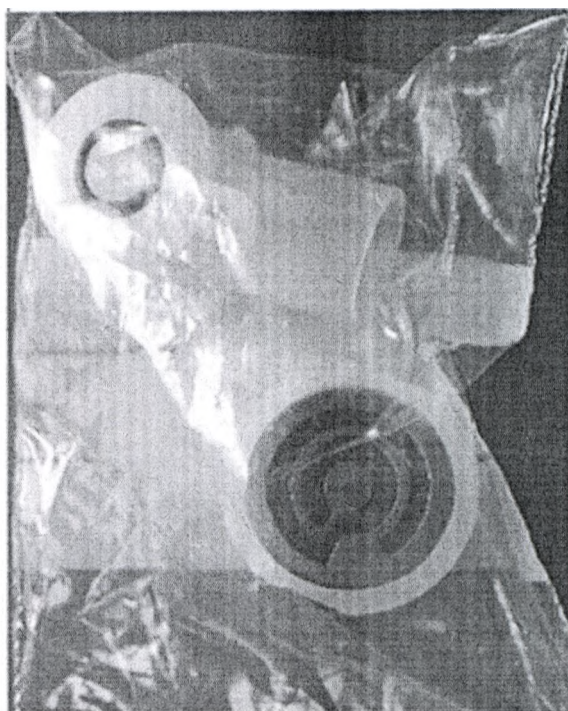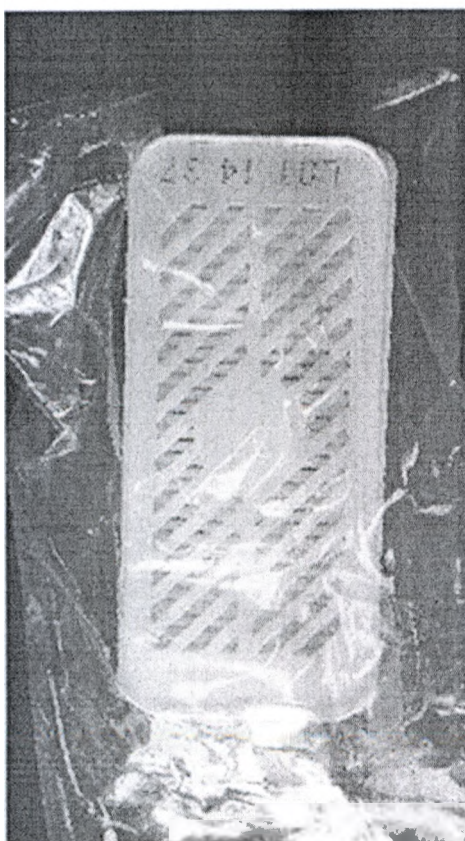


РЕМКОМПЛЕКТ НА 5000 ЧАСОВ




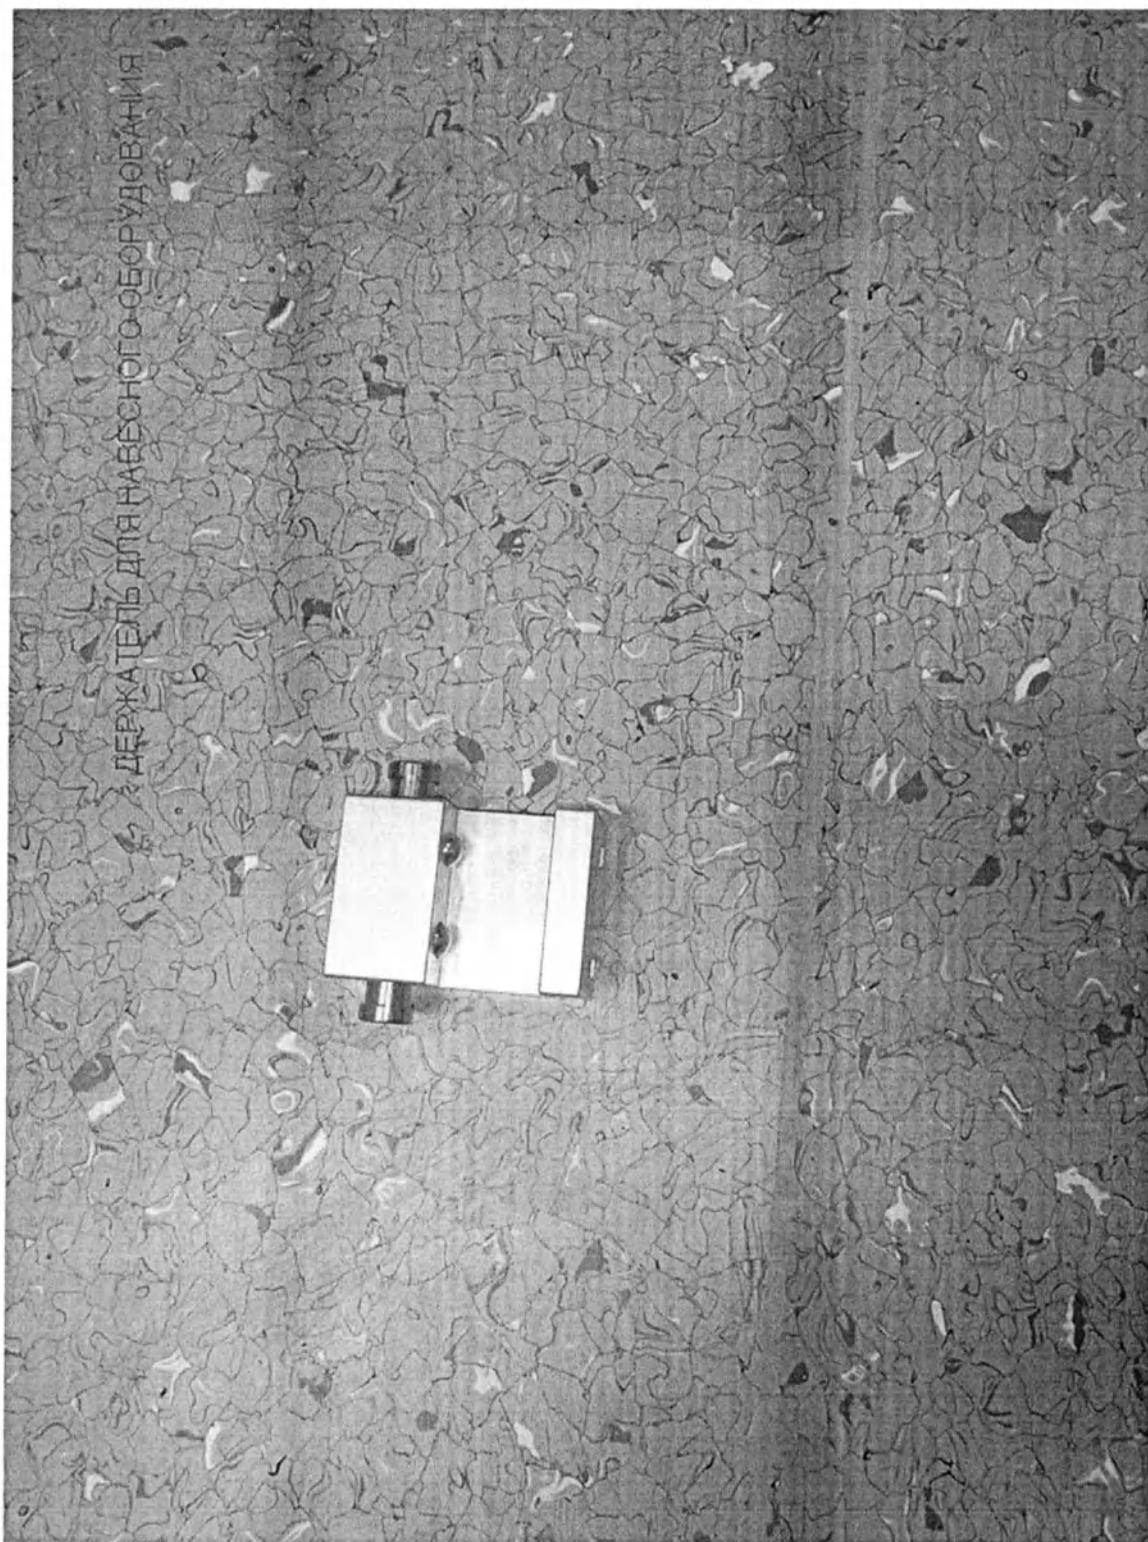




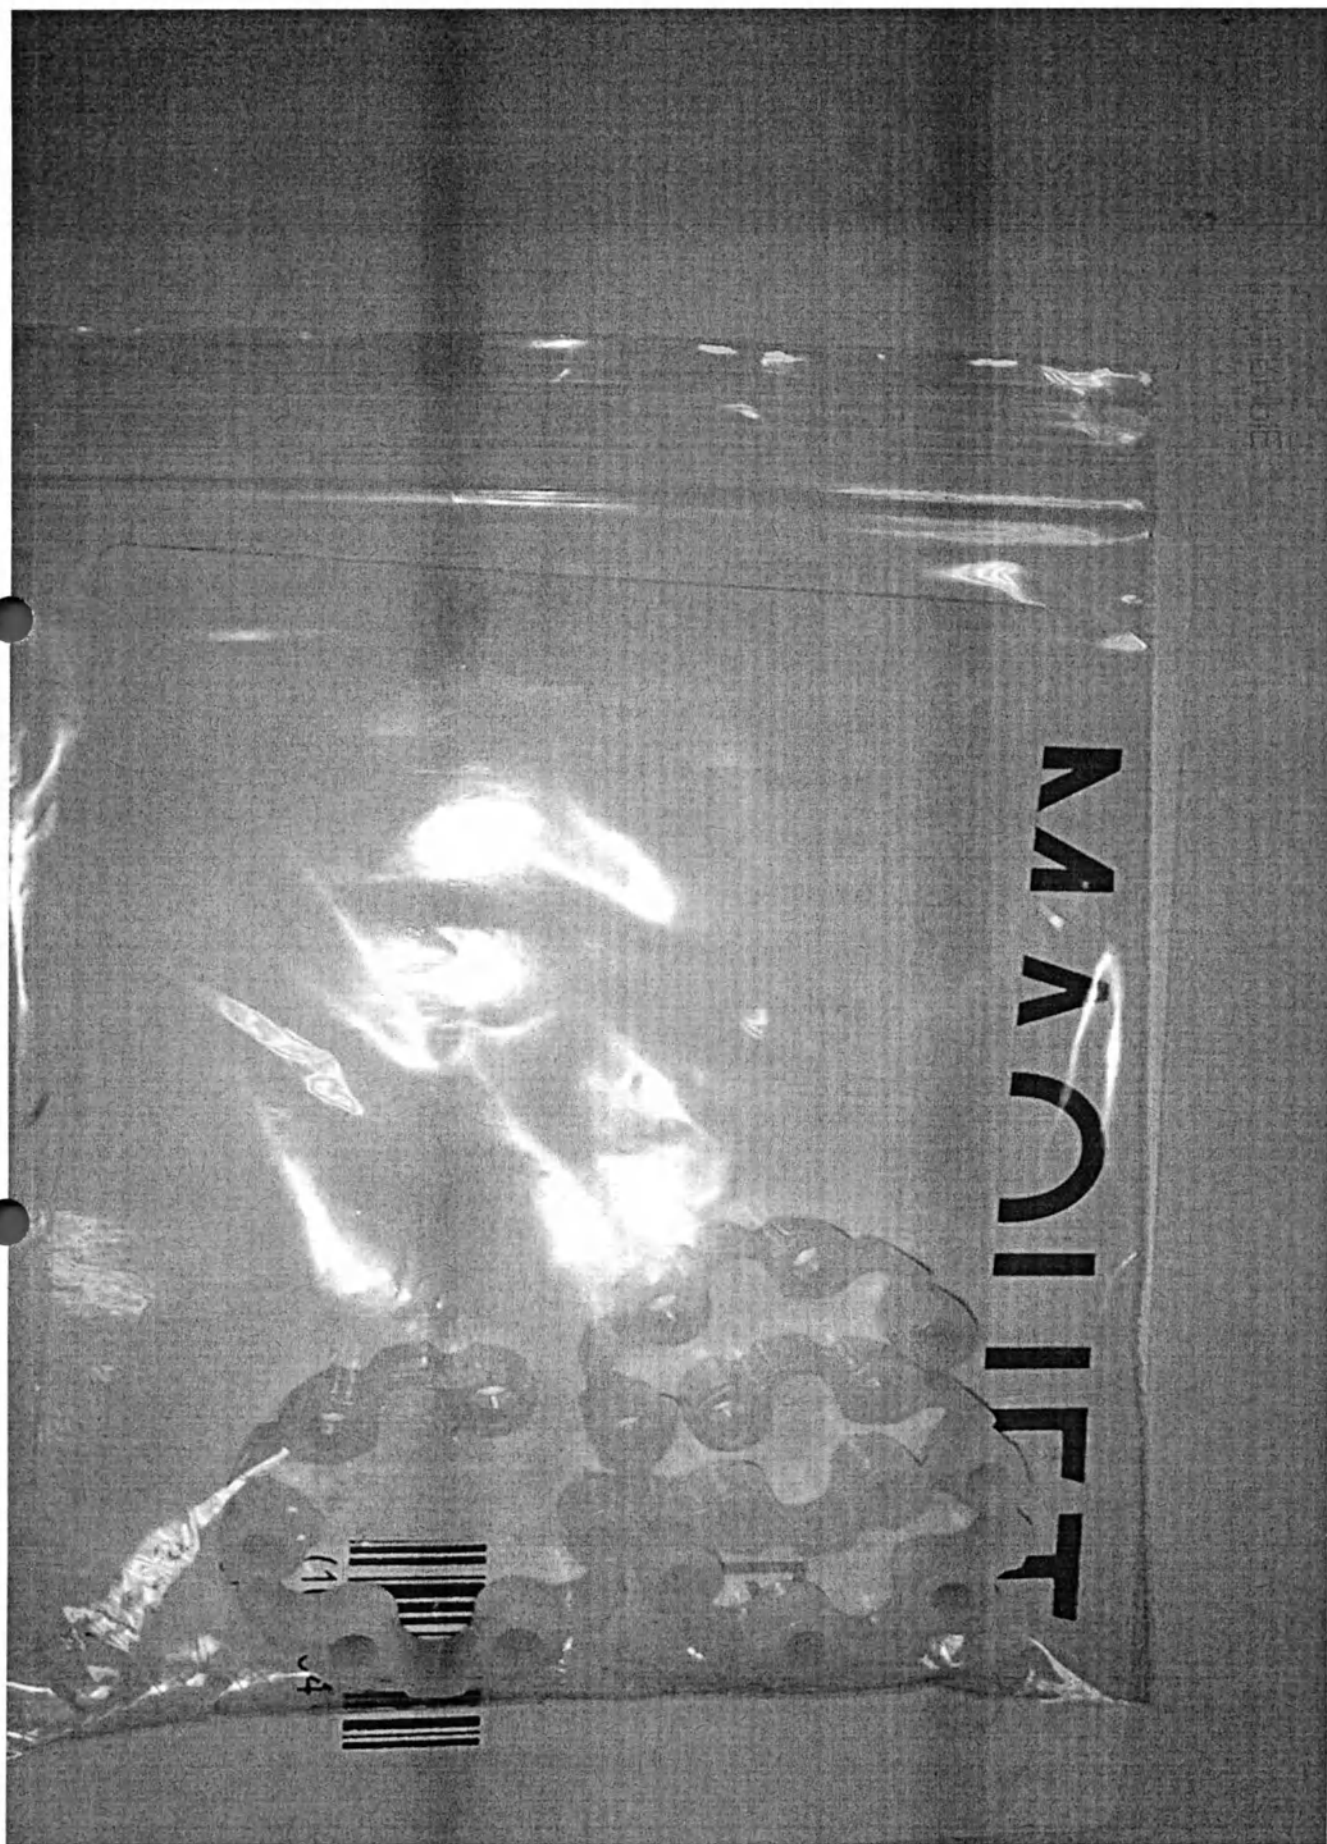




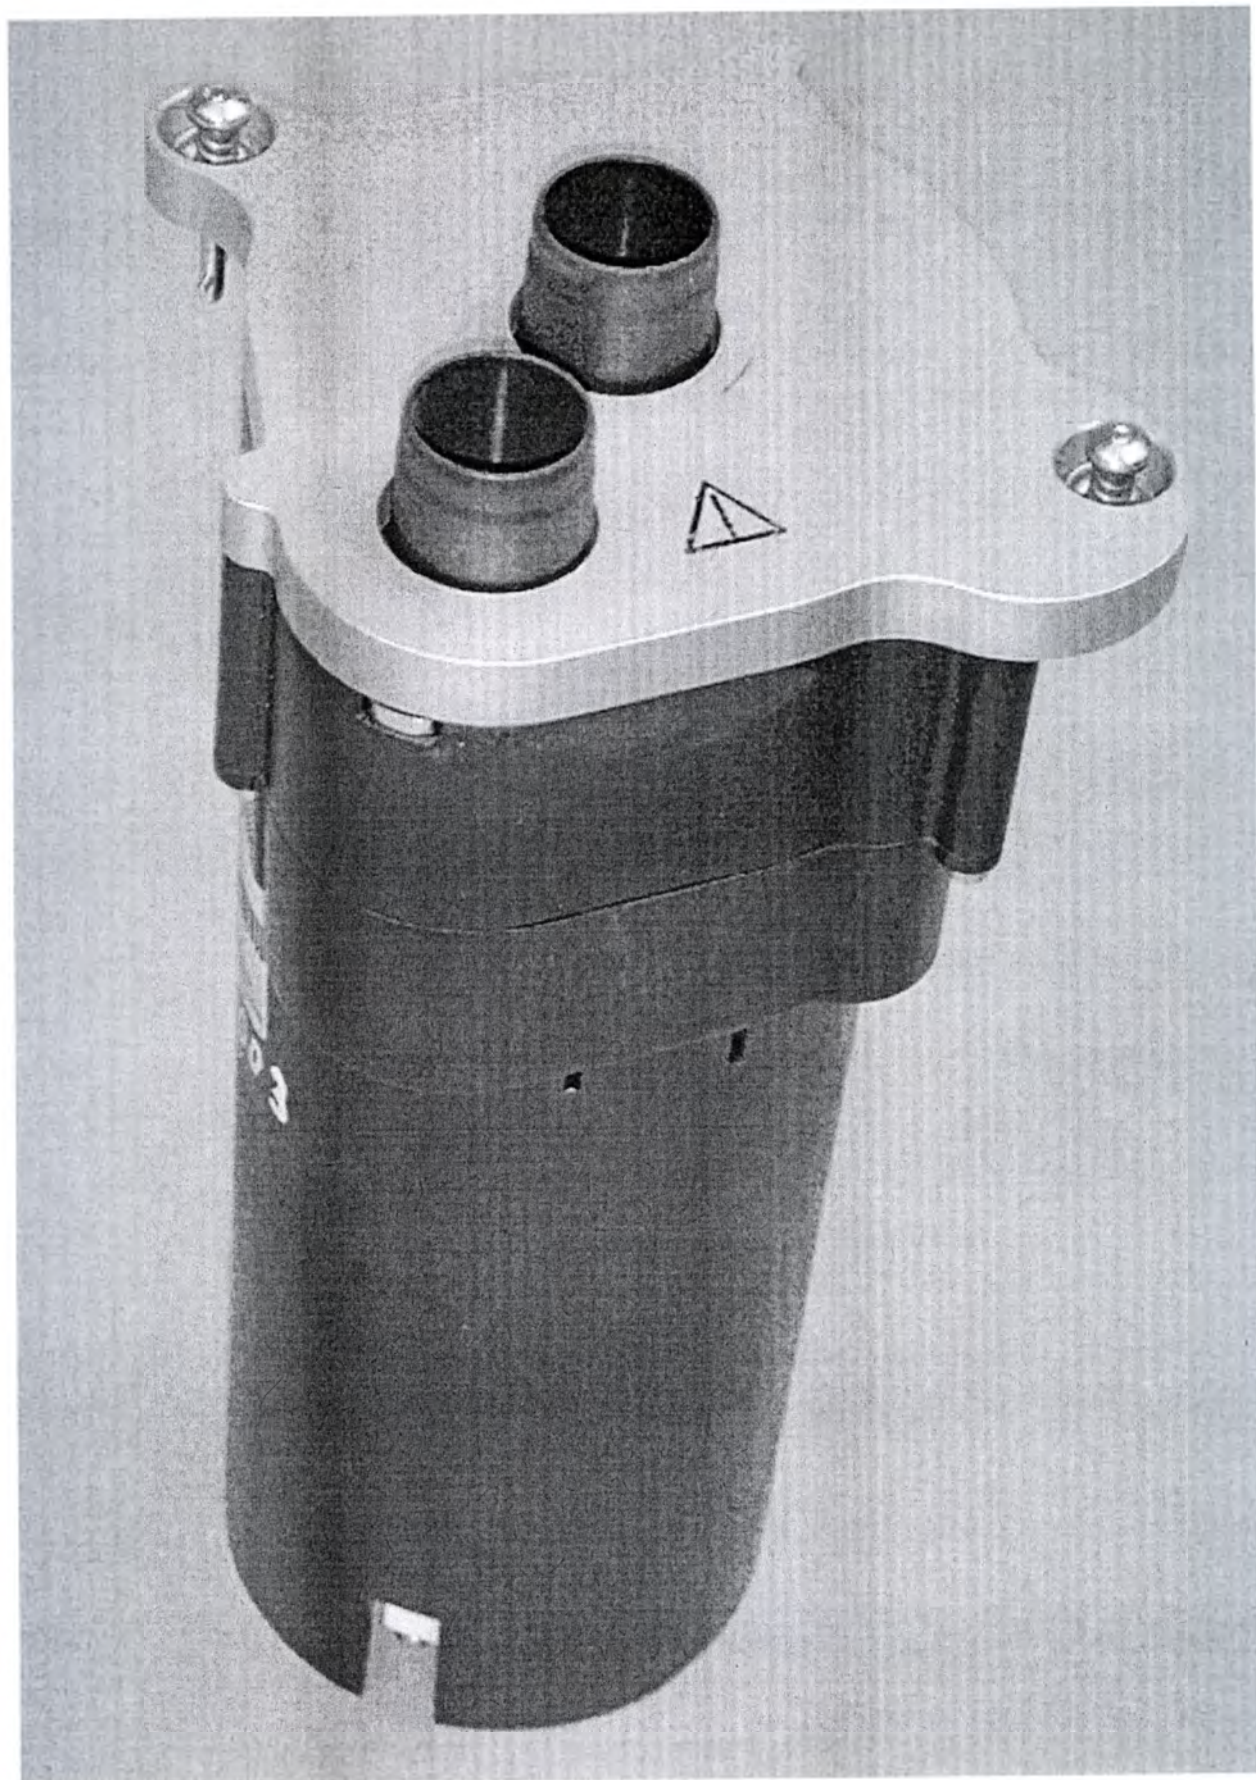




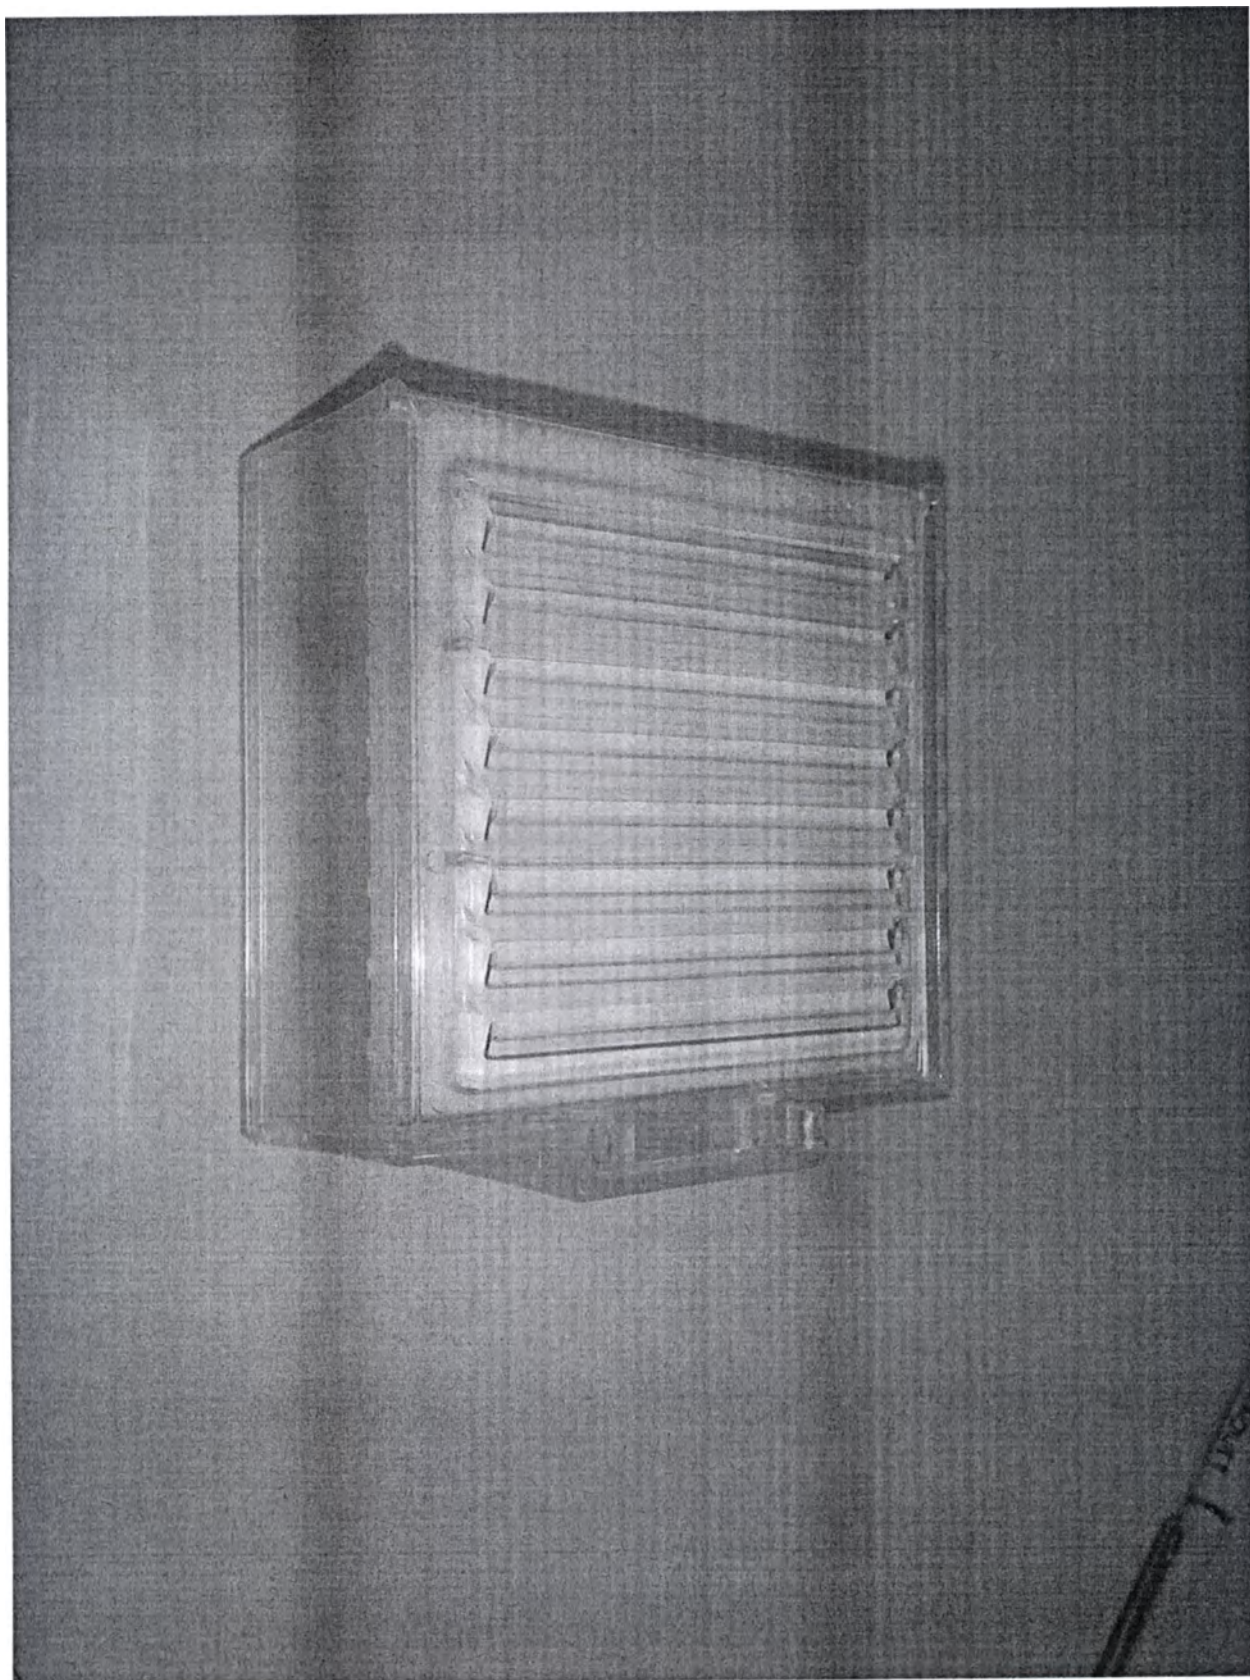



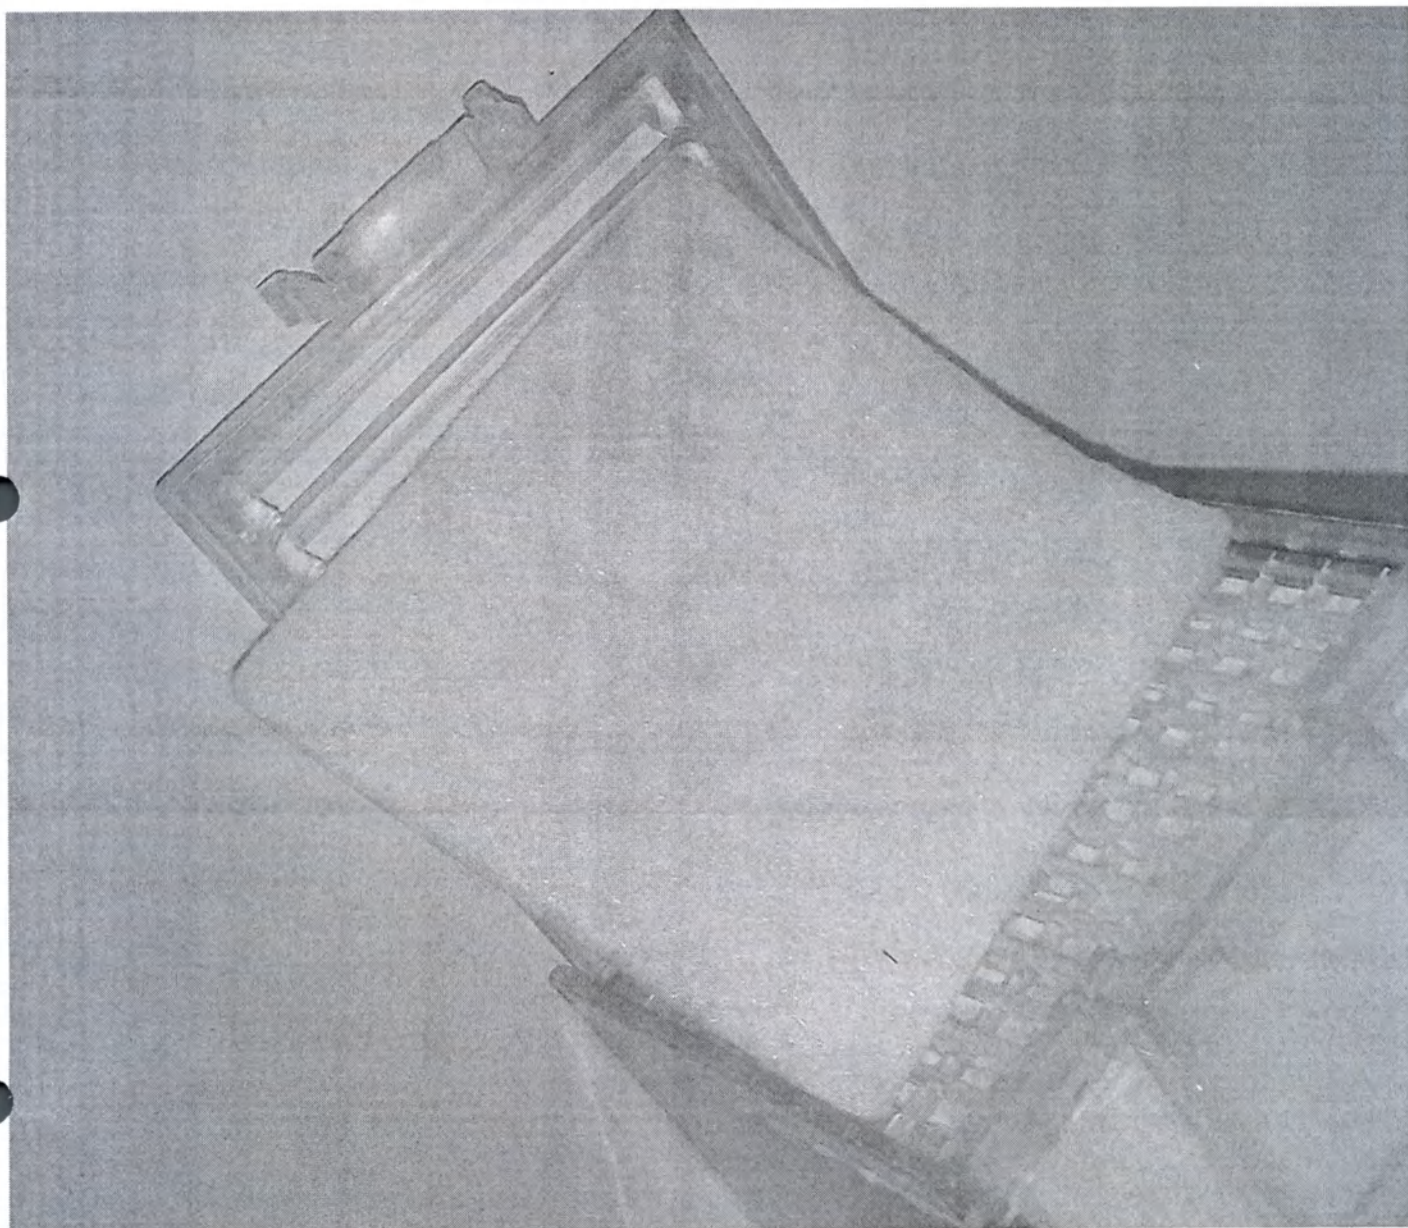




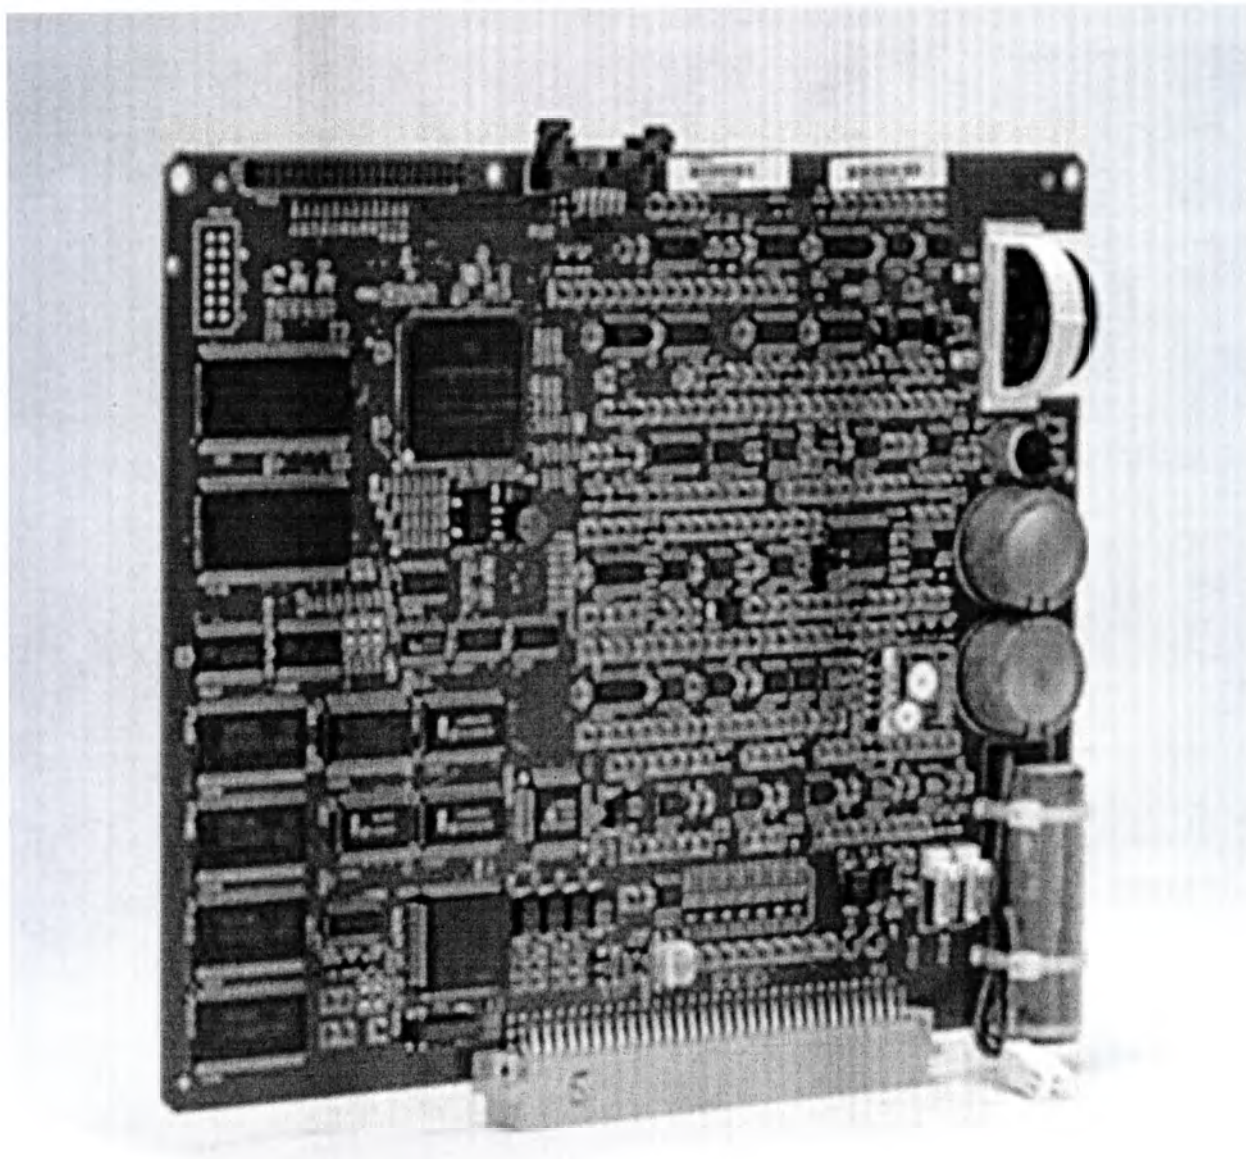



## Модуль передачи данных с креплением

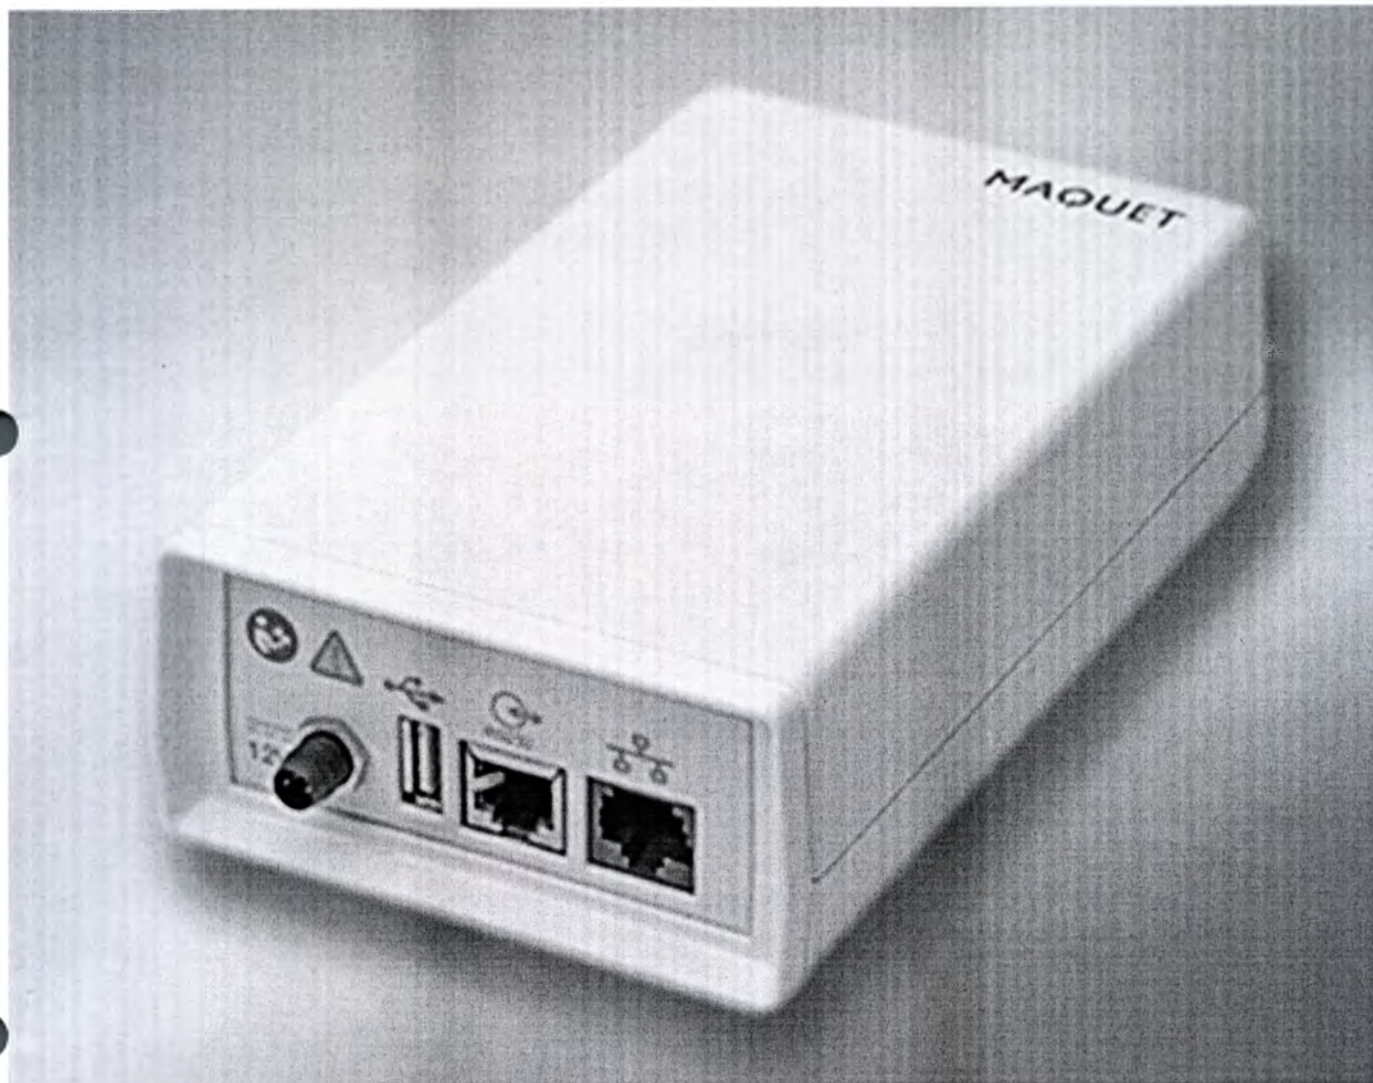







ЛЕГКОЕ ТЕСТОВОЕ ВЗРОСЛОЕ





Прошито и пронумеровано

64 листа

Ген.директор





«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «МАКЕ»



К.Н. Ульянова

2017 г.

**Дополнение  
к  
документу**

**«ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ»**

**Аппарат искусственной вентиляции легких Servo Ventilator в  
исполнении Servo-air с принадлежностями**

**производства компании MAQUET CRITICAL CARE AB**

**(Маке Критикал Кэа АБ)**







Ген. директор  
ООО «Маке»  
Ульянова К.Н.



Прошито и  
скреплено печатью  
2 листа